


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

**Спиральи эмболизационные отделяемые
для эндоваскулярных манипуляций,
варианты исполнения**


Оболочка интродьюсера IDC (вместе с twist lock)




Спираль IDC

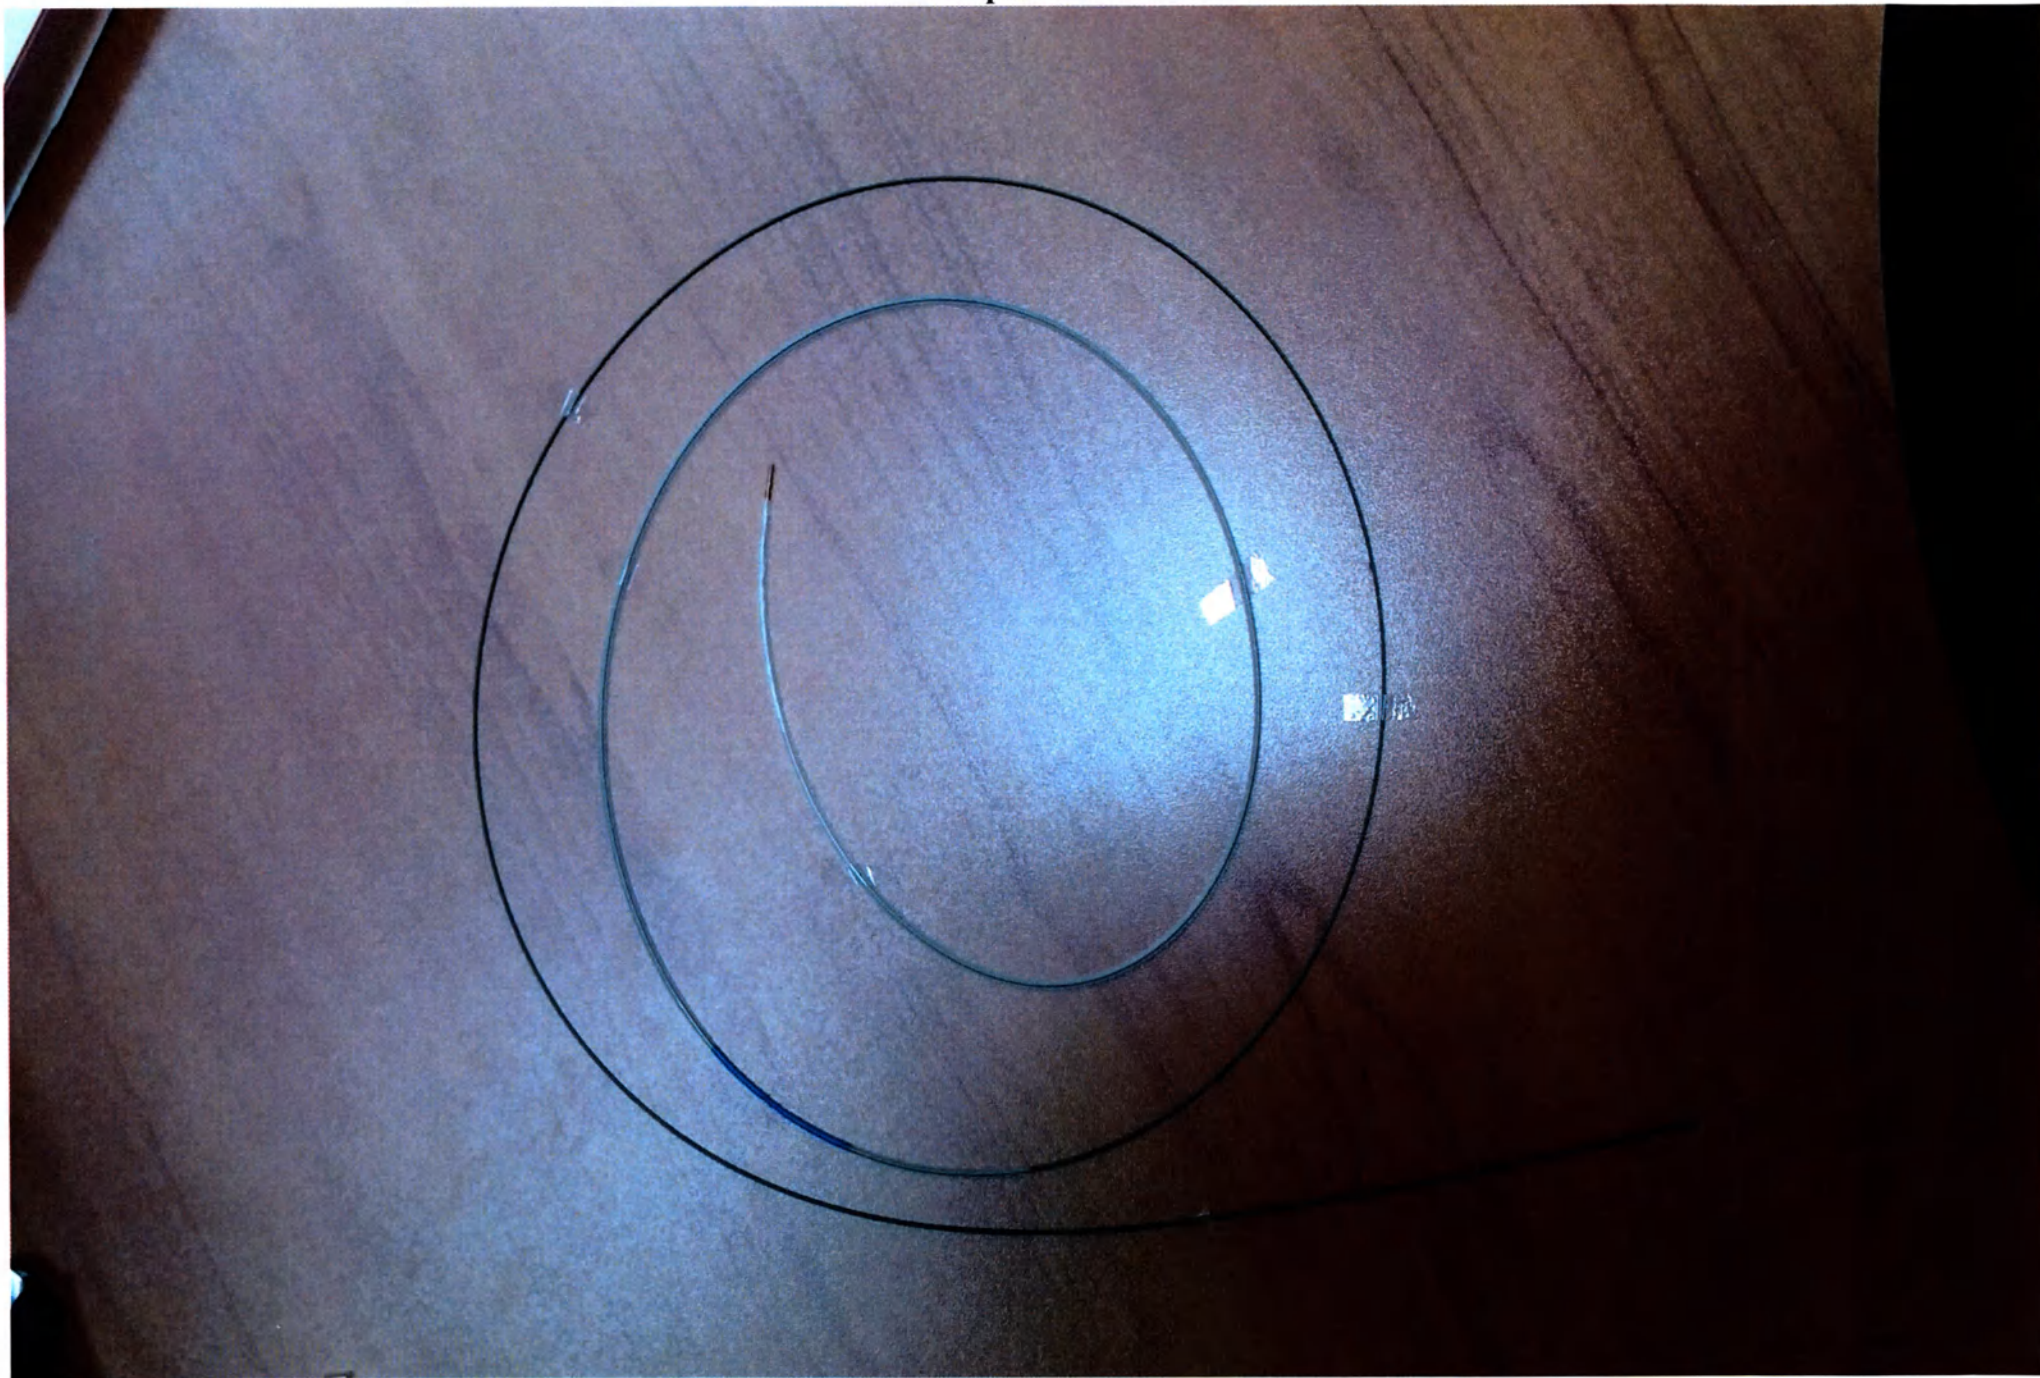

Ротационный гемостатический клапан (только для спиралей Interlock Spiral 2D, Interlock VortX Diamond, Interlock 35 2D, Interlock 35 Cube, Interlock 35 Diamond)

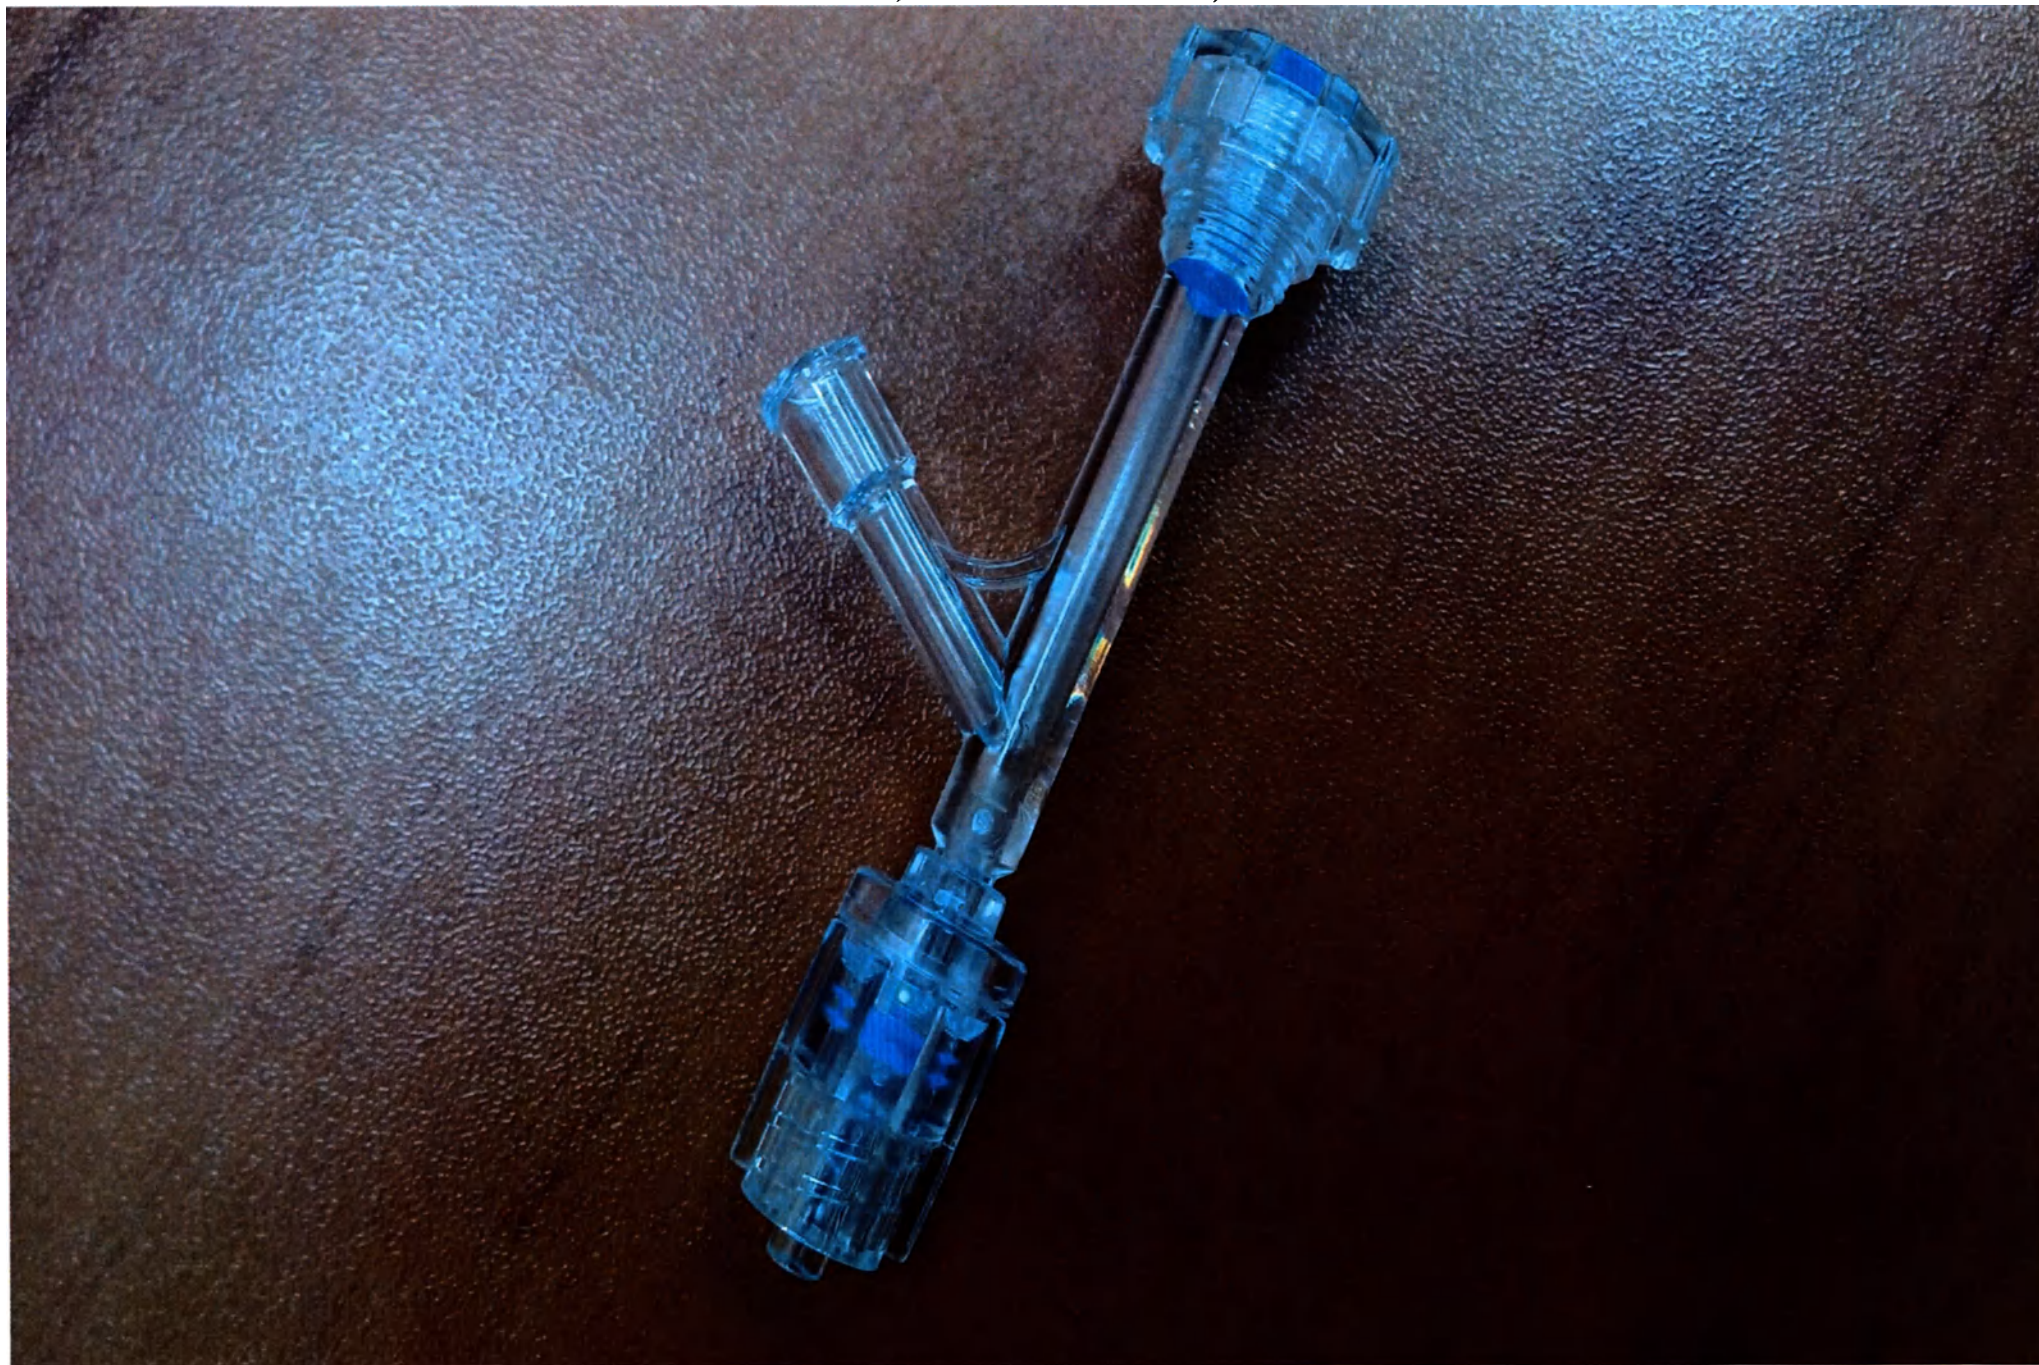

Защитная трубка

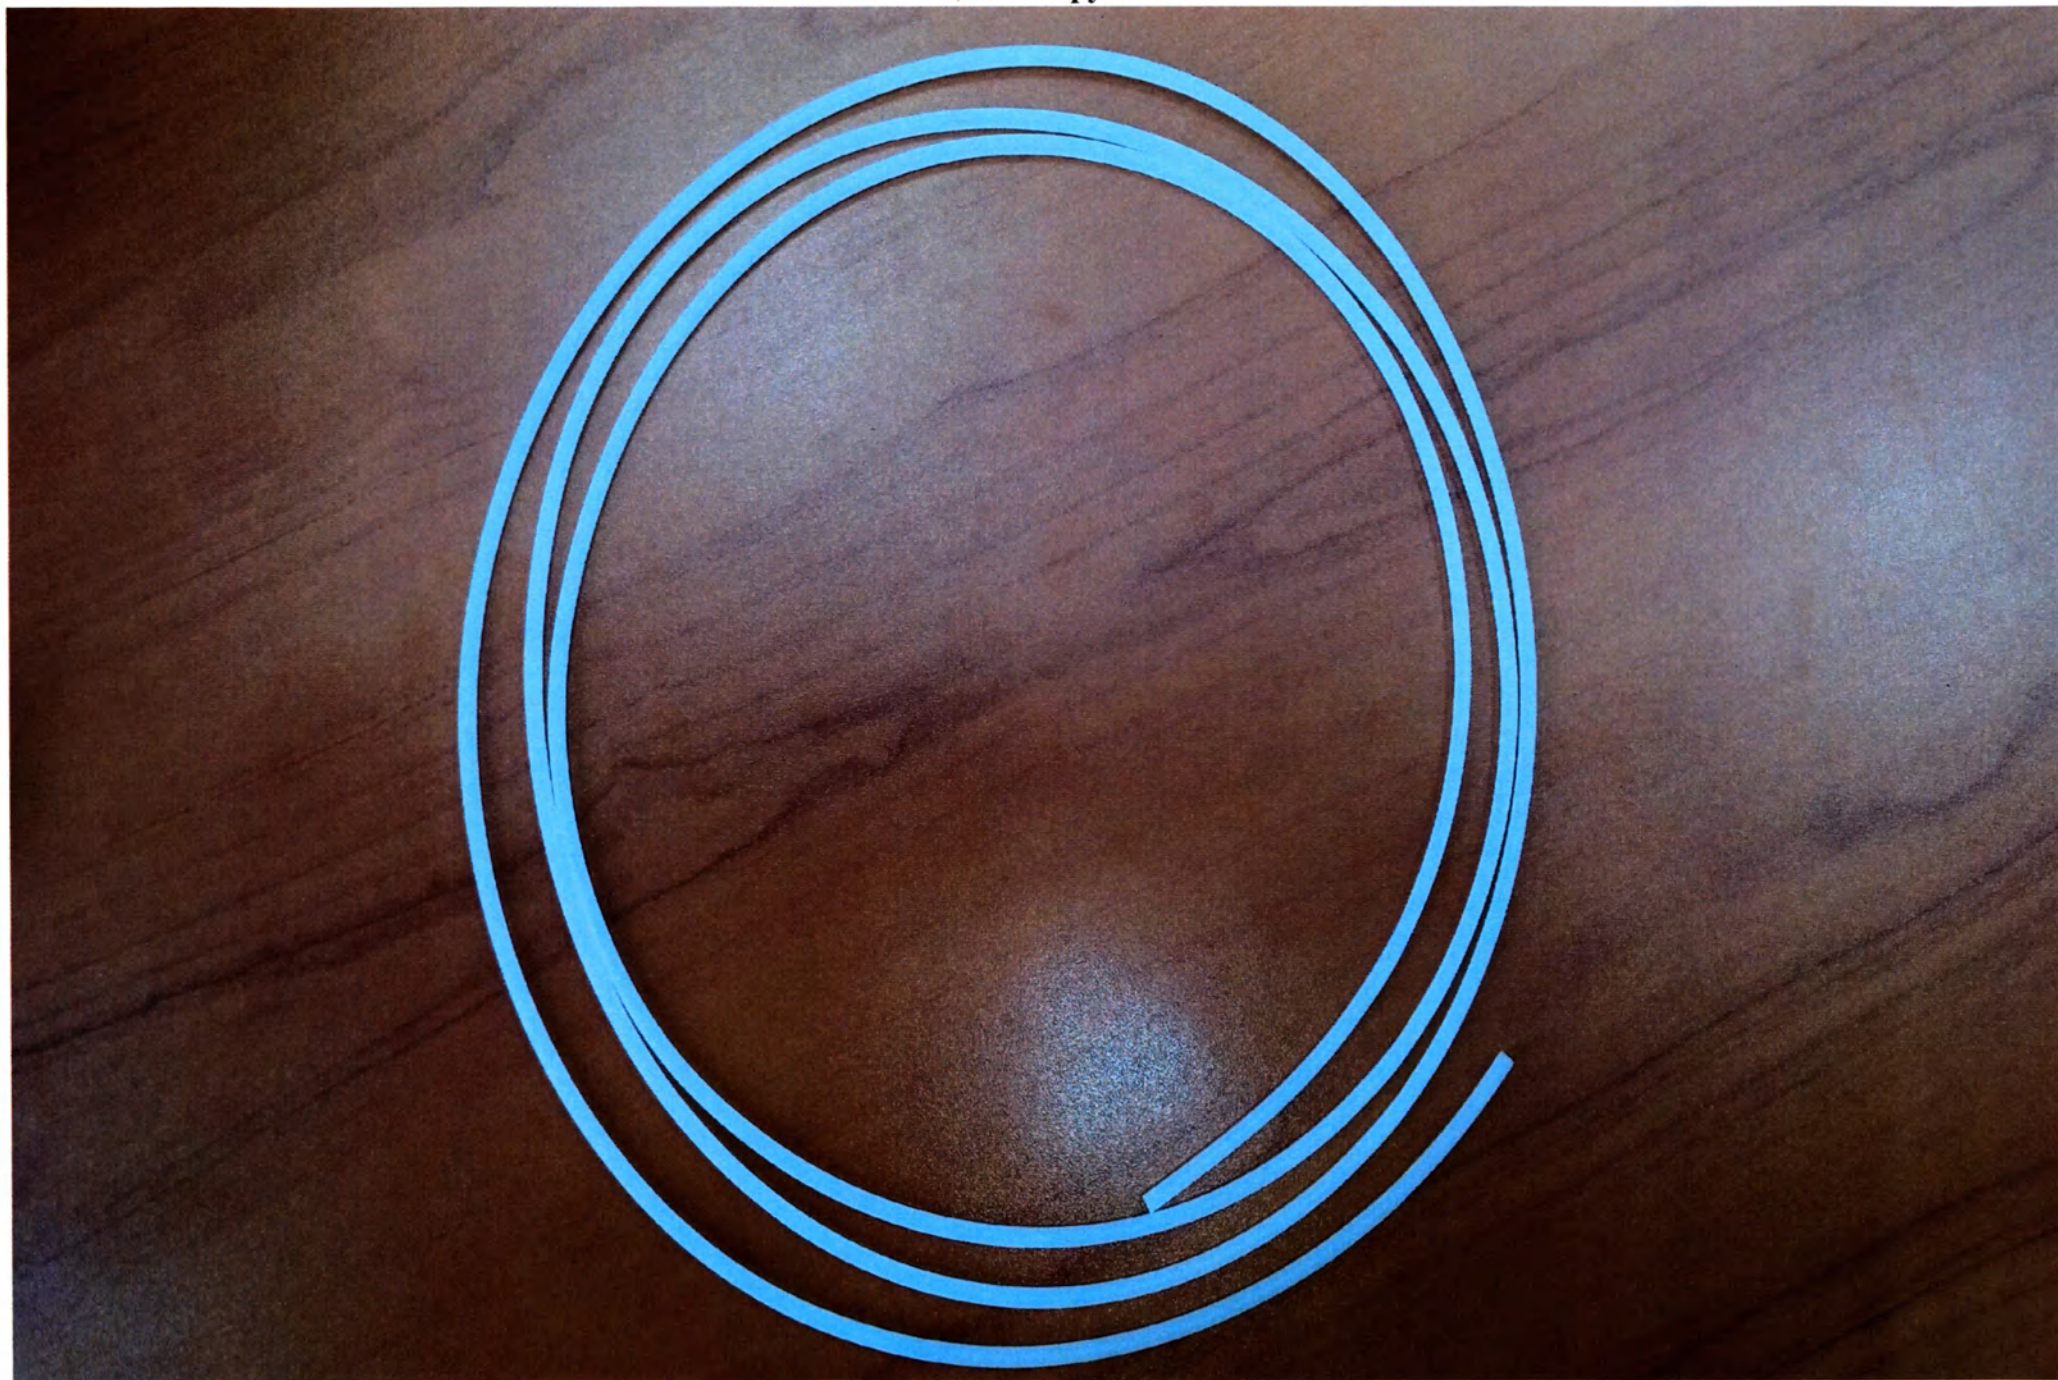


Зажимы для защитной трубки




Проксимальная втулка для удержания проводника



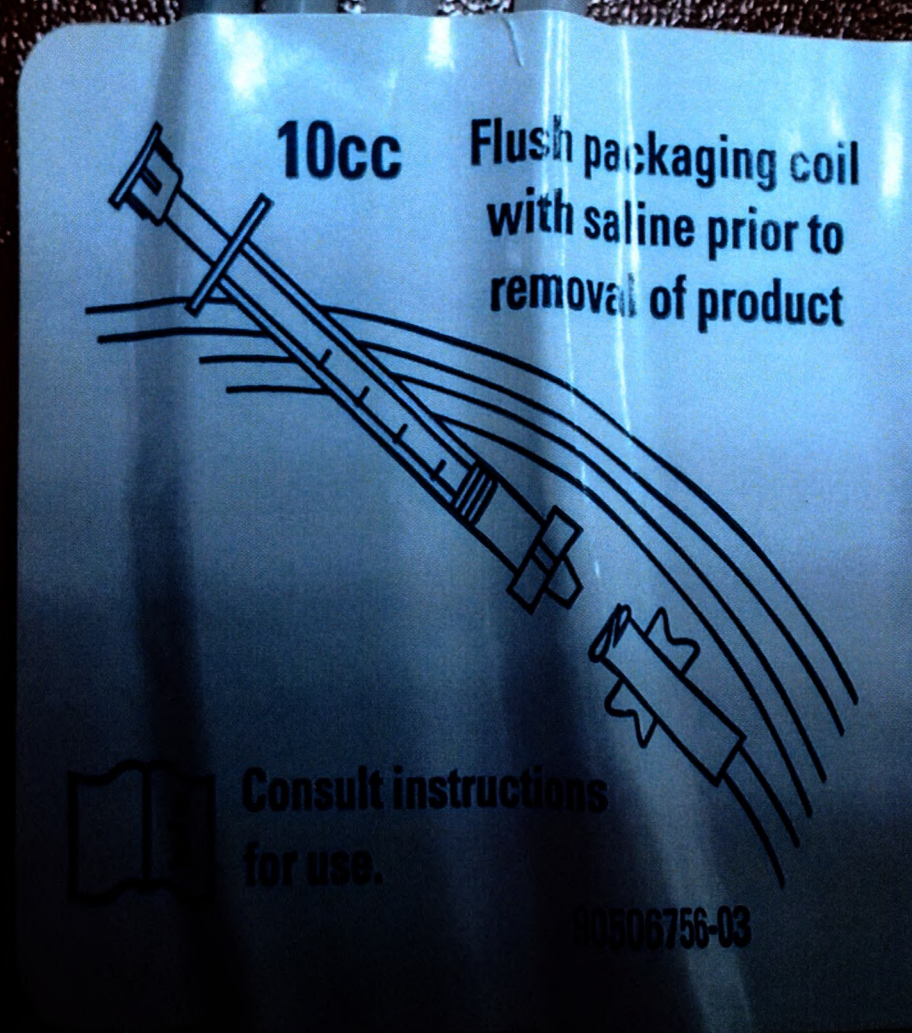


Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 мягкая, длиной 4 см: общий вид

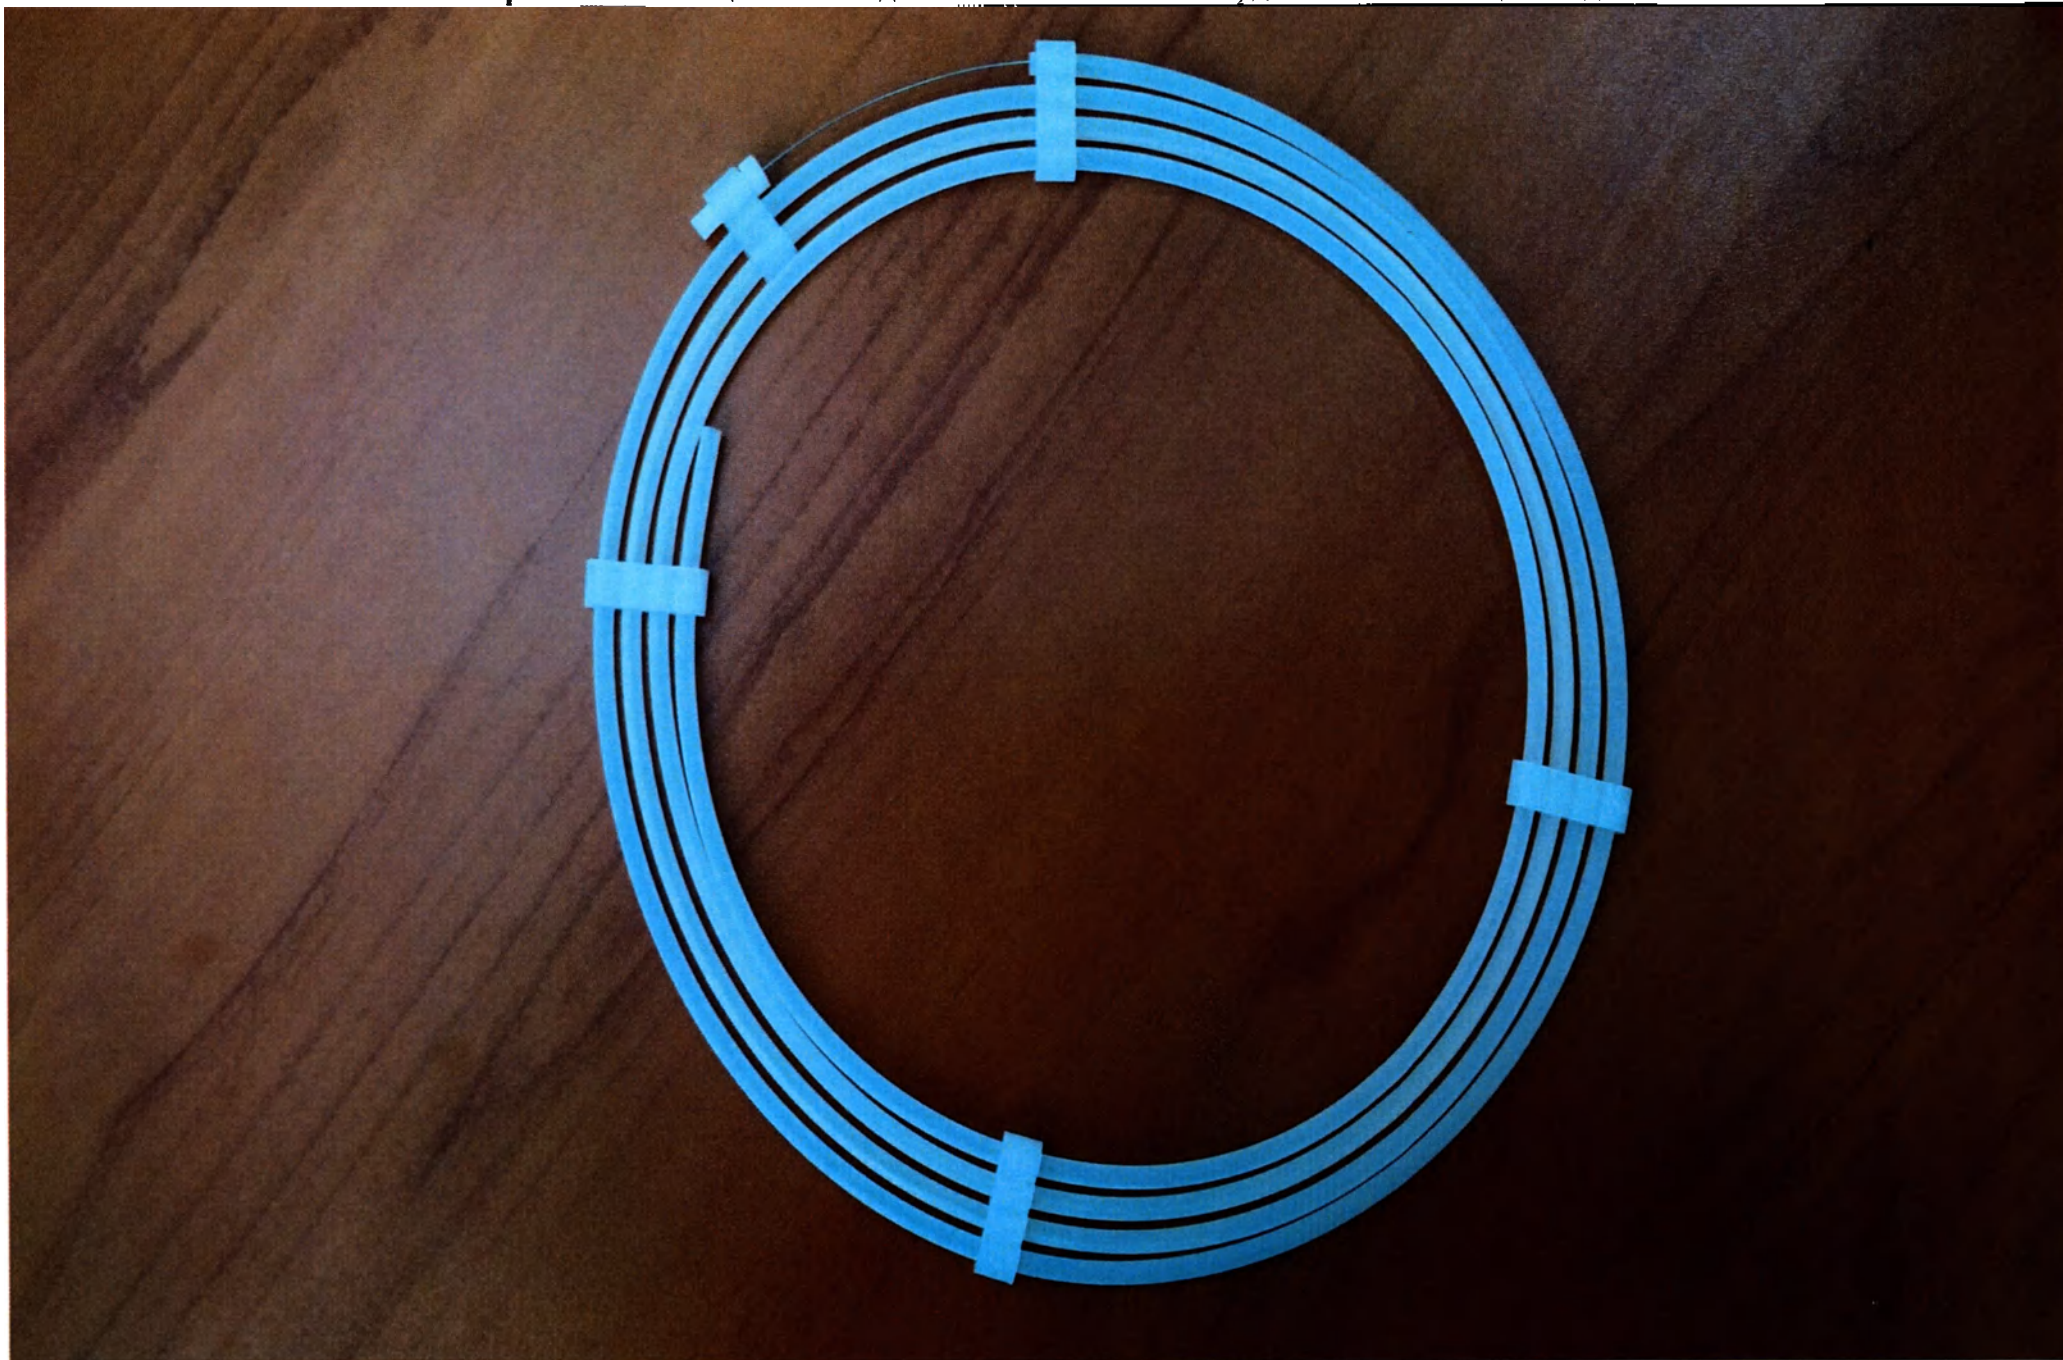


Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 мягкая, длиной 4 см: маркировка 1-ой стороны запечатываемого пакета




Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 мягкая, длиной 4 см: маркировка 2-ой стороны запечатываемого пакета

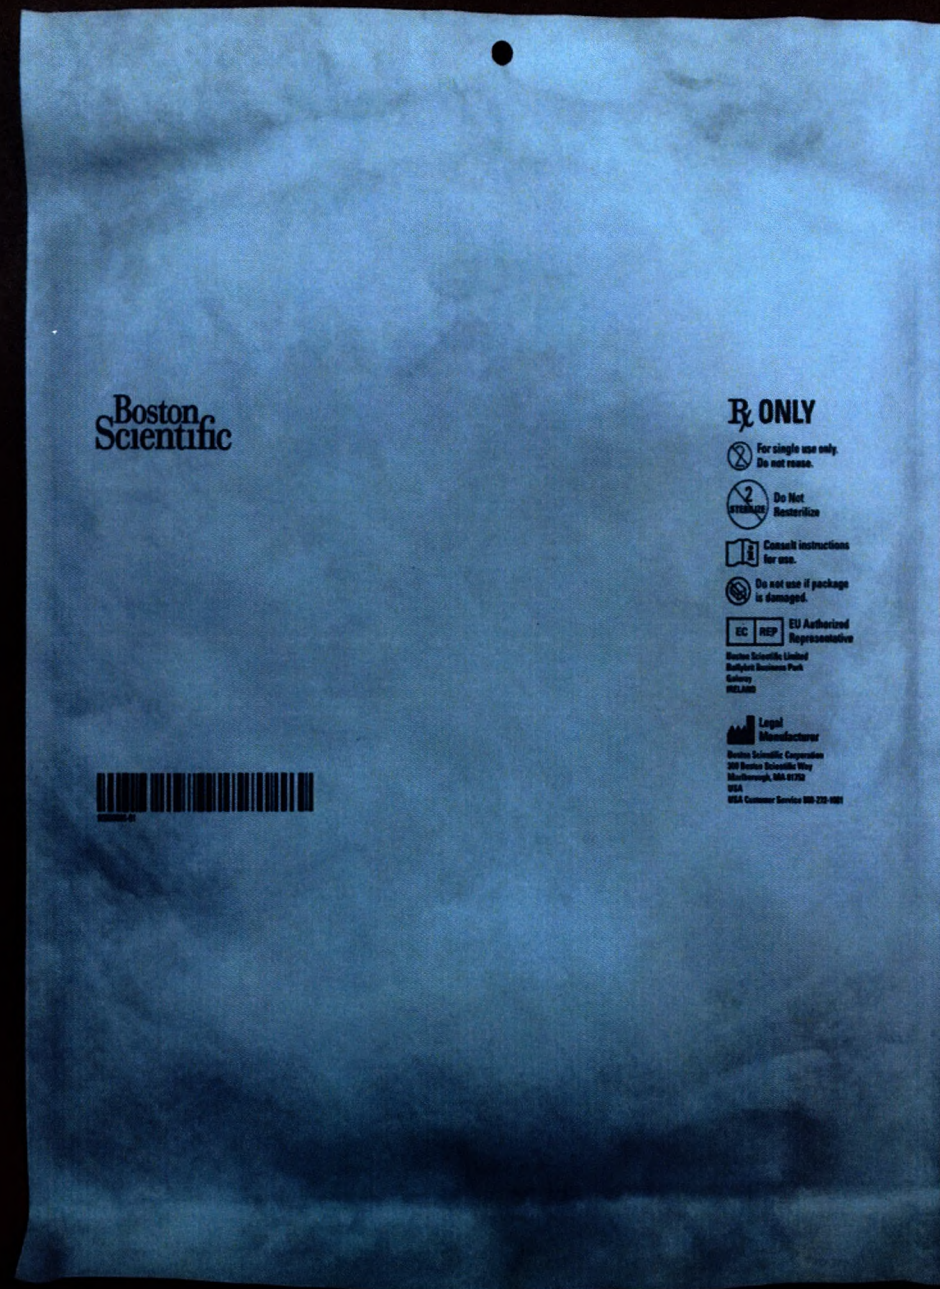


Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 мягкая, длиной 4 см:
маркировка 1-ой стороны упаковки

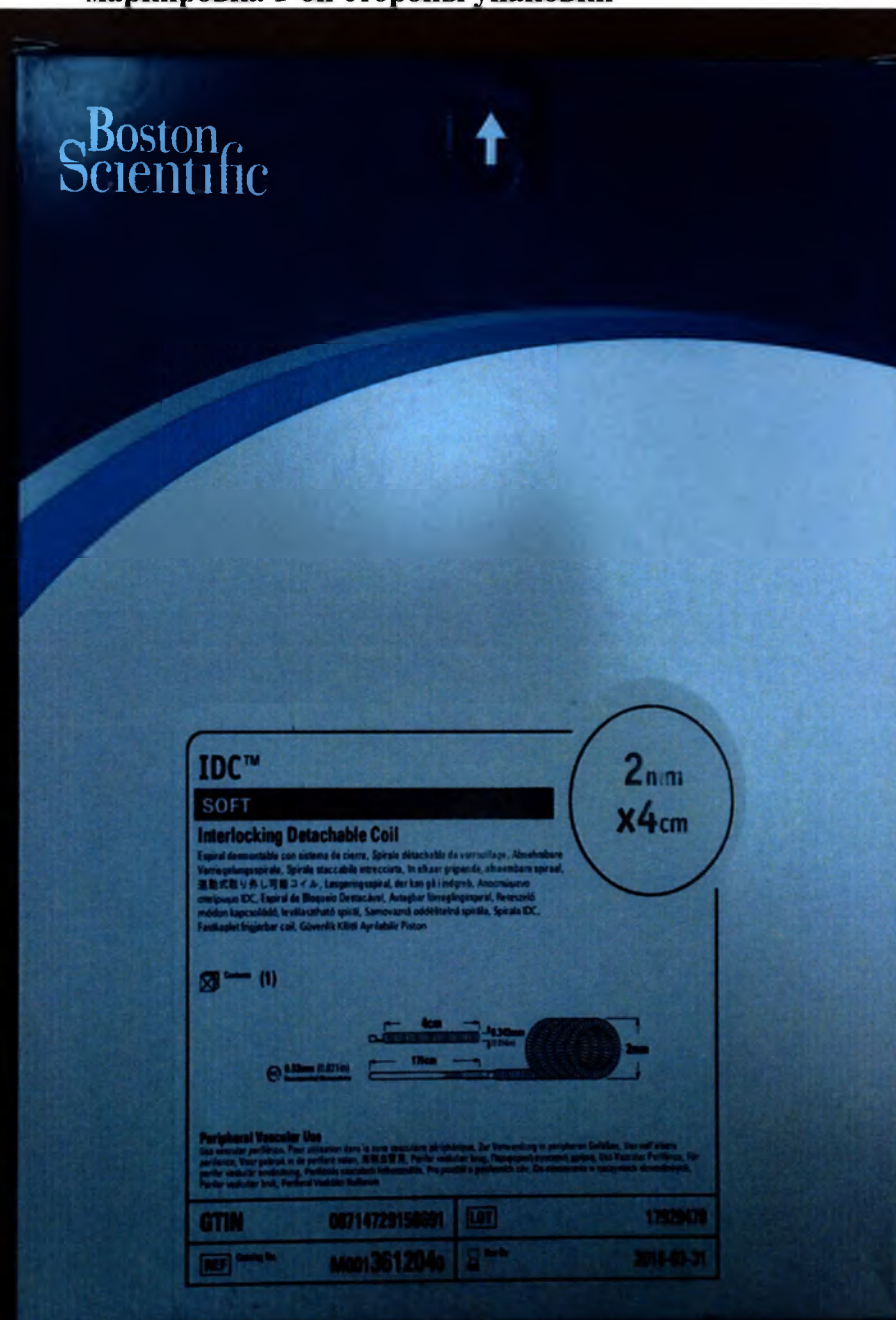


Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 мягкая, длиной 4 см:
маркировка 2-ой стороны упаковки

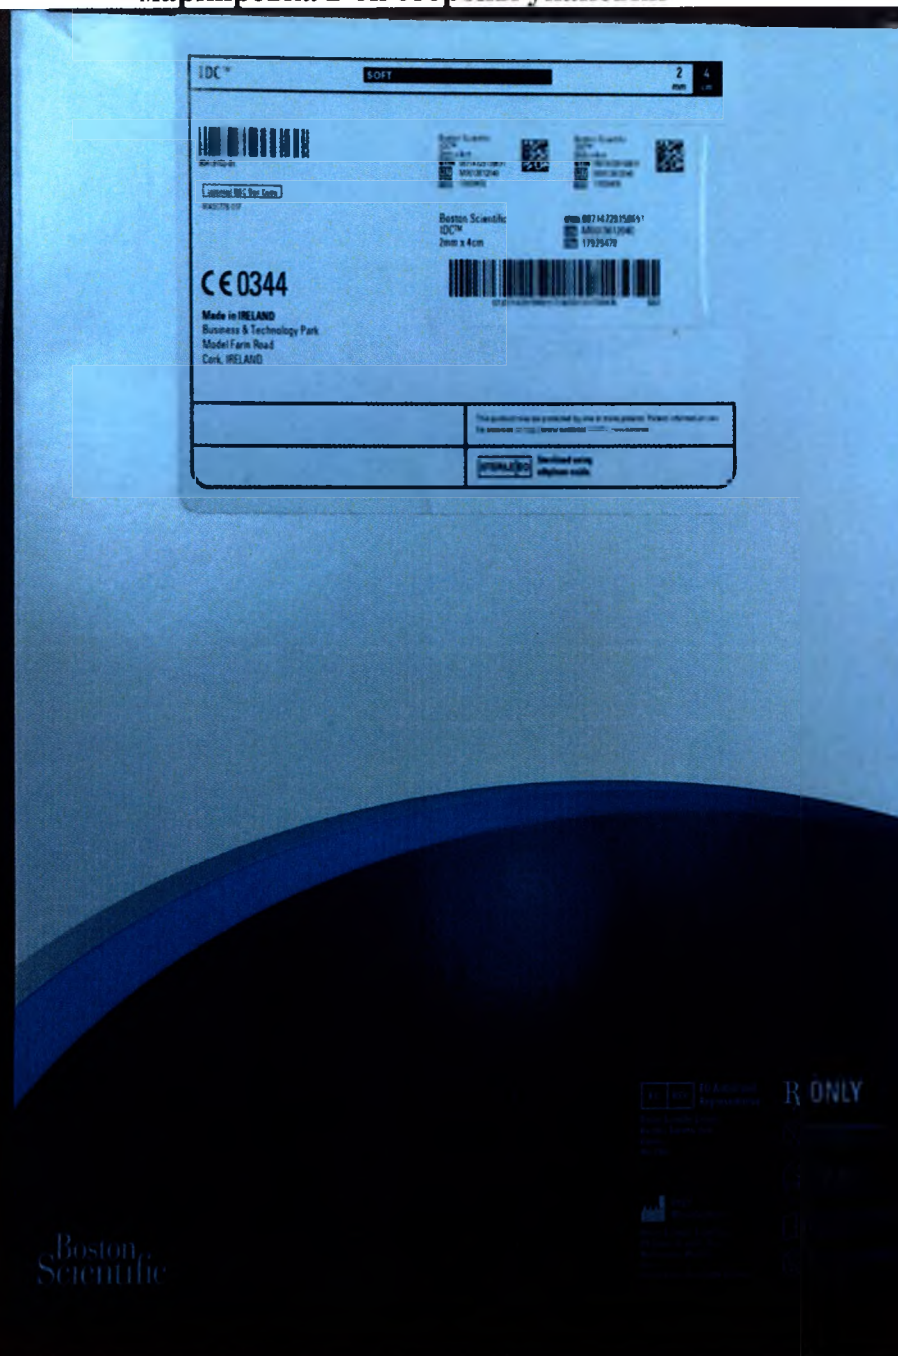


Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 мягкая, длиной 4 см: маркировка боковой стороны упаковки

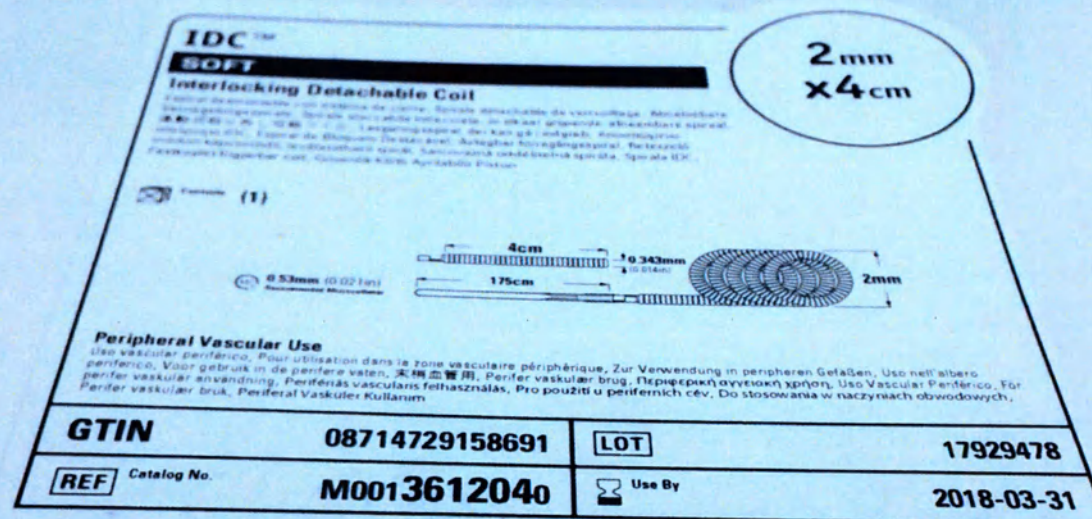

Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 стандартная, длиной 4 см: общий вид

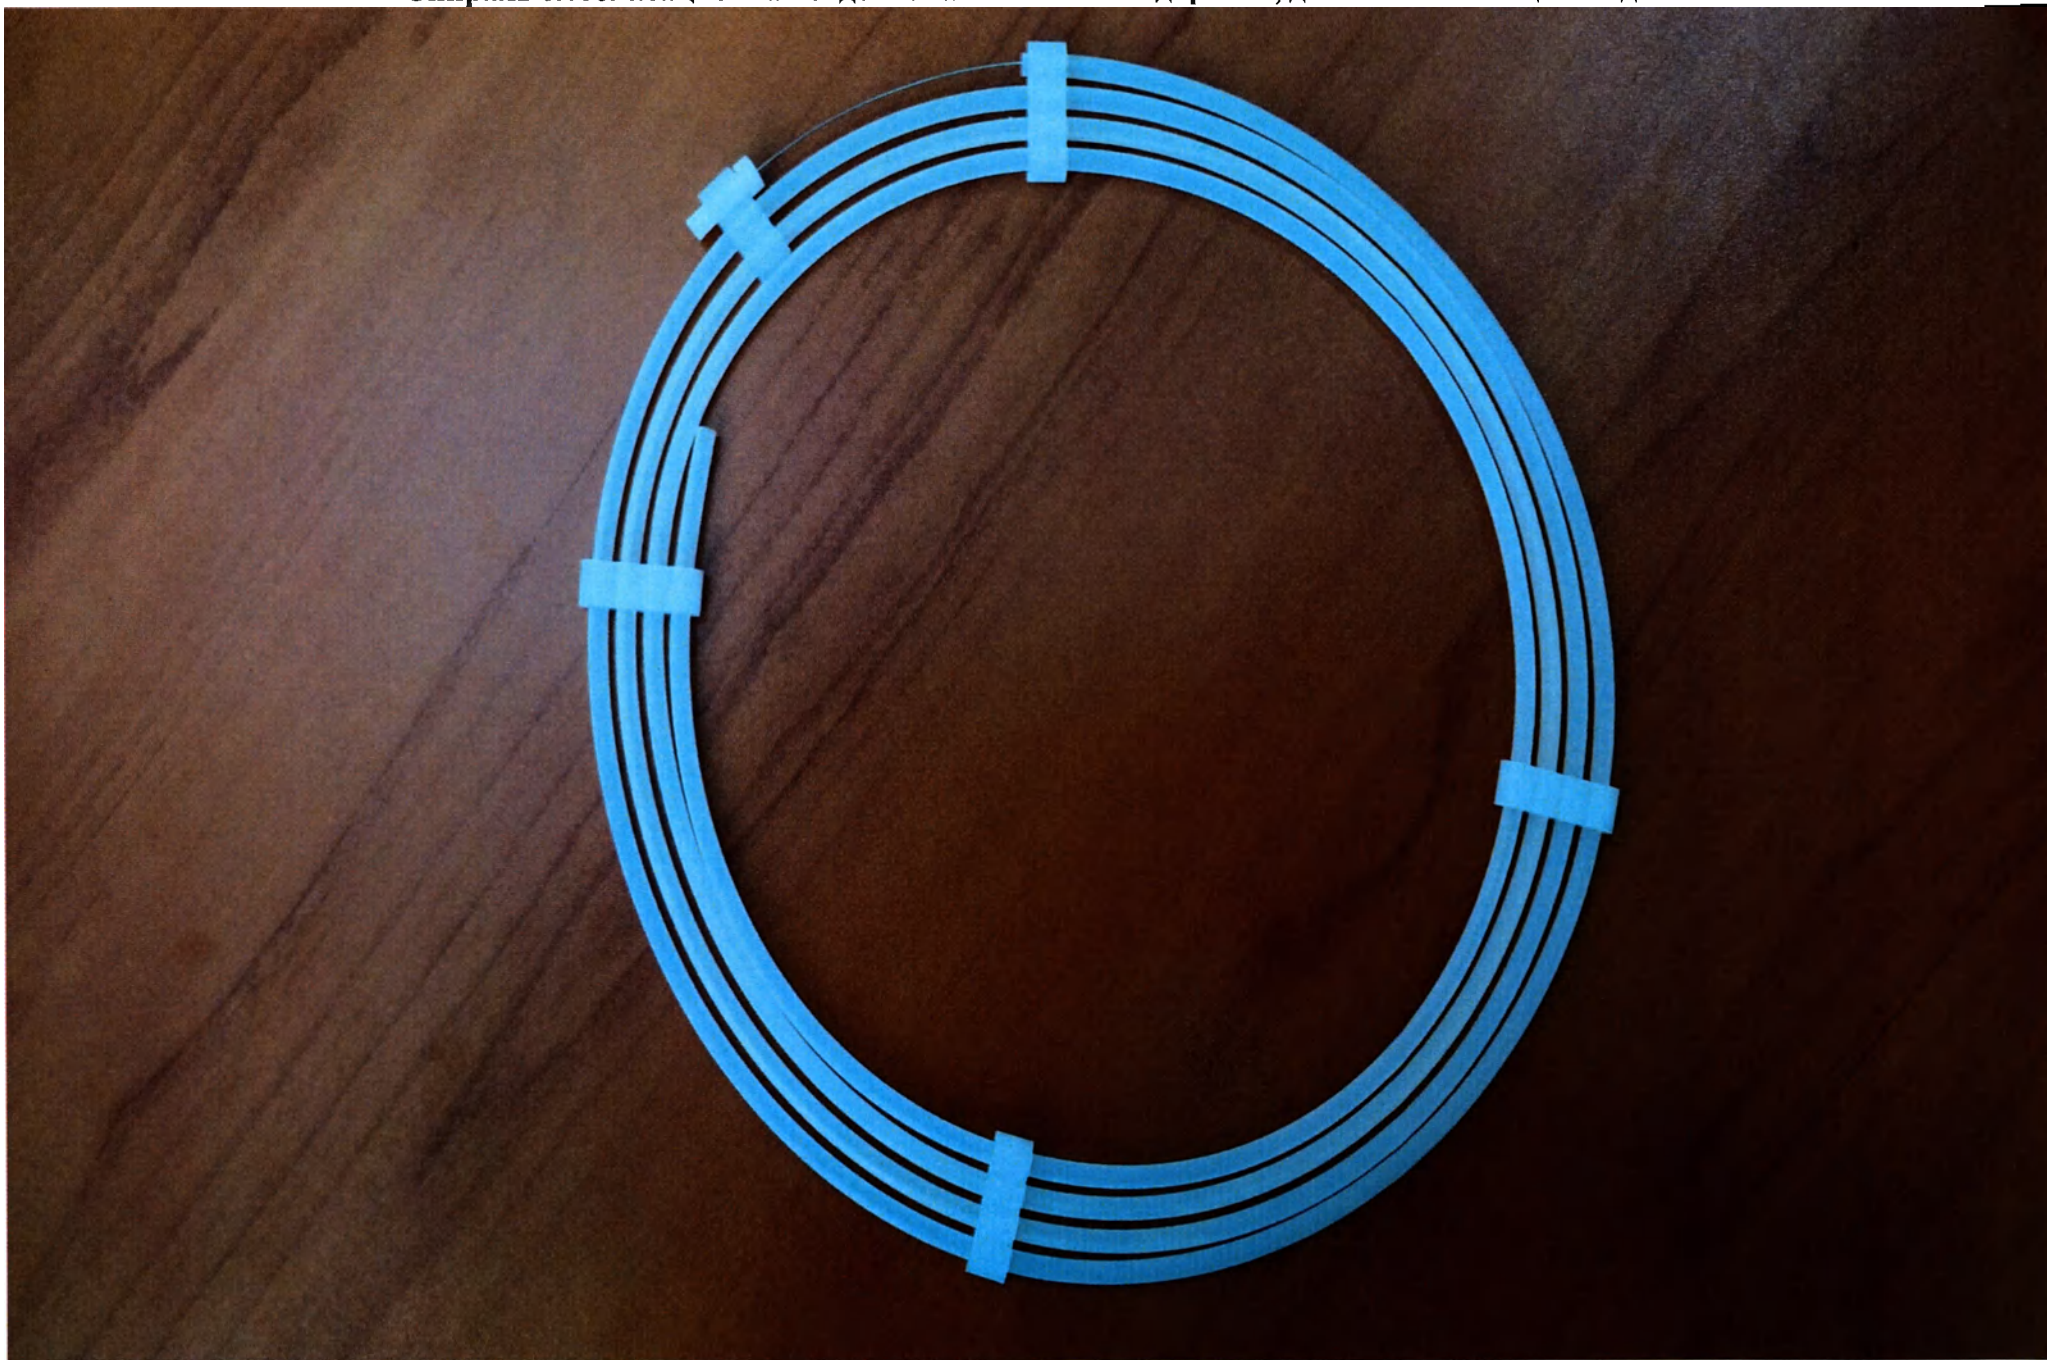

Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 стандартная, длиной 4 см: маркировка 1-ой стороны запечатываемого пакета

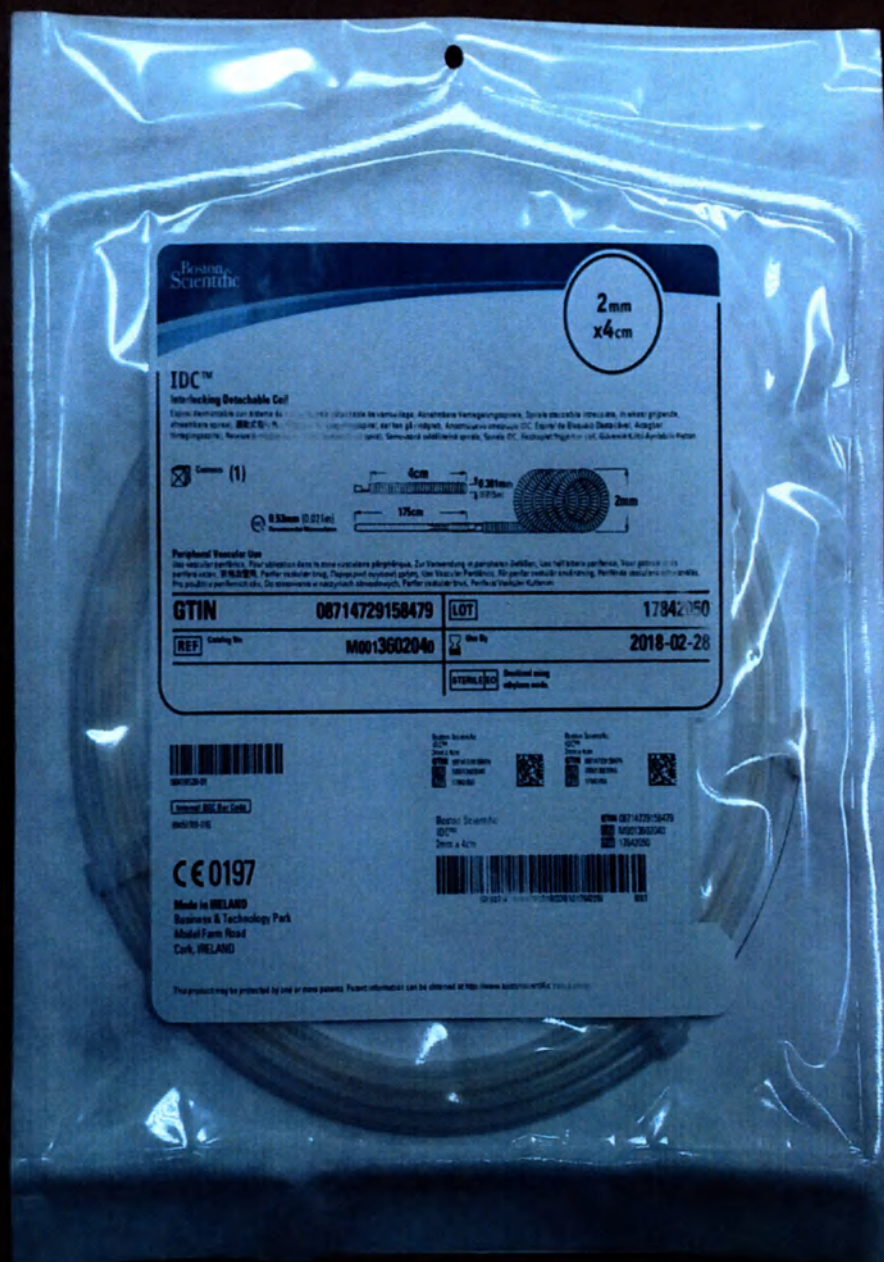

Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 стандартная, длиной 4 см: маркировка 2-ой стороны запечатываемого пакета

Boston
Scientific



Rx ONLY

For single use only.
Do not reuse.

2
Do Not
Reinsert

Consult instructions
for use.

Do not use if package
is damaged.


EC REP EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballycliff Business Park
Galway
IRELAND


Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
390 Boston Scientific Way
Waltham, MA 02451
USA
USA Customer Service 800 333 4471

Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 стандартная, длиной 4 см:
маркировка 1-ой стороны упаковки

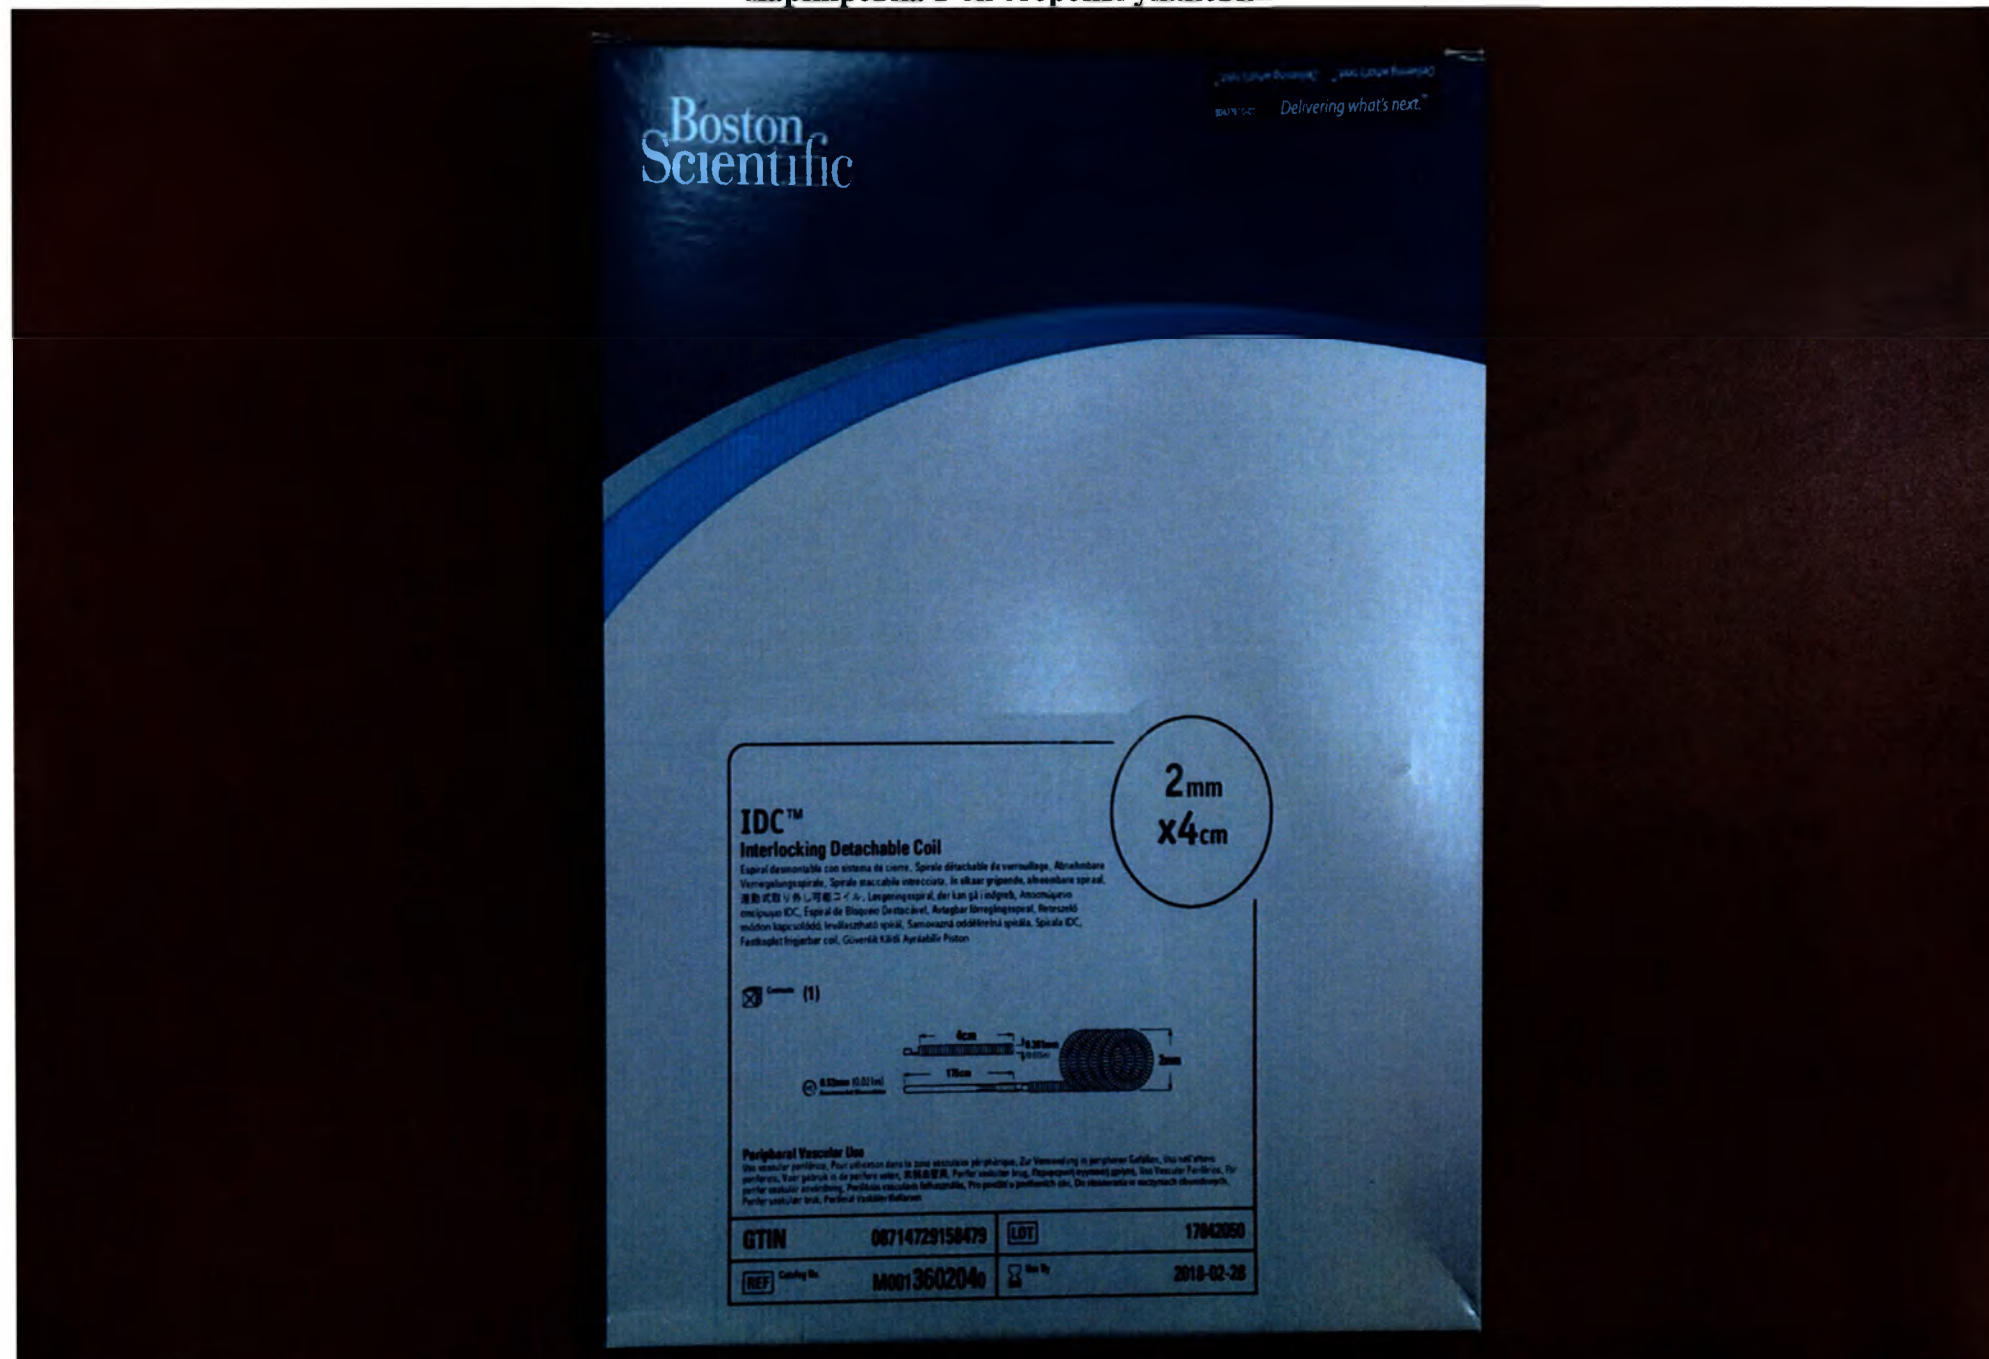


Спираль эмболизационная отделяемая IDC 18 стандартная, длиной 4 см:
маркировка 2-ой стороны упаковки

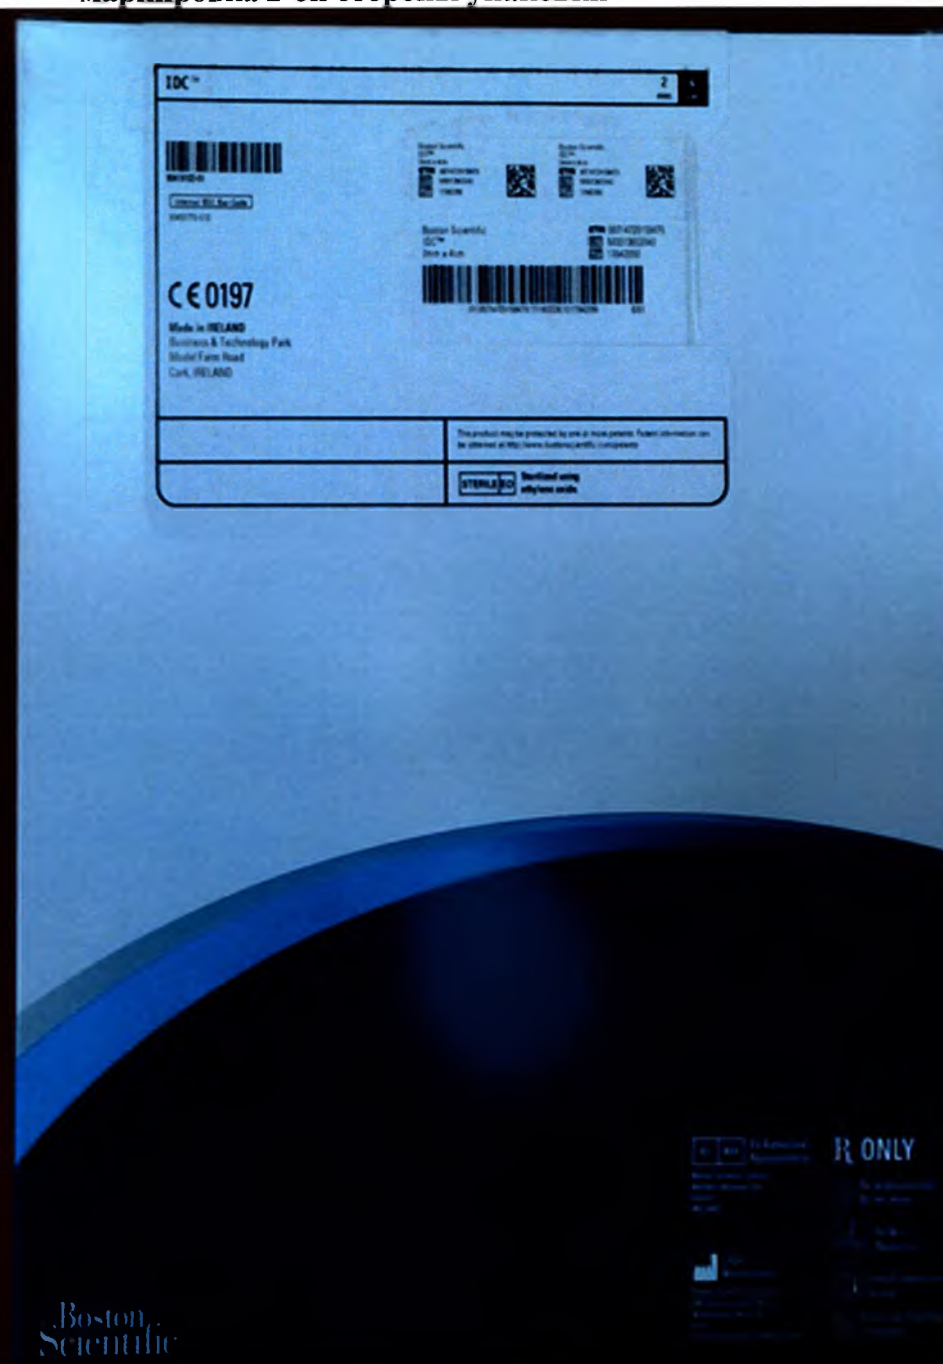


[illegible]


Спираль эмболизационная отделяемая Interlock Spiral 2D, длиной 60 см: общий вид

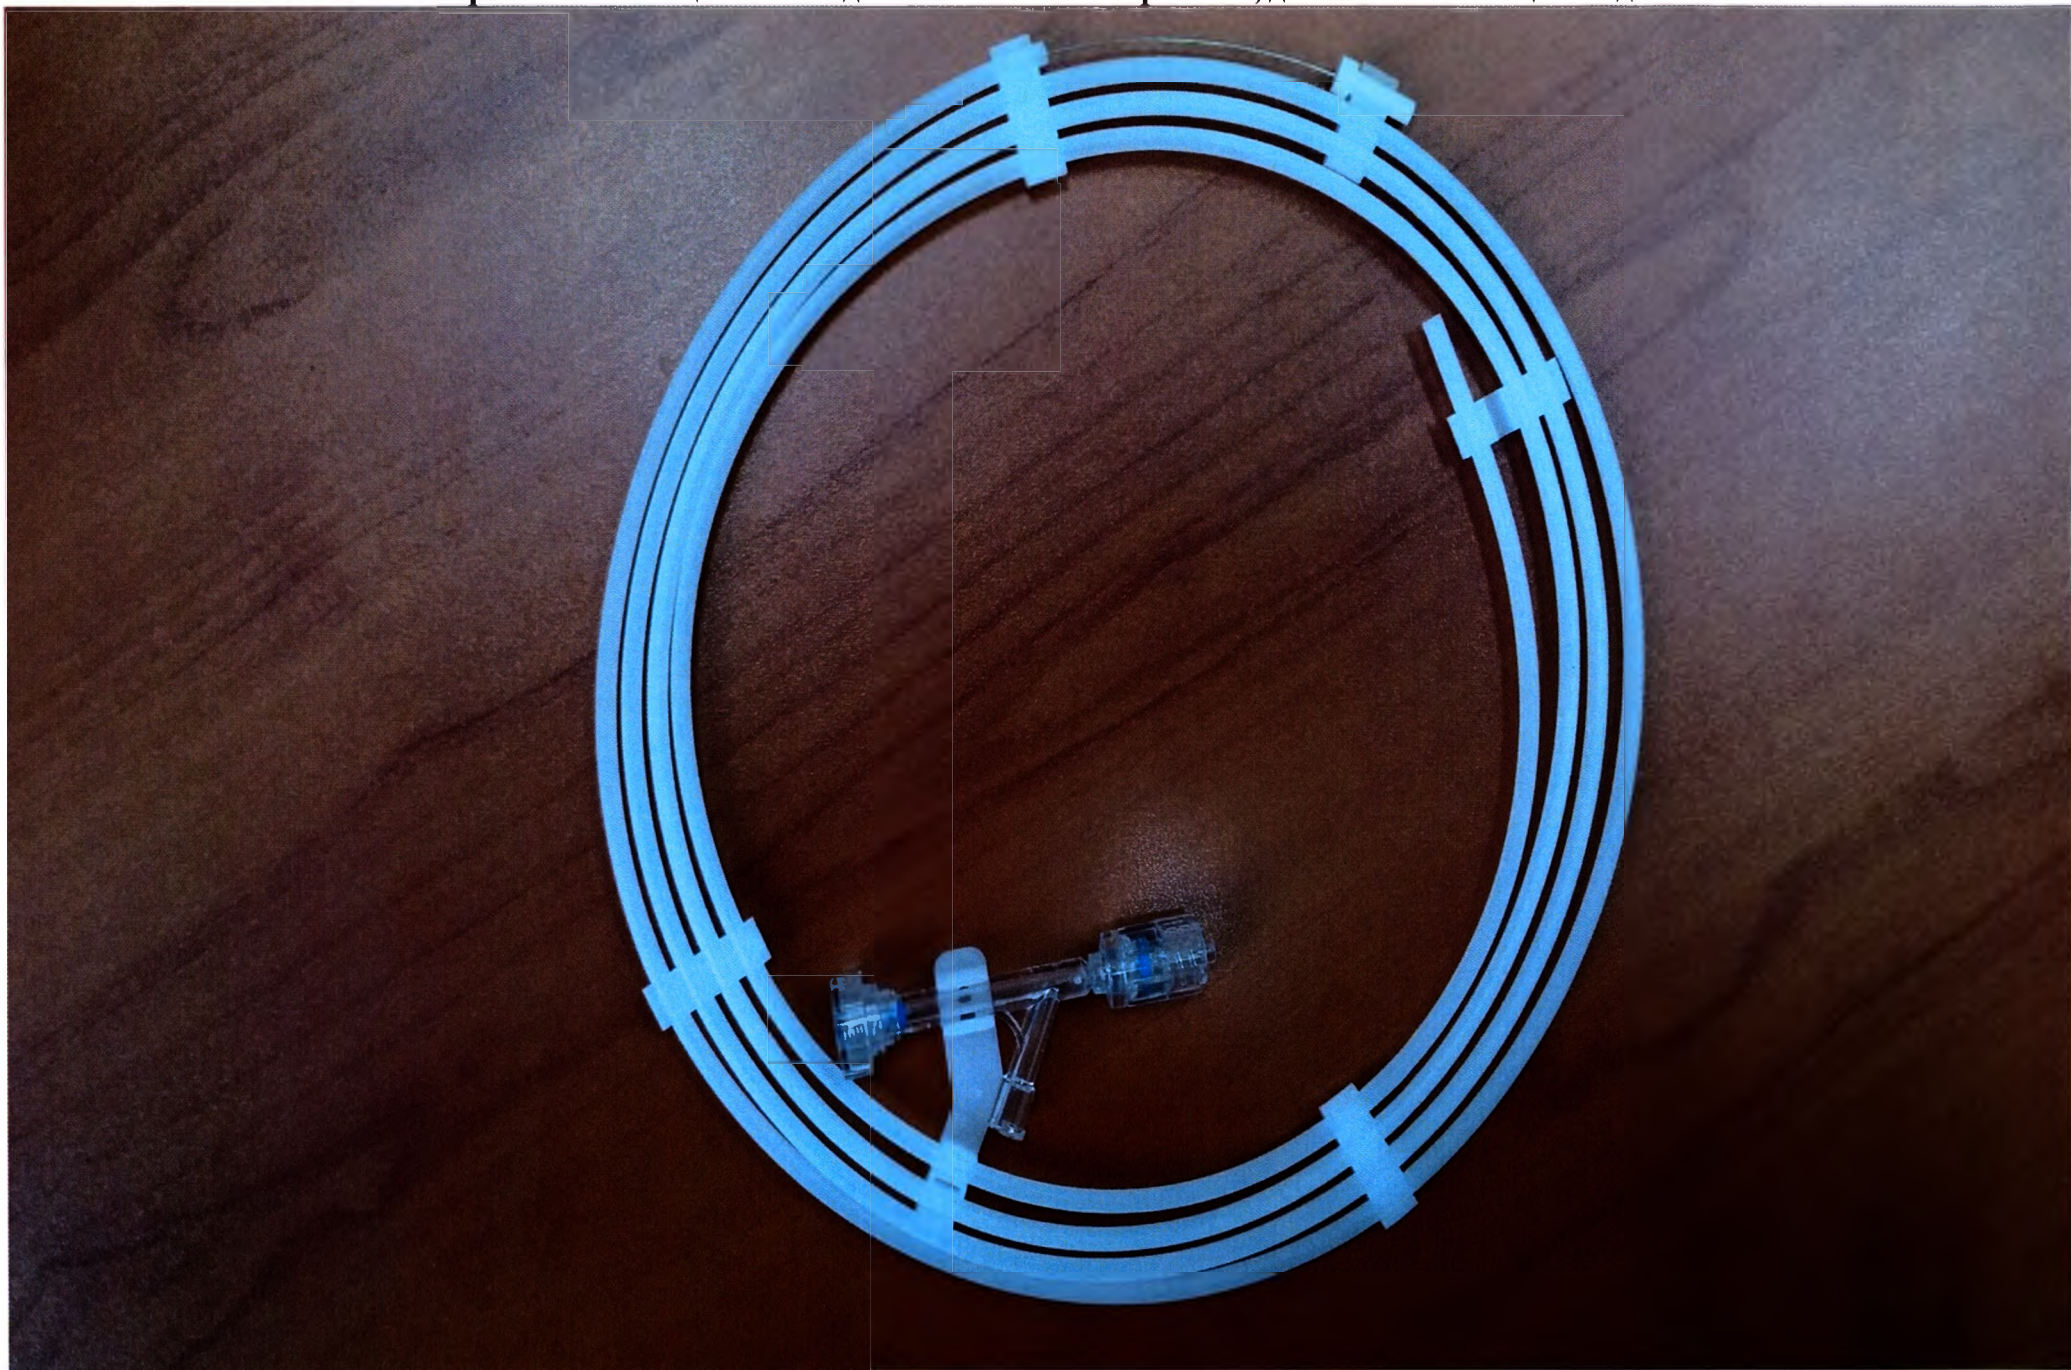


Спираль эмболизационная отделяемая Interlock Spiral 2D, длиной 60 см: маркировка 2-ой стороны упаковки

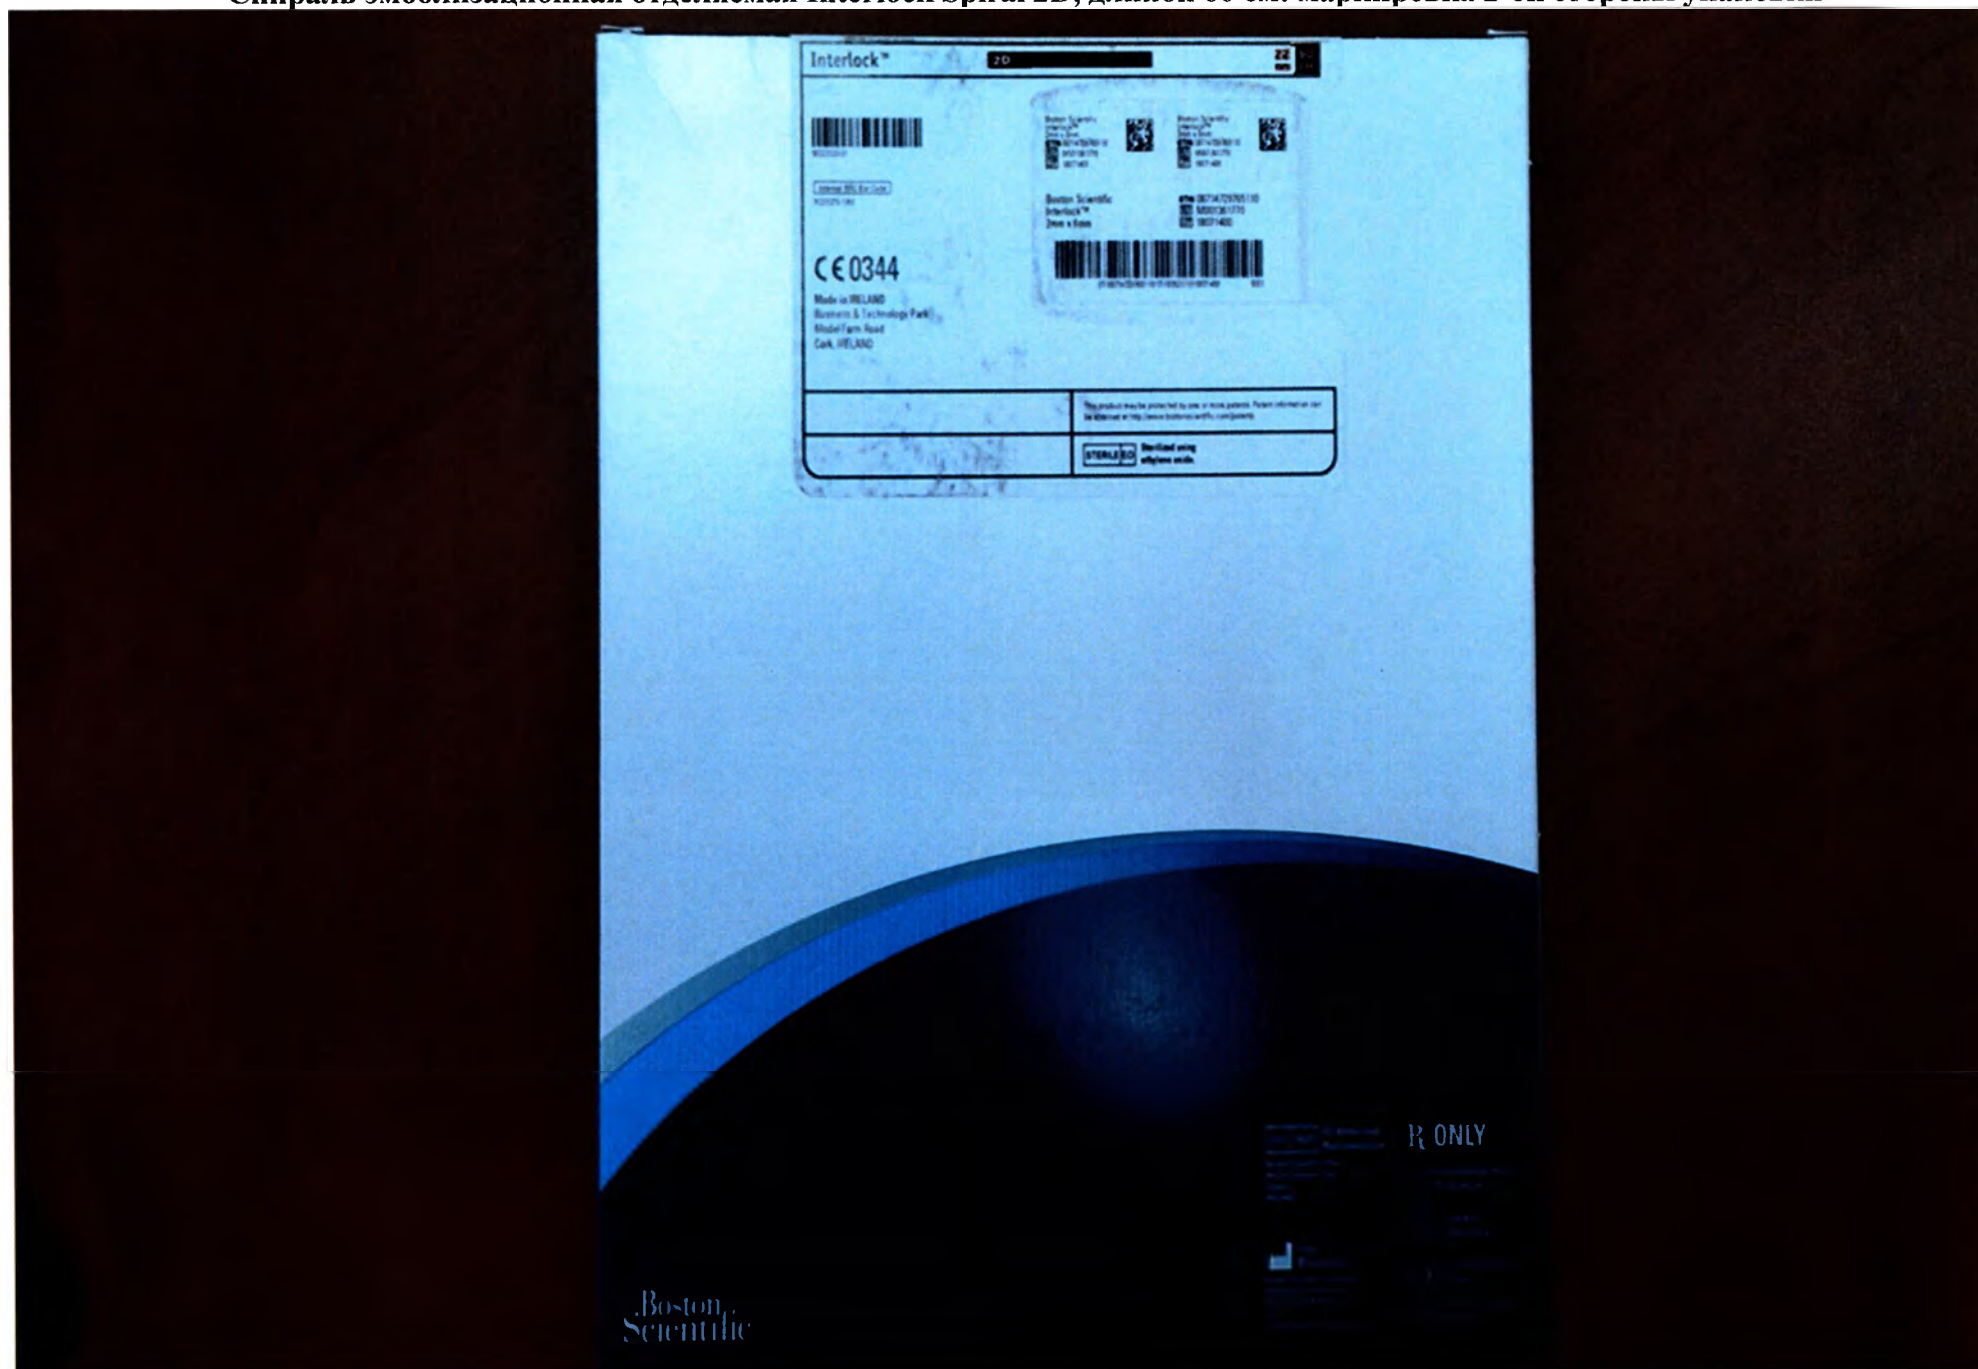

Спираль эмболизационная отделяемая Interlock Spiral 2D, длиной 60 см: маркировка боковой стороны упаковки

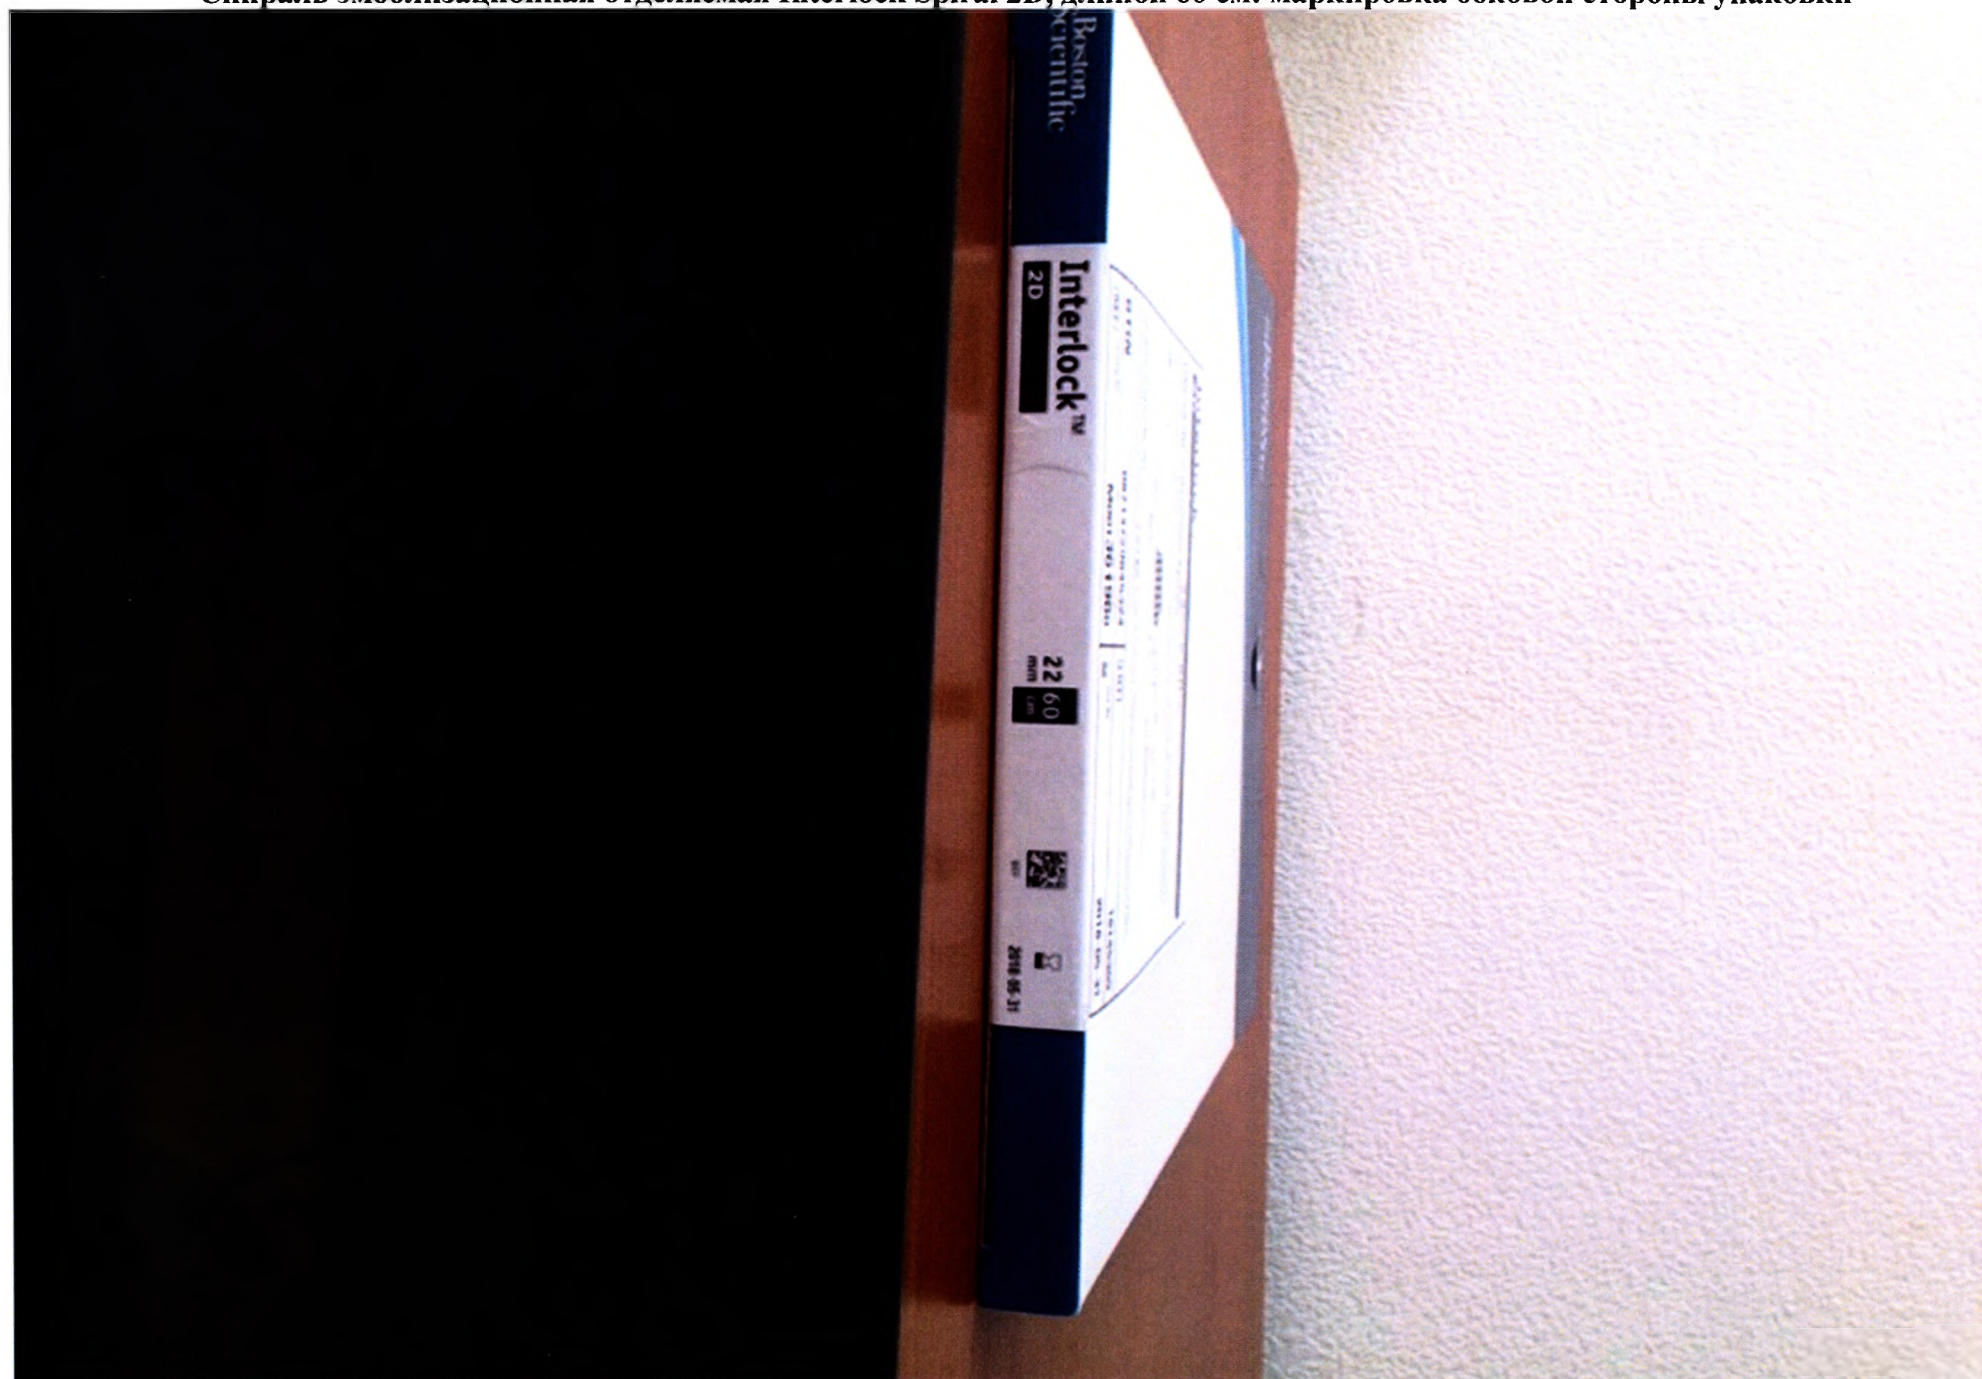

Спираль эмболизационная отделяемая Interlock VortX Diamond, длиной 8 см: общий вид

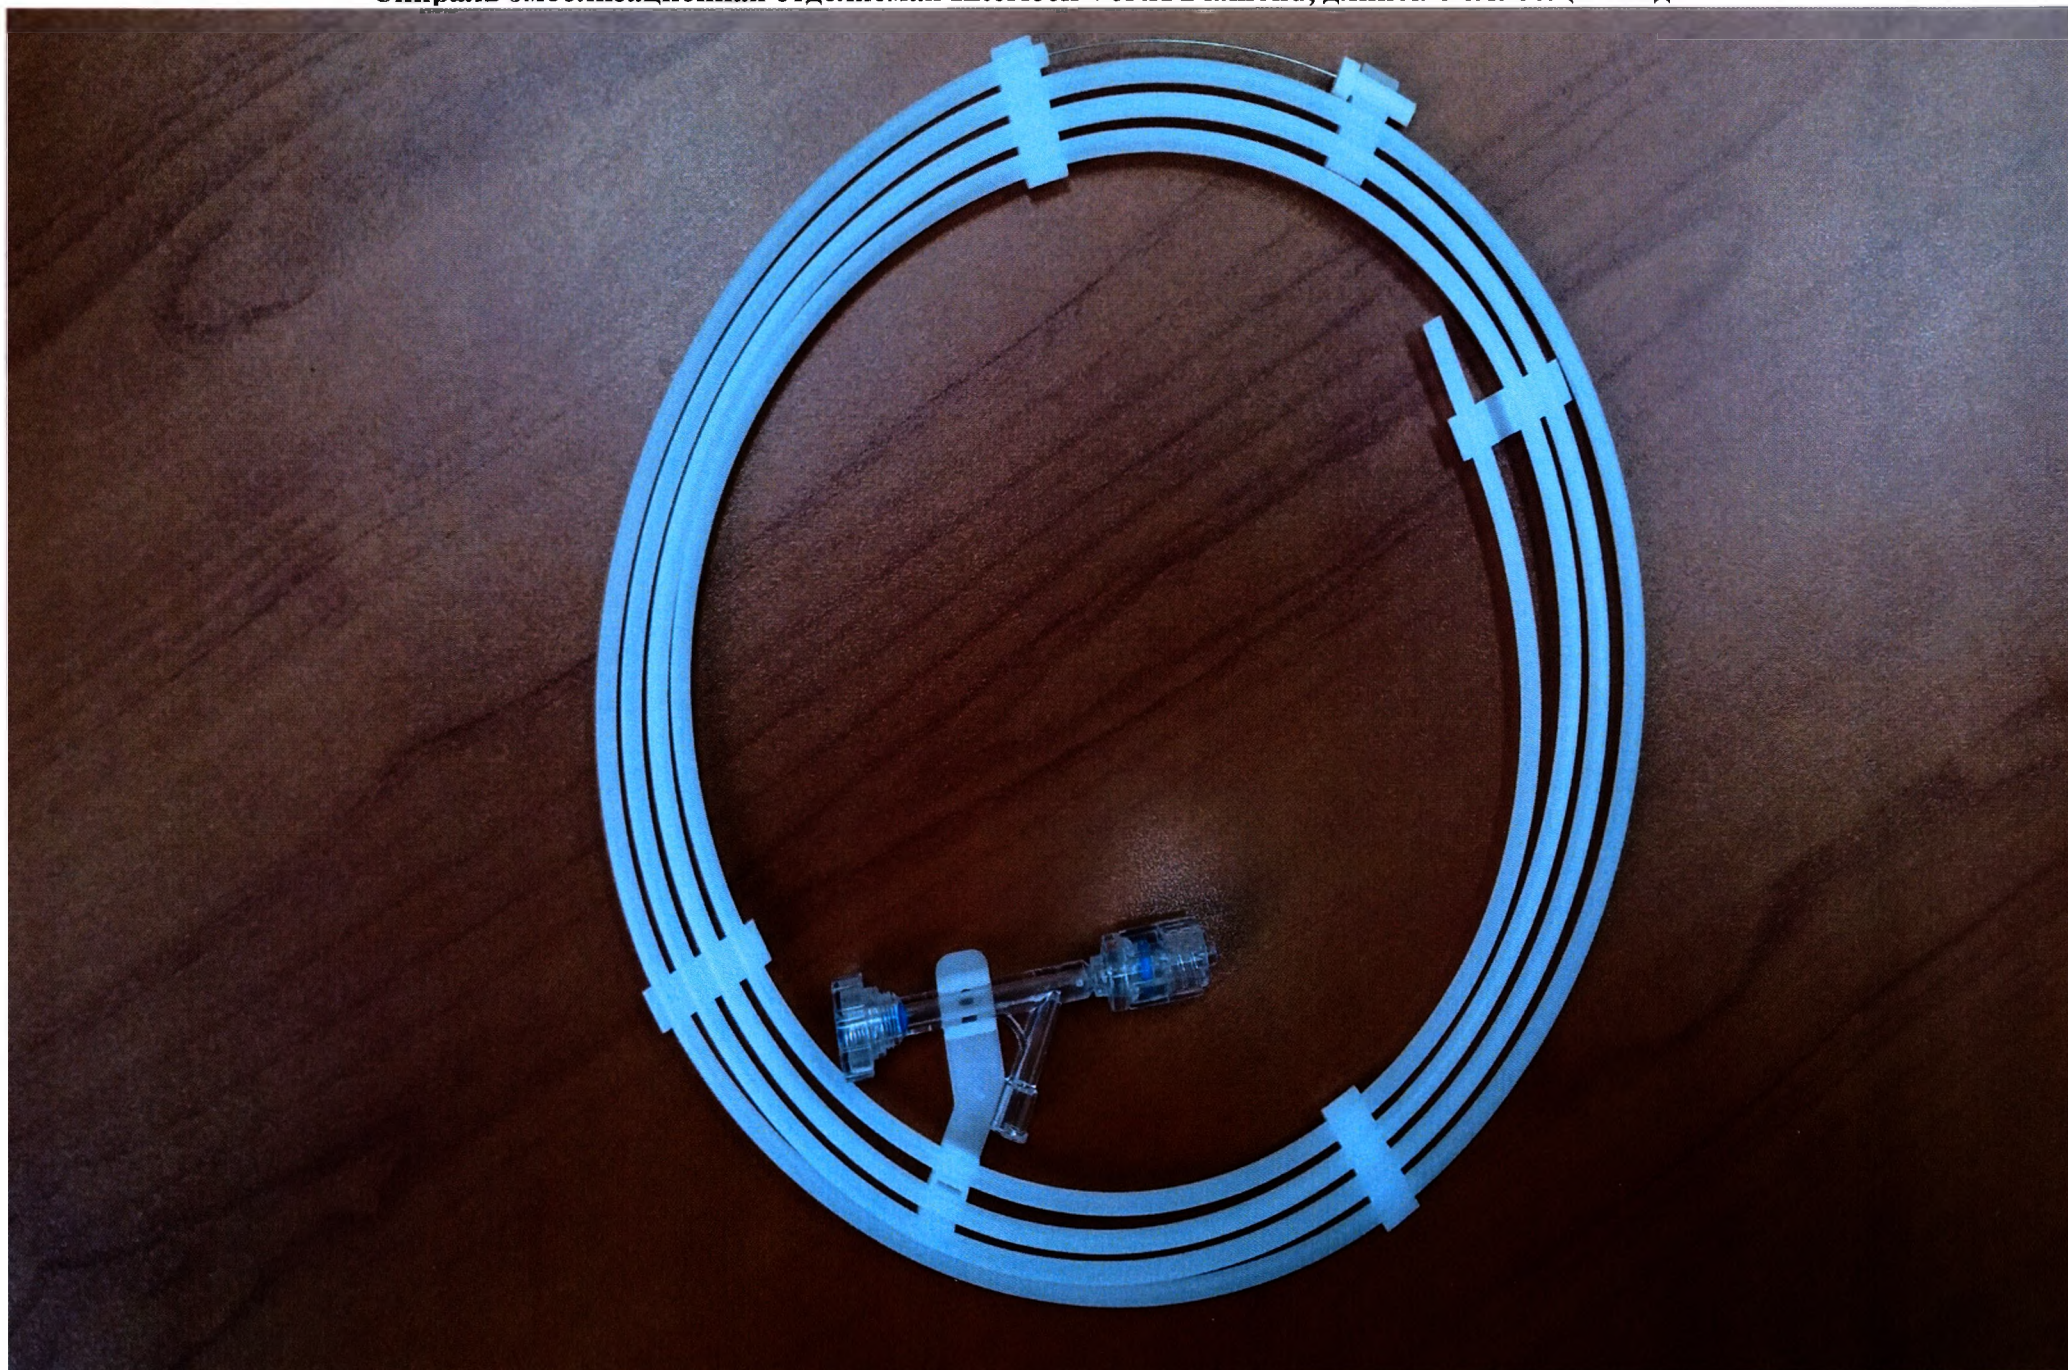



Спираль эмболизационная отделяемая Interlock VortX Diamond, длиной 8 см: маркировка 2-ой стороны запечатываемого пакета

Boston
Scientific



Rx ONLY

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Resterilize

Consult instructions
for use.

Do not use if package
is damaged.

EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Bulfinch Business Park
Galway
IRELAND

Legal
Manufacturer

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 800 325 4881

Boston
Scientific



Interlock™

VortX™ Diamond Coil

2mm X 6mm X 8cm

Fibered IDC™ Occlusion System

Sistema de oclusión IDC con fibra. Système d'occlusion IDC en fibre. Fiber-IDC Occlusionssystem. Sistema per occlusione a fibre IDC. Fiber-IDC-occlusionssystem. ファイバー-IDC オクルージョンシステム. Fiber-Petal IDC occlusionssystem. Závazný omdpový, je nález IDC. Sistema de Oclusão IDC com Fibras. Fiberlueret IDC occlusionssystem. Bórhelyzáló, IDC (betételezővel kapcsolódó spirál) tartalmú ocludó rendszer. Választási ocludó IDC system. System okluzujący ze światłowodem IDC. IDC okluzjonssystem med fiber. Fiberli IDC Okluzjon Sistemi

☒ Common (1)




Peripheral Vascular Use


Use vascular peripheral. Pour utilisation dans la zone vasculaire périphérique. Zur Verwendung in peripheren Gefäßen. Use nel sistema periferico. Voor gebruik in de perifere vaat. 末梢血管用. Perifer vasculär ång. Pääpäässä käytettävä ankkuri. Perifer Vascular Perfekt. For perifer vasculär användning. Periféris vasculáris felhasználás. Per použití v periférních cév. Do stosowania w naczyniach obwodowych. Perifer vasculär bruk. Periferal Vasculär Kullam

GTIN	08714729765110	LOT	18071400
REF Catalog No.	M001361770	Use By	2018-05-31


Спираль эмболизационная отделяемая Interlock VortX Diamond, длиной 8 см: маркировка 2-ой стороны упаковки

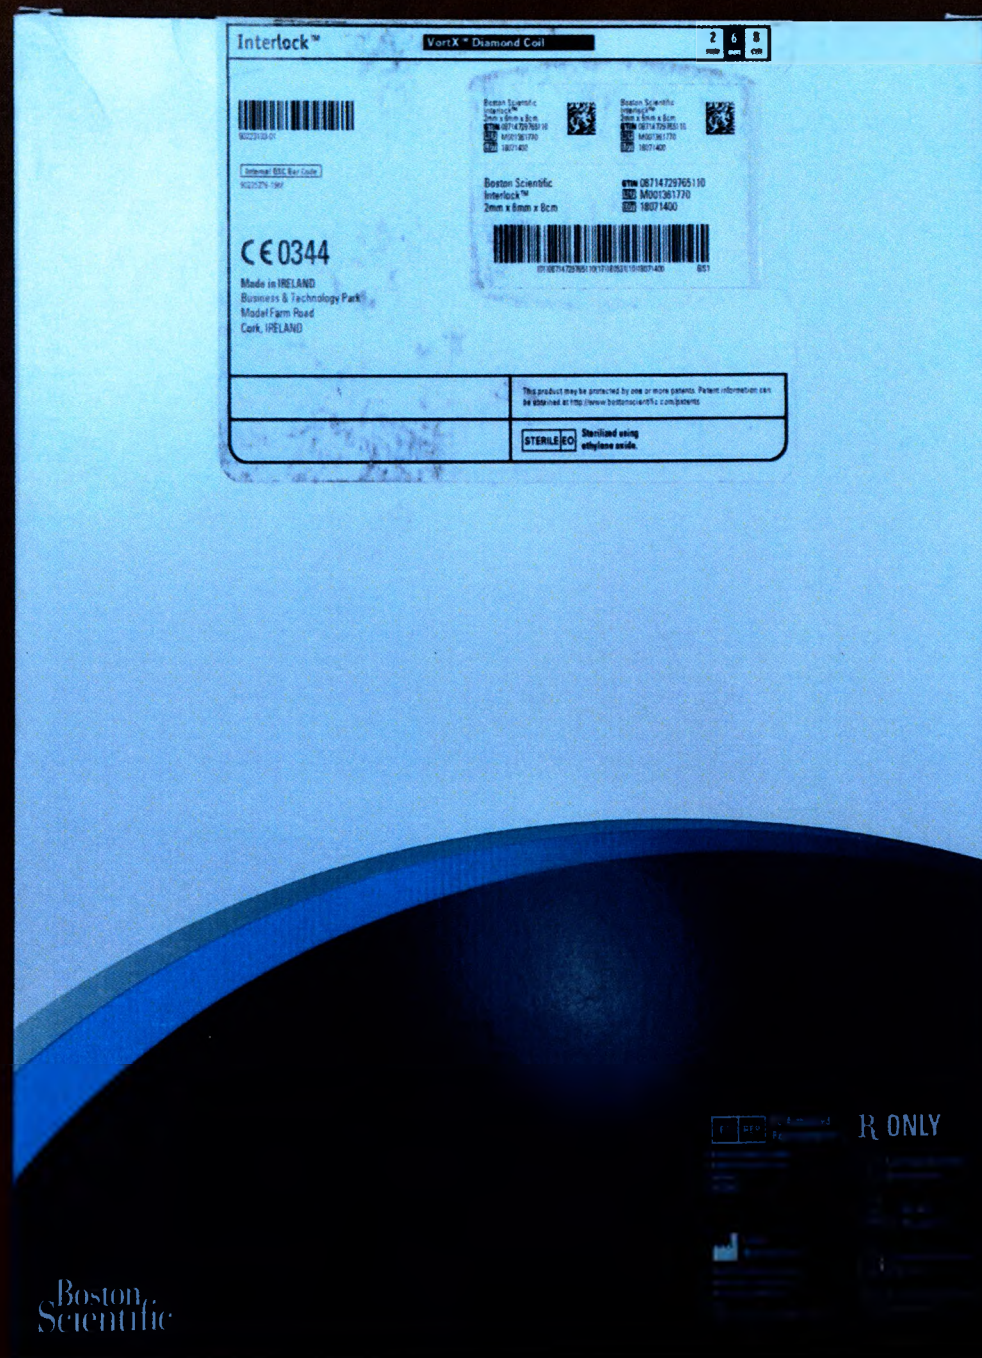

Спираль эмболизационная отделяемая Interlock VortX Diamond, длиной 8 см: маркировка боковой стороны упаковки

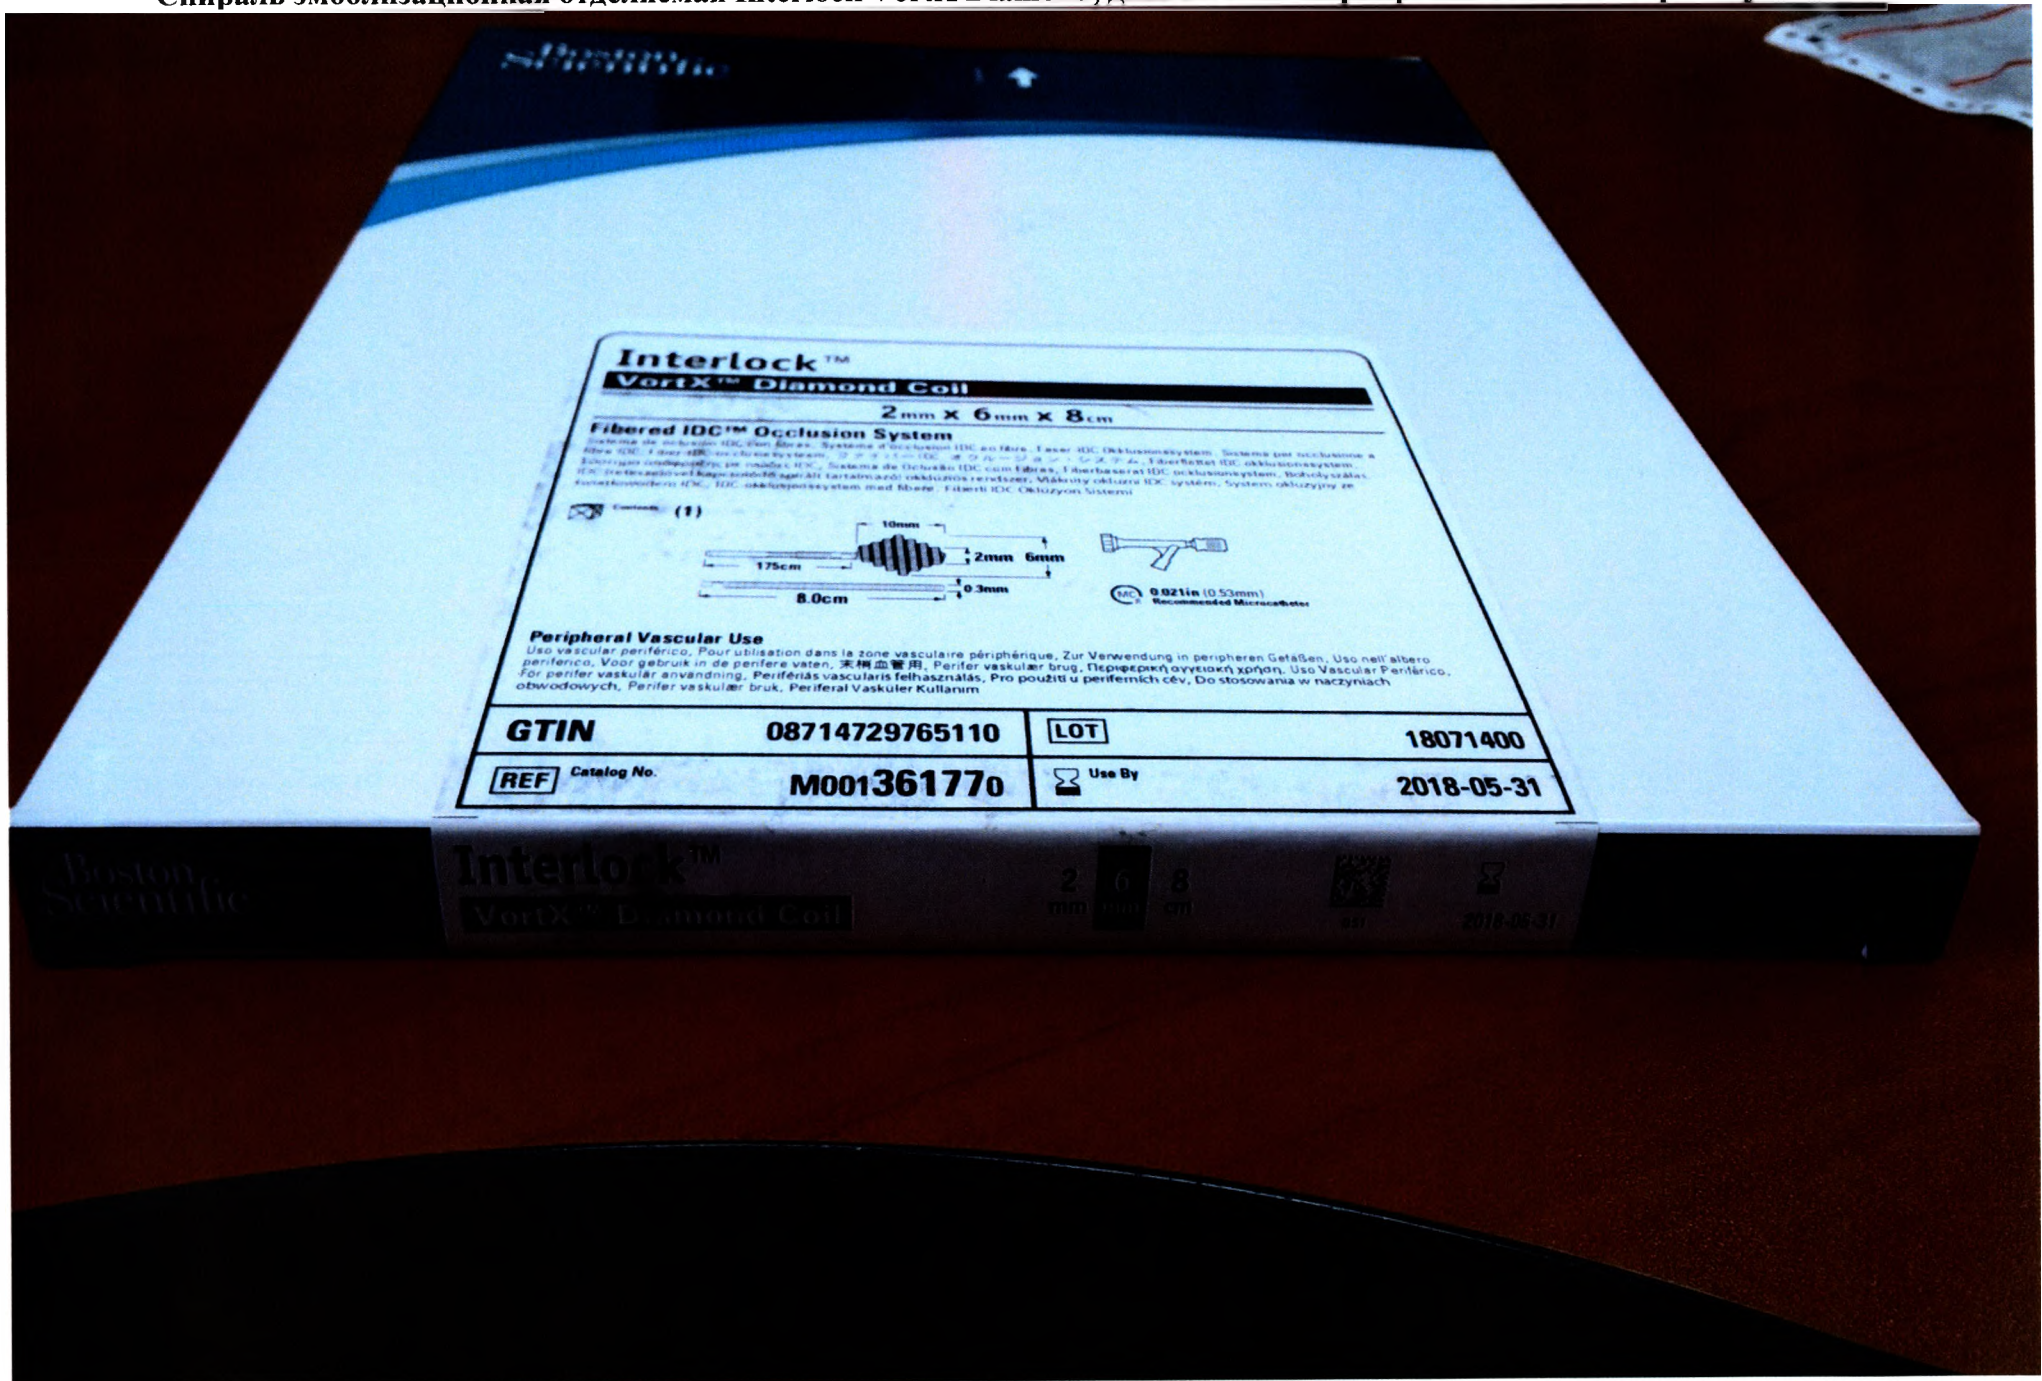

Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 2D, длиной 40 см: общий вид

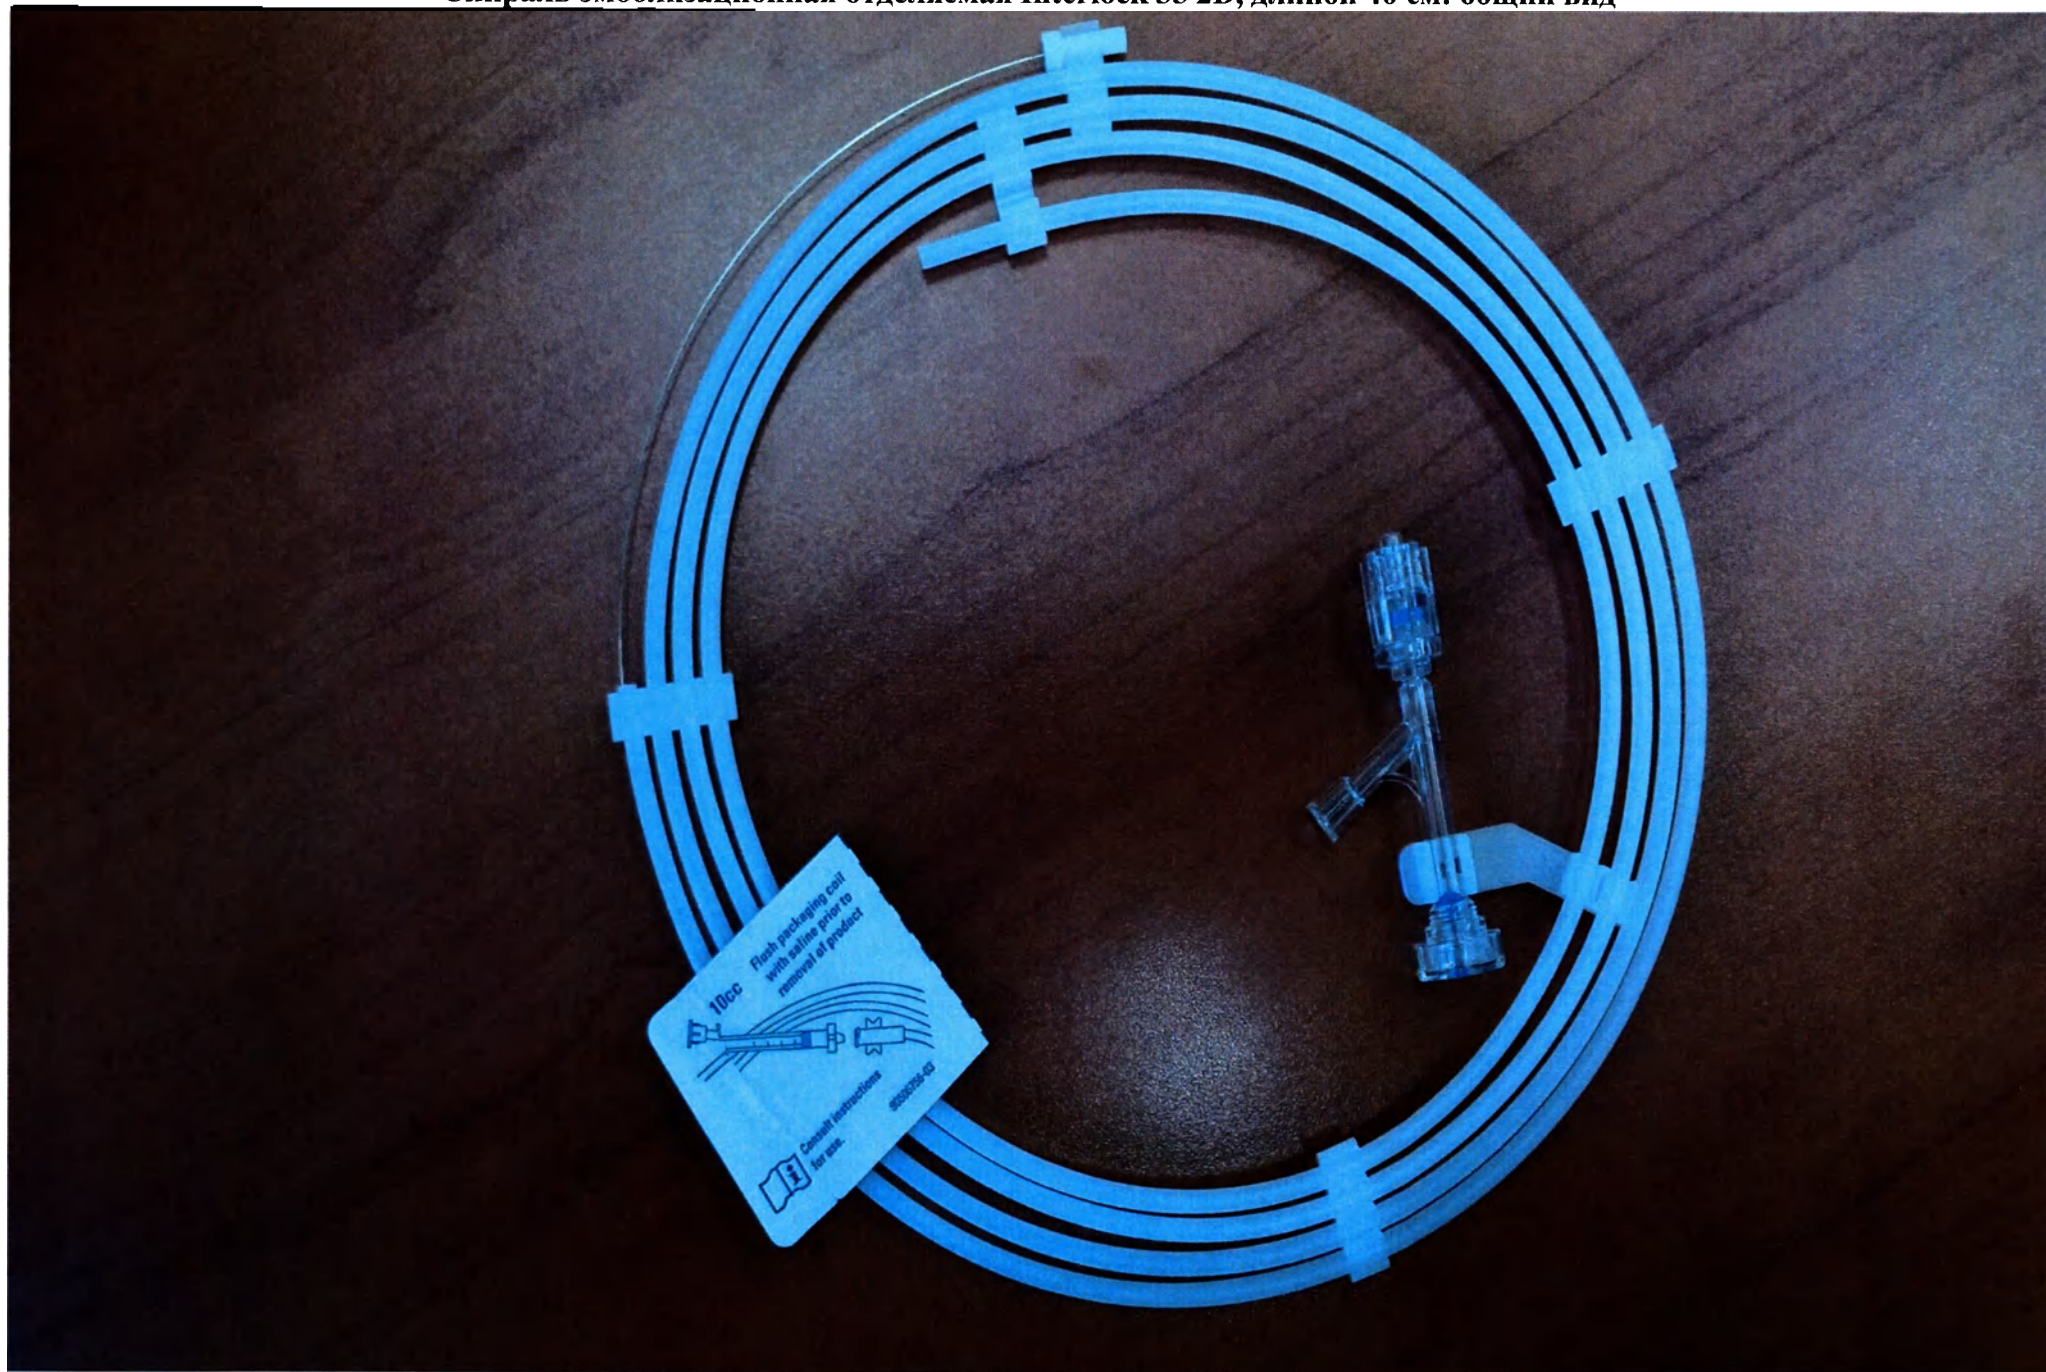

Boston
Scientific



Rx ONLY

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Resterilize

Consult instructions
for use.

Do not use if package
is damaged.

EC REP EU Authorized
Representative


Boston Scientific Limited
Bulfinch Business Park
Salway
WELAND

Legal
Manufacturer
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 800-572-1000


Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 2D, длиной 40 см: маркировка 2-ой стороны упаковки



Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 2D, длиной 40 см: маркировка боковой стороны упаковки

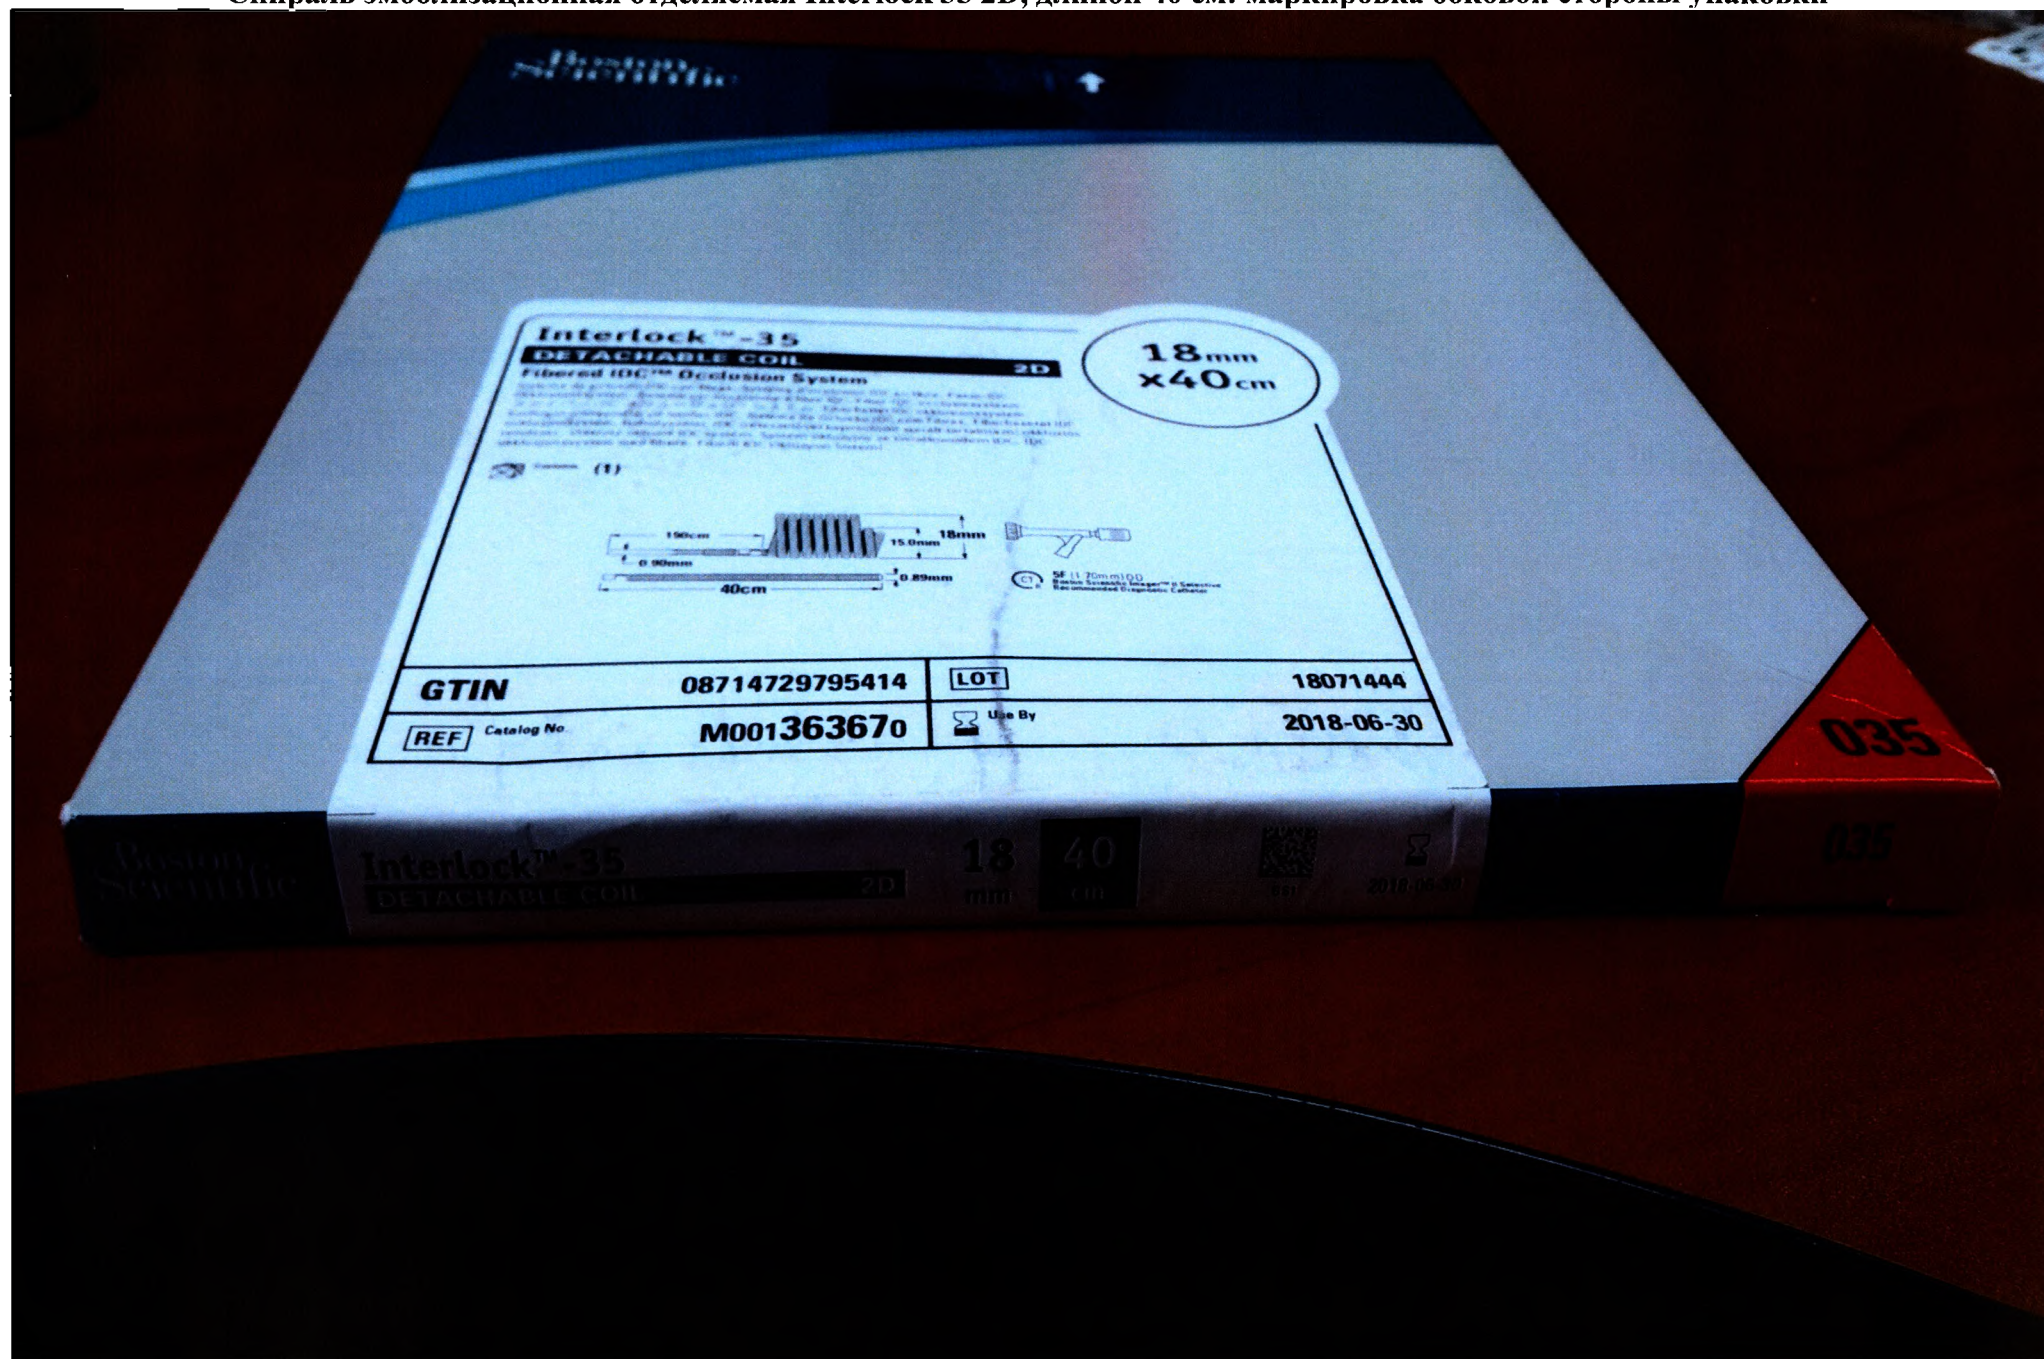


Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 Cube, длиной 40 см: общий вид

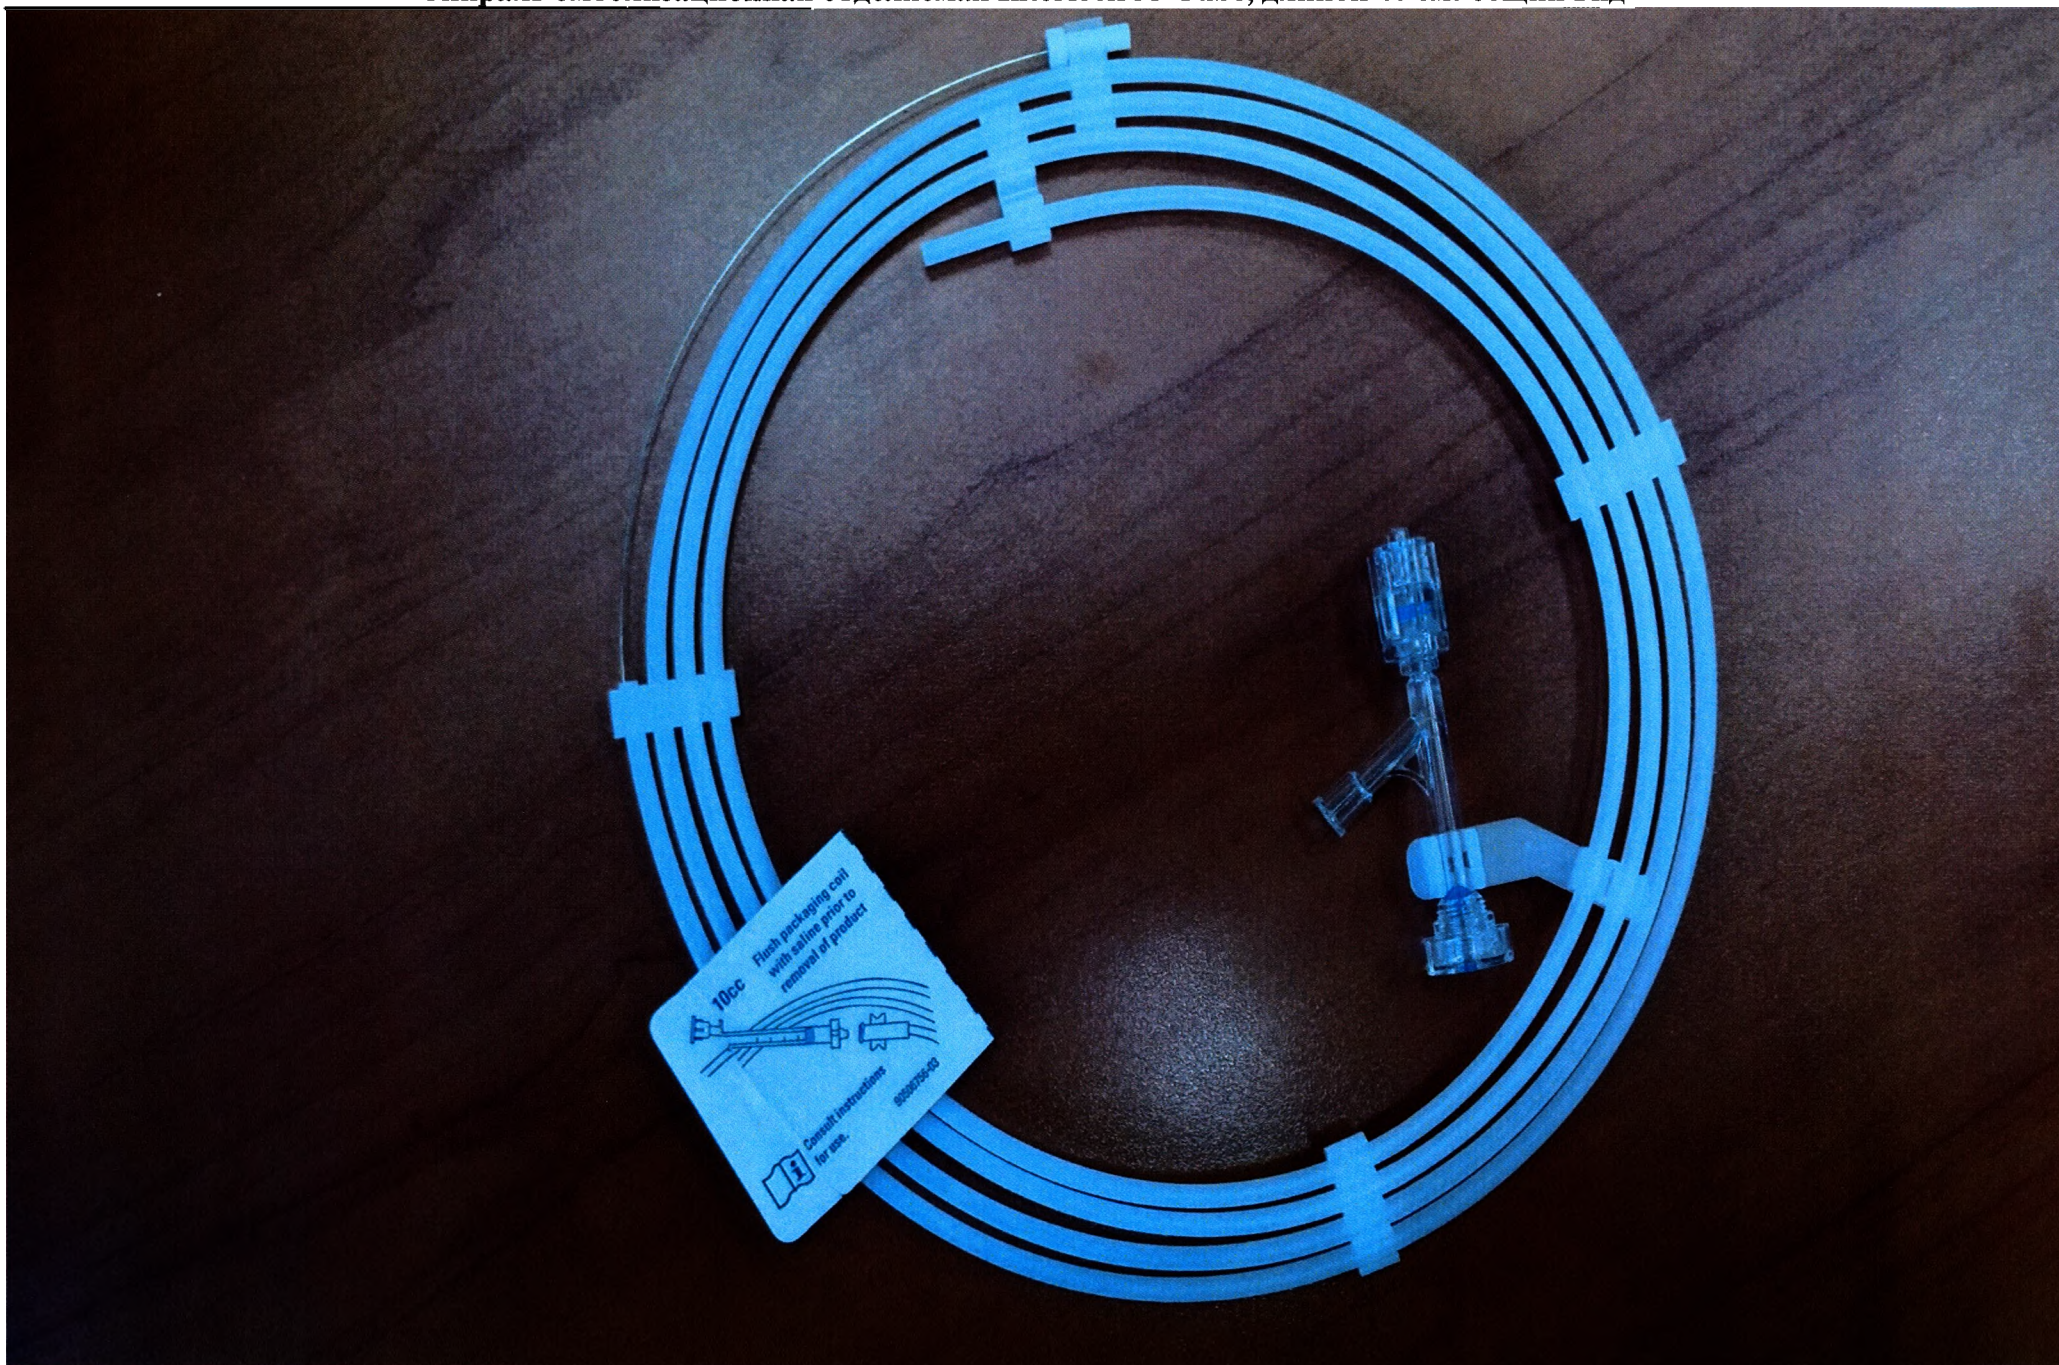


Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 Cube, длиной 40 см: маркировка 1-ой стороны запечатываемого пакета



Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 Cube, длиной 40 см: маркировка 2-ой стороны запечатываемого пакета

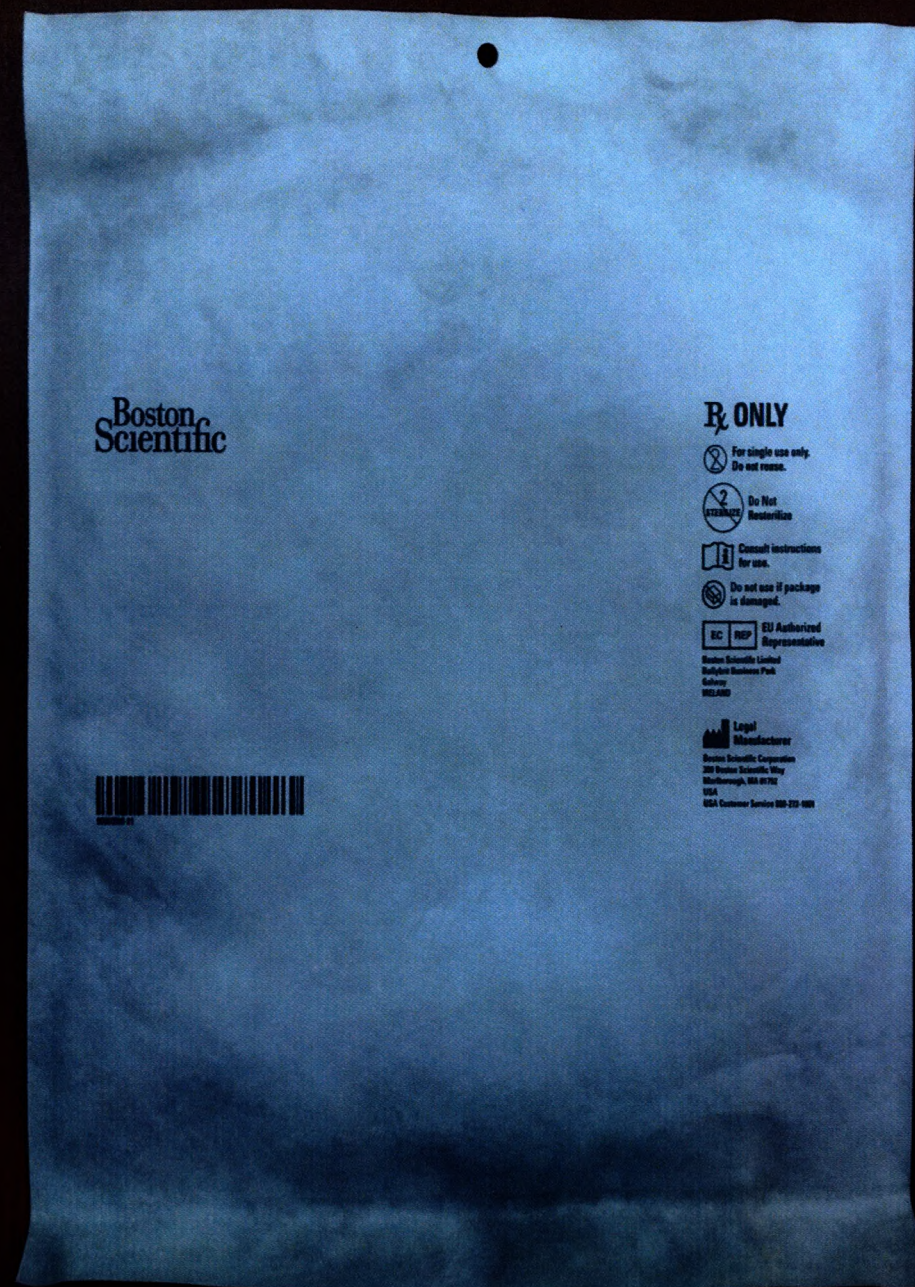


Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 Cube, длиной 40 см: маркировка 1-ой стороны упаковки

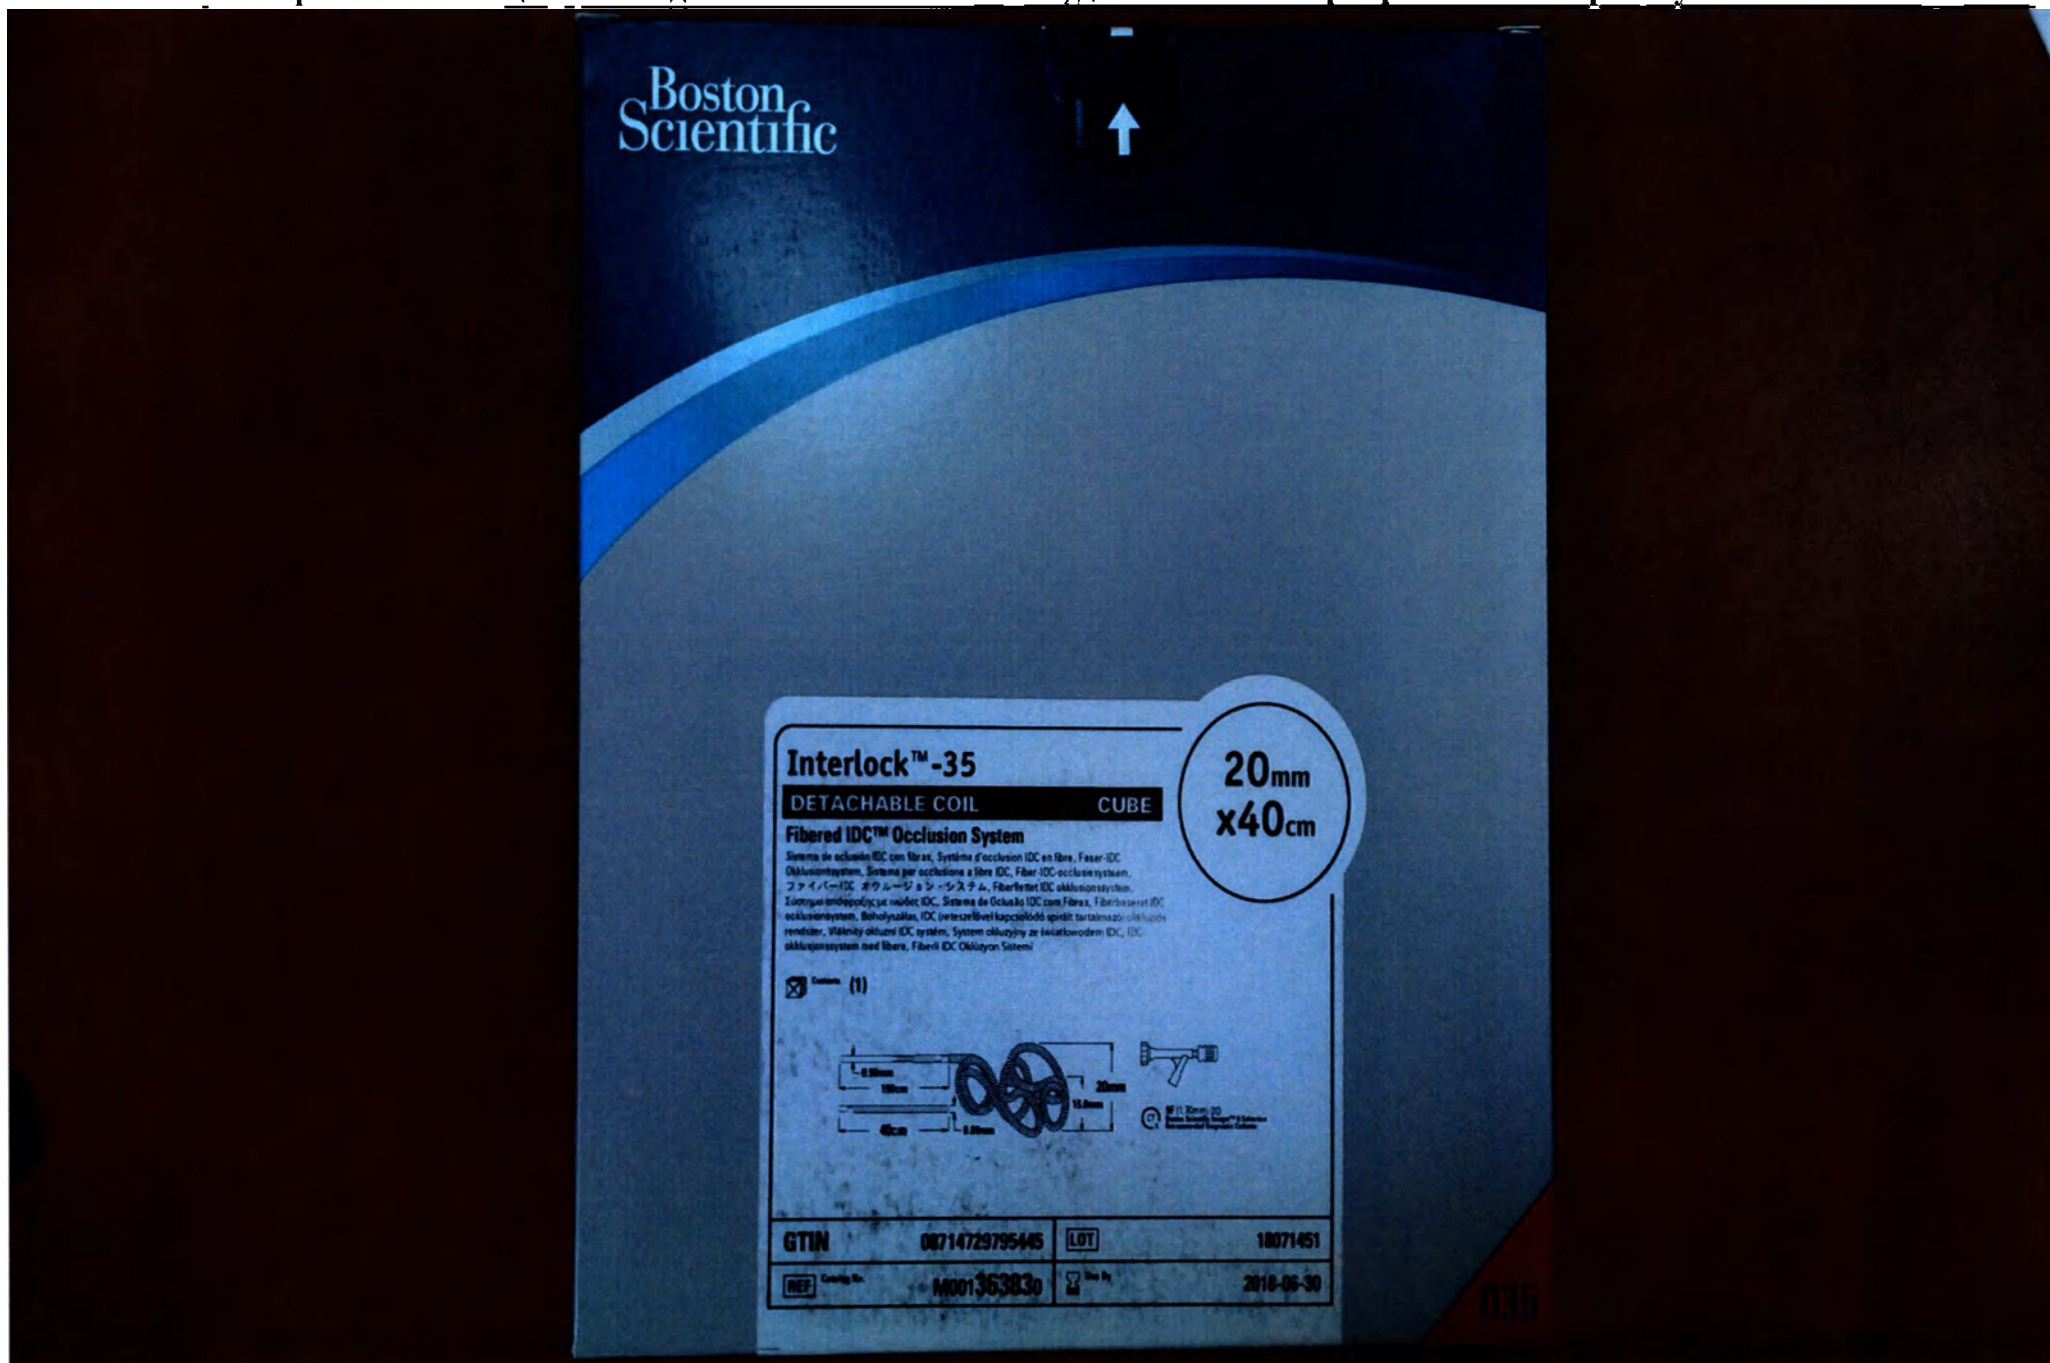


Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 Cube, длиной 40 см: маркировка 2-ой стороны упаковки



Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 Cube, длиной 40 см: маркировка боковой стороны упаковки

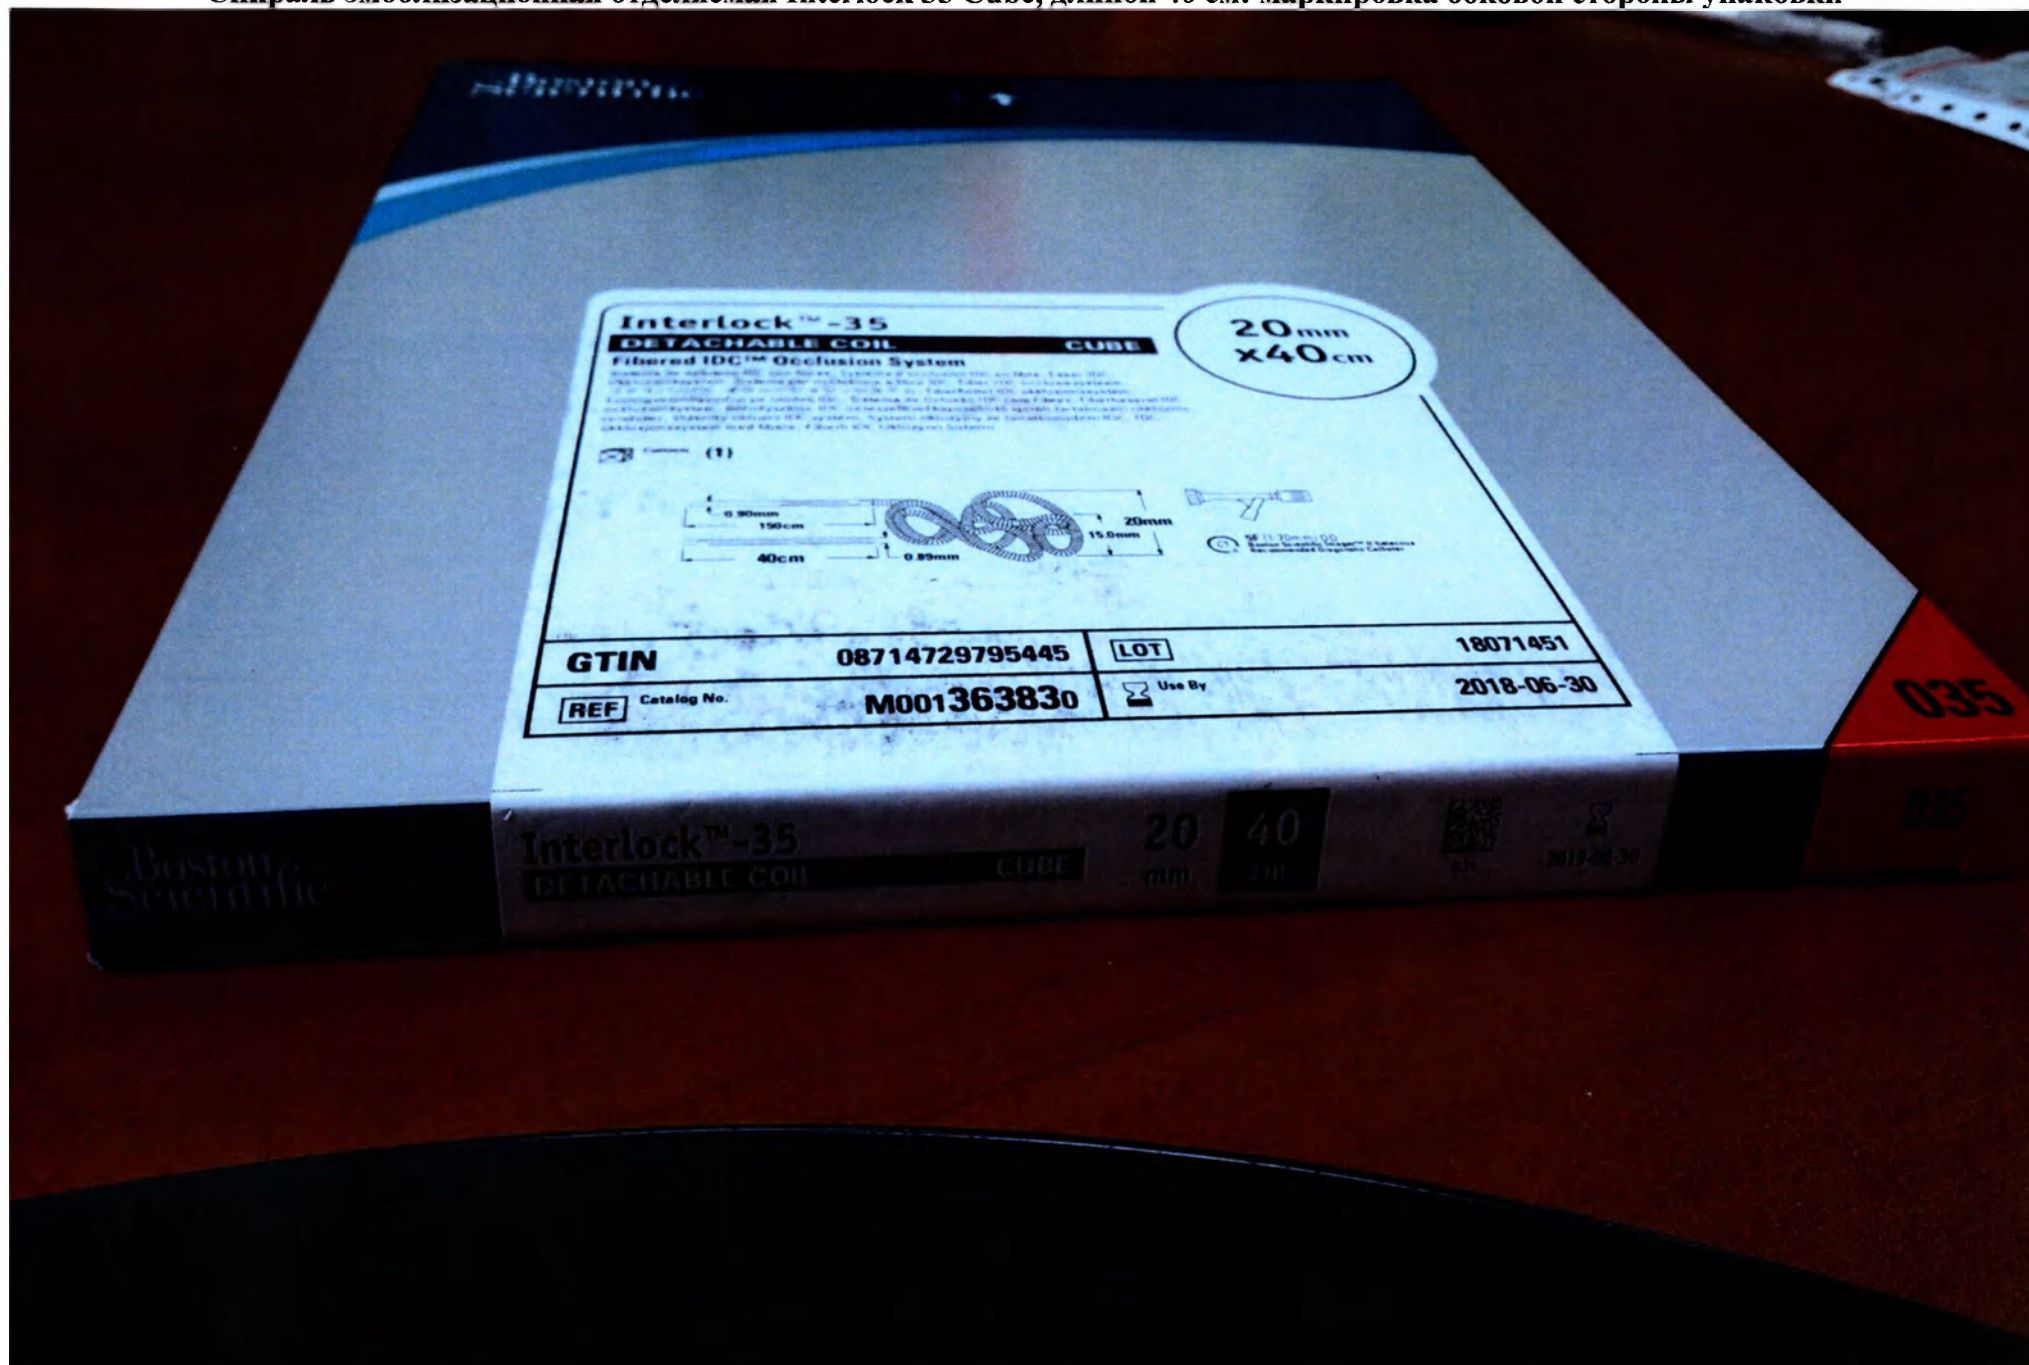

Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 Diamond, длиной 9,2 см: общий вид

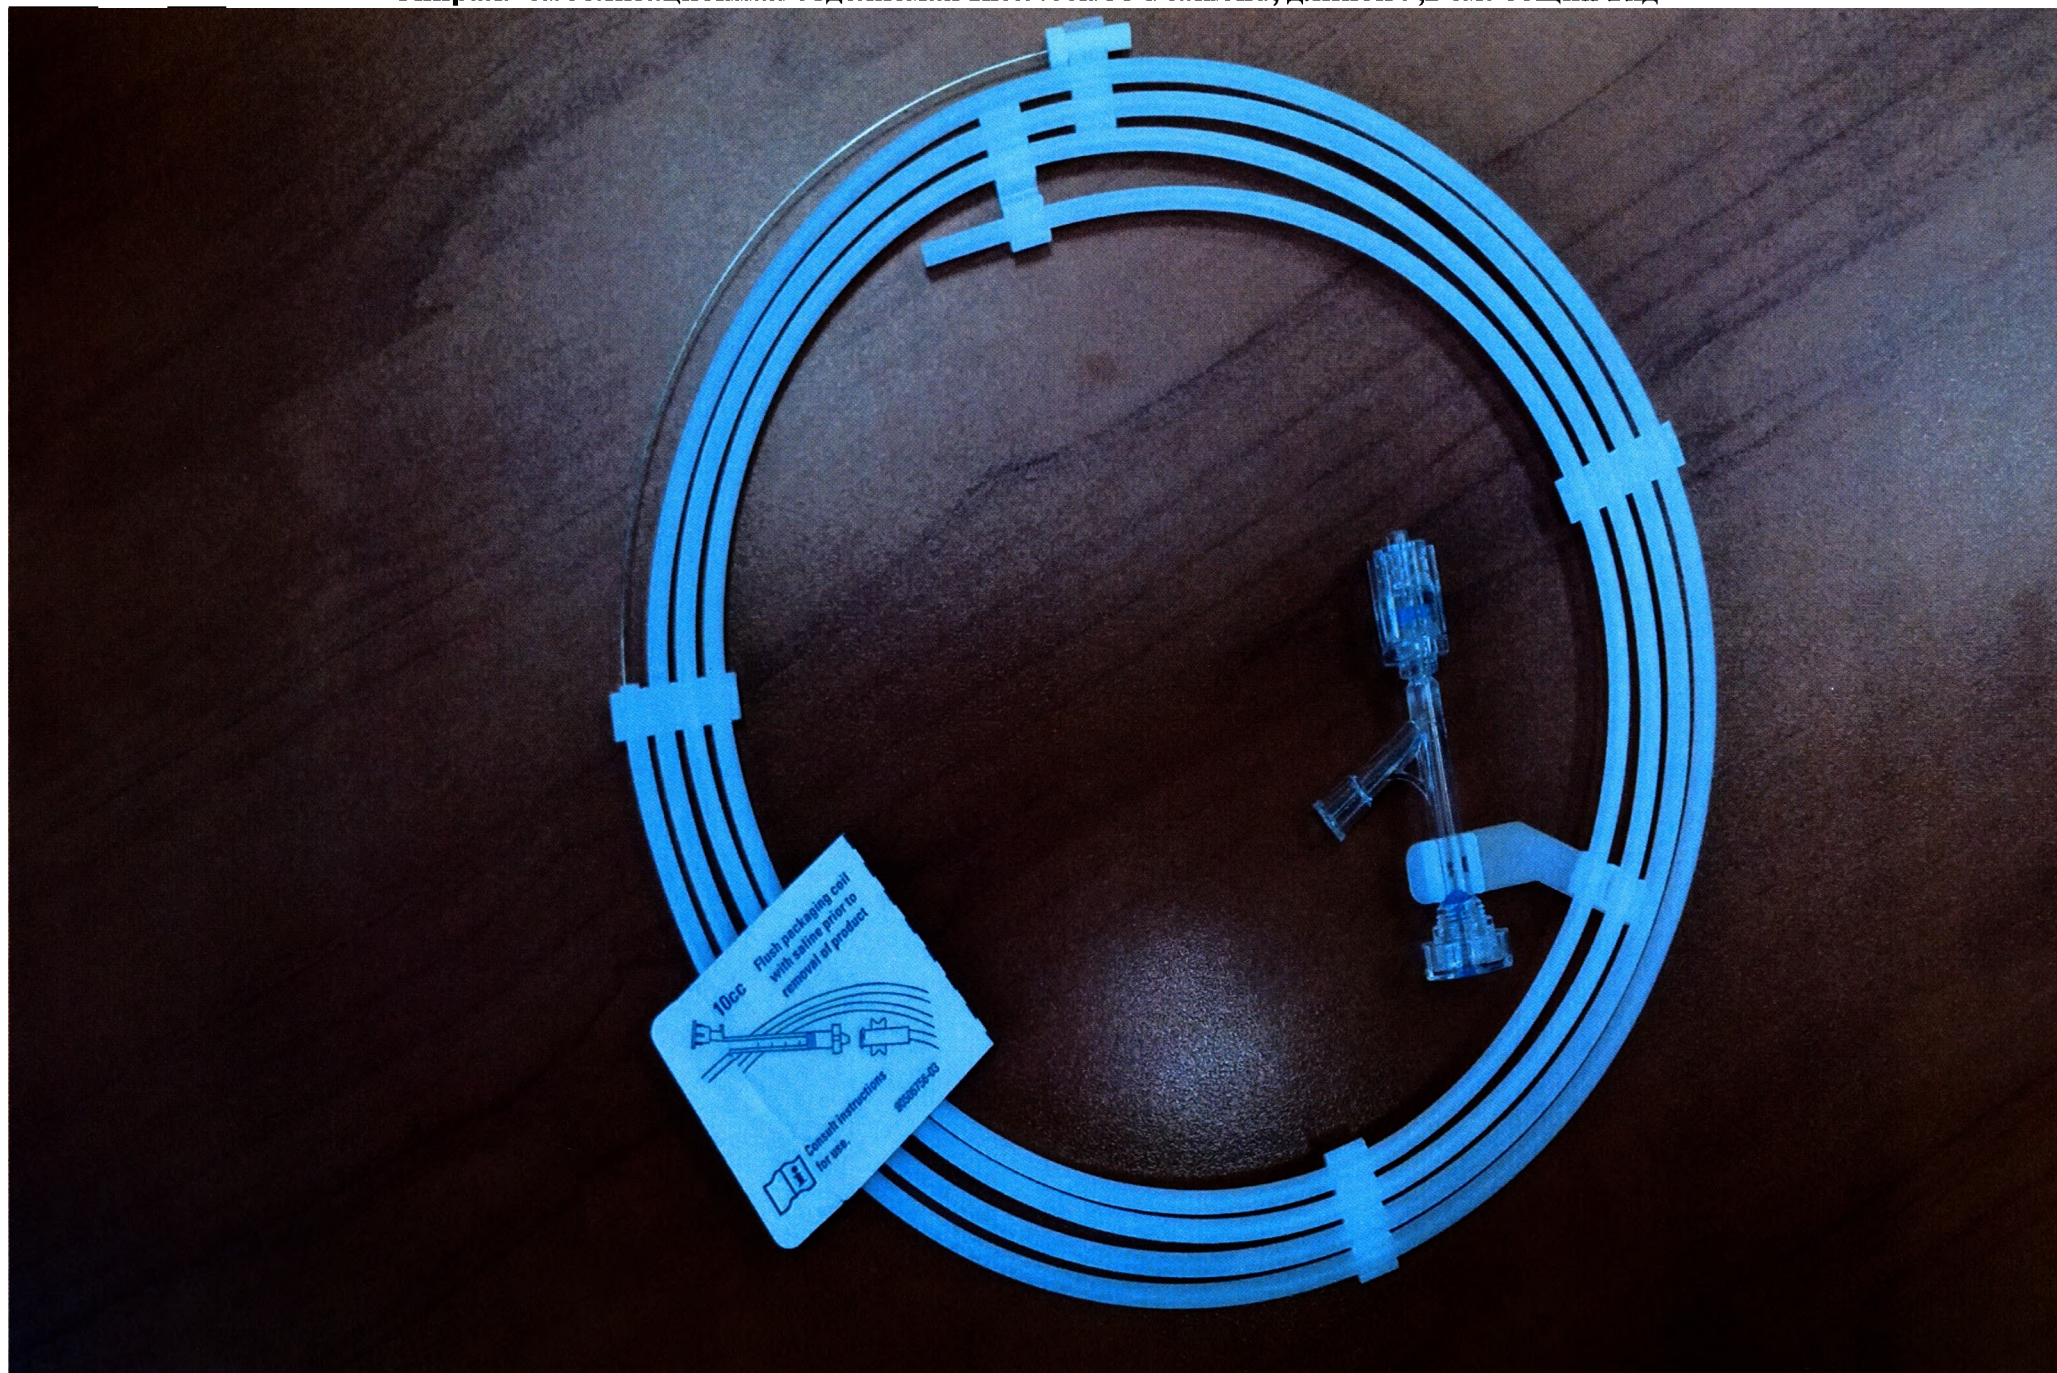



Interlock™ -35

DETACHABLE COIL

DIAMOND

Filtered IDC™ Occlusion System

Sistema de oclusión IDC con fibra. Système d'occlusion IDC en fibre. Faser-IDC Okklusjonssystem. Sistema per occlusione a fibre IDC. Fiber-IDC occlusion system.
 ファイバーIDC、オクルージョン・システム。Fiberfaset IDC okklusjonsystem. Ziermyślo układowy ze włókna IDC. Sistema de Oclusão IDC com Fibra. Fibrasystem IDC avkluvsystem. Болокнящая IDC интерваскулярная спираль с таргетной окклюзией нити. Váňový okluzní ICC systém. System okluzyjny ze światłowodem IDC. IDG-uključovný systém s vláknom. Fiberli IDC Okluzyon Sistemi.

	Catheter (1)	
	150cm 0.50mm 9.2cm 0.25mm	

CT #1 35m (1) GD Boston Scientific Image™ & Selection Recommended Diagnostic Catheter

GTIN	08714729795520	LOT	17883317
REF Catalog No.	M001363920	Use By	2018-04-30

STERILE Sterilized using ethylene oxide.


00419129-01

Internal BSC Bar Code
0003024-330

CE 0197

Made in IRELAND
Business & Technology Park
Model Farm Road
Cork, IRELAND

Boston Scientific
Interlock™ -35
Diamond
GTIN 08714729795520
REF M001363920
LOT 17883317

Boston Scientific
Interlock™ -35
Diamond
GTIN 08714729795520
REF M001363920
LOT 17883317


 08714729795520 17100400 1007 P00317 BS1

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston
Scientific



Rx ONLY

For single use only.
Do not reuse.

Do Not
Sterilize

Consult instructions
for use.

Do not use if package
is damaged.

EU Authorized
Representative

Boston Scientific Limited
Ballynahinch Business Park
Ballynahinch
N. Ireland

Legal
Manufacturer
Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 800-322-1888

Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 Diamond, длиной 9,2 см: маркировка 1-ой стороны упаковки

Boston
Scientific

„Bioscience Resource Project“ „Bioscience Resource Project“
Delivering what's next™

Interlock™-35

DETACHABLE COIL DIAMOND

6mm
x9.2cm

Fibered IDC™ Occlusion System

Sistema de oclusión IDC con fibra, Sistema d'occlusión IDC en fibra, Faser IDC
Oklusjonsystem, Sistema per occlusione a fibre IDC, Fiber IDC occlusion system,
ファイバーIDC オクルージョン・システム, Fiberfaser IDC okklusjonsystem,
Sistemu emboforizatsionnyy s nitey, IDC, Sistema de Ocusão IDC com Fibras, Fiberfaserat IDC
okklusjonsystem, Bőholyszálalás, IDC (vetenzékelési) kapcsolódó spirális tartalmú okklúziós
rendszer, Vlaknitély okluzní IDC systém, System okluzyjny ze światłowodem IDC, IDC
okklusjonsystem med fibre, Fiberli IDC Okluzyon Sistemi

Contents (1)



150cm
6.0mm
9.2cm
6.0mm

GTIN 08714729795520


LOT 17083317

REF Catalog No. M001363920


Use By 2018-04-30

035

Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 Diamond, длиной 9,2 см: маркировка 2-ой стороны упаковки

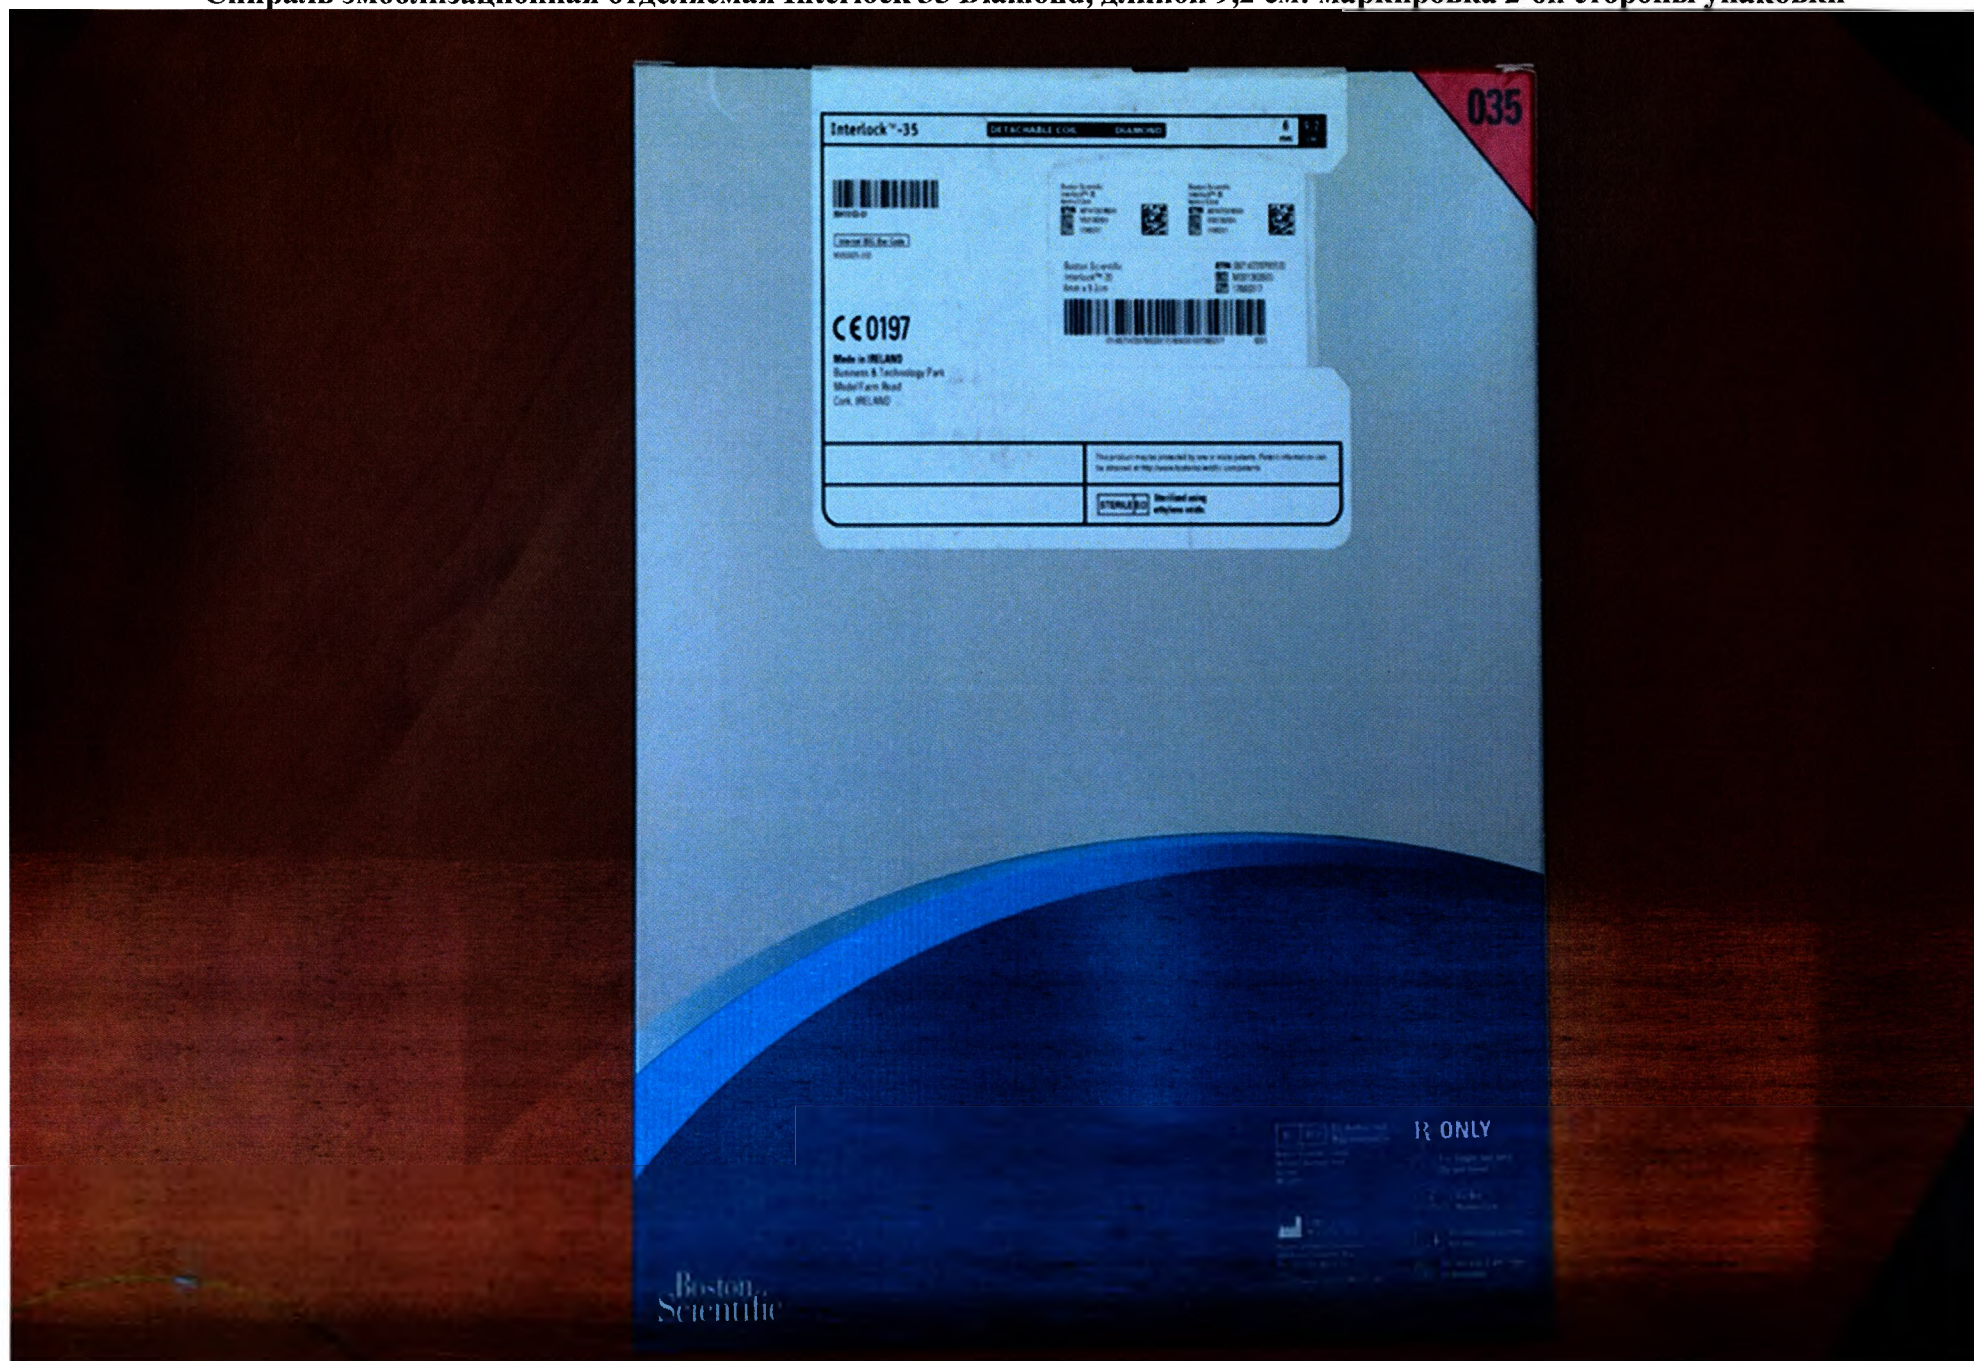

Спираль эмболизационная отделяемая Interlock 35 Diamond, длиной 9,2 см: маркировка боковой стороны упаковки

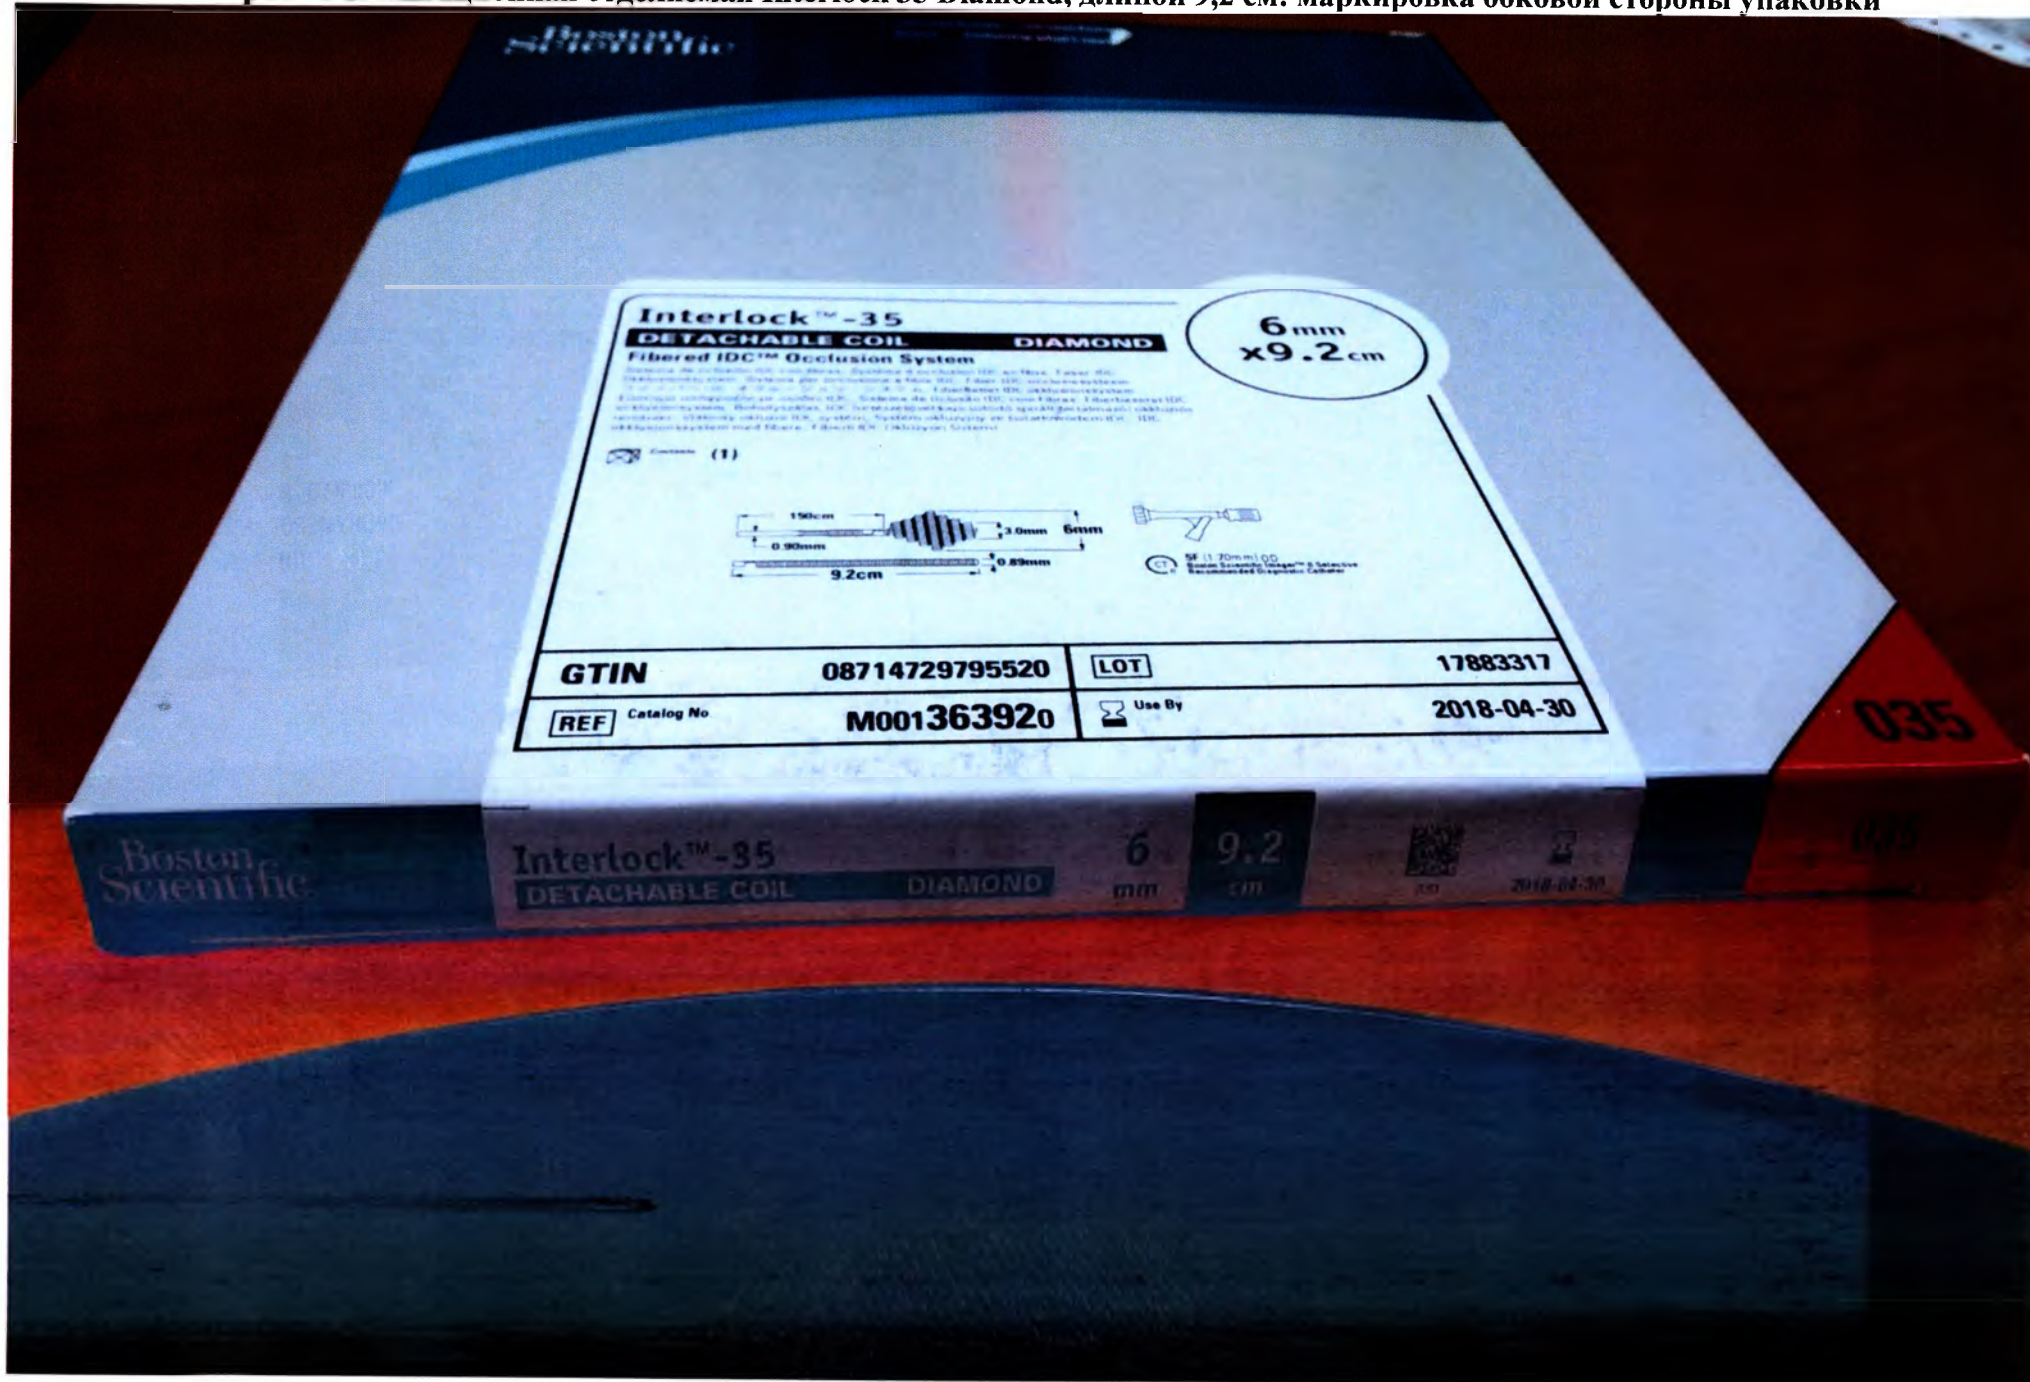

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
48 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

