



Внешний вид


Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

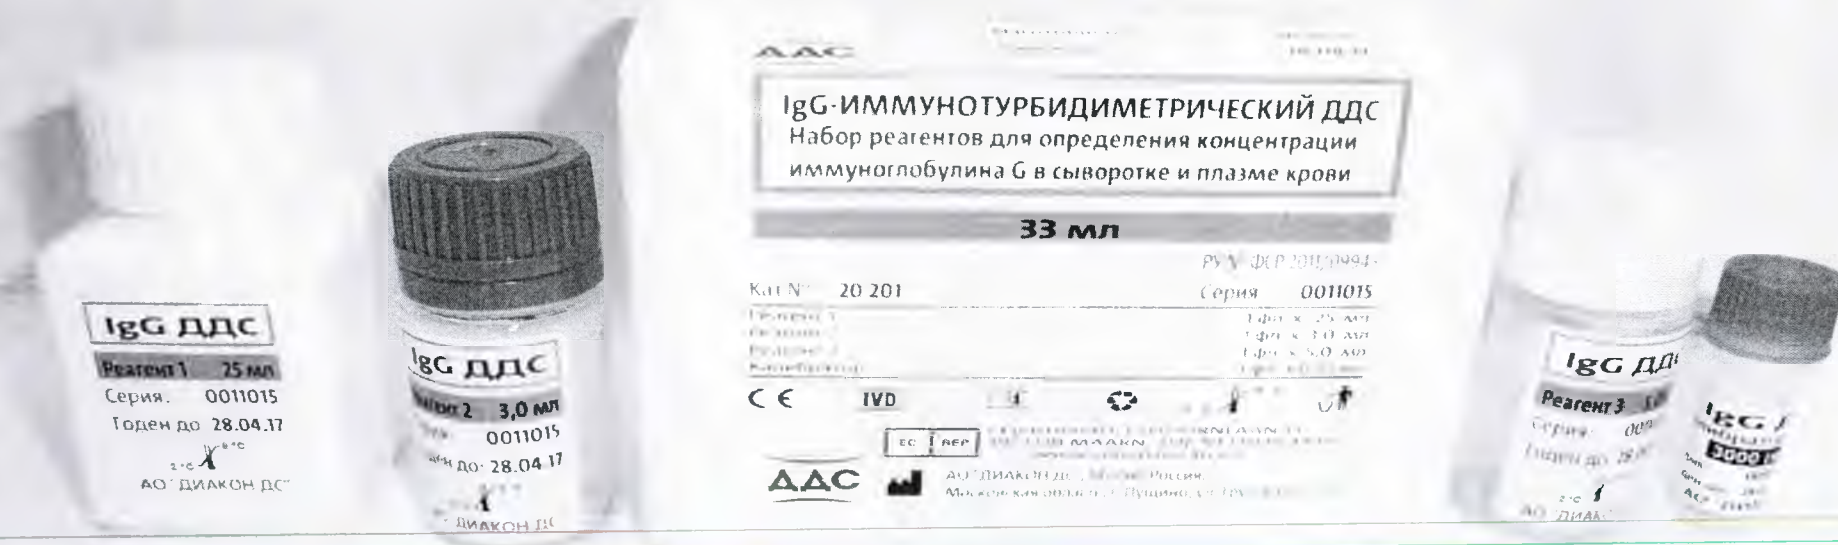

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

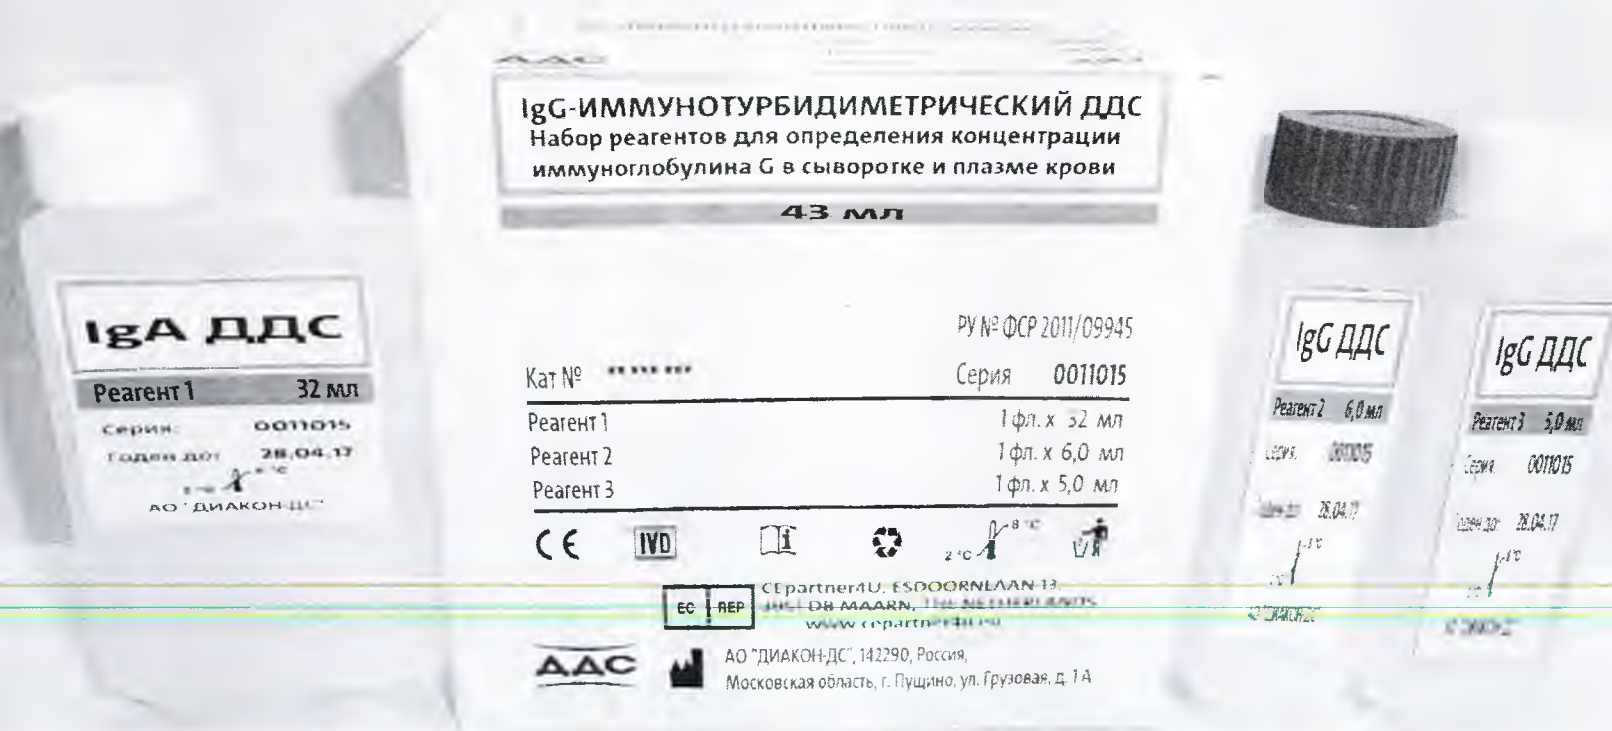


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови
(IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

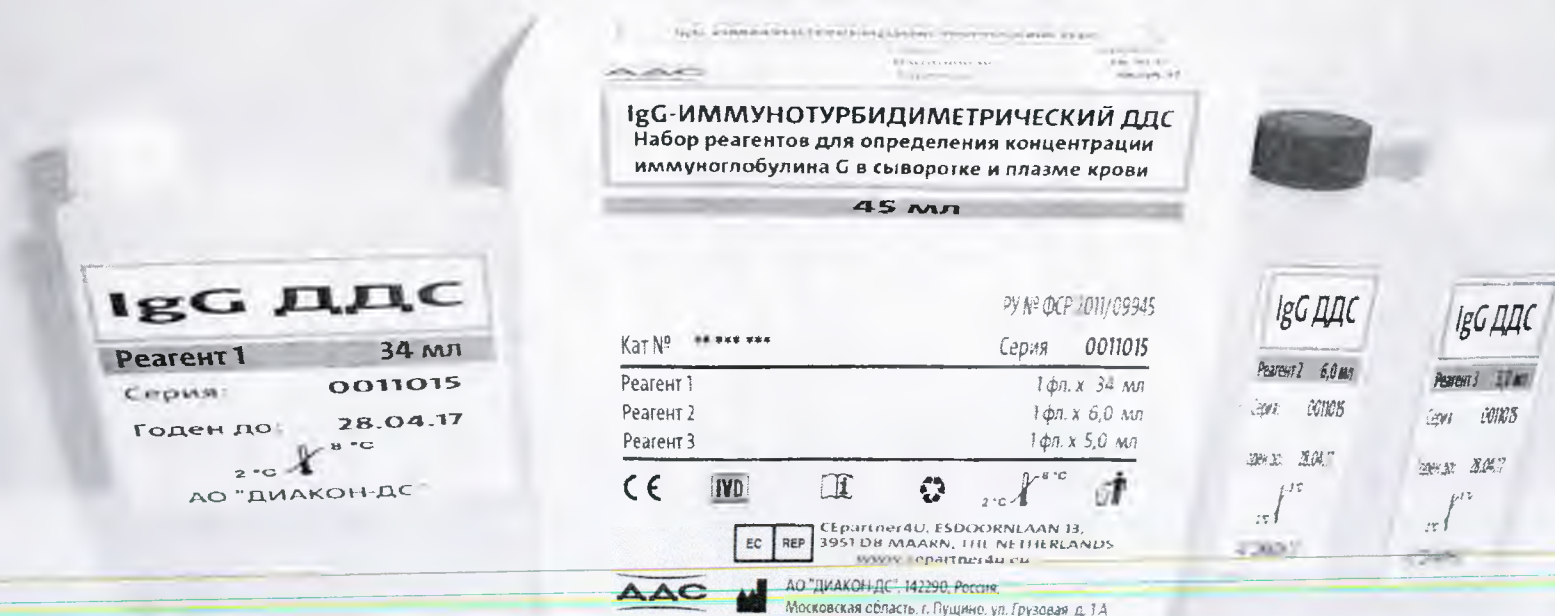

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

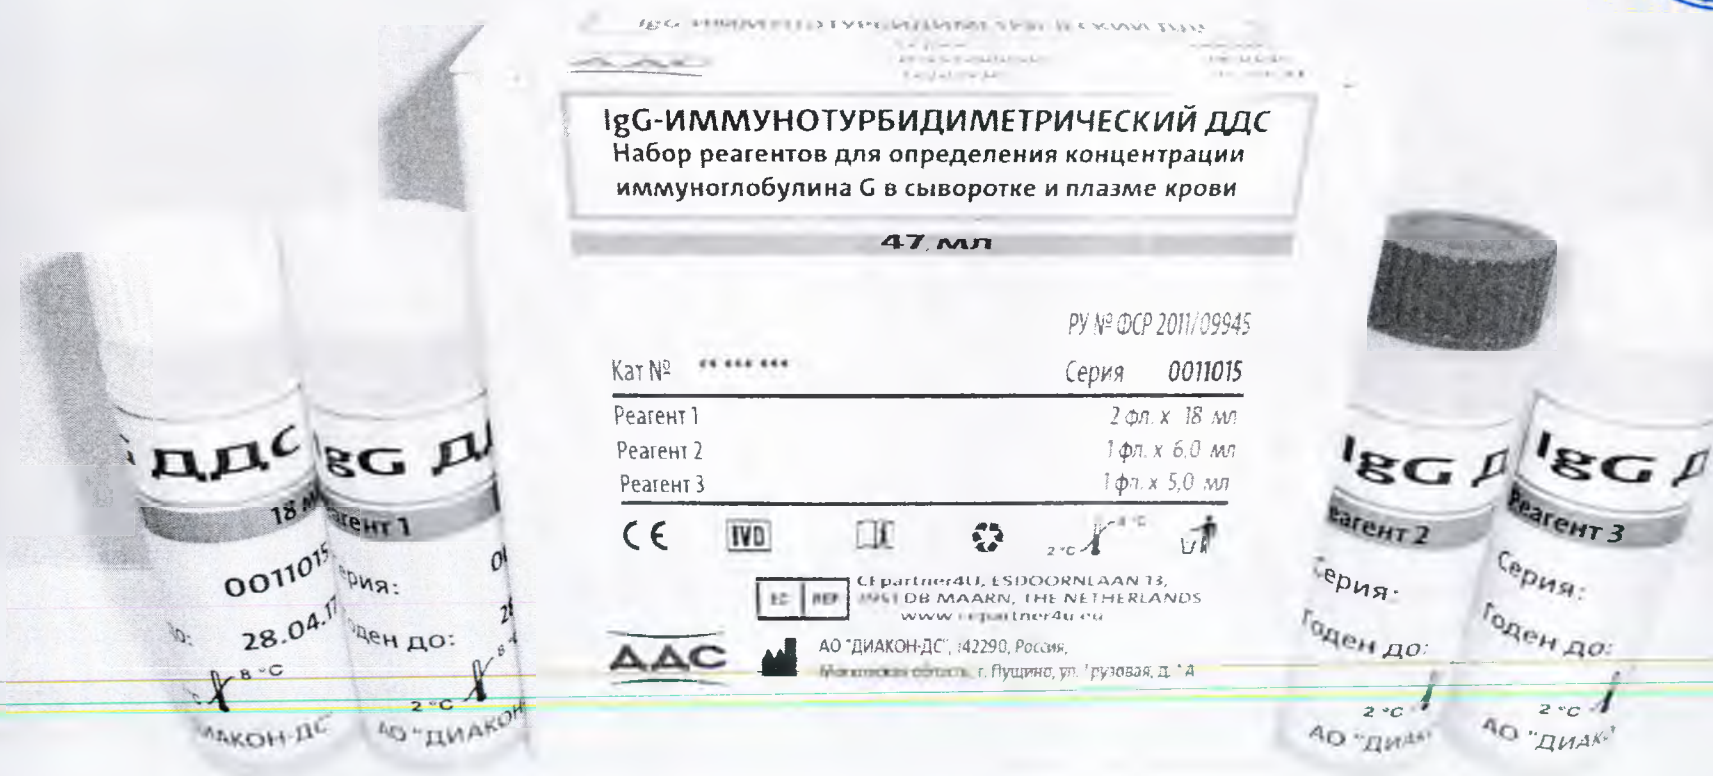


Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)



Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

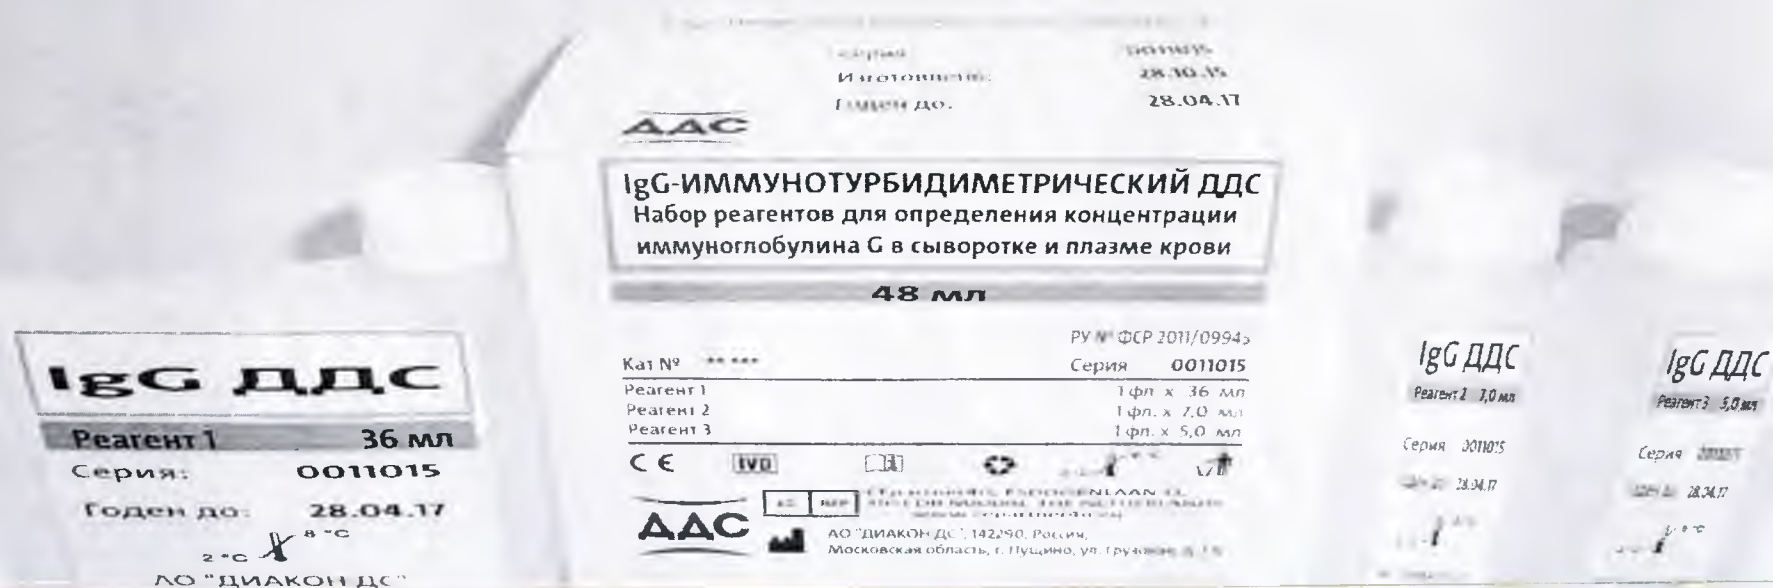

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)



ААС

IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС
Набор реагентов для определения концентрации
иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови

48 мл

РУ № ФСР 2011/09945

Кат № ****

Серия **0011015**

Реагент 1

2 фла. х 18 мл

Реагент 2

1 фла. х 1,0 мл

Реагент 3

1 фла. х 5,0 мл

CE

IVD


1

2

3

4

ААС



АО «ДИАКОН-ДС», 142290, Россия,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

IgG ДДС

Реагент 2 - 2,0 мл

Серия 0011015

Годен до: 28.04.17

IgG ДДС


Реагент 3 - 5,0 мл

Серия 0011015

Годен до: 28.04.17


Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

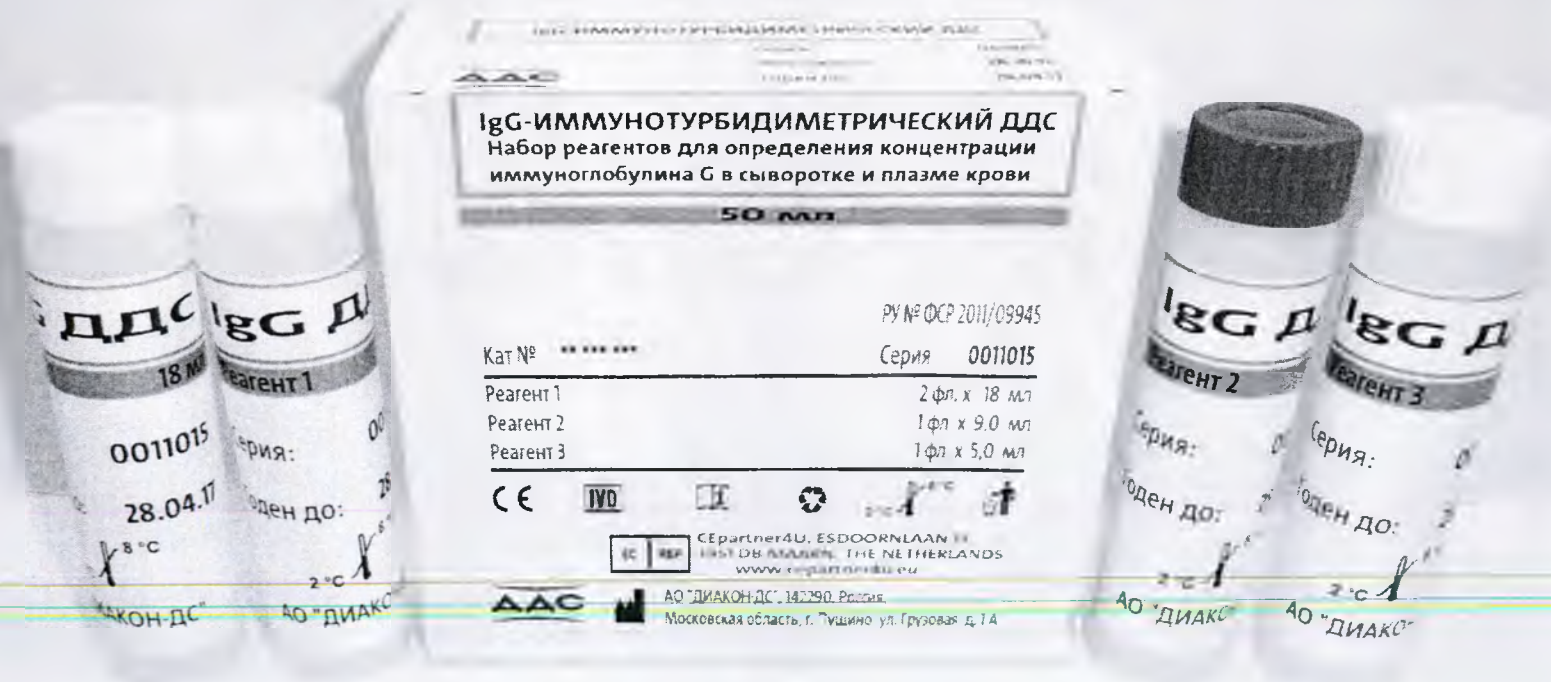



Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

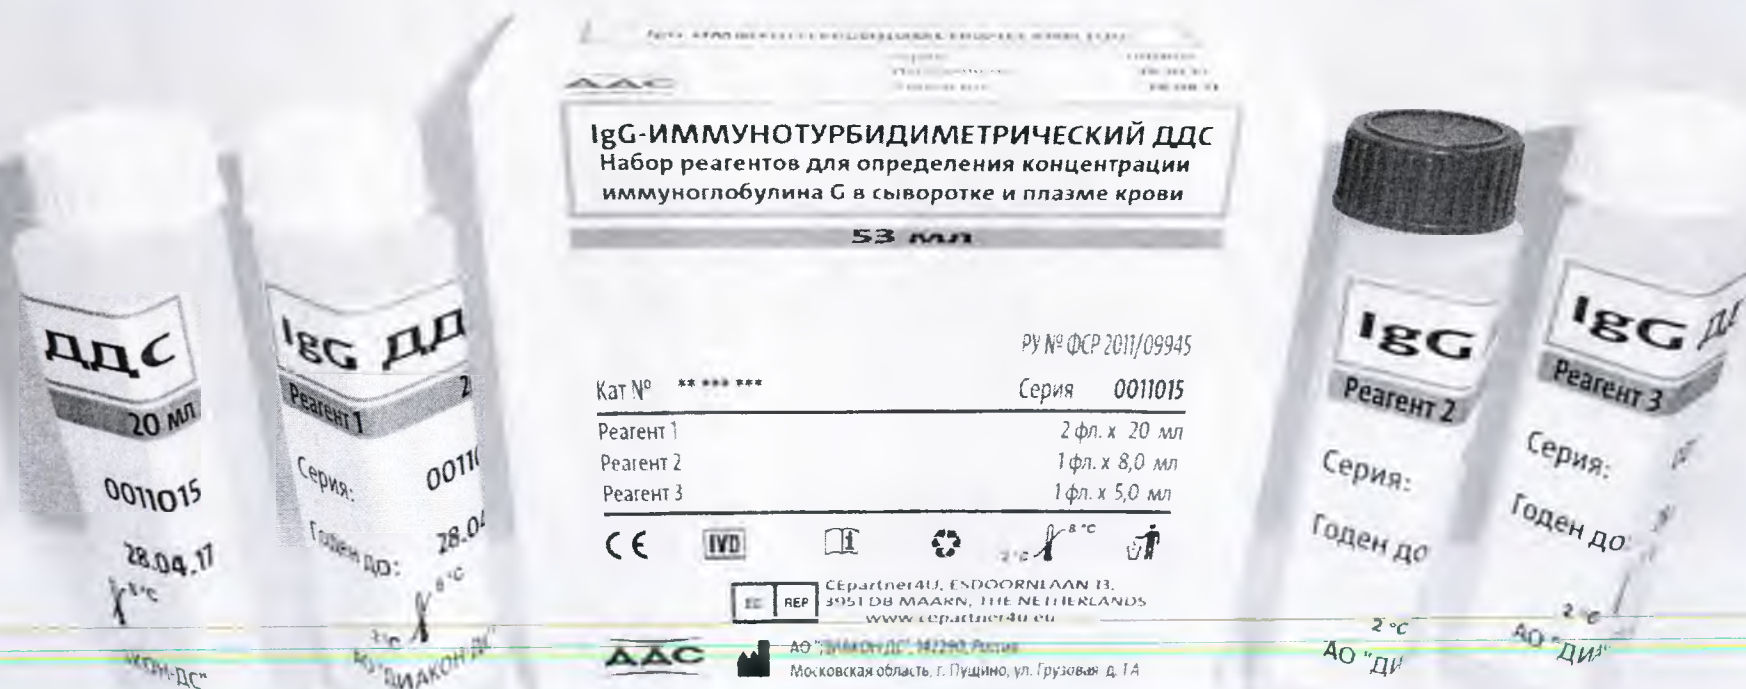

Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

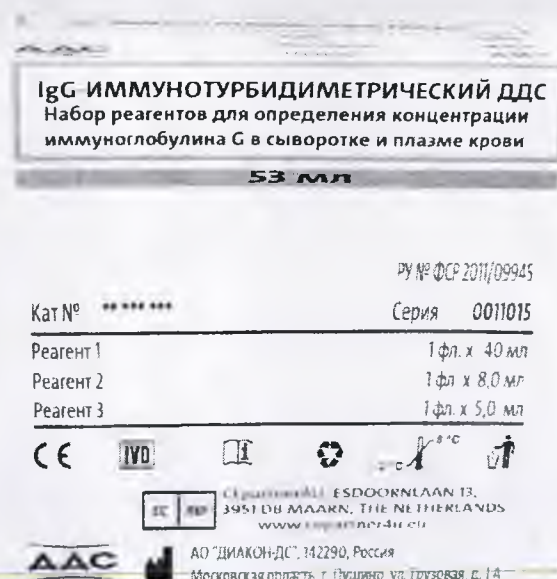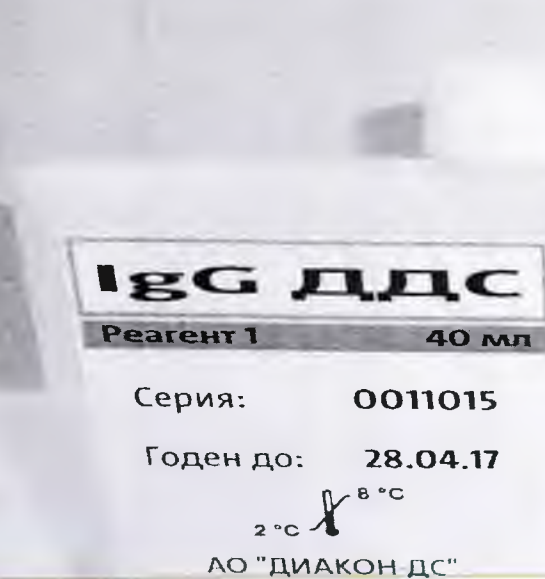


Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)



Внешний вид

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

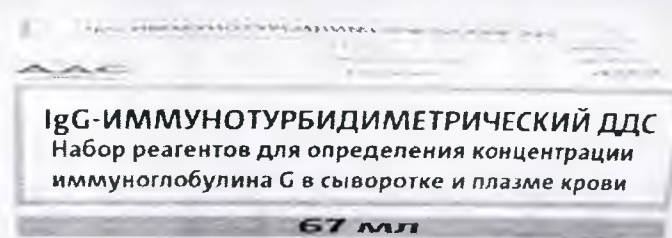

Кат № *****
 Реагент 1 2 фл. х 26 мл
 Реагент 2 2 фл. х 5,0 мл
 Реагент 3 1 фл. х 5,0 мл

РУ № ФСР 2011/09945


Серия 0011015

CE IVD II 2-3°C 10 min
 CEpartner4U, ESDOORN LAAN 13,
 3715 DB MAARN, THE NETHERLANDS
 www.cepartner4u.nl


АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
 Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая д. 1А




Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови
(IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

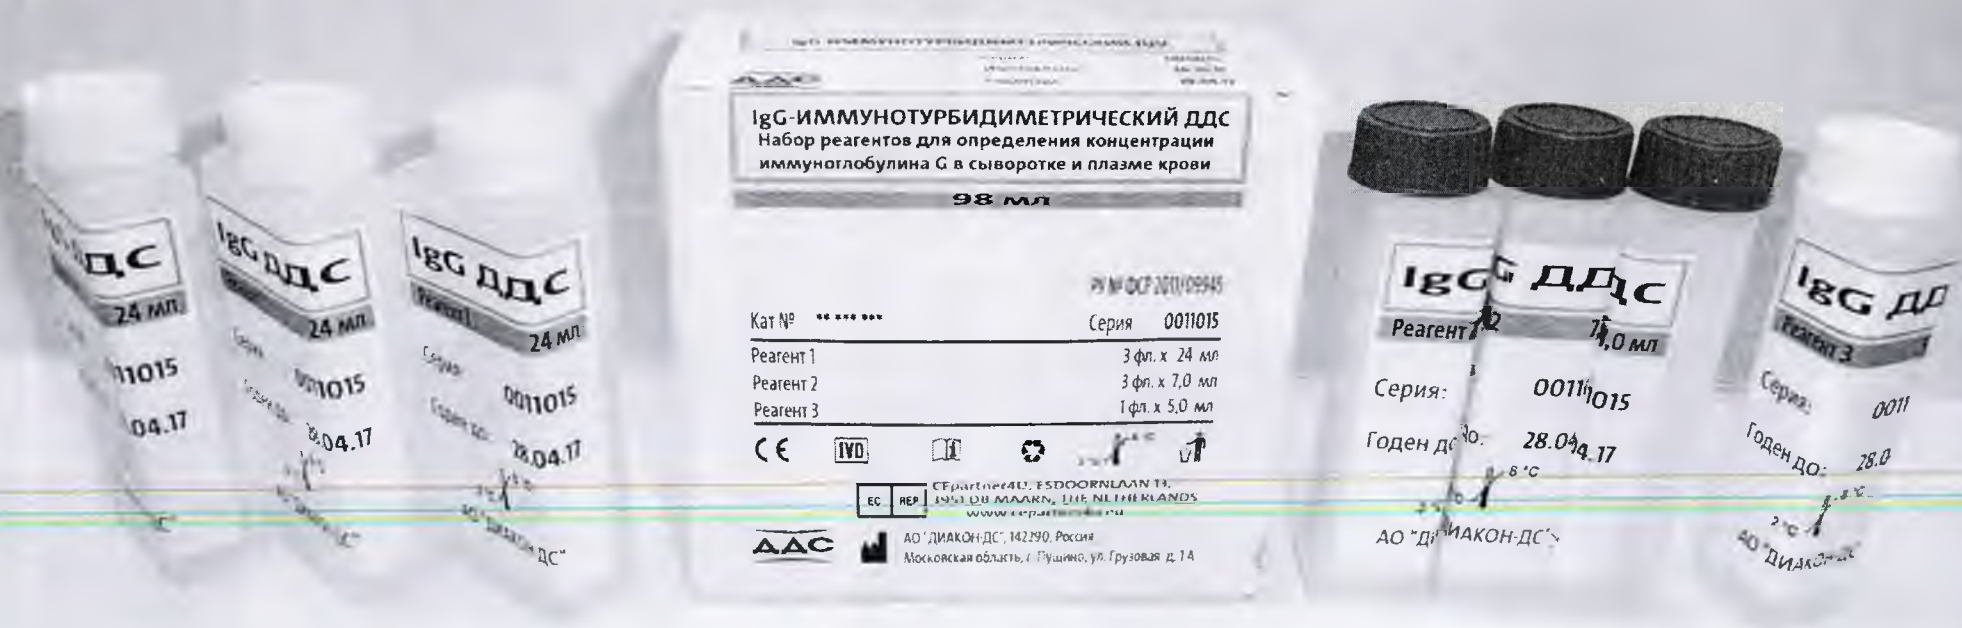

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

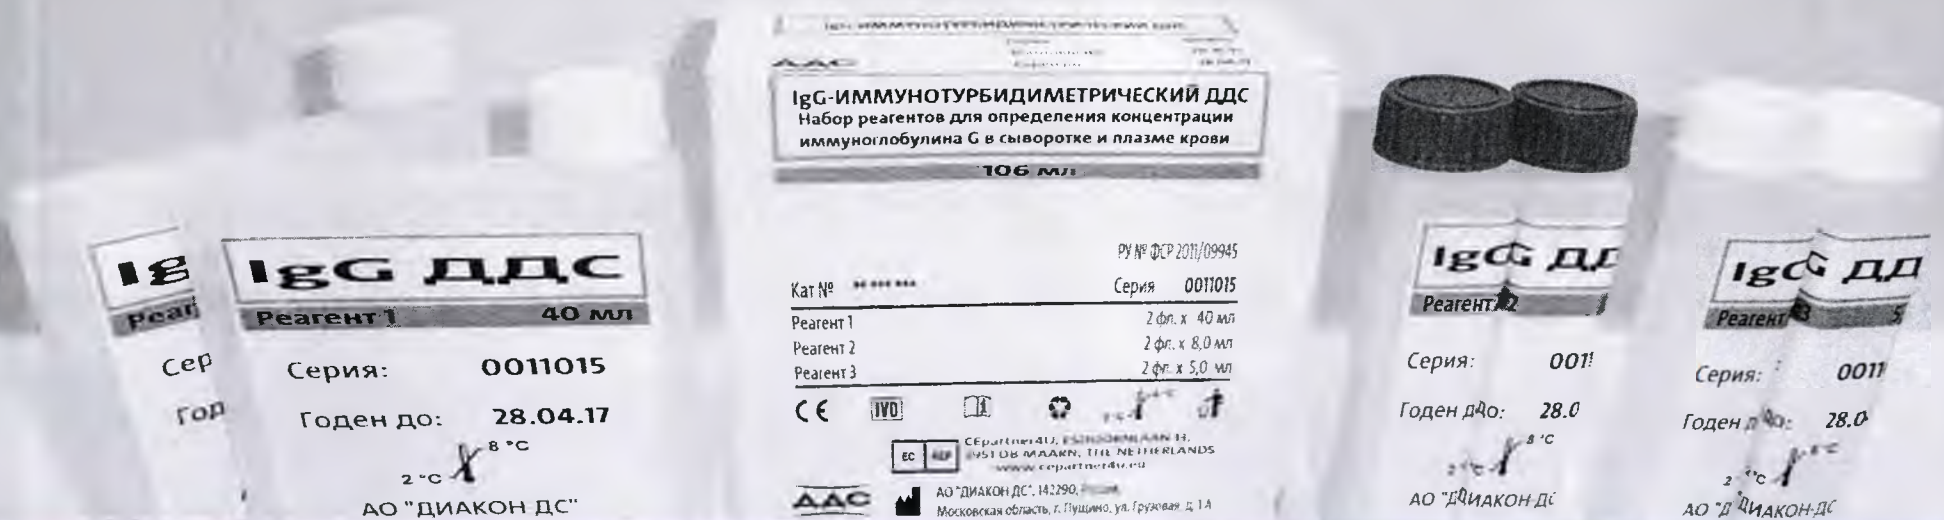

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

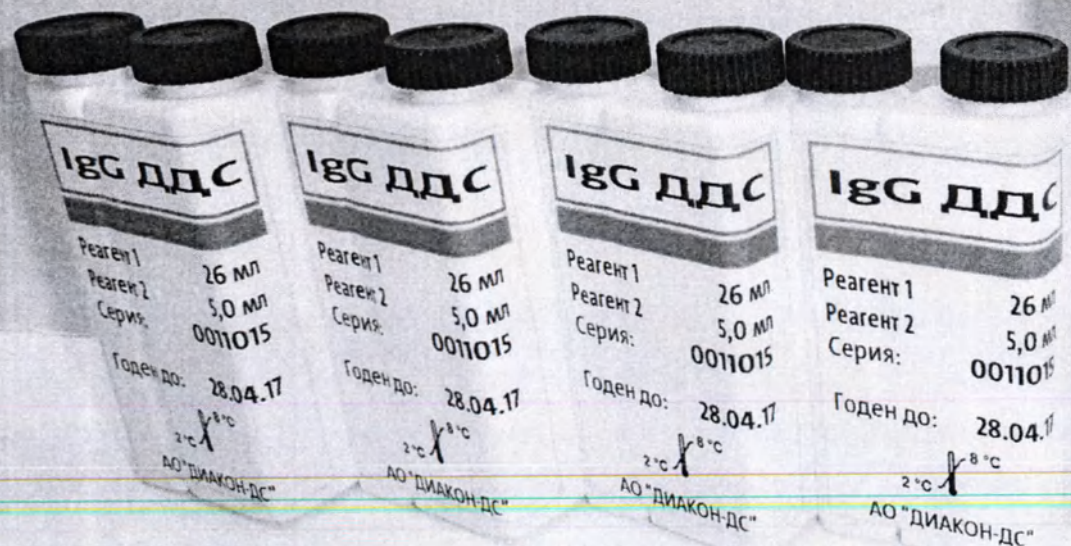

IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС
Набор реагентов для определения концентрации
иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови

134 мл

РУ № ФСР 2011/09945

Кат. №

Серия 0011015

Реагент 1	4 фл. х 26 мл
Реагент 2	4 фл. х 5,0 мл
Реагент 3	2 фл. х 5,0 мл


CE IVD

CEpartner4U, ISDOORN LAAN 13,
3951 DB MAAK, THE NETHERLANDS
www.cepartner4u.nl


АО «ДИАКОН-ДС» 142390 Россия
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А



Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови (IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

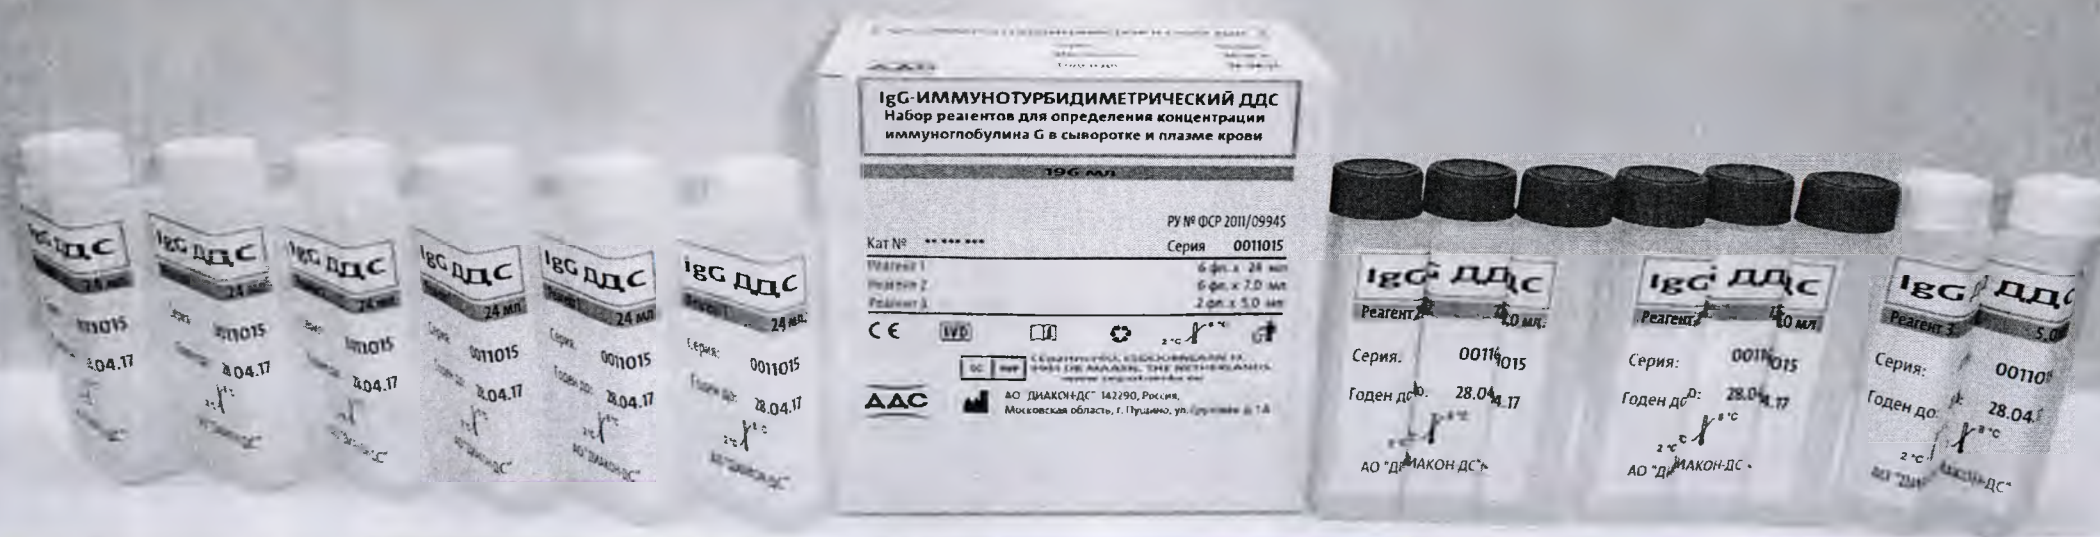

Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови
(IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)

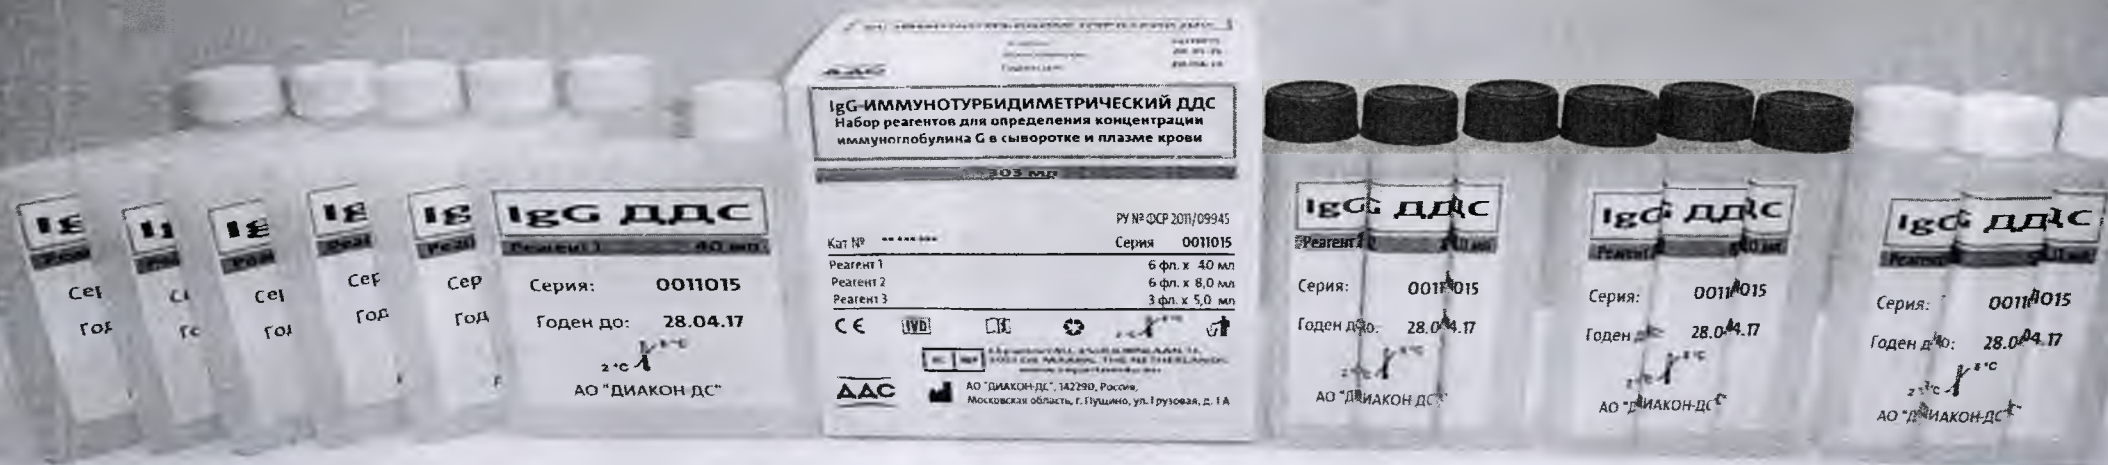


Внешний вид
Набора реагентов для определения концентрации иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови
(IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС)



IgG-ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ ДДС

Набор реагентов для определения концентрации
 иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови

Кат №	*****	РУ № ФСР 2011/09945
		Серия 0011015
Реагент 1		1 фл. х 800 мл
Реагент 2		1 фл. х 100 мл
Реагент 3		2 фл. х 100 мл



CE MARKING, ESTABLISHED IN
 1991 IN MAARN, THE NETHERLANDS.
 www.repro.nl



АО "ДИАКОН-ДС", 142290, Россия,
 Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

