

**Фотографические изображения медицинского изделия:
Аппарат лазерный ACTION II (Er:YAG) с принадлежностями**

ВНЕШНИЙ ВИД



LUTRONIC



0434

Product Name : Er:YAG Laser

Model Name : ACTION II

Laser Product Class : CLASS IV

Laser Wavelength : 2940nm

Electrical Shock Class : CLASS I, TYPE B

Electrical Rating : AC220-230V: __50/60Hz / 2.2kVA



2015



SN AT415G008



Manufacturer : Lutronic Corporation.

Lutronic Center, 219, Sowon-ro, Deogyang-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea

TEL : +82-31-908-3440 FAX: +82-31-907-3440

<http://www.lutronic.com>

MADE IN KOREA



Before operating the device, read the operator's manual.



EC Representative : Read the operator's manual.

**VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE
TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
CLASS IV LASER PRODUCT**

MAX. Er:YAG LASER POWER : 2.2J

PULSE DURATION : 200μs ~ 1.5s

MAX. AIMING LASER POWER @ 650nm < 5mW

I. Аппарат лазерный ACTION II (Er:YAG), в составе:



1. Основной блок системы – 1 шт.
2. Манипулятор шарнирный с противовесом – 1 шт.




3. Педаль управления ножная – 1 шт.



4. Сетевой кабель – 1 шт.


II . Принадлежности:

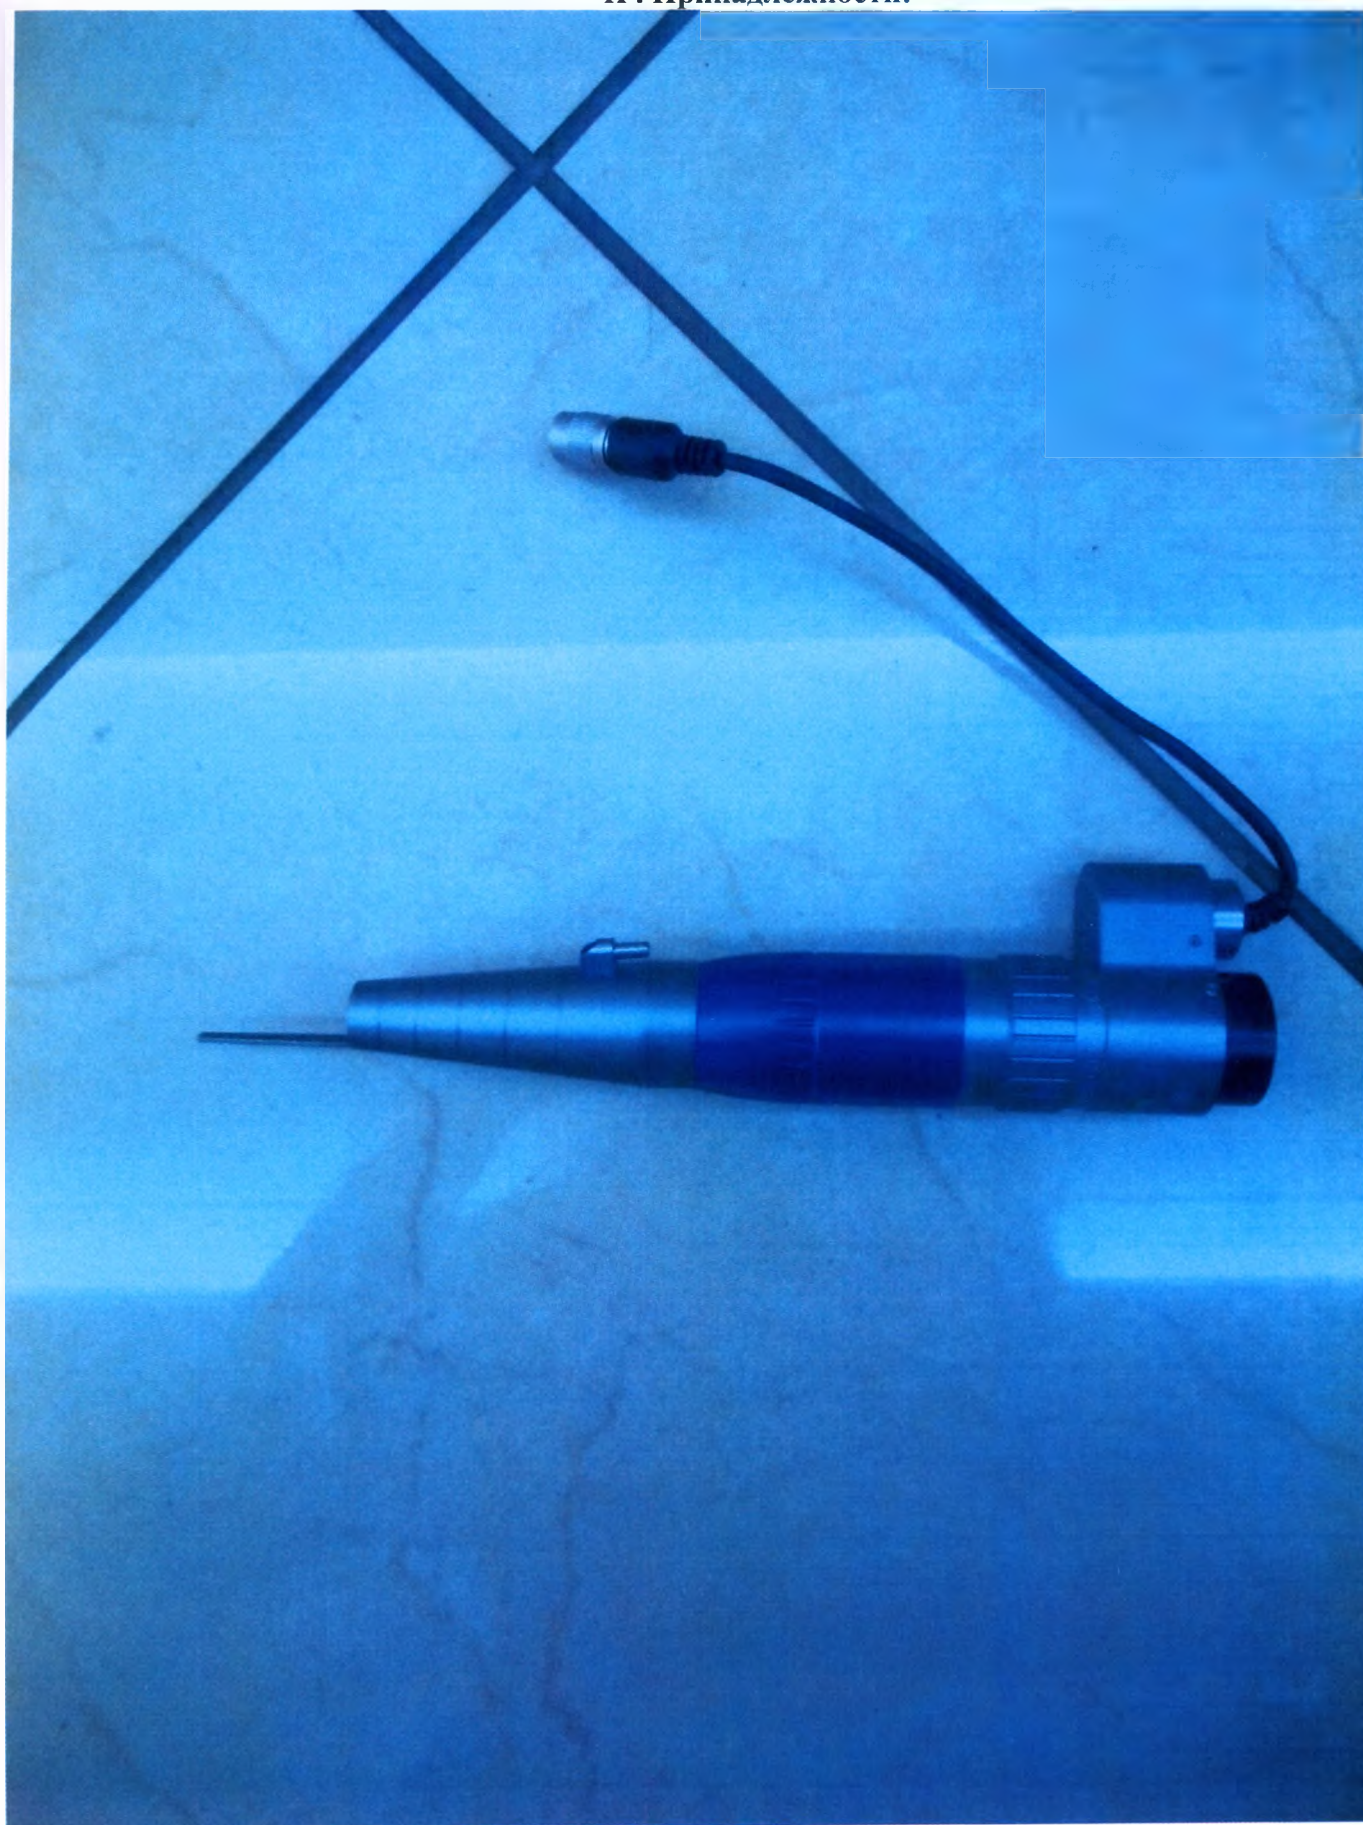

1. Манипула 1-7 мм Zoom – 1 шт.



2. Манипула «Шайнинг Пил» – 1 шт.

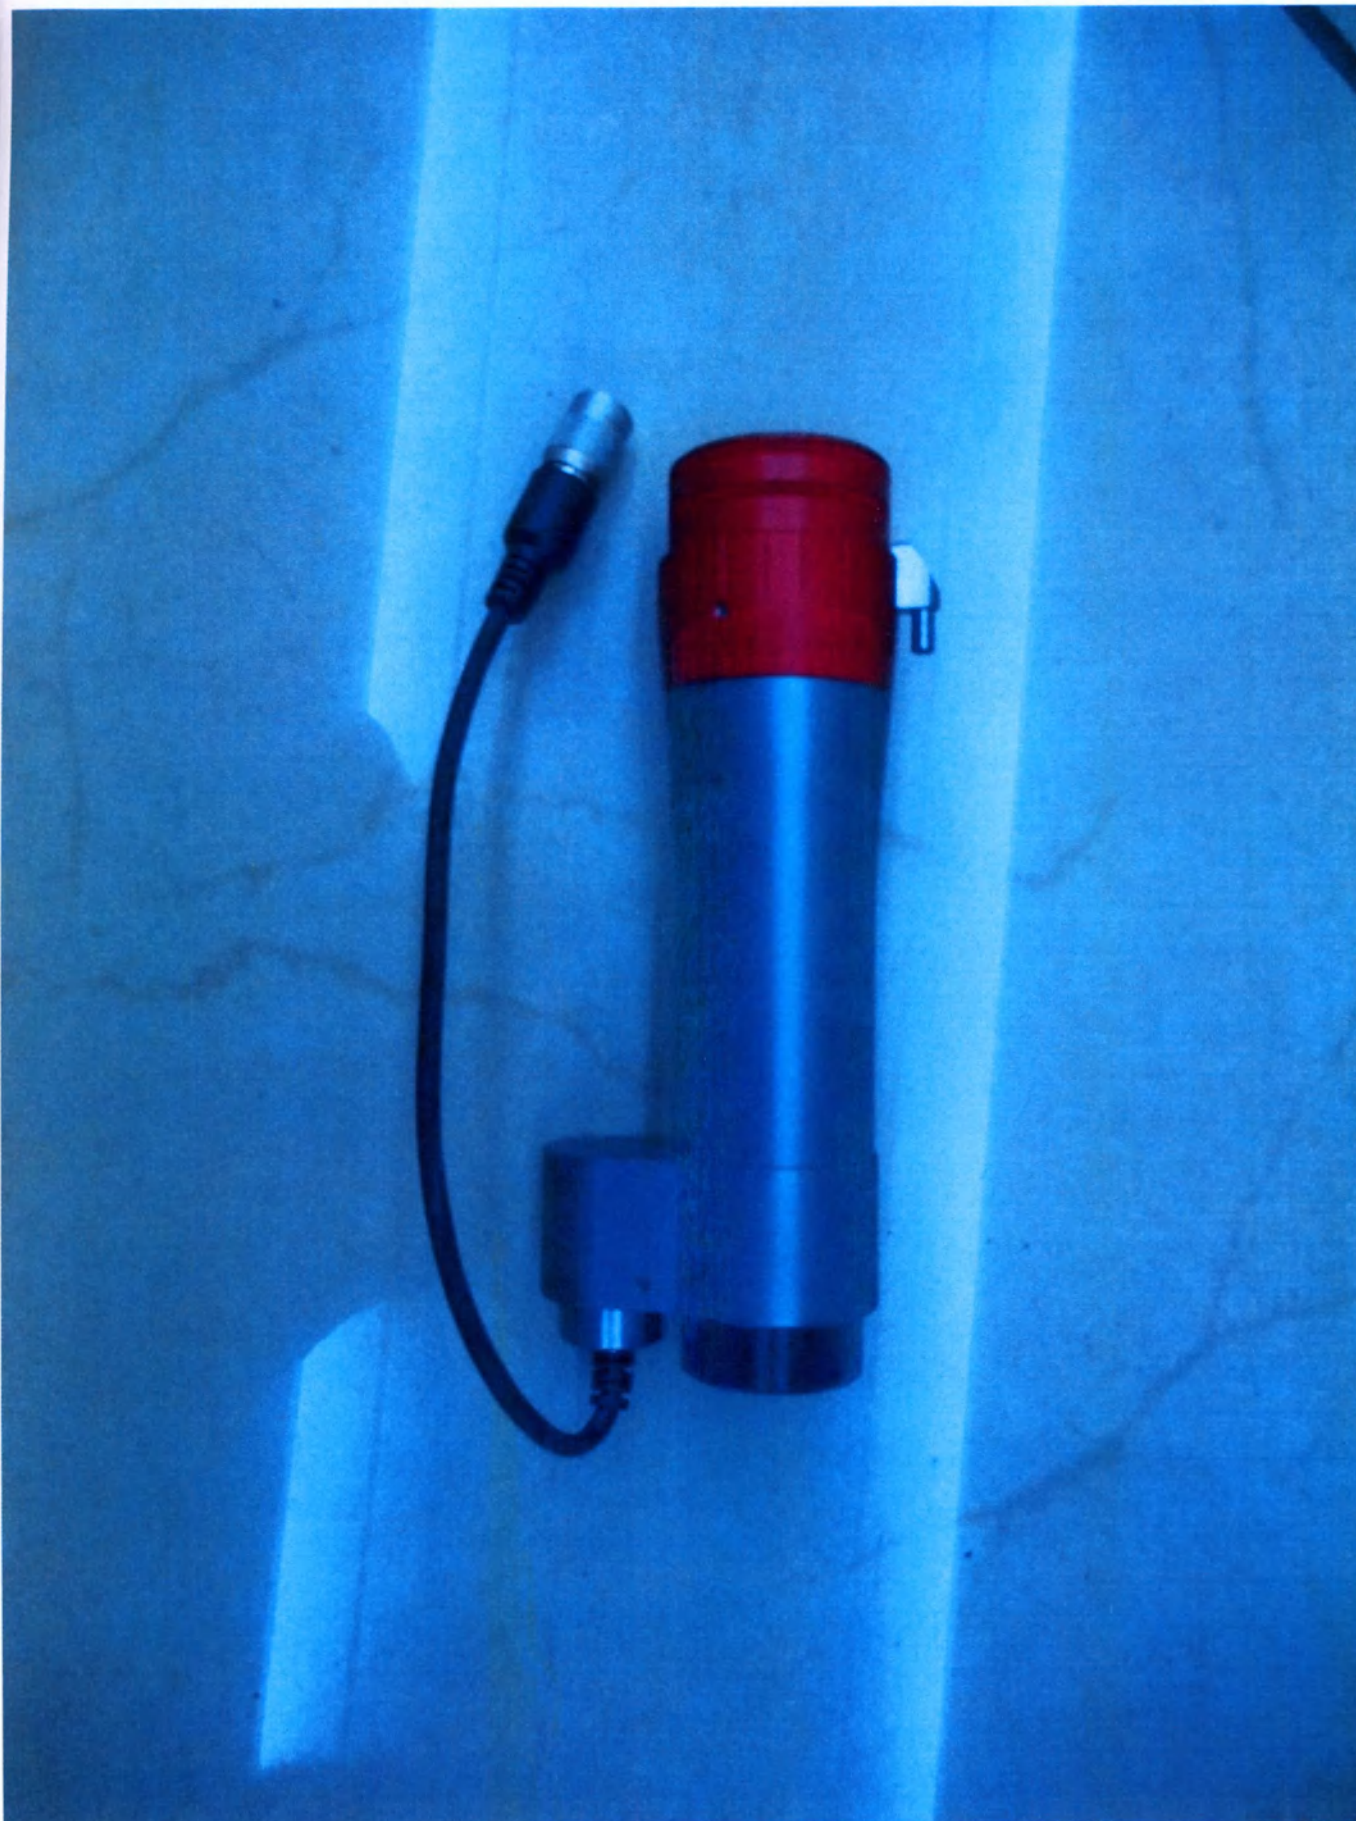

3. Манипула фракционная – 1 шт.



4. Наконечник для фракционной манипулы 9x9 мм – 1 шт.



5. Наконечник для фракционной манипулы 6х6 мм – 1 шт.



6. Наконечник для фракционной манипулы диаметр 12 мм – 1 шт.



7. Манипула «Petit 90°» – 1 шт.



8. Манипула «Petit 360'» – 1 шт.



9. Направляющая для манипул «Petit 90'» и «Petit 360'» – не более 4 шт.



10. Рефлектор для манипулы «Petit 90'» – не более 5 шт.



11. Рефлектор для манипулы «Petit 360'» - не более 5 шт.




12. Переходник для манипул «Petit 90'» и «Petit 360'» – не более 2 шт.



13. Кейс (коробка) для насадок и излучателей – не более 4 шт.



14. Ключ запуска – 2 шт.

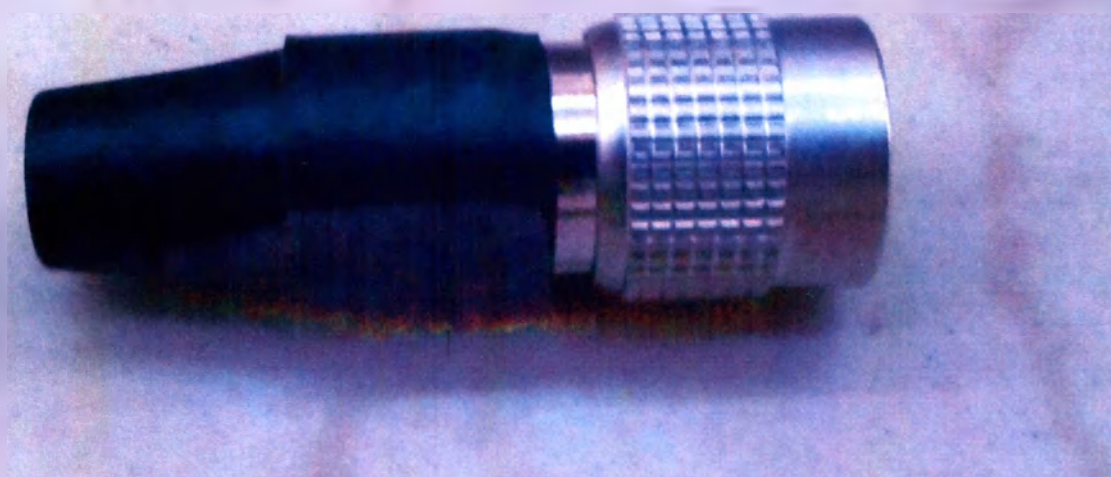

15. Блокиратор дистанционный – 1 шт.




16. Крепёжные винты для манипулятора – 3 шт.



17. Предохранитель – 2 шт.



18. Очки защитные для врача – не более 4 шт.

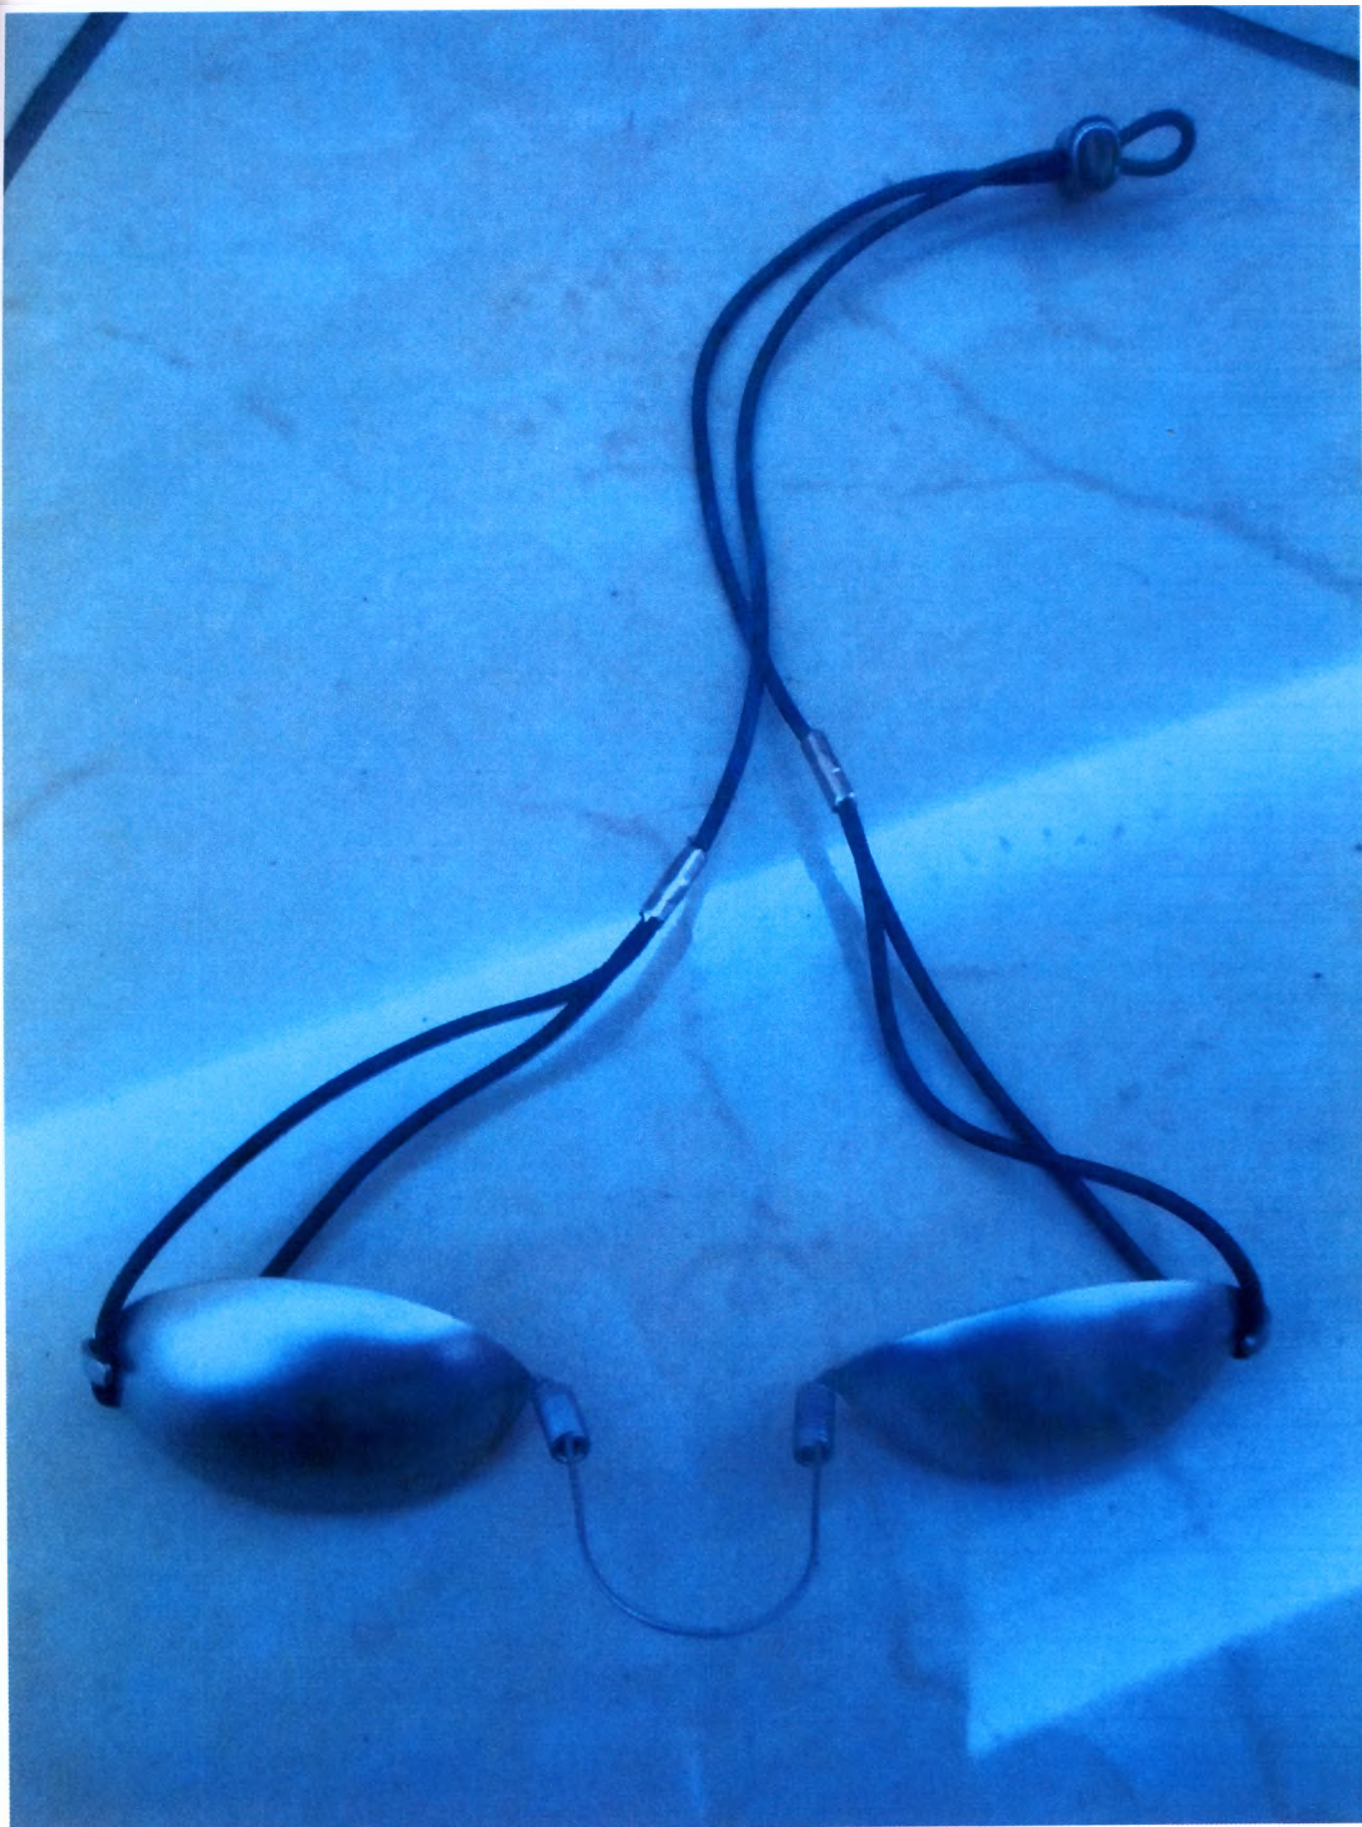

19. Очки защитные металлические для пациента – не более 2 шт.



20. Набор для замены воды в системе охлаждения:
- воронка – 1 шт.
 - трубки – 2 шт.



23. Знак предупреждения об опасности лазерного излучения (для внешней стороны двери процедурного кабинета) – не более 2 шт.

В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

27 (двадцать семь) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Лутроник центр»

Золотарев А. А.

