


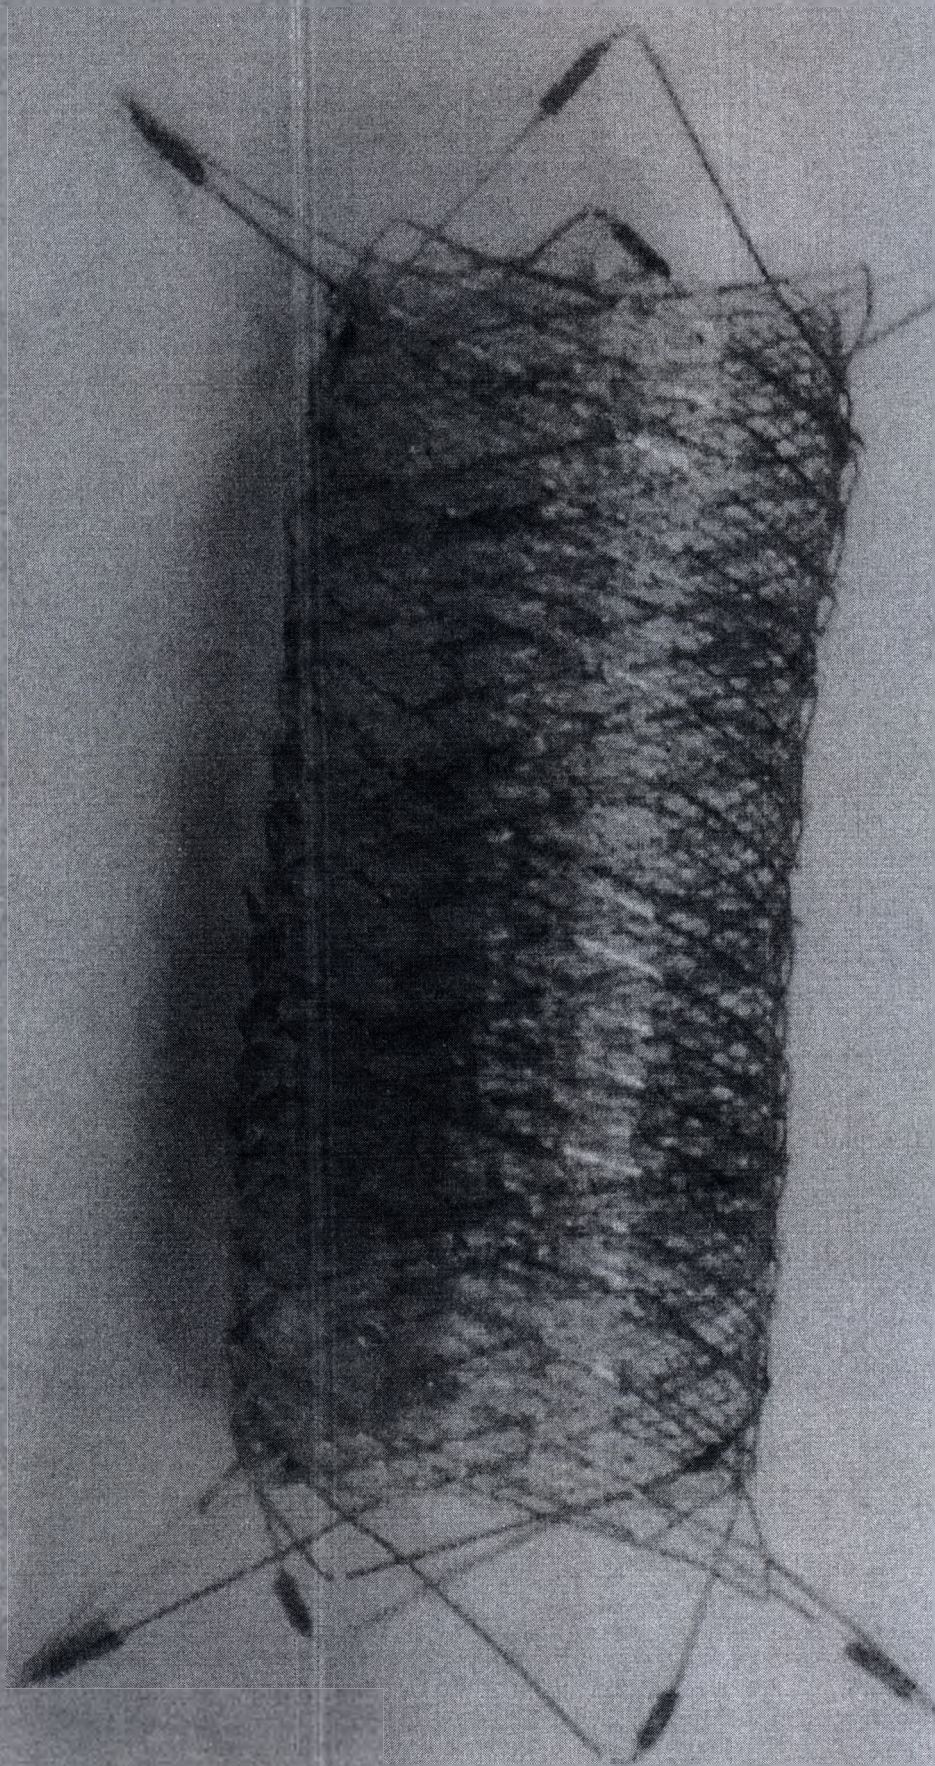

В 1
с
л
-
срел / Указание о месте
по мере необходимости

FRED

Flow Re-Direction Endoluminal Device

Dispositif endoluminal de redirection du flux
Endoluminalprethaus mit Flussumleitung
Dispositivo endoluminal de redireccion de flujo
Dispositivo endoluminal de redireccionamento do fluxo
Dispositivo Endoluminal di Redirectionamento do Fluxo
Endoluminal anordning til omdirigering af blod
Endoluminalanordning til omdirigering af blod
Endoluminalanordning til omdirigering af blod
Endoluminalanordning til omdirigering af blod
Endoluminalanordning til omdirigering af blod
Endoluminalanordning til omdirigering af blod

Endoluminal anordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod
Endoluminalanordning for omdirigering af blod

Arterialisieringsmodul endoluminal eszköz
Pijavica modularisierings endoluminal eszköz
Endoluminalanordning für Arterialisierung
Włocznica modułowa endoluminalna do przepływu
Dispositiv endoluminal pentru redirecționare
Dispositiv endoluminal pentru redirecționare
Dispositiv endoluminal pentru redirecționare
Dispositiv endoluminal pentru redirecționare
Dispositiv endoluminal pentru redirecționare
Dispositiv endoluminal pentru redirecționare
Dispositiv endoluminal pentru redirecționare


Flow Re-Direction

OD 5.0 mm	TL 21 mm	WL 14 mm
---------------------	--------------------	--------------------

Headway® 27
Microcatheter Compatible:
0.027 inch (0.69 mm)

REF Catalog Number
FRED5015

LOT Lot Number
13091627

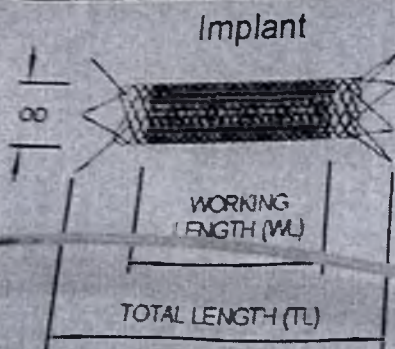


OD (mm)	TL (mm)	WL (mm)	
4.5	26	20	Min
5.0	21	14	Max

ED2011-002

FRED

Flow Re-Direction Endoluminal Device



Non-Pyrogenic Non pyrogène Pyrogenfrei Apyrogeno Apyrogeno NÃO-pirógeno	Non-pyrogen Pyrogenfrei Pyrogenfrei Icke-pyrogen Icke-pyrogen Mij. nupirogennos	Pyrogenik Degildir Pyrogenik Degildir Pyrogenik Degildir Pyrogenik Degildir Pyrogenik Degildir Pyrogenik Degildir	Mitepyrogen Nem pirogen Apyrogen Nepirogenisk Apyrogen Apyrogen
--	--	--	--

MicroVention, Inc.
1311 Valencia Avenue
Tustin, CA 92780 USA
PH: 714 247 8000
www.microvention.com

CE 0297

EC REP MicroVention Europe
30 bis, rue du Vieil Abreuvoir
78100 Saint-Germain-en-Laye
France

STERILE
Sterilized Usi

FOR EXPORT ONLY Rx-ONLY

Date of
Manufacture

2013-09

Use f

AW11005 Rev. A 2011-10 (LB11082)

5.0 mm | 21 mm | 14 mm

Рис. 3. Схема устройства эндолуминального устройства (система доставки)

схема устройства эндолуминального устройства

FLOW RE-DIRECTION

OD

5.0 mm

TL

21 mm

WL

14 mm

Headway® 27
Microcatheter Compatible:
0.027 inch (0.69 mm)

REF


Catalog Number
FRED5015

LOT

Lot Number
13091627

Non-Pyrogenic
Non pyrogène
Pyrogenfrei
Apirogeno
Apirogeno
Não-pirog

Implant

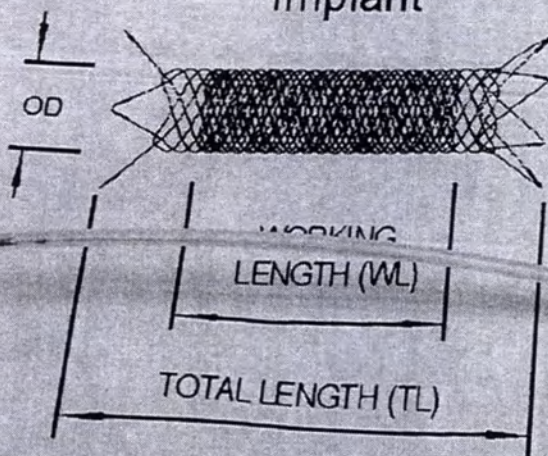

OD
(mm)

TL
(mm)

WL
(mm)

4.5

26

20

Min

5.0

21


14

Max


ED2011-002


FRED™

Flow Re-Direction Endoluminal Device

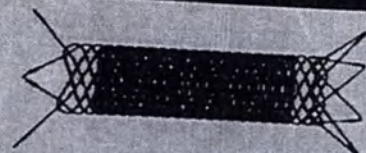

интервальный график



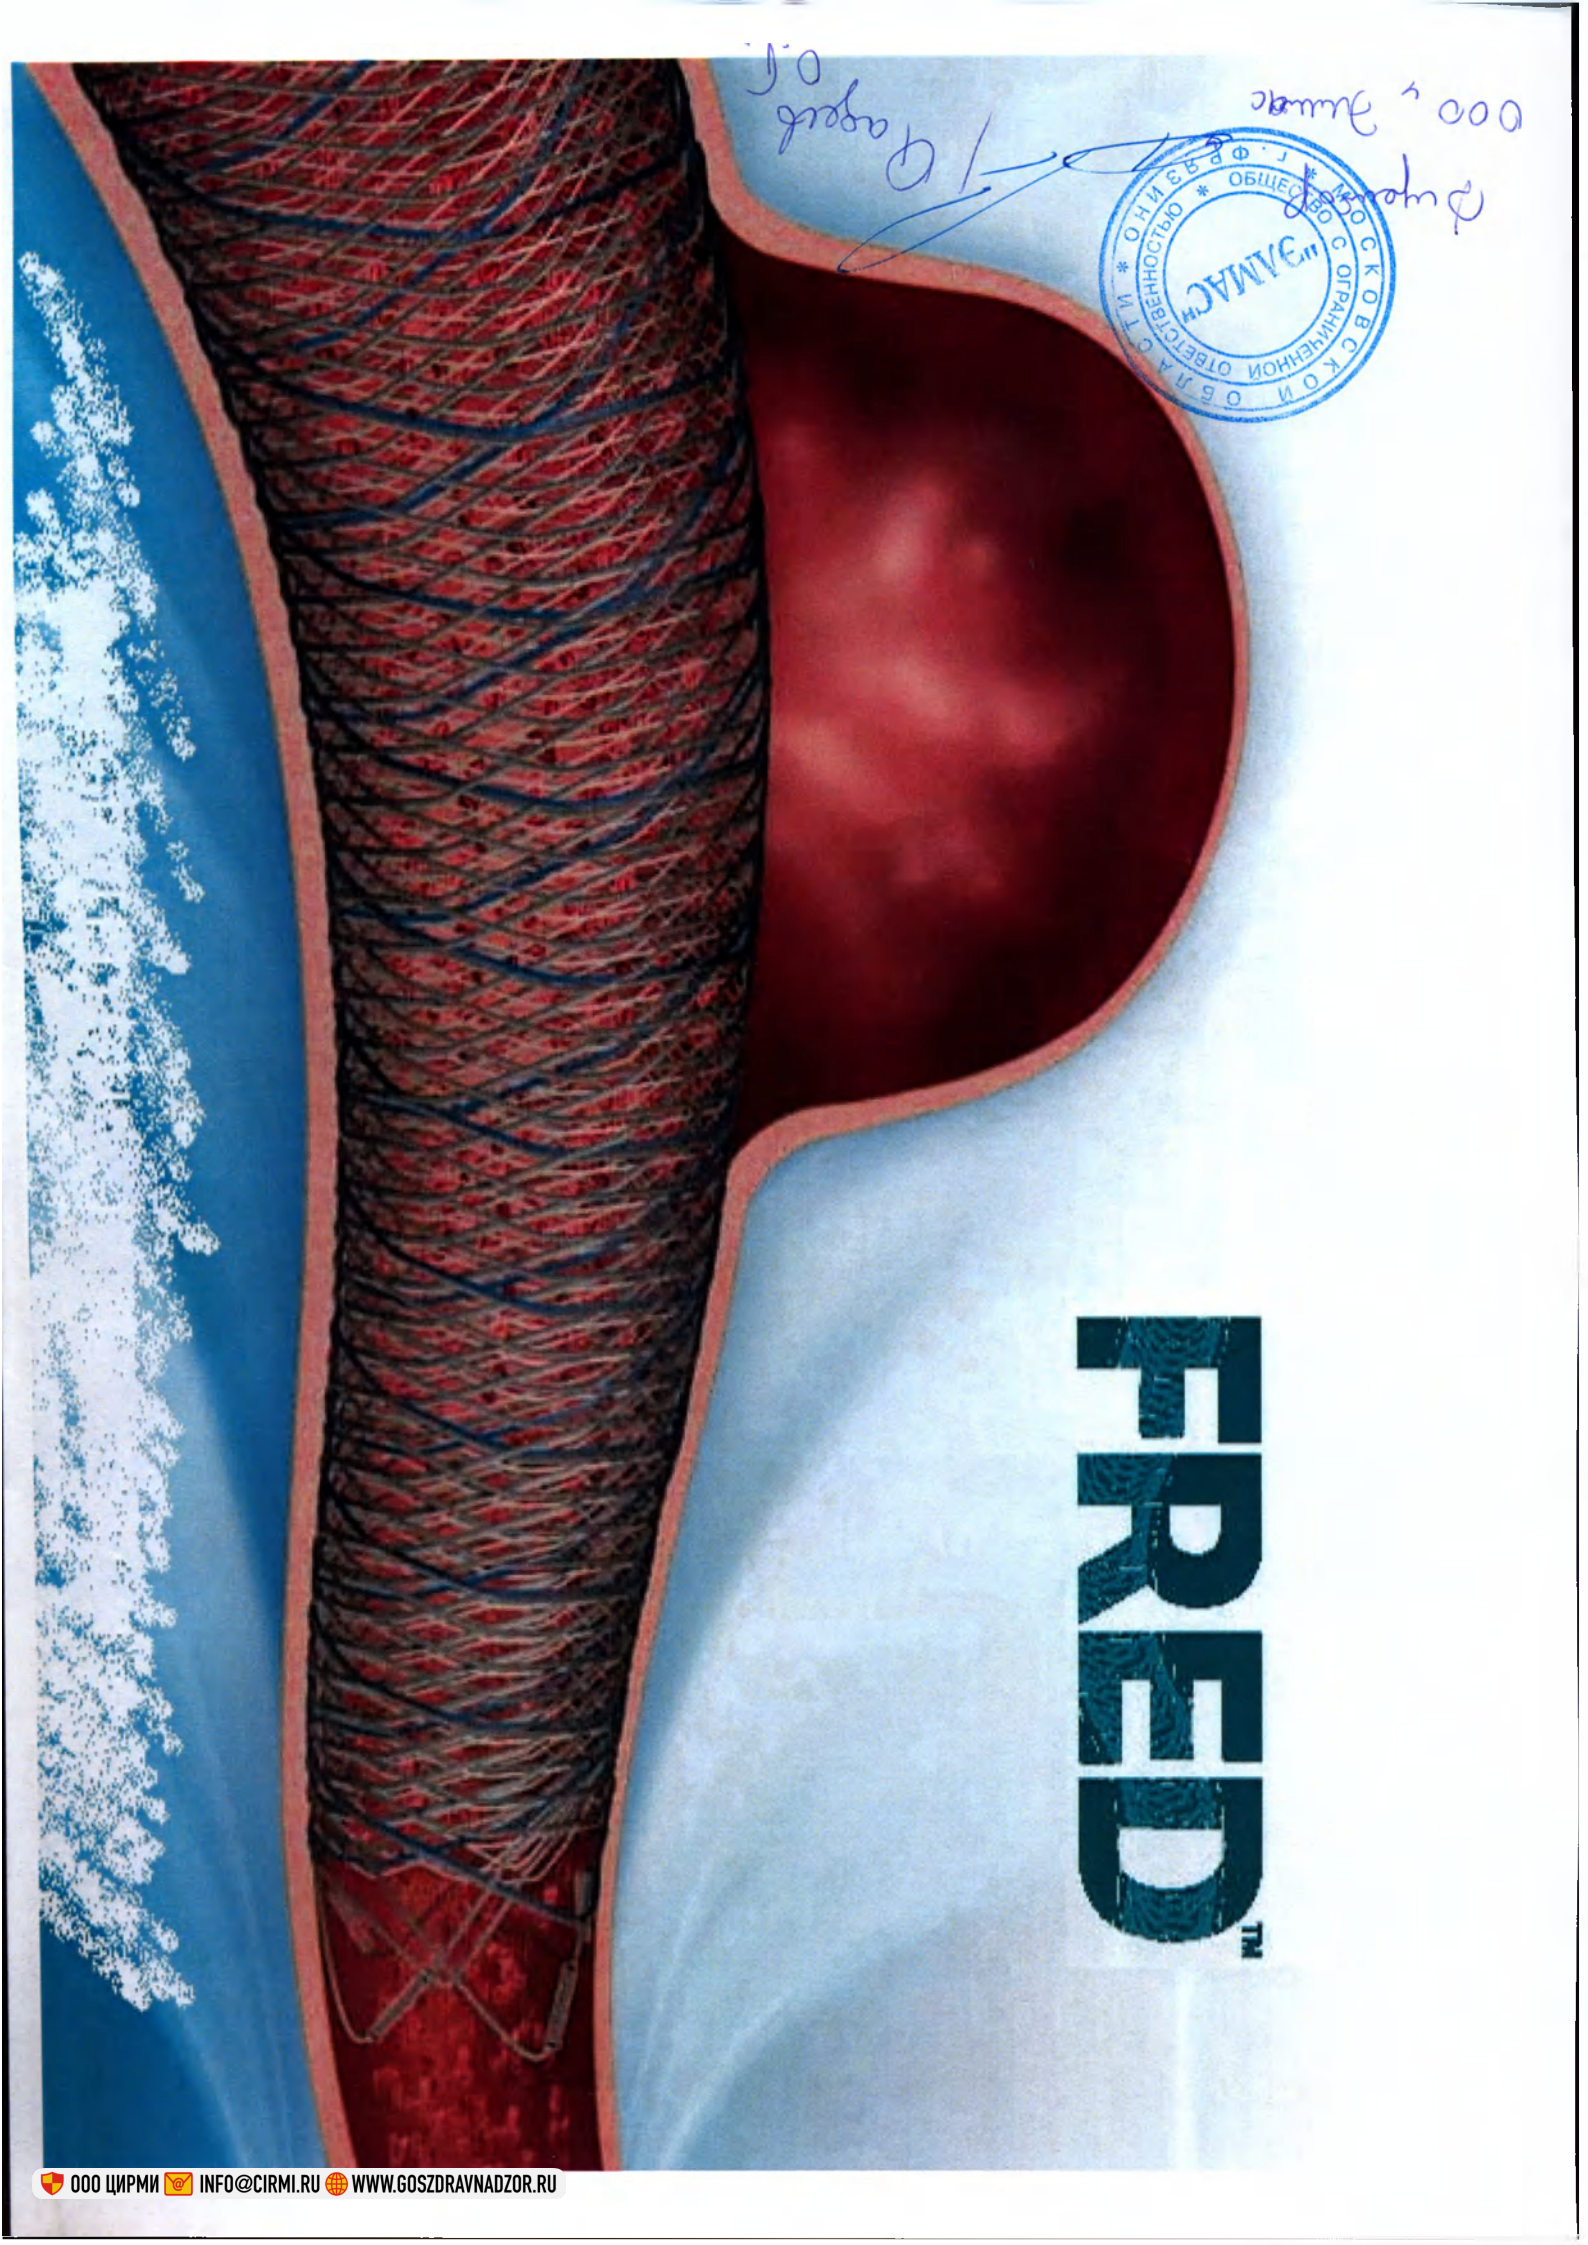

FRED™



19 April 05
000, ЭМАС