


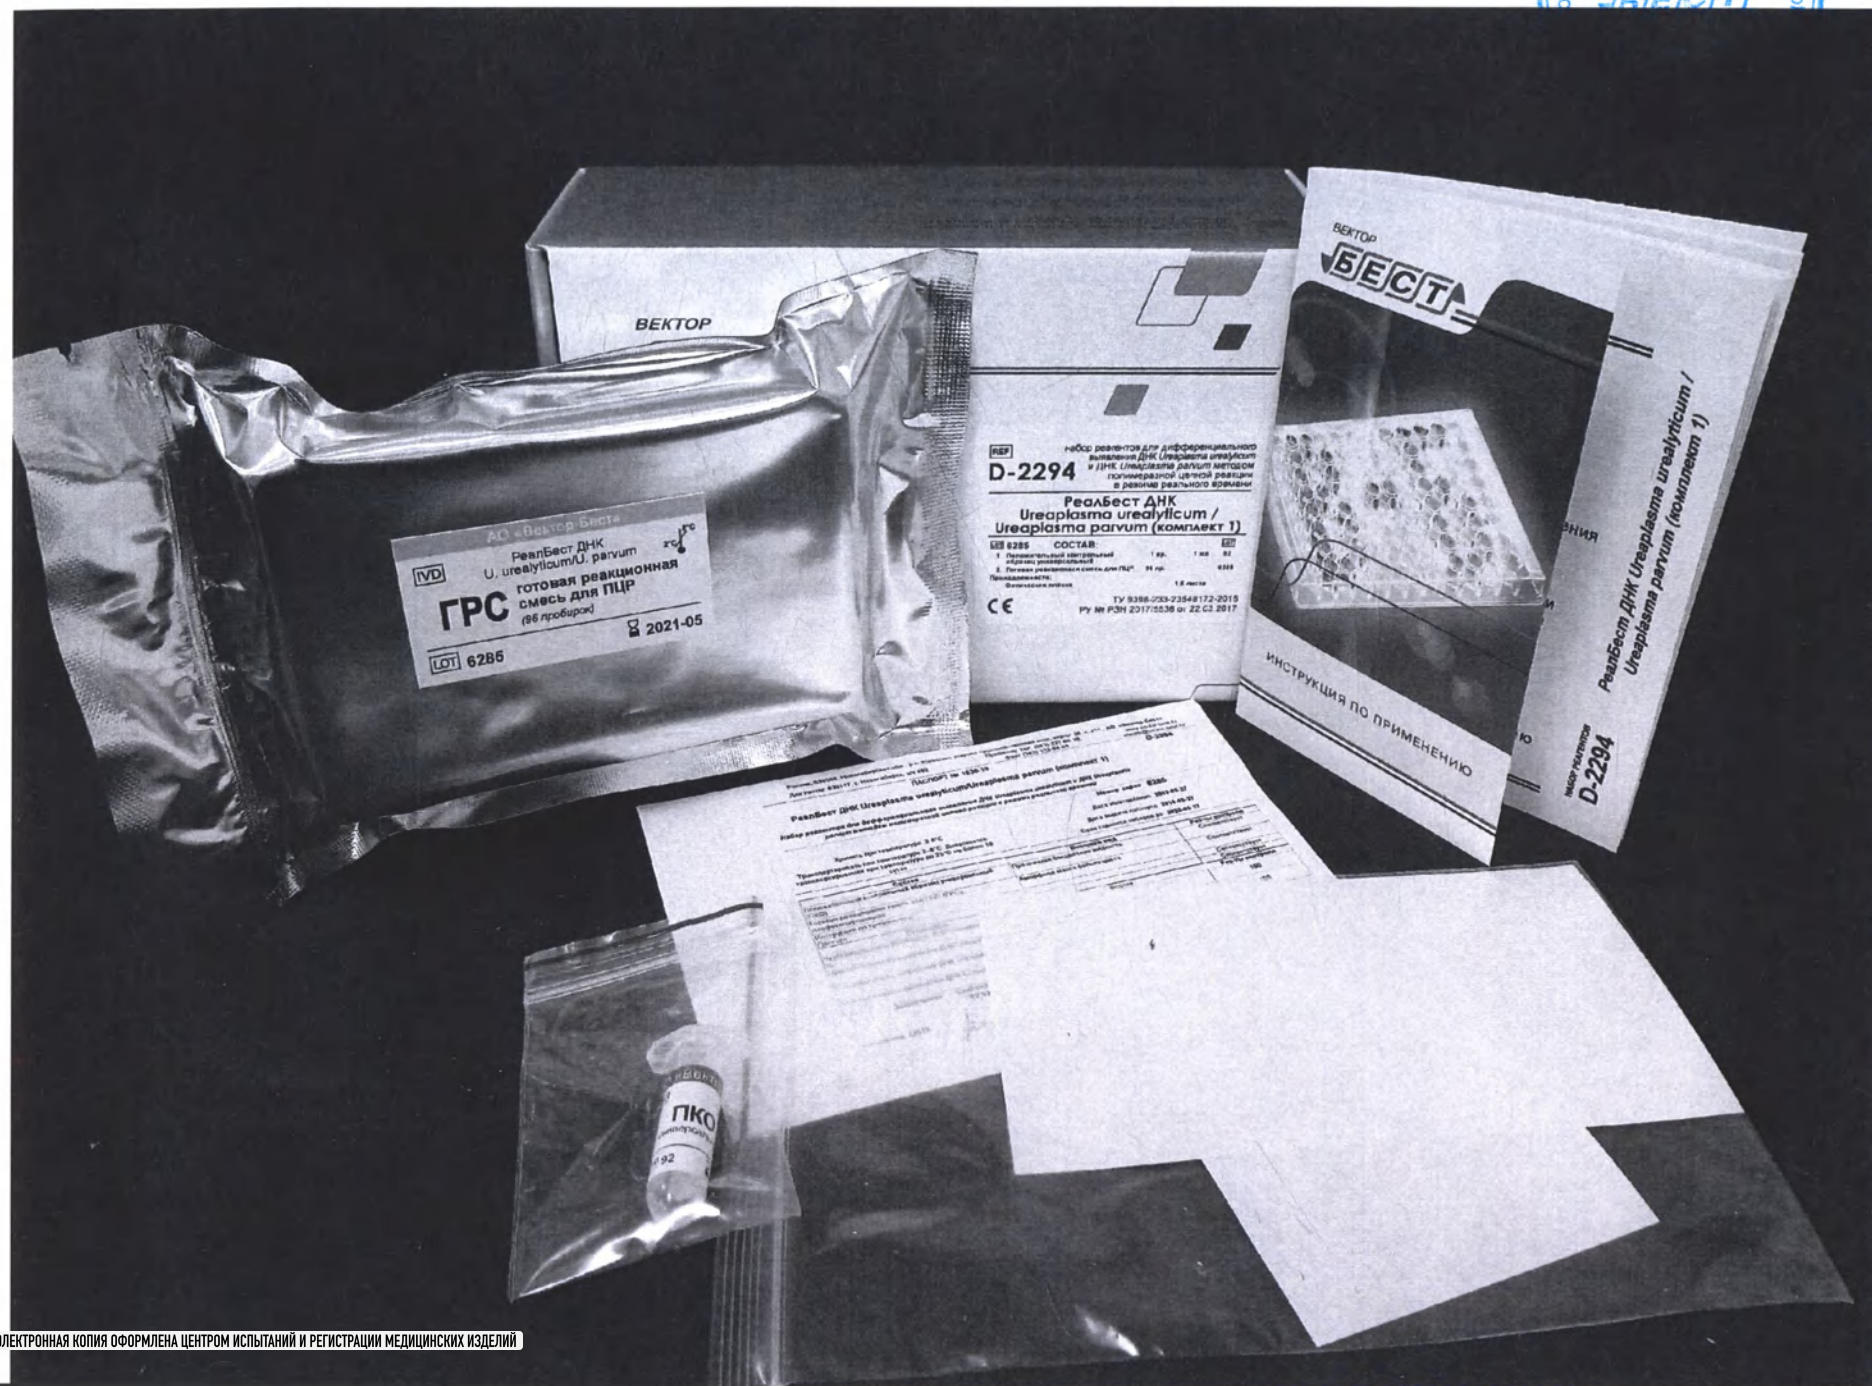

ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-2294

набор реагентов для дифференциального
выявления ДНК *Ureaplasma urealyticum*
и ДНК *Ureaplasma parvum* методом
полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК
***Ureaplasma urealyticum* /**
***Ureaplasma parvum* (комплект 1)**

LOT 6285

СОСТАВ:

LOT

- | | | | |
|--|--------|------|------|
| 1. Положительный контрольный образец универсальный | 1 пр. | 1 мл | 92 |
| 2. Готовая реакционная смесь для ПЦР | 96 пр. | | 6285 |

Принадлежности:

Оптическая плёнка

1,5 листа

CE

ТУ 9398-233-23548172-2015
ПУ № РЗН 2017/5538 от 22.03.2017




ВЕКТОР

БЕСТ


REF **D-2294**

LOT **6285**



IVD

Σ 96



2019-05-27

2020-05-27

РеалБест ДНК
Ureaplasma urealyticum /
Ureaplasma parvum (комплект 1)



22942705200628501113



Для профессионального применения

АО «Вектор-Бест»

IVD

РеалБест ДНК
U. urealyticum/U. parvum

2°C
8°C

ГРС

готовая реакционная
смесь для ПЦР
(96 пробирок)

LOT

6285





2021-05



Фотическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для дифференциального
для ДНК Ureaplasma urealyticum и ДНК Ureaplasma parvum методом полимеразной цепной реакции в режиме
реального времени (РеалБест ДНК Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum (комплект 1))» № 3


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
2019 г.





10


2019 г.

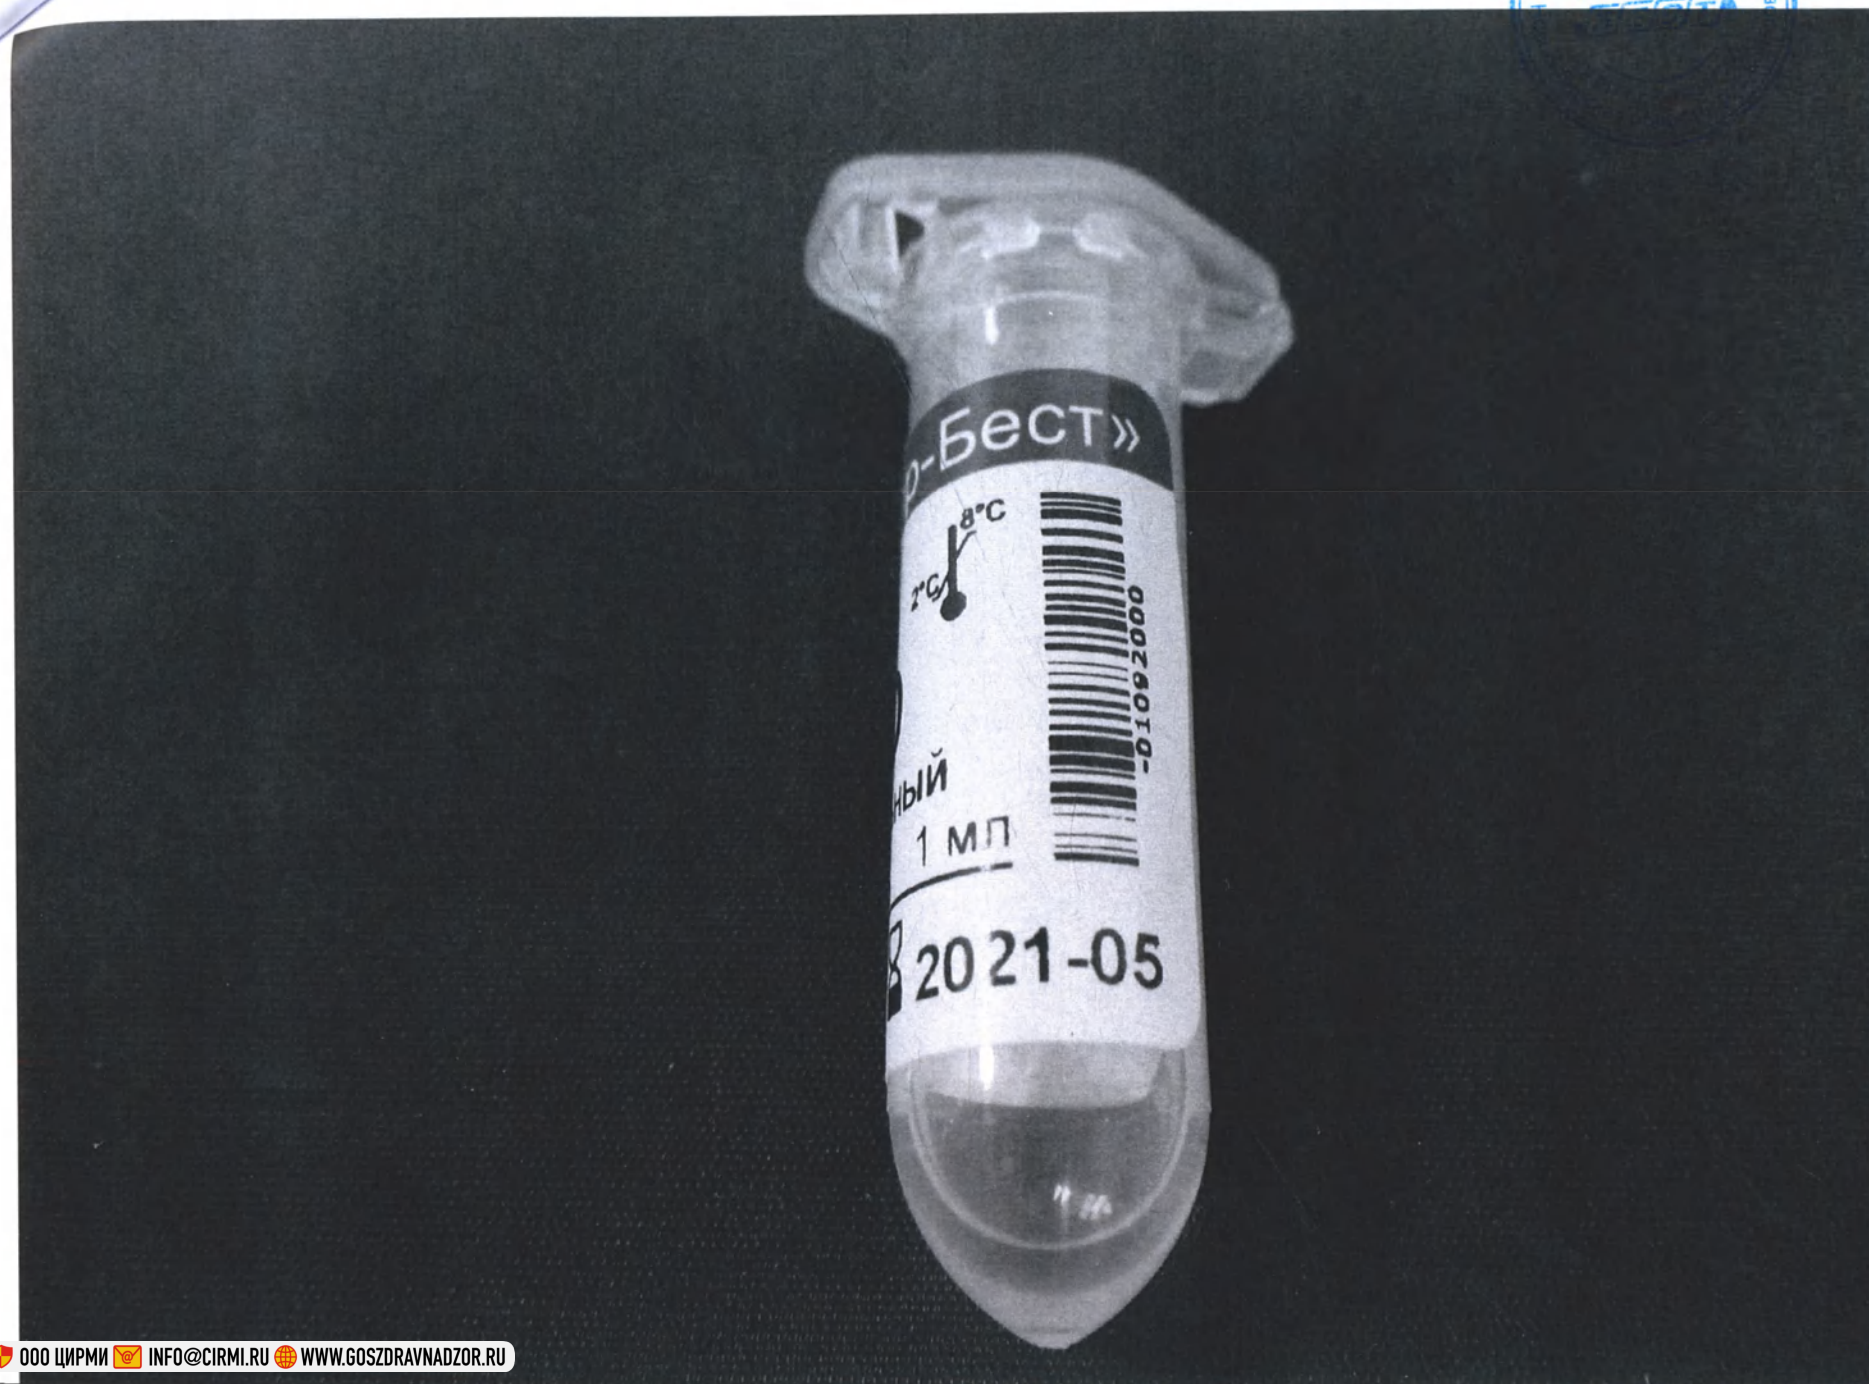

Сканированное изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для дифференциального выявления *Ureaplasma urealyticum* и ДНК *Ureaplasma parvum* методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК *Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum* (комплект 2))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
2019 г.





БЕКТОР

БЕСТ

REF

D-2295

набор реагентов для дифференциального
выявления ДНК *Ureaplasma urealyticum*
и ДНК *Ureaplasma parvum* методом
полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

**РеалБест ДНК
Ureaplasma urealyticum /
Ureaplasma parvum (комплект 2)**

LOT 58

СОСТАВ:



LOT

1. Положительный контрольный образец универсальный	1 пр.	1 мл	92
2. Реакционная смесь для ПЦР	10 пр.		58
3. Раствор для восстановления	2 фл.	по 2 мл	26


CE

ТУ 9398-233-23548172-2015
ПУ № РЗН 2017/5538 от 22.03.2017



REF **D-2295** LOT **58**
    2019-07-08
 2020-07-08


РеалБест ДНК
Ureaplasma urealyticum /
Ureaplasma parvum (комплект 2)

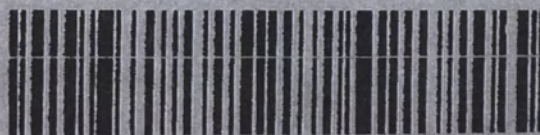



22950807200005800011



Для профессионального применения

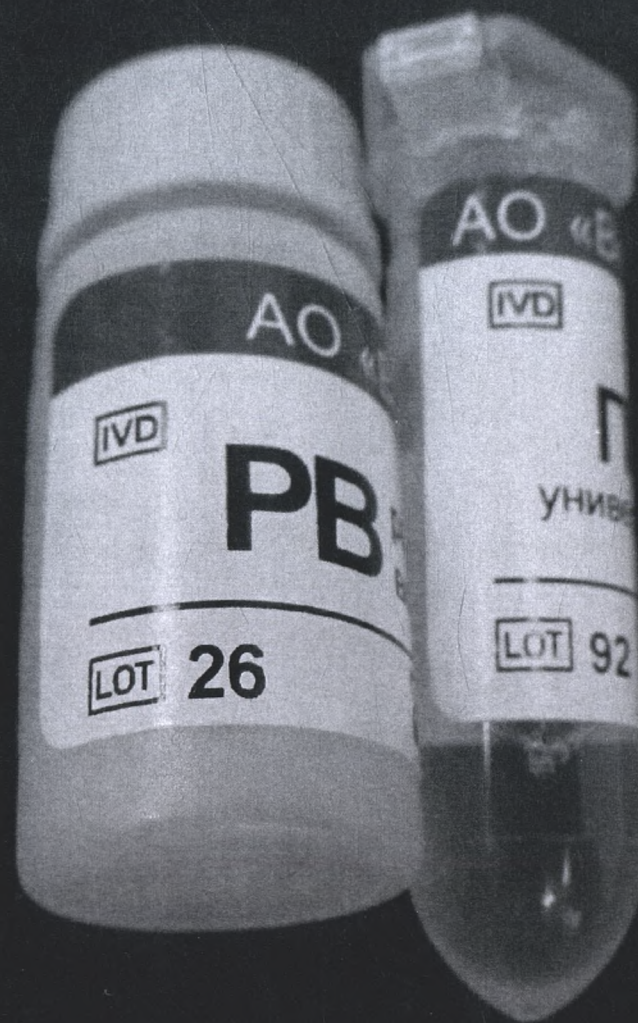




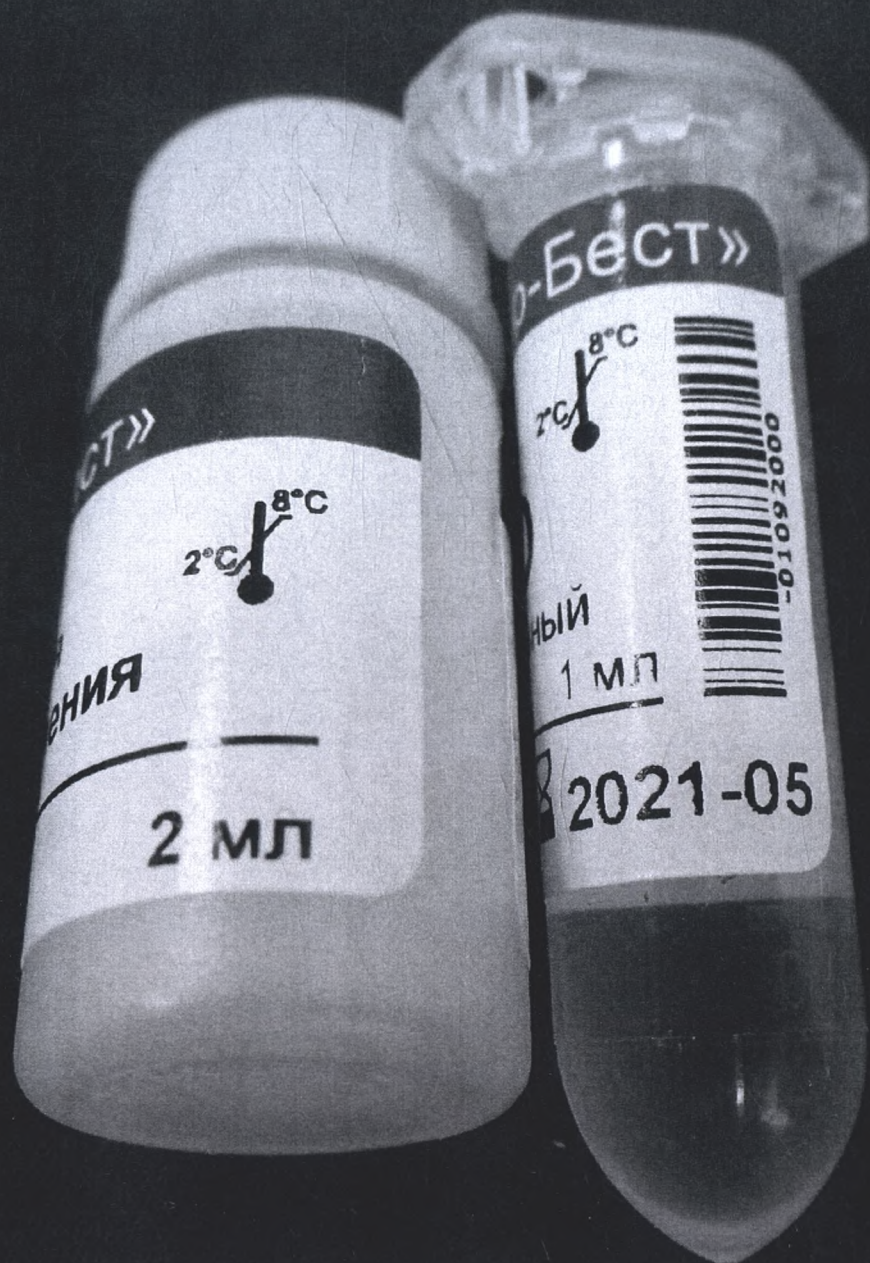

Фотоснимок изображения компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для дифференциального
ДНК *Ureaplasma urealyticum* и ДНК *Ureaplasma parvum* методом полимеразной цепной реакции в режиме
реального времени (РеалБест ДНК *Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum* (комплект 2))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» Хусаинов М.Д.
2019 г.

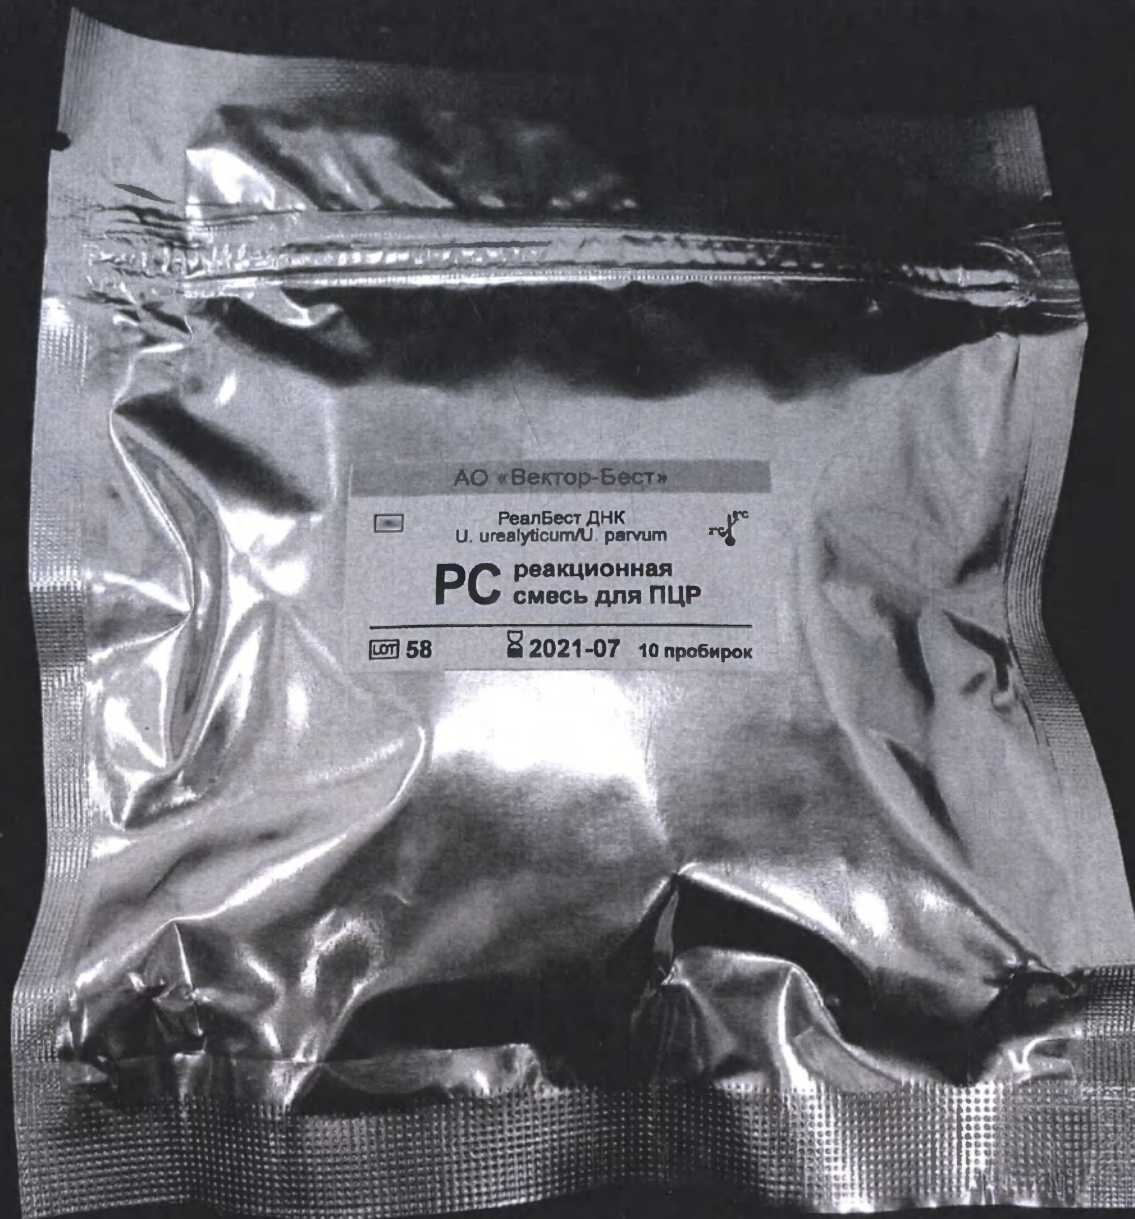

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 74 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

“ 7 / 11 ” 11 / 2019 г. 9 г.
Масяго А.В.

