

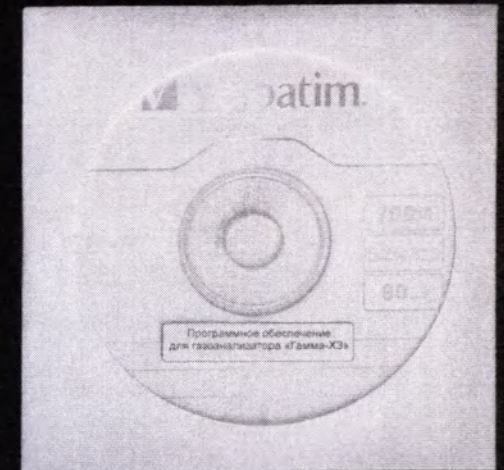



из отключено реле
N 30712 от 26.08.2017

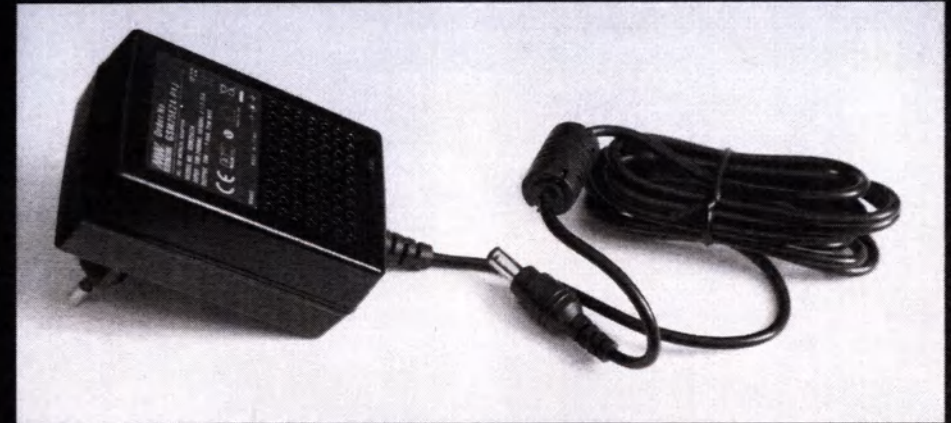

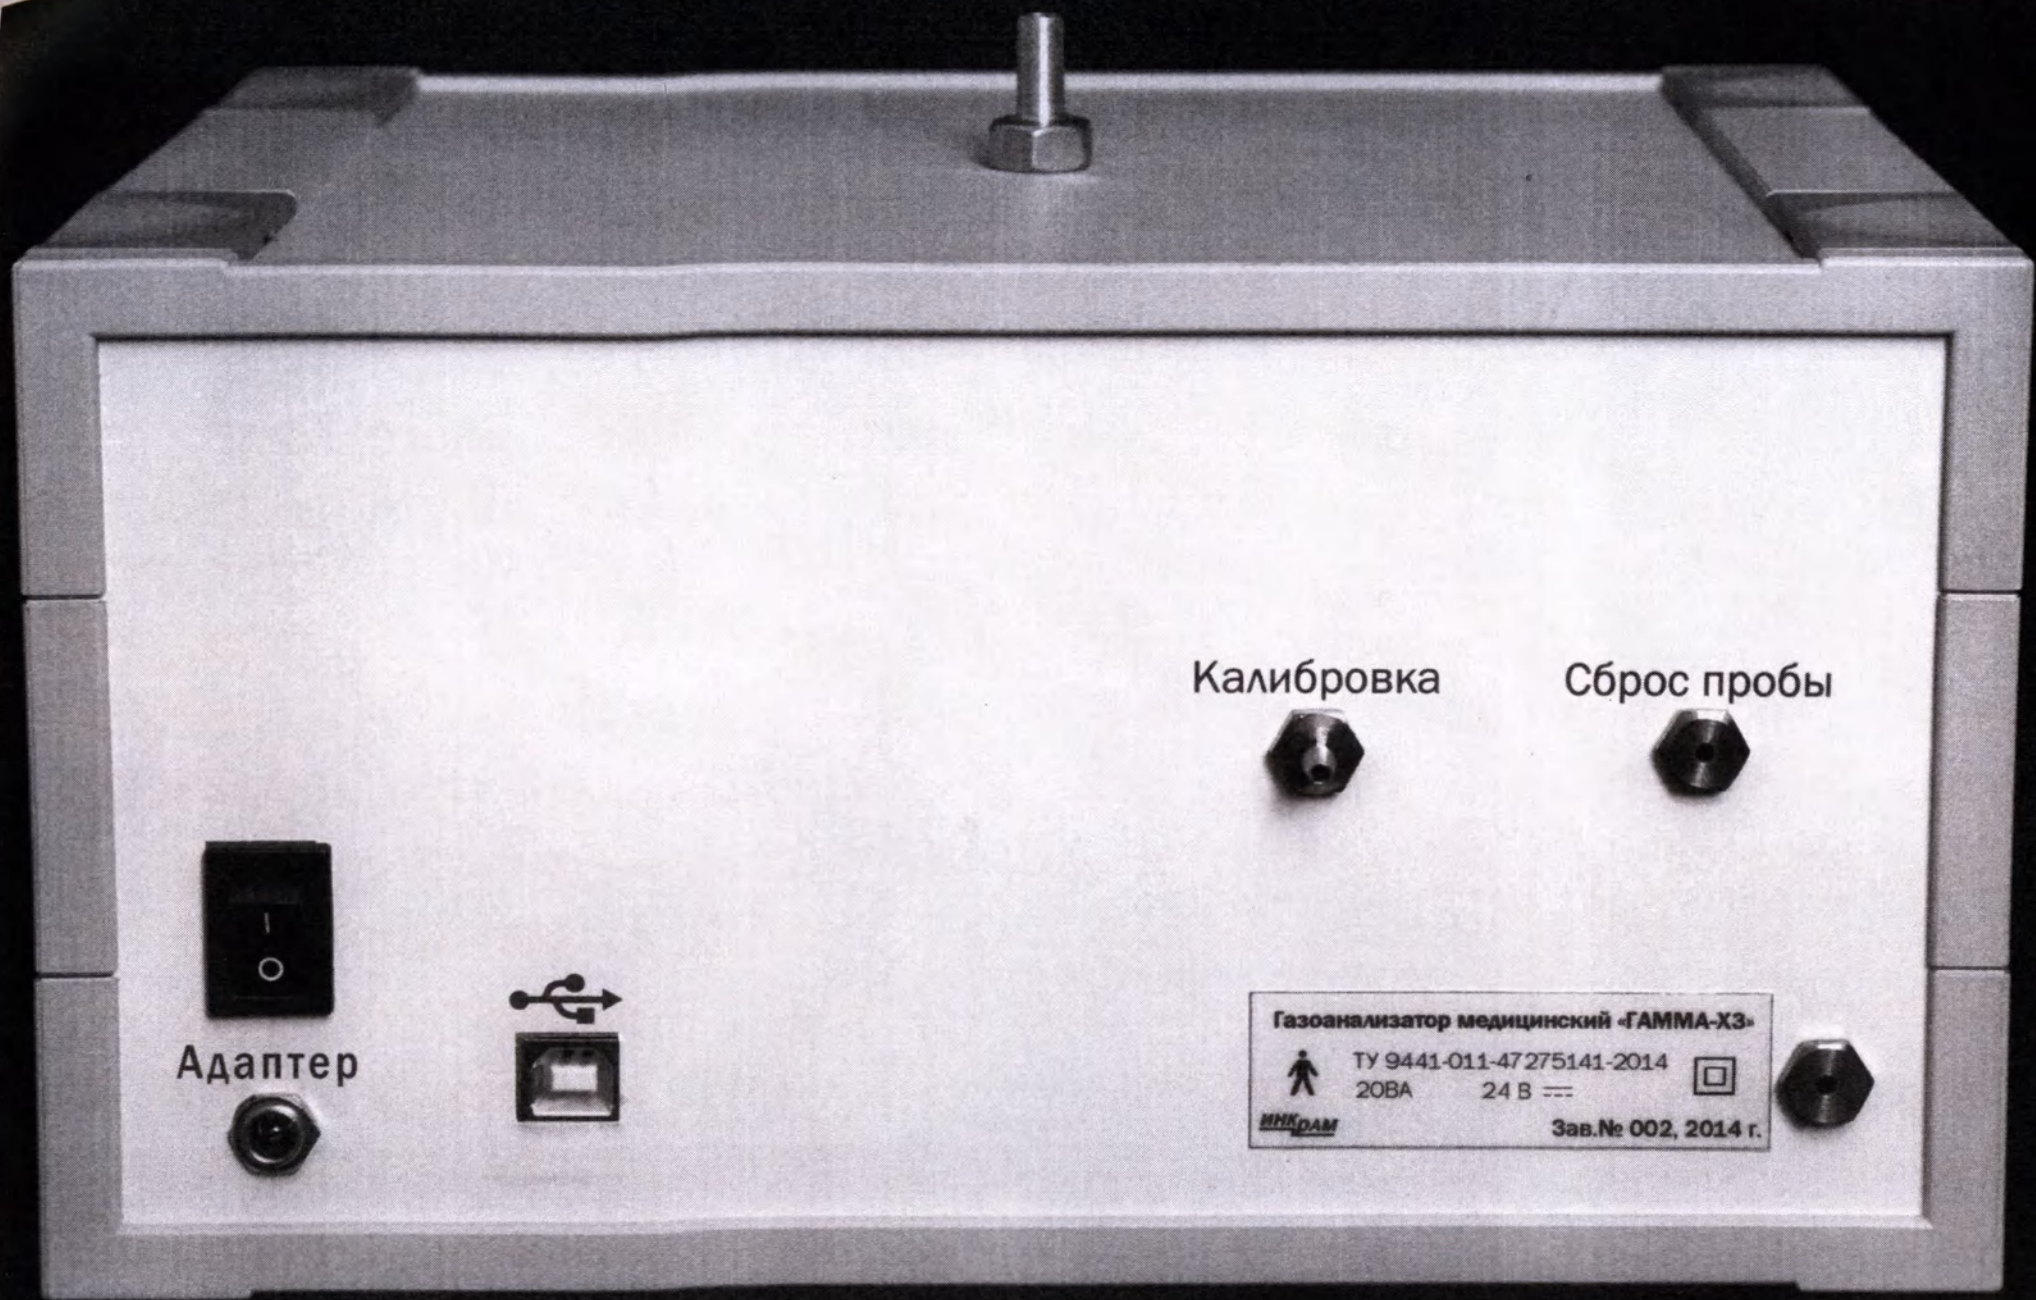

Калибровка

Сброс пробы

Адаптер

Газоанализатор медицинский «ГАММА-ХЗ»



ТУ 9441-011-47 275141-2014

20ВА

24 В ---



МНХРАМ

Зав. № 002, 2014 г.

Генеральный директор
ООО «НПФ «ИНКРАМ»

Болодурин Б.А.

