

Блок монитора



Разветвитель 6-ти канальный




Преобразователь 1-го канала



Преобразователь 2-го канала



Держатель разветвителя

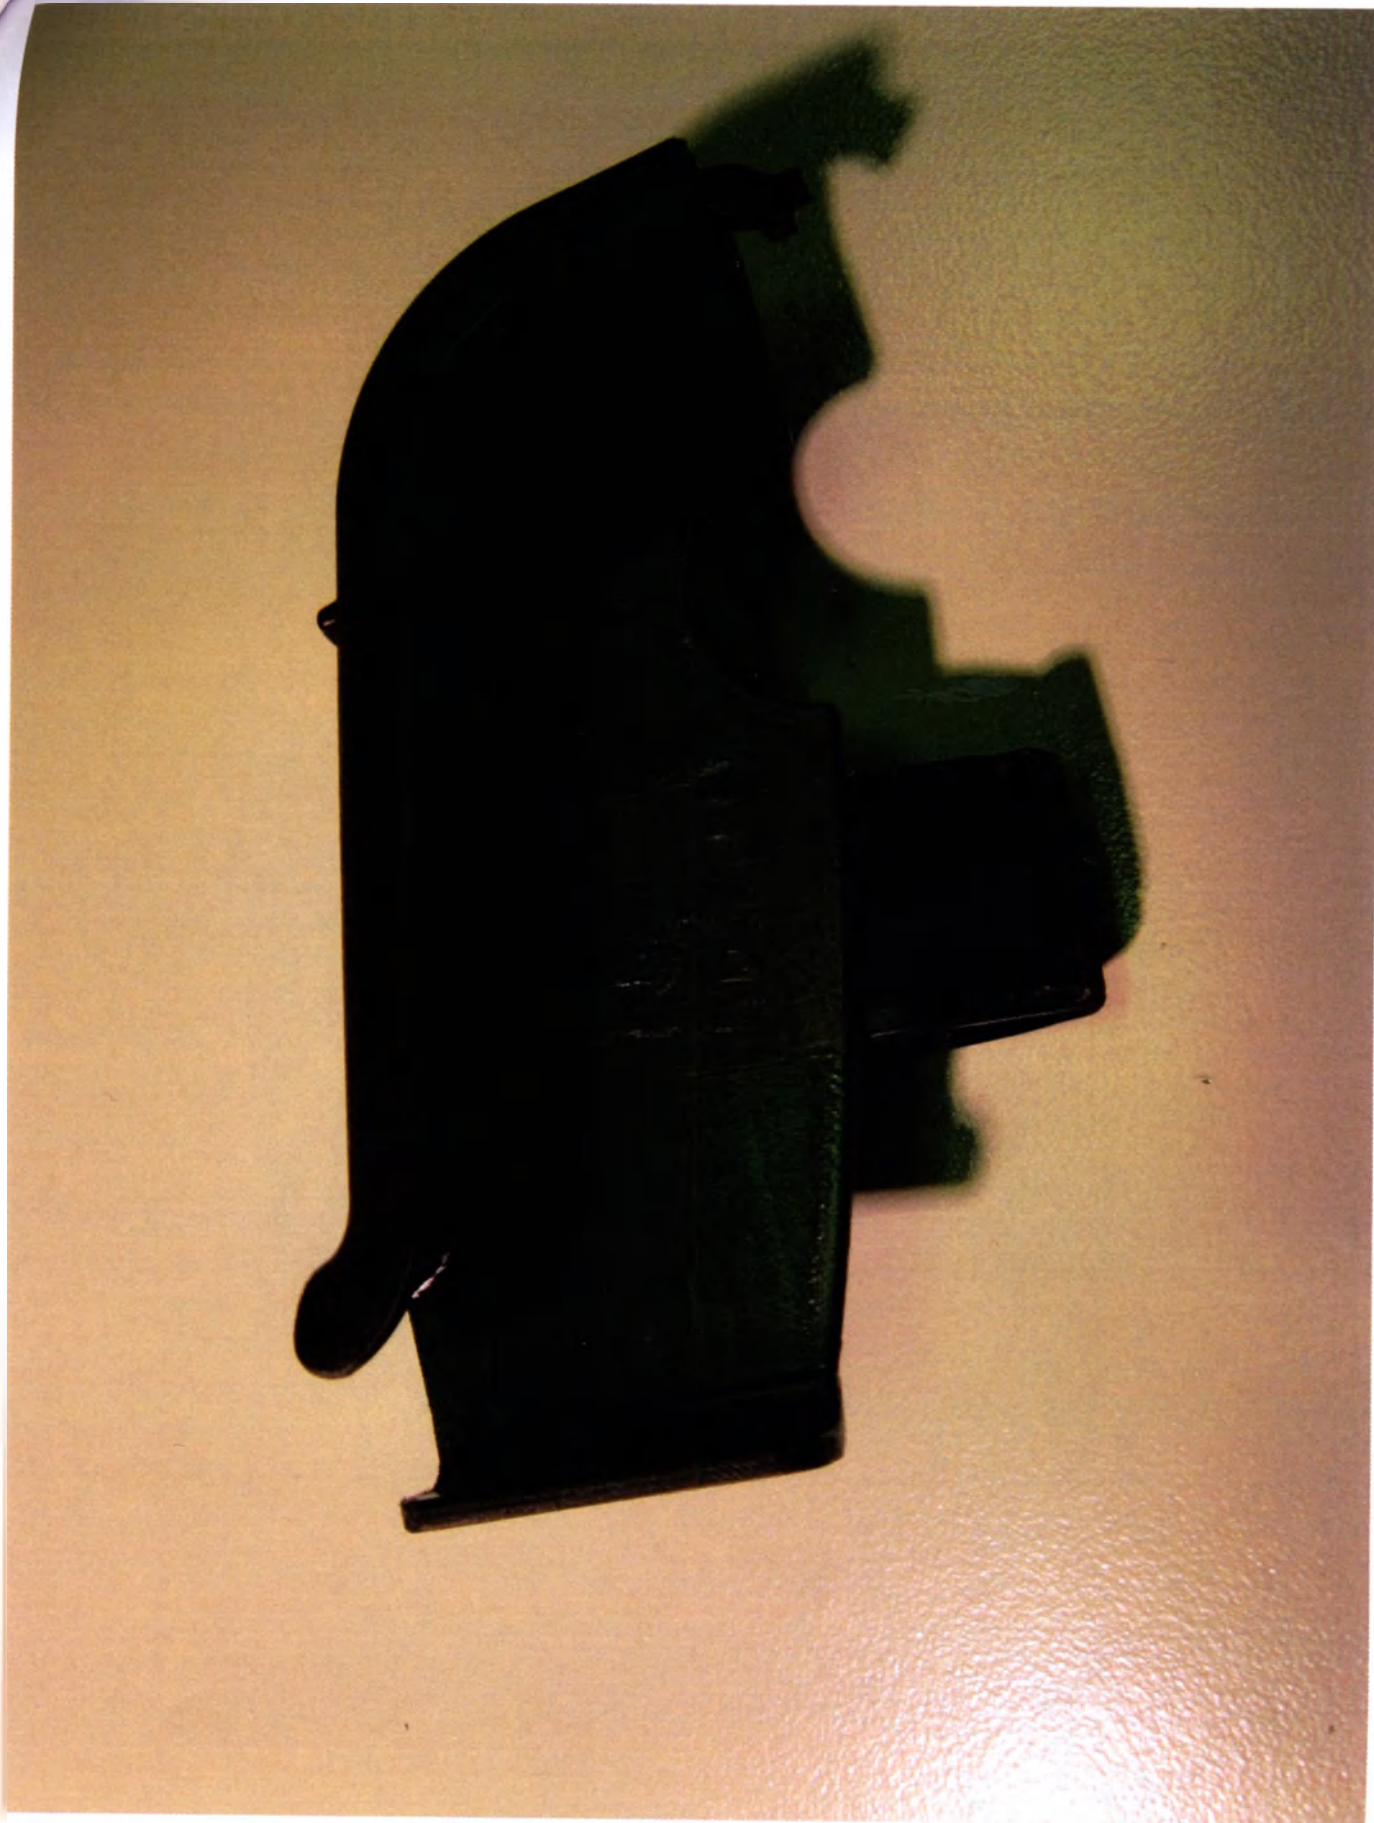

удлинительный кабель 1 м



Удлинительный кабель 2 м



Блок питания



Сетевой кабель









Преобразователь 3-го канала



Преобразователь 4-го канала

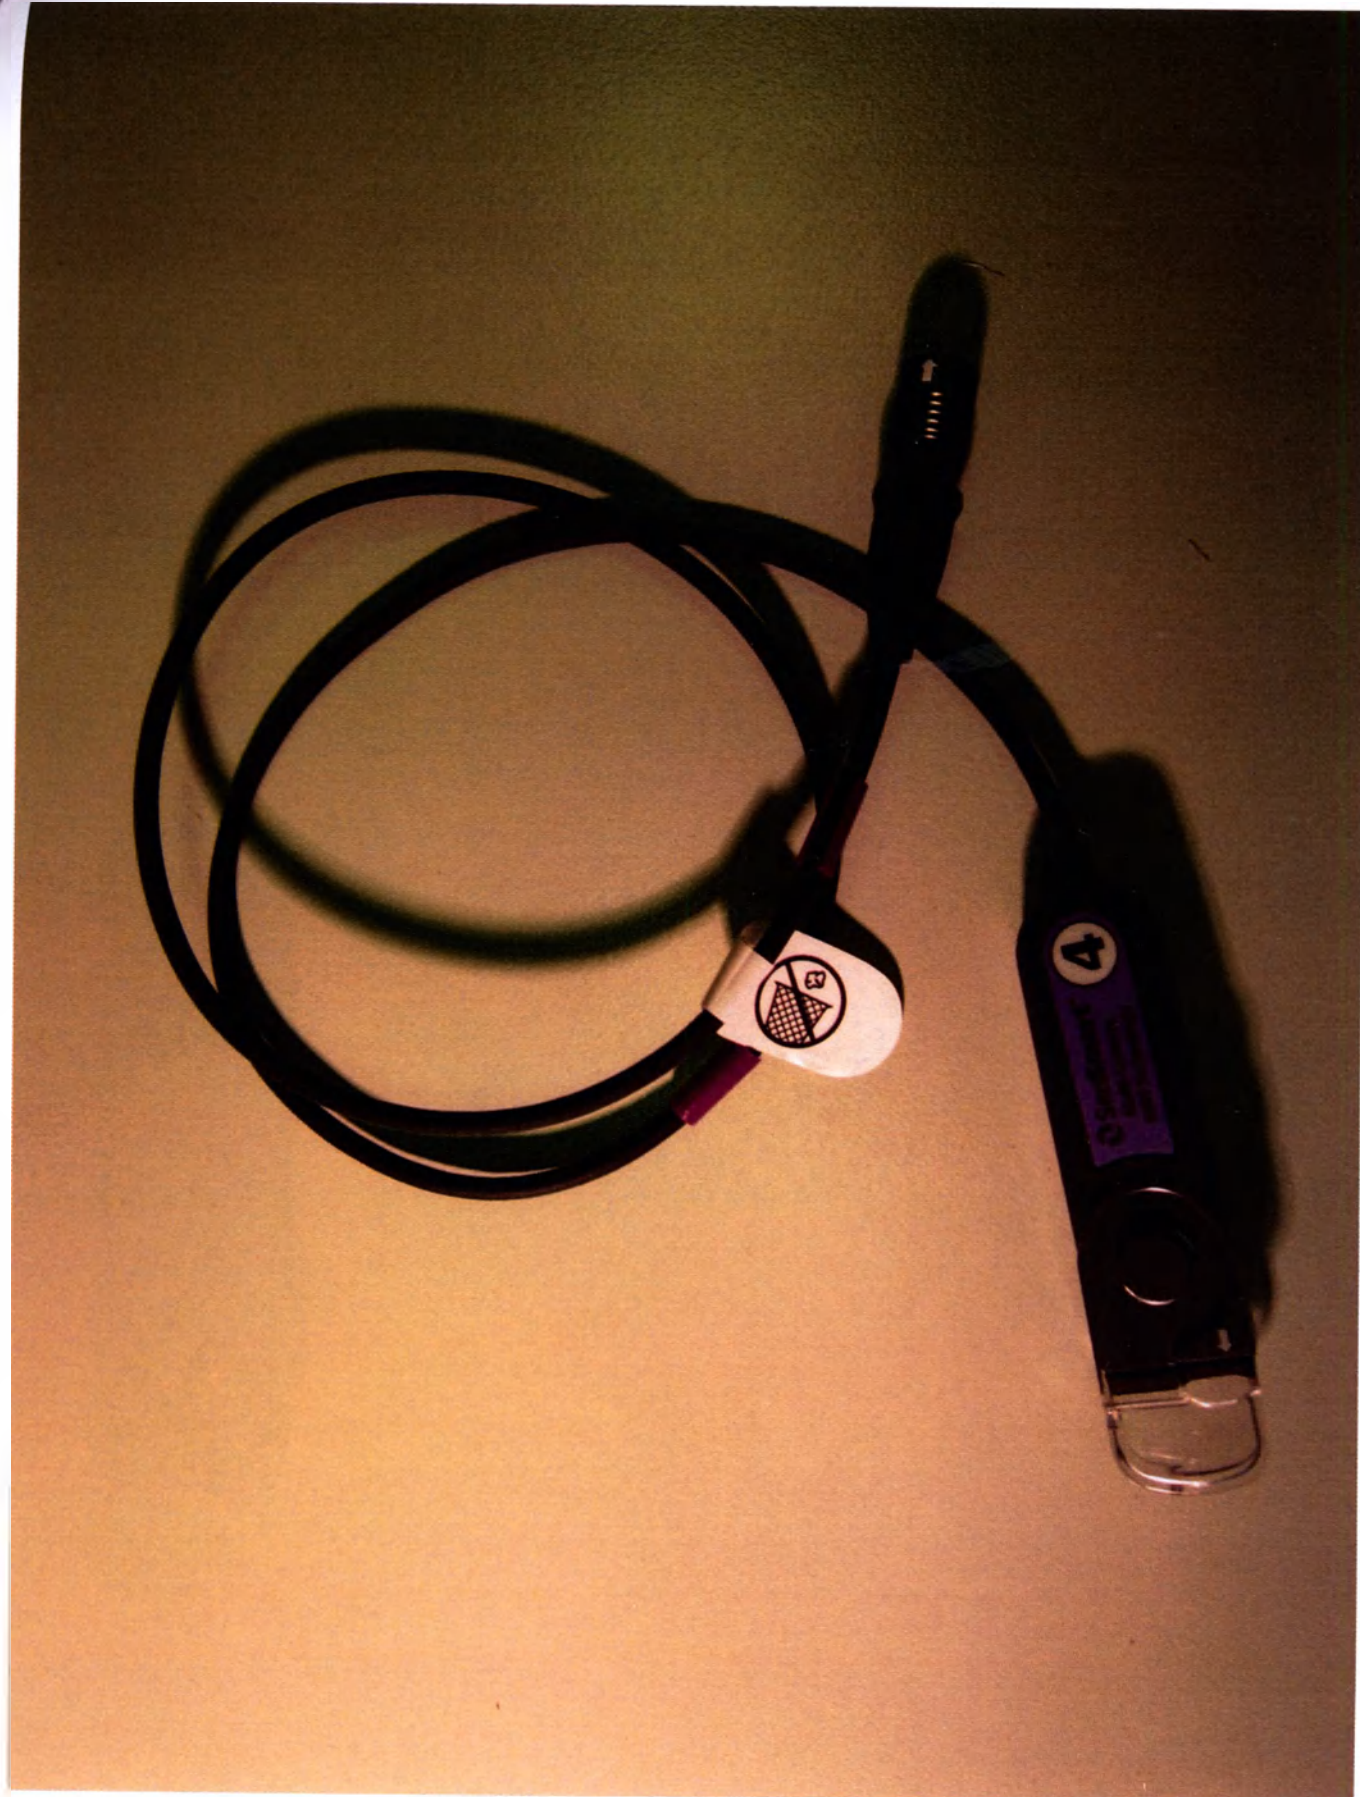


Преобразователь 5-го канала

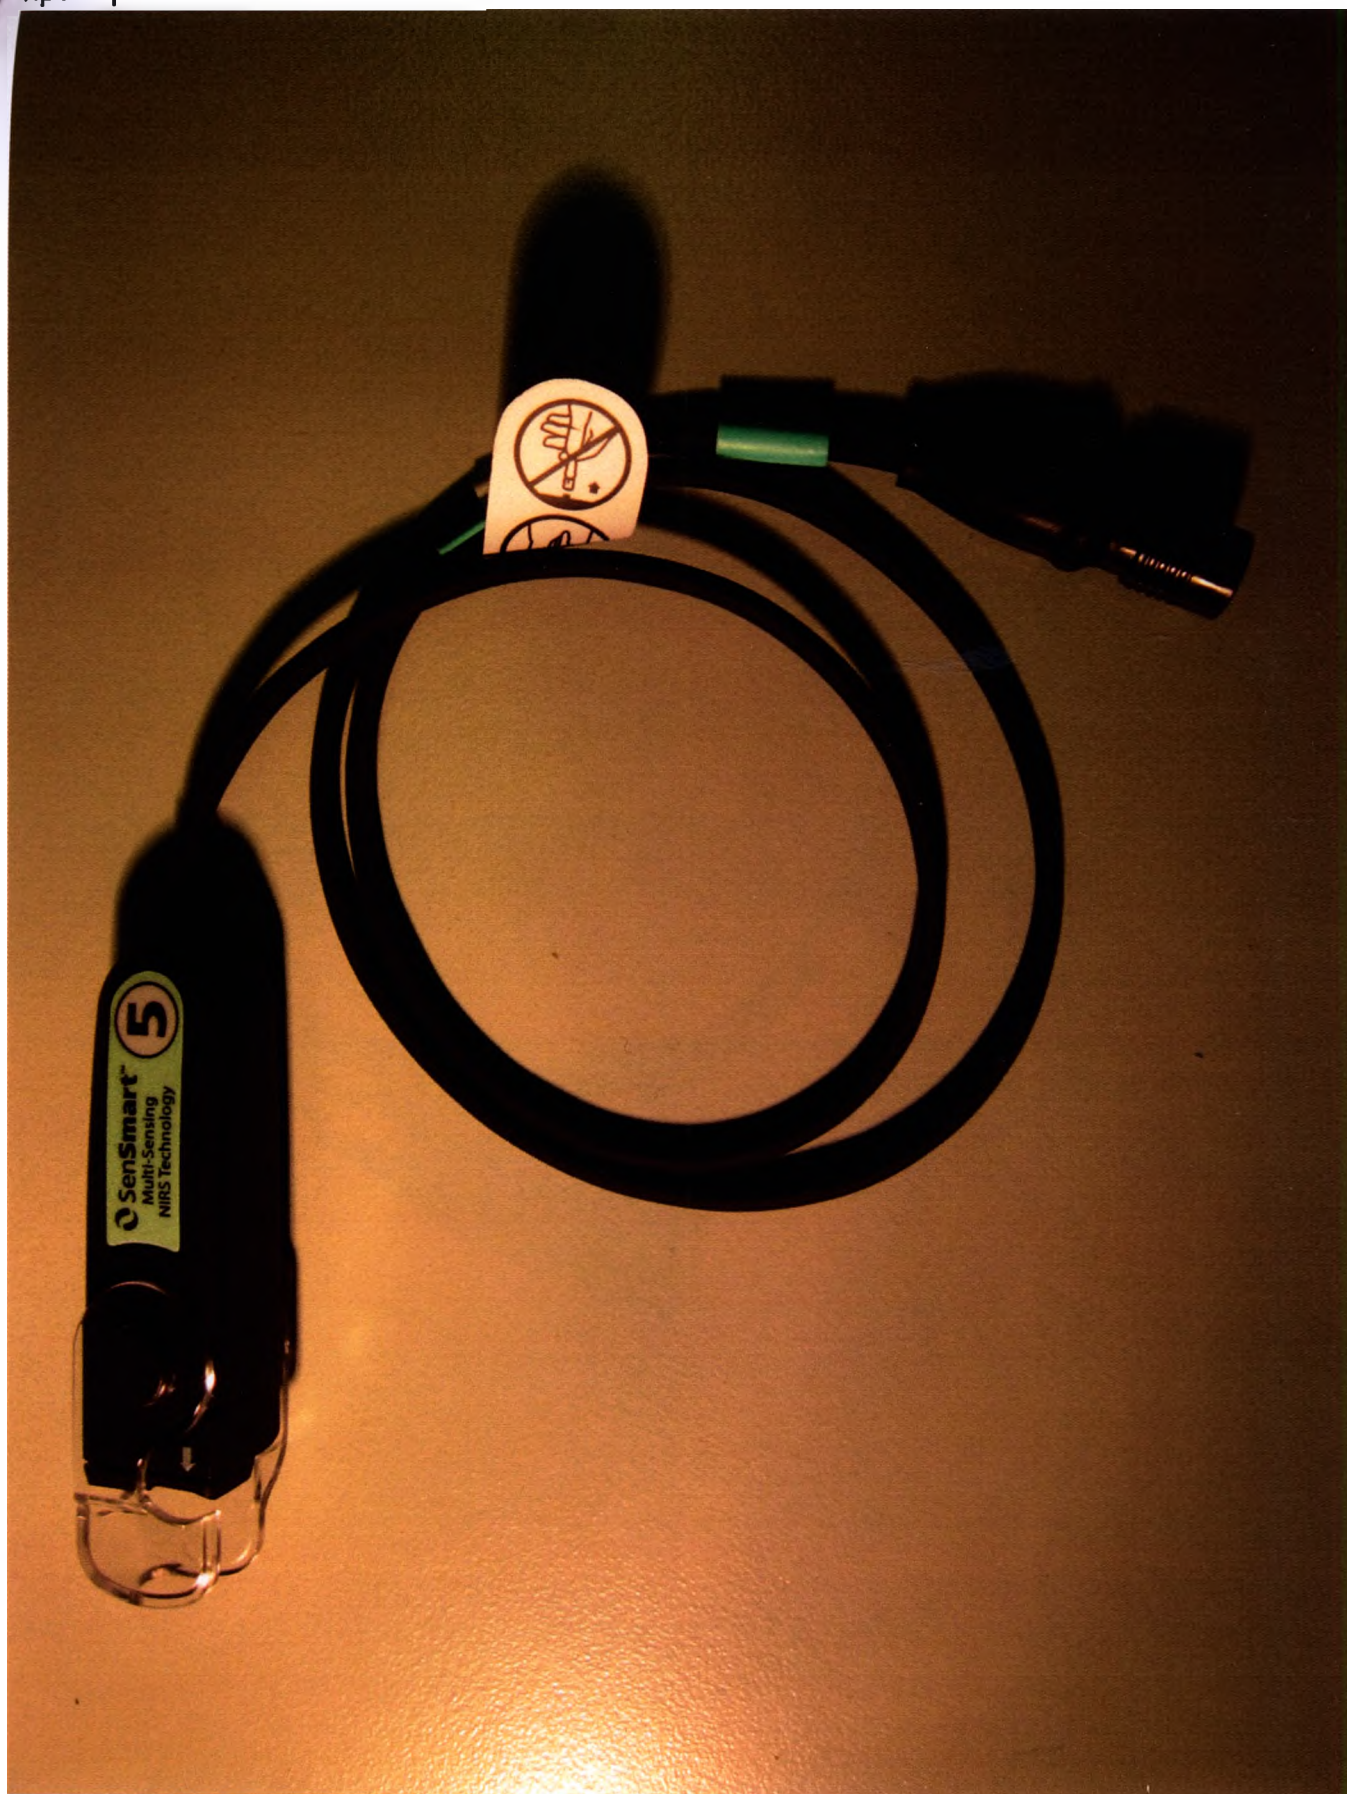


Преобразователь 6-го канала



Кабель датчика оксиметрии

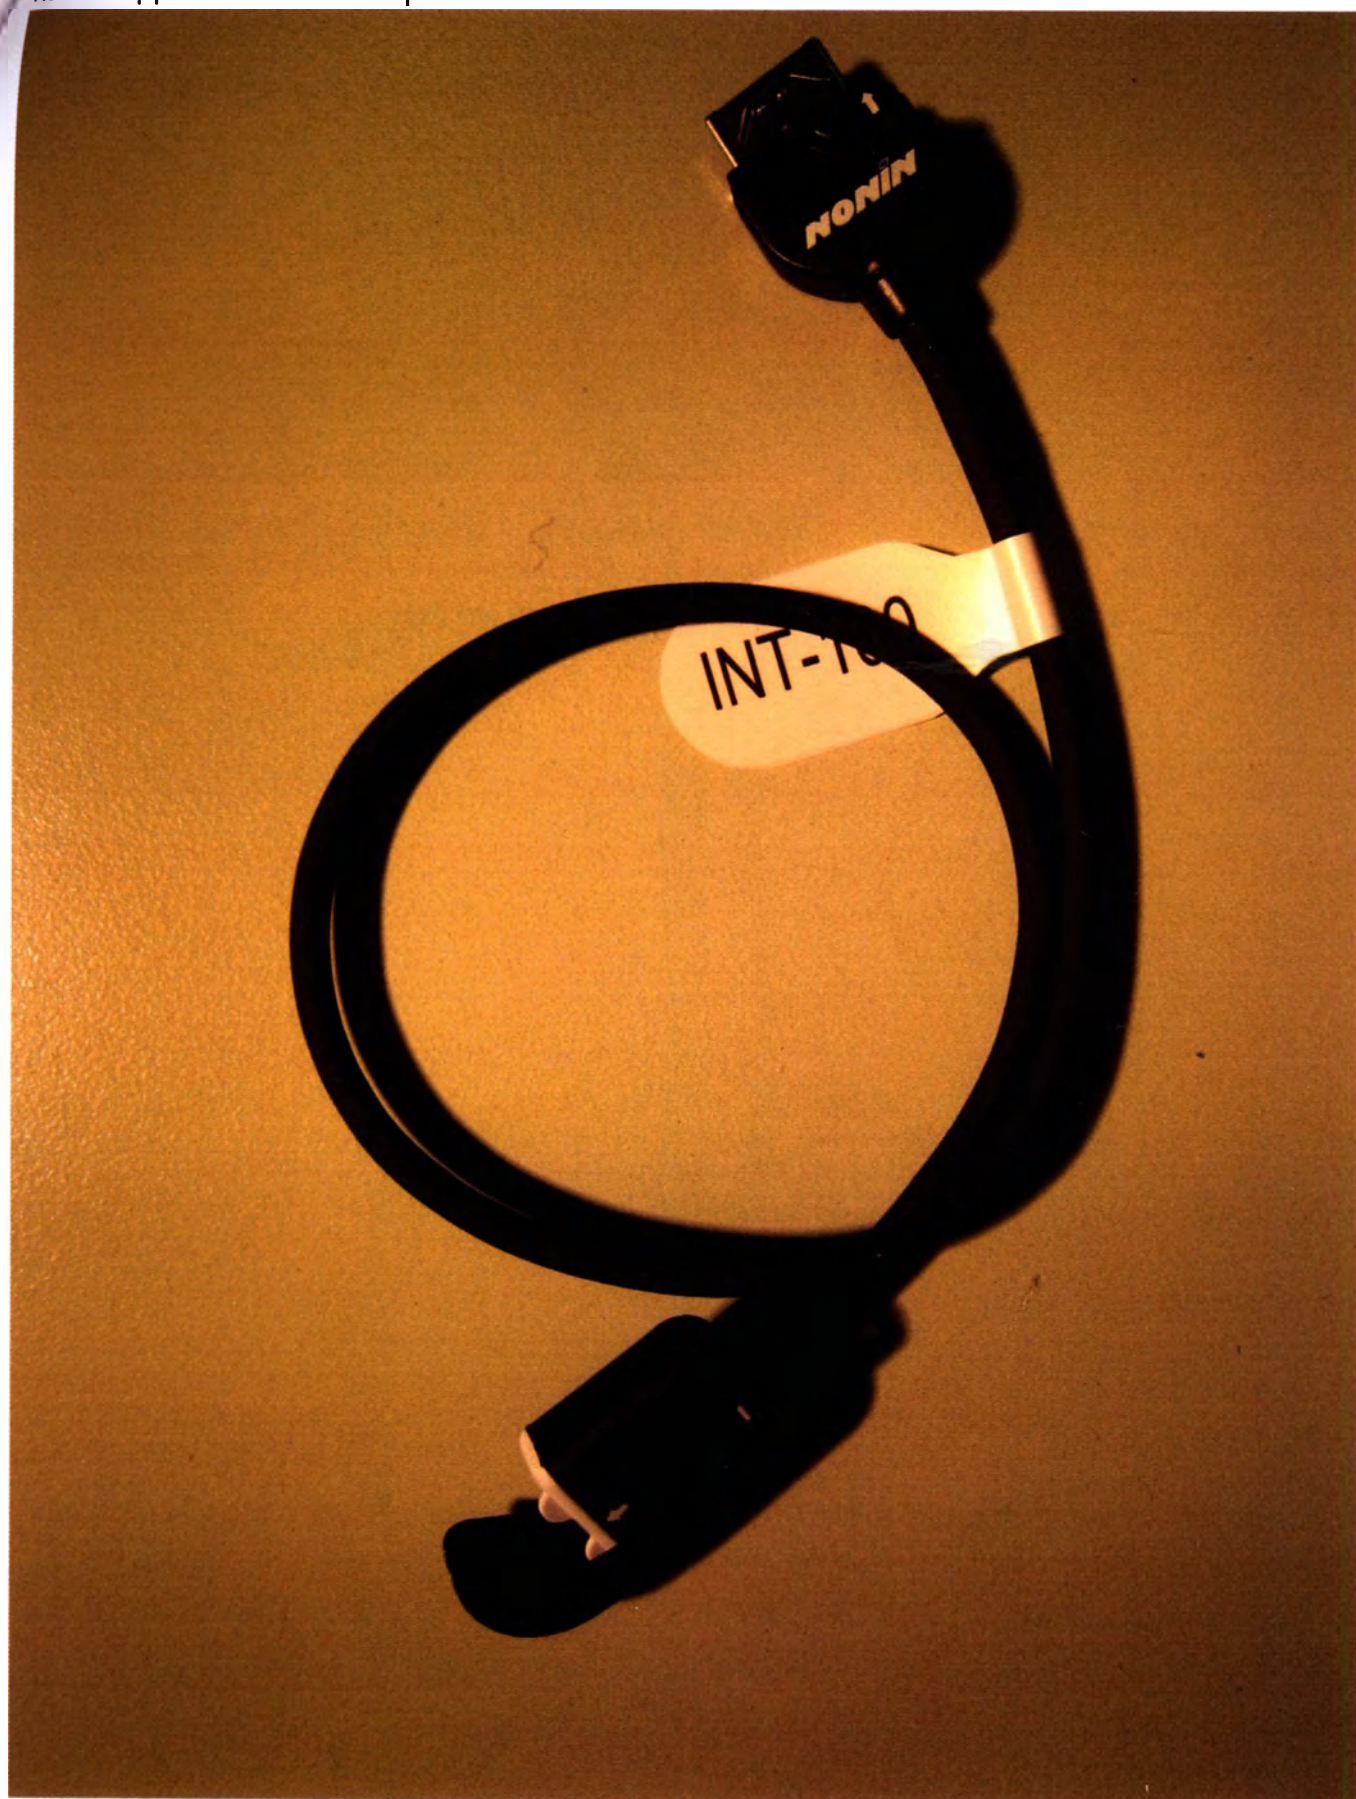


Датчик церебральной/соматической оксиметрии для взрослых и детей Classic Plus

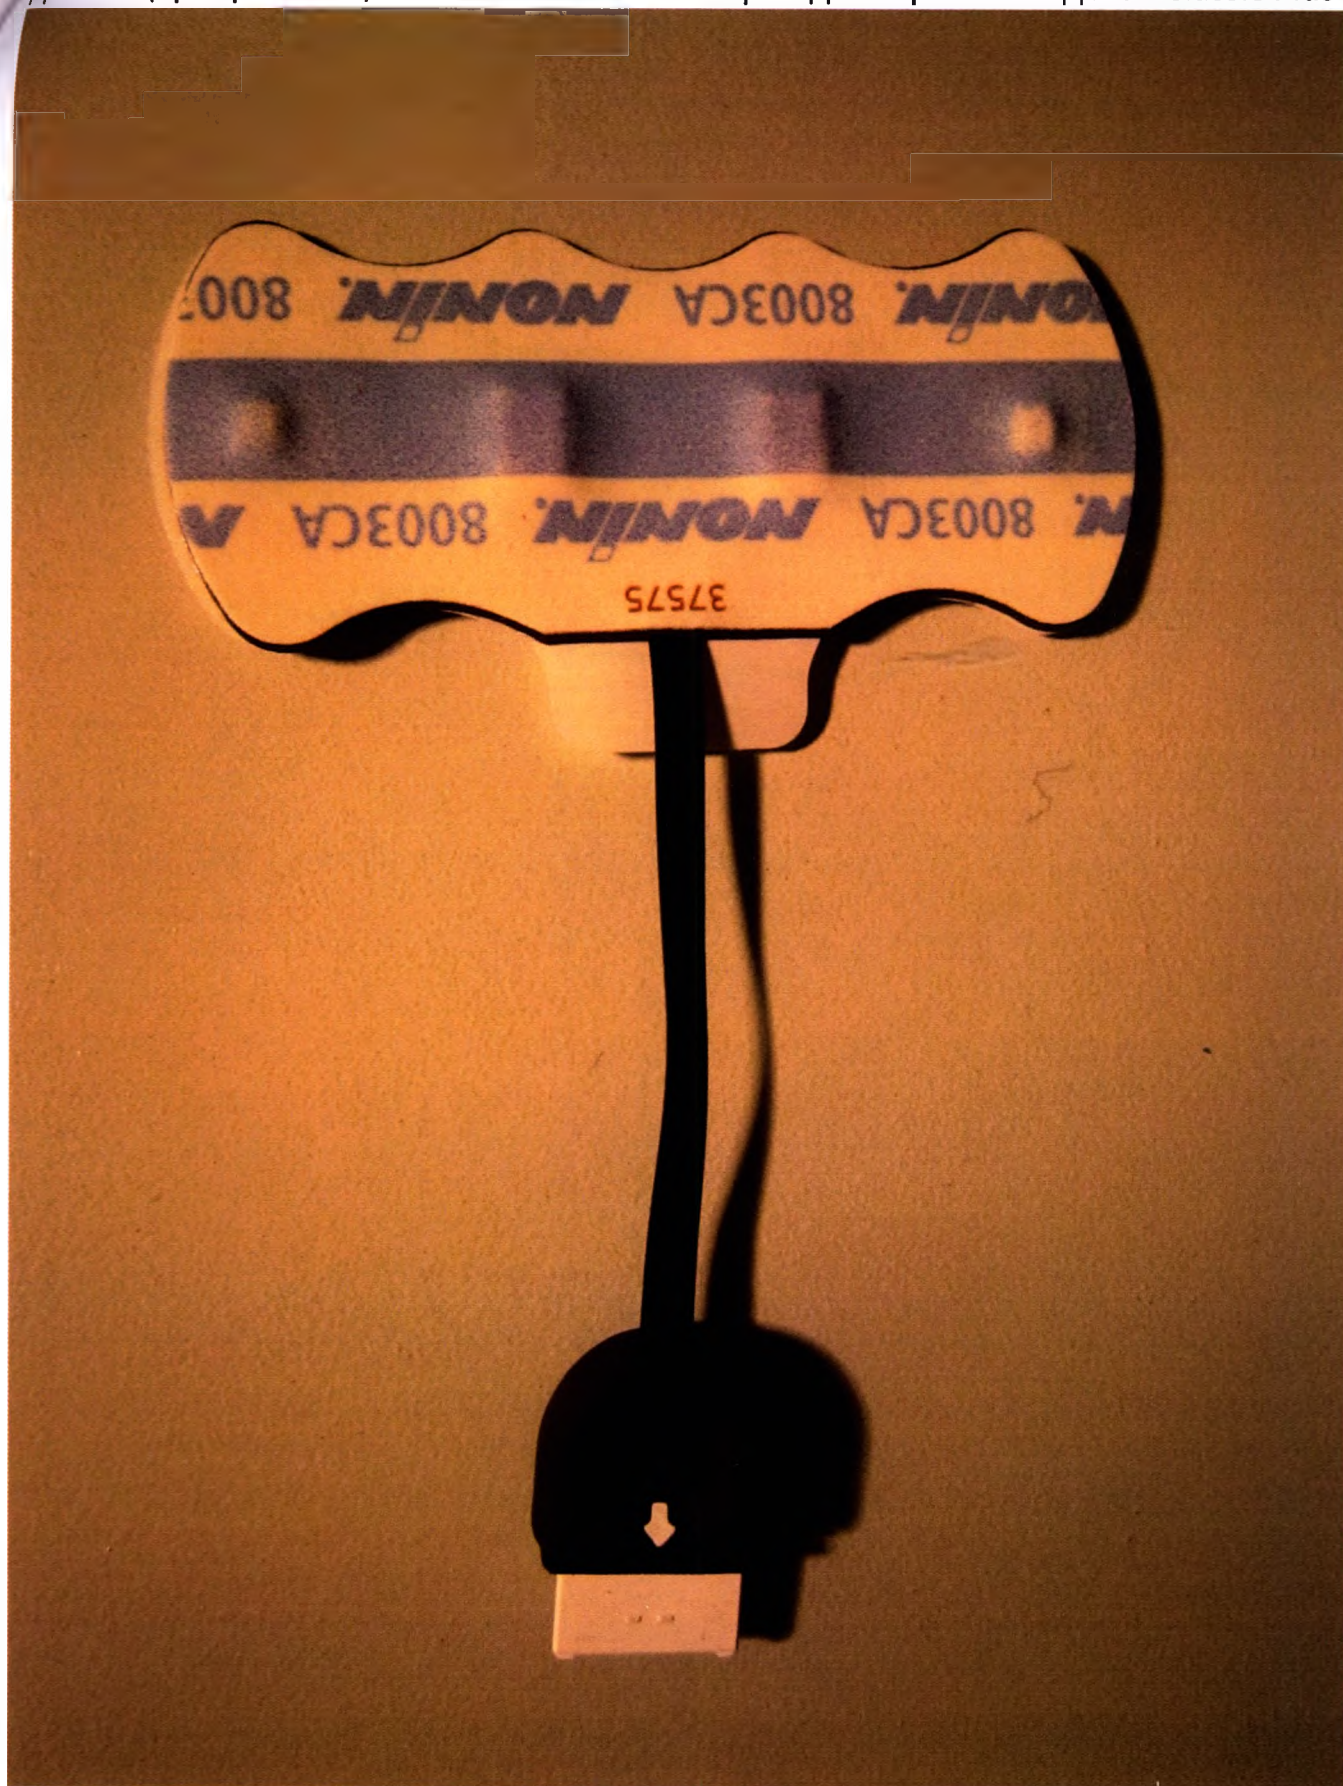



Датчик церебральной/соматической оксиметрии для взрослых и детей Advance



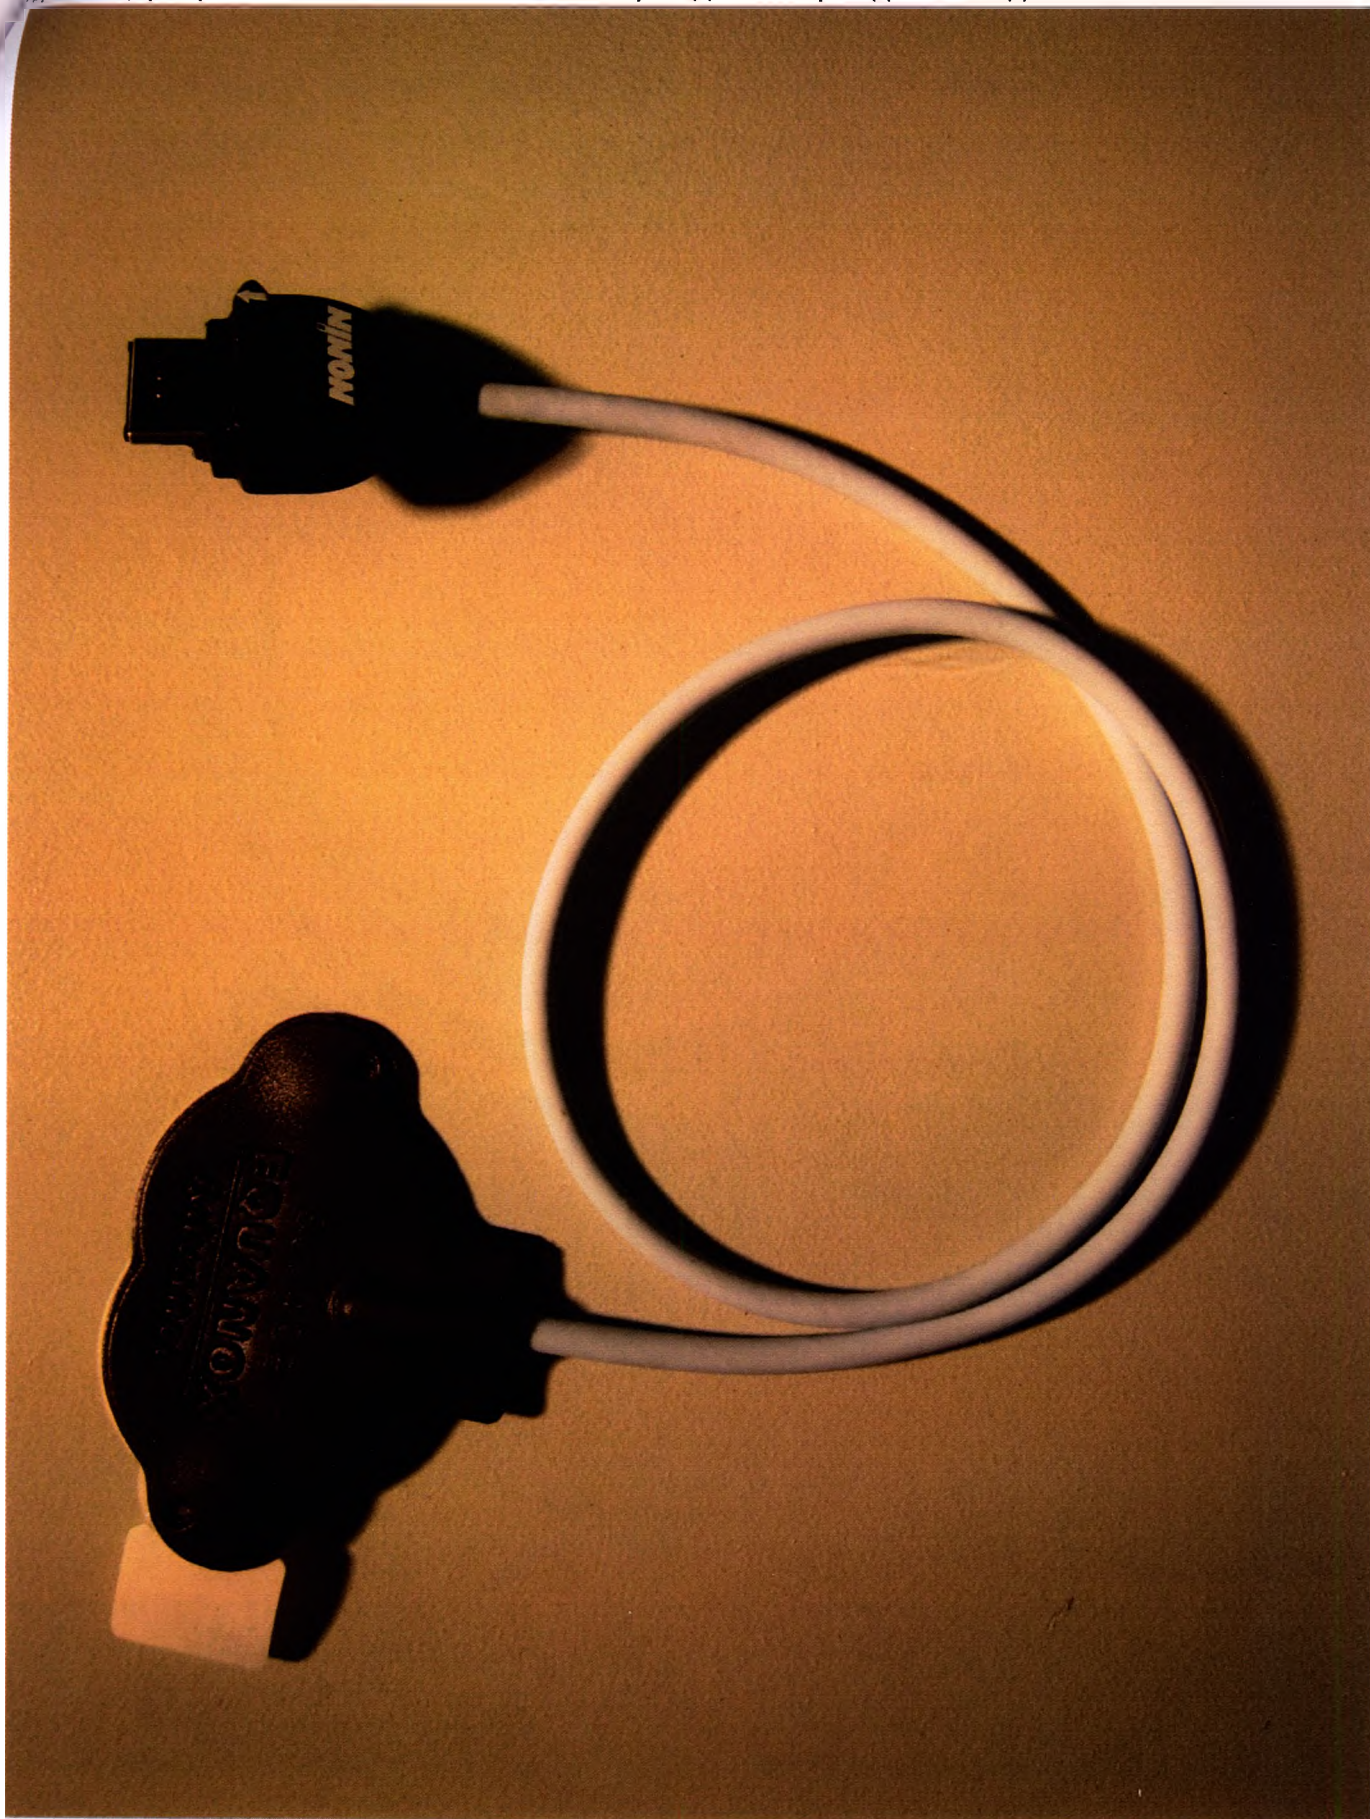




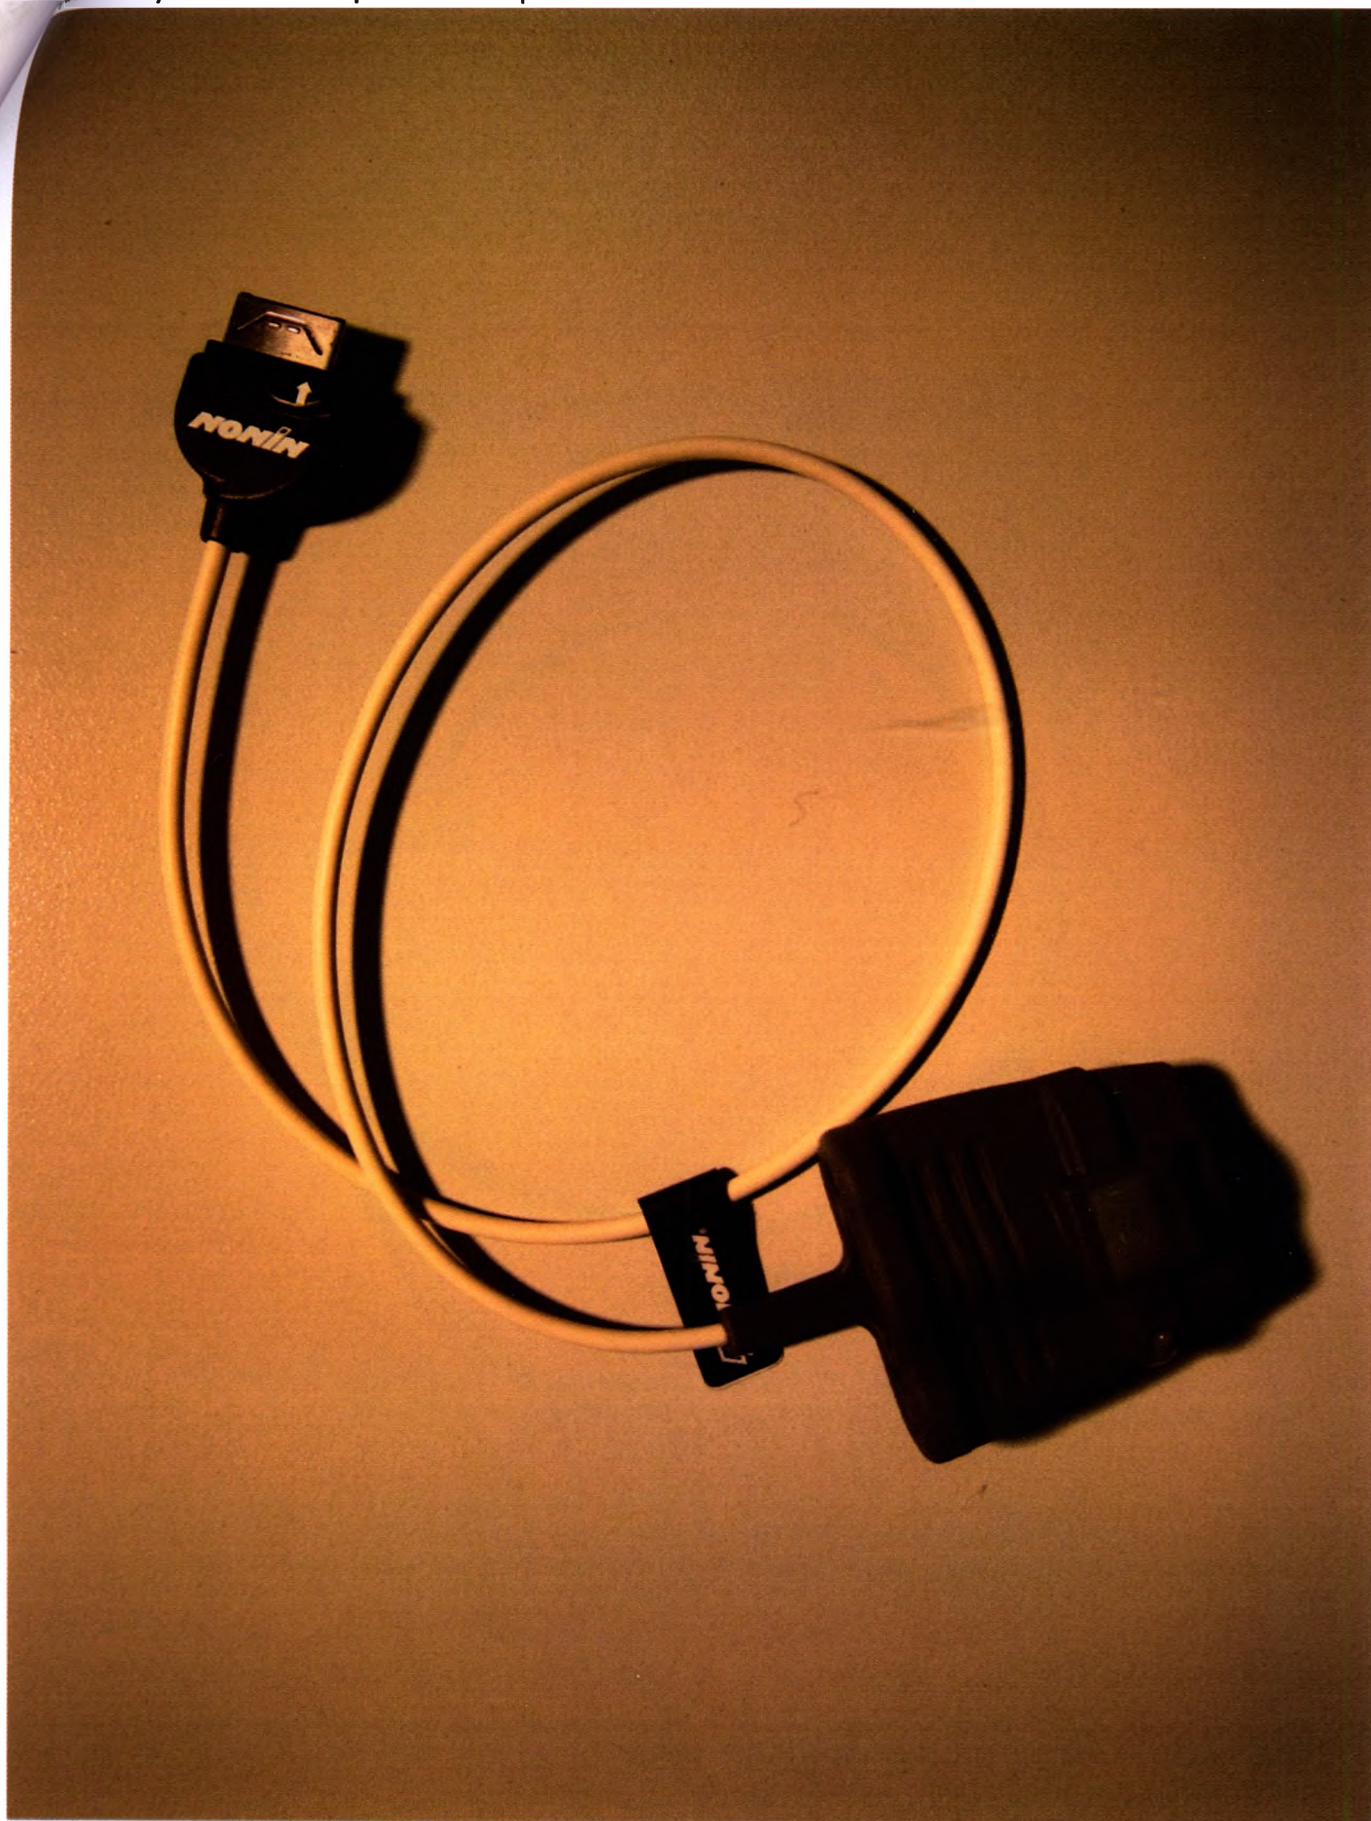


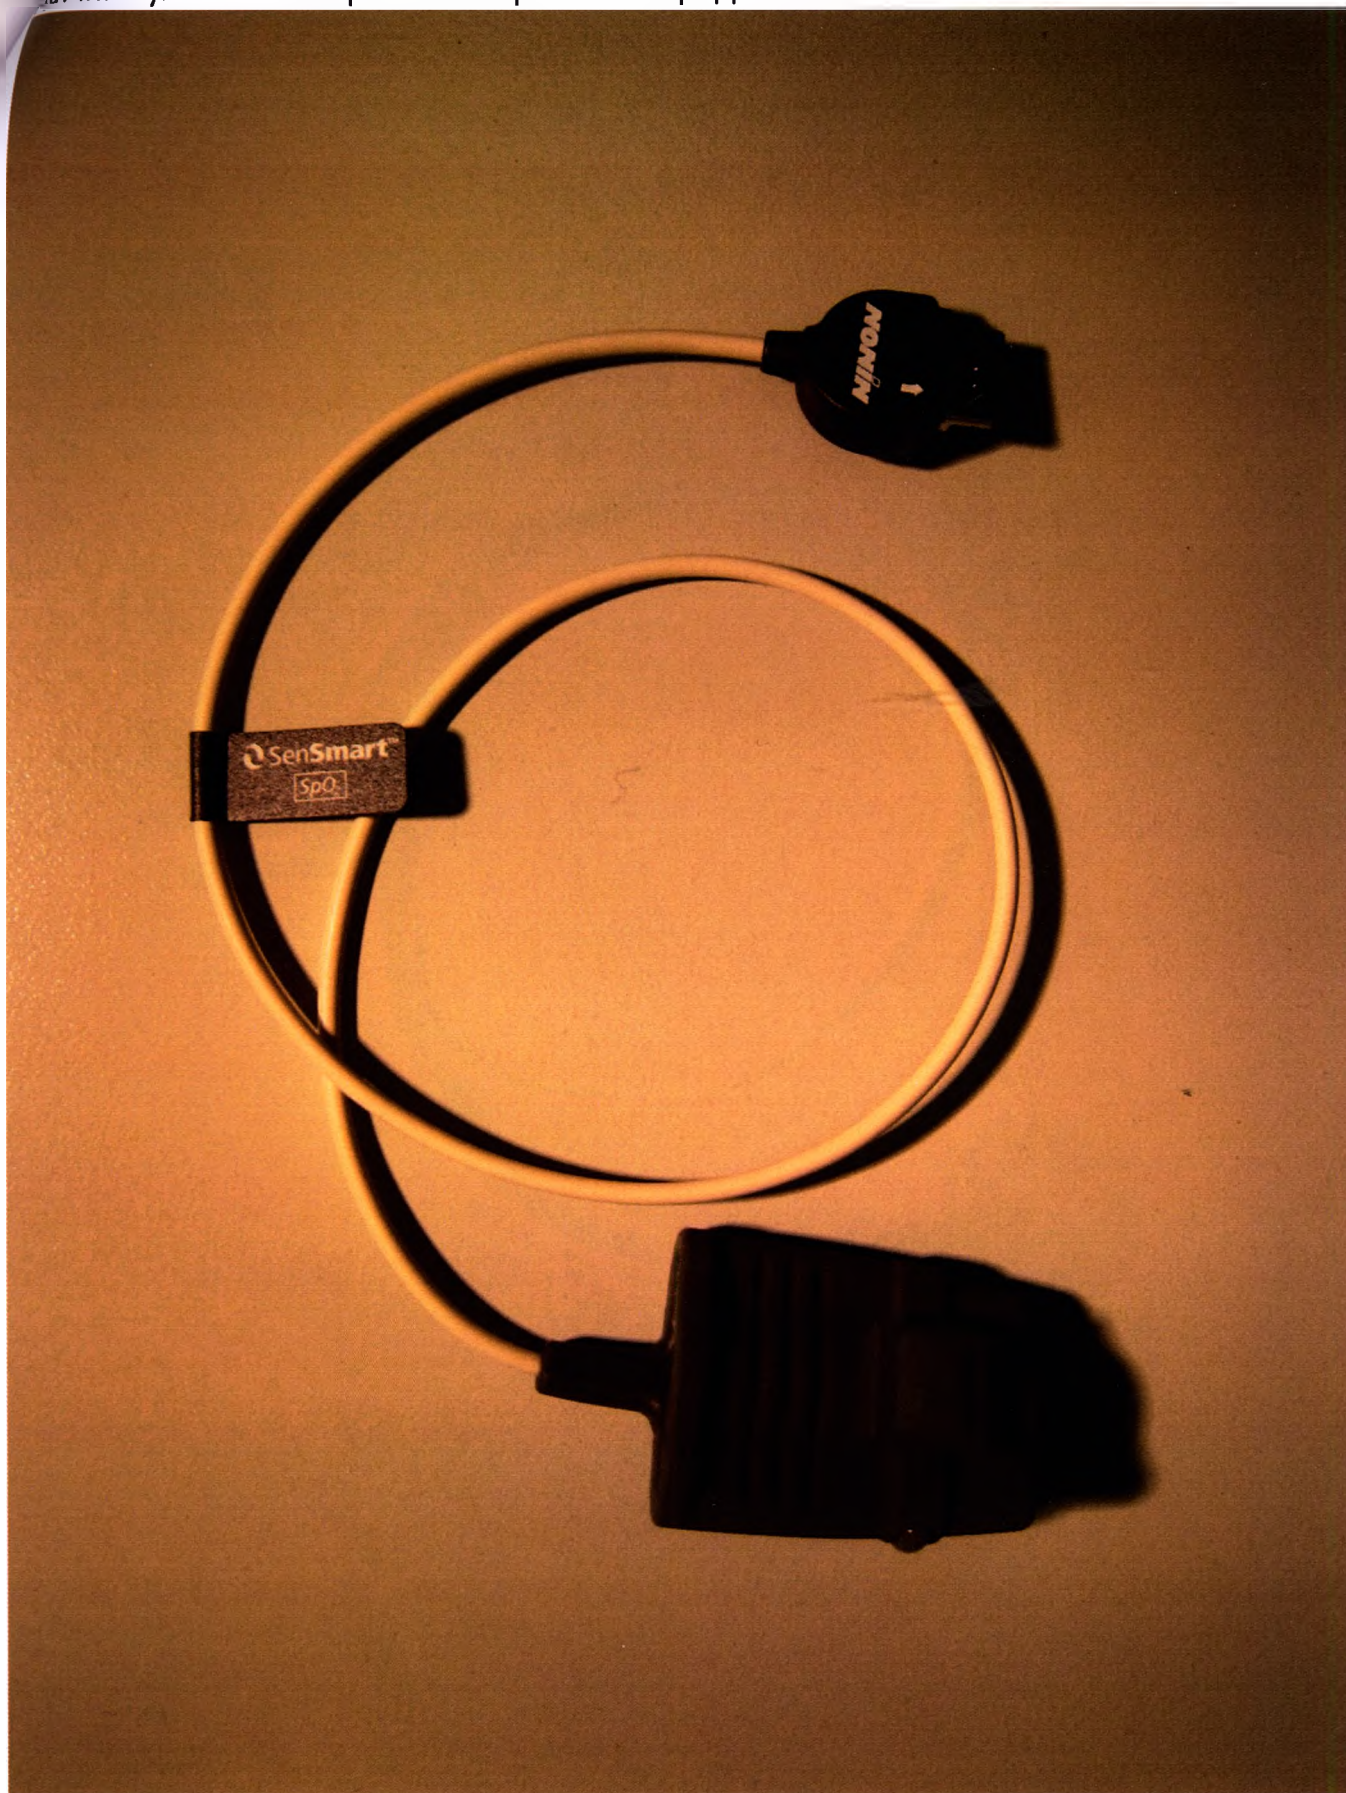


Датчик пульсоксиметрии многоразовый Малый

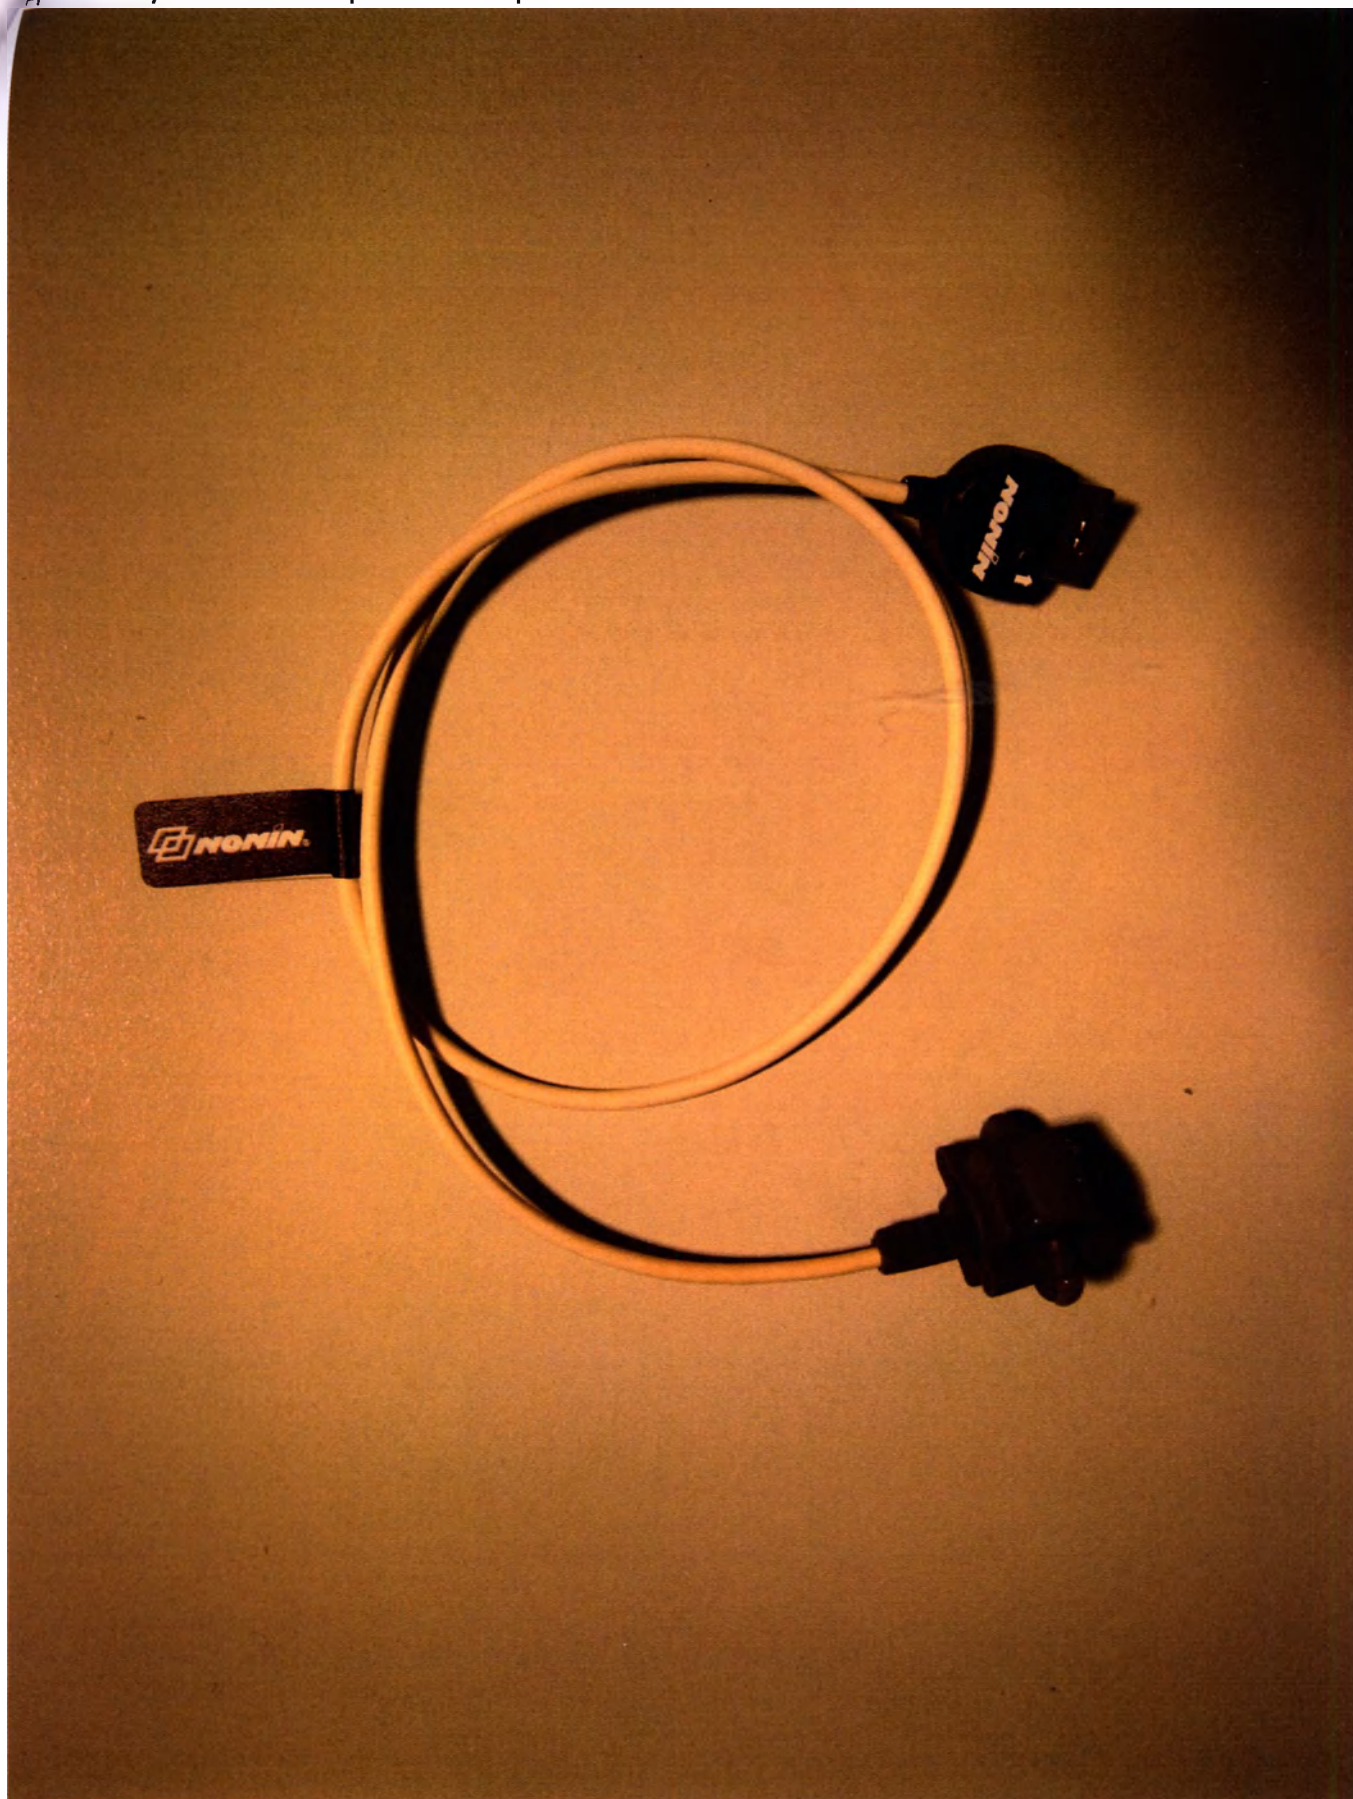

Датчик пульсоксиметрии одноразовый для новорожденных

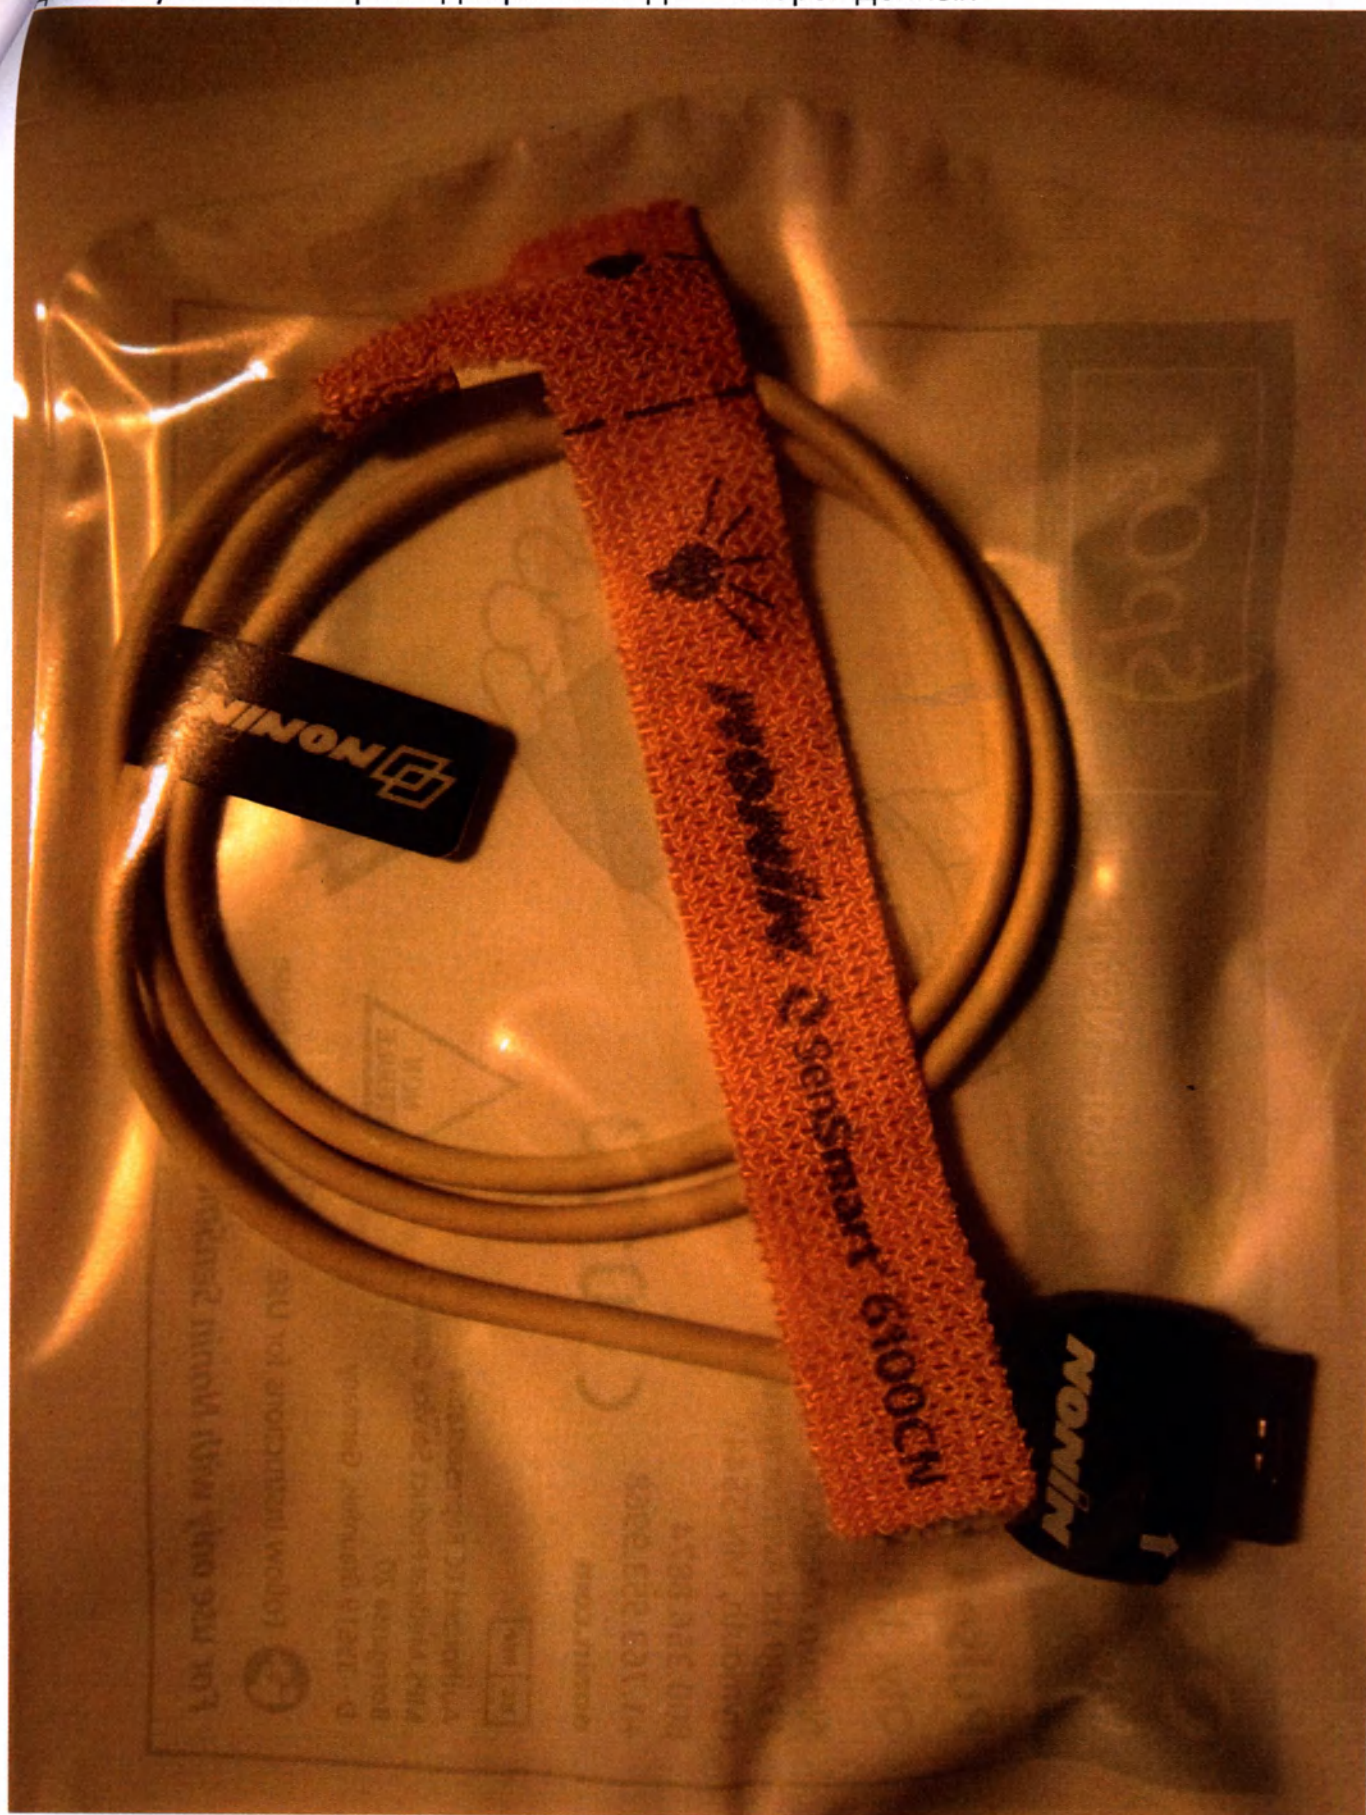

крепление на стойку


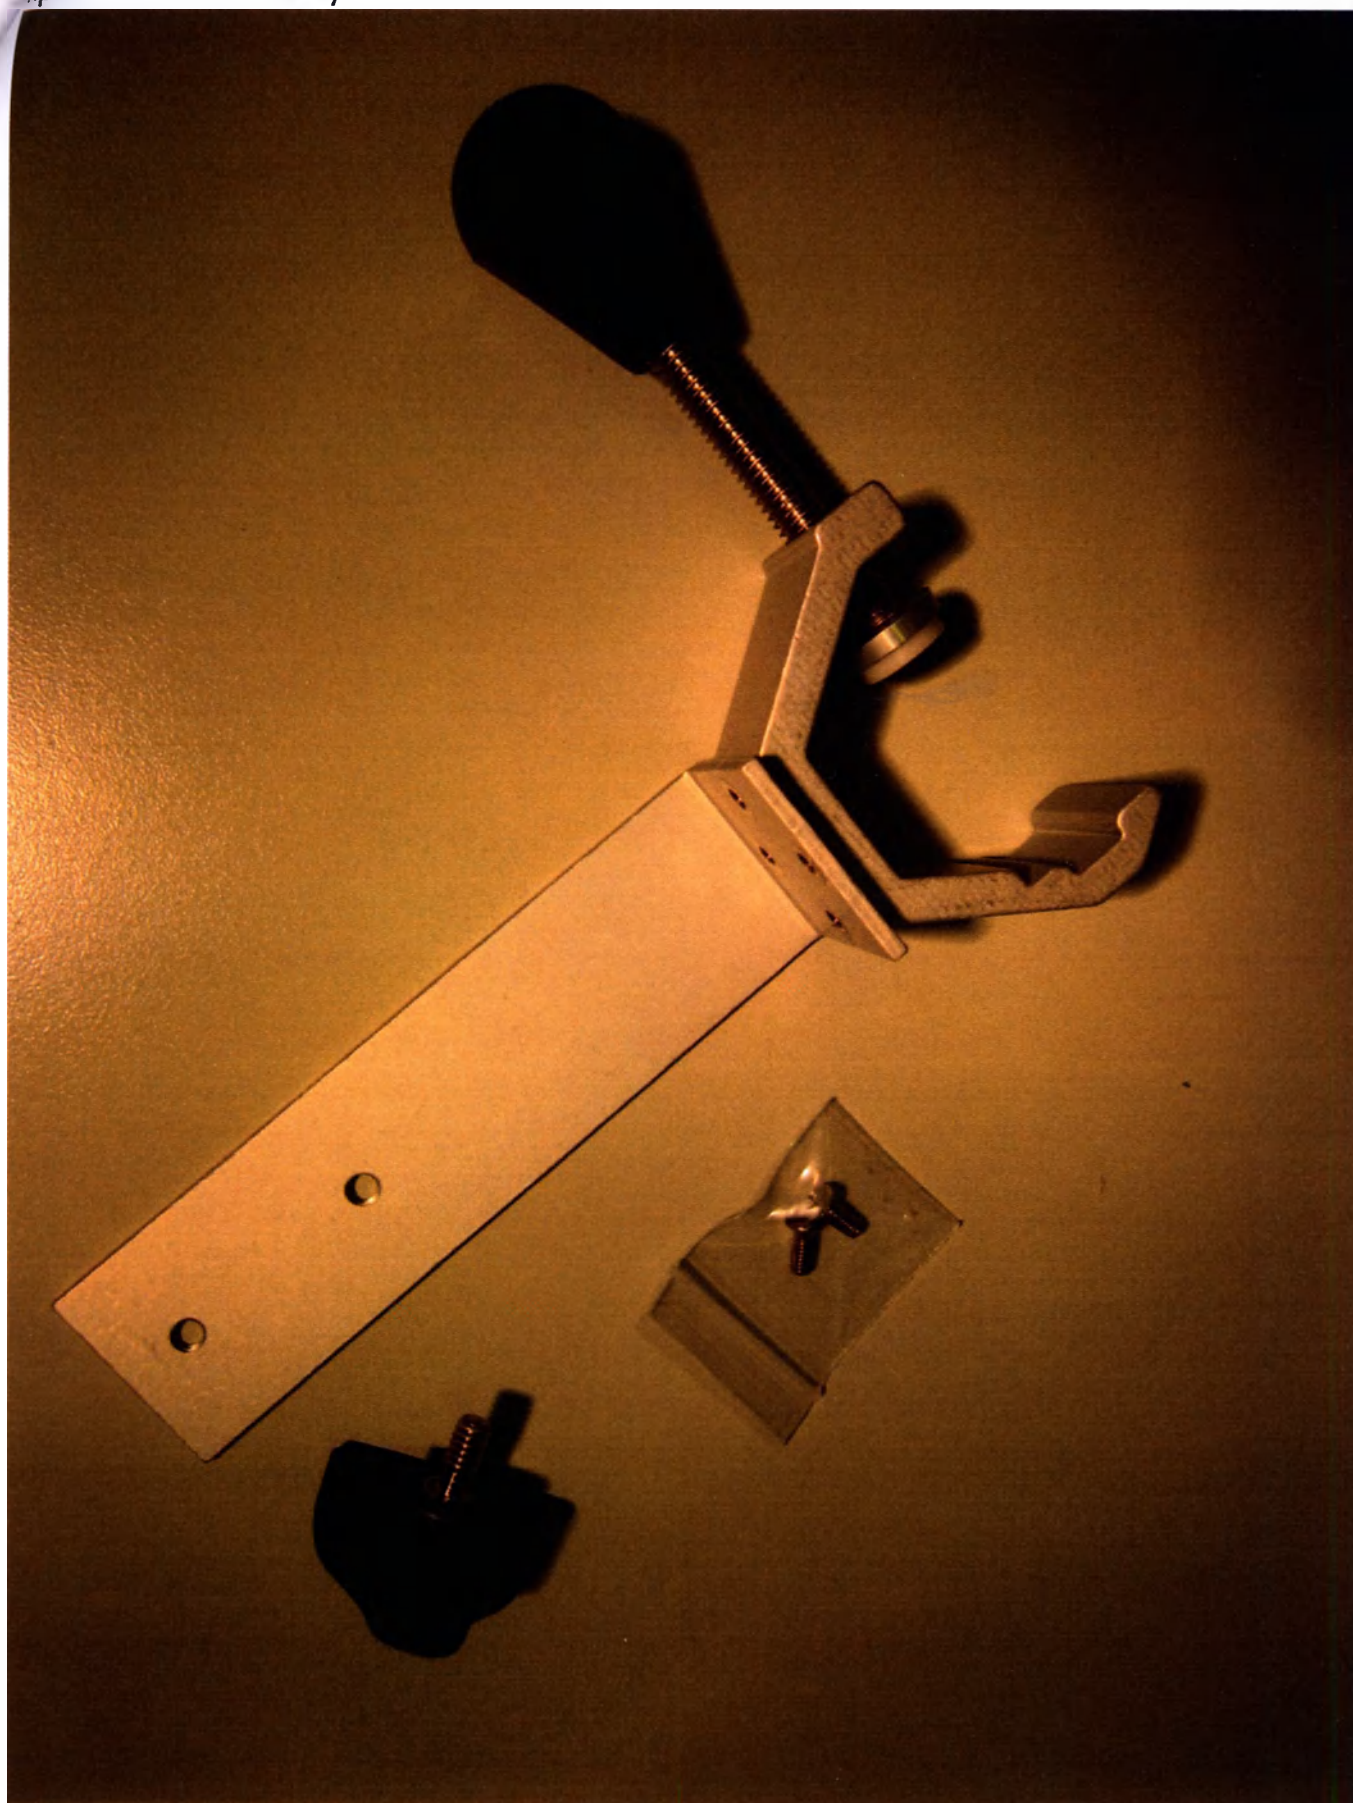


Сумка-укладка



Зажим датчика



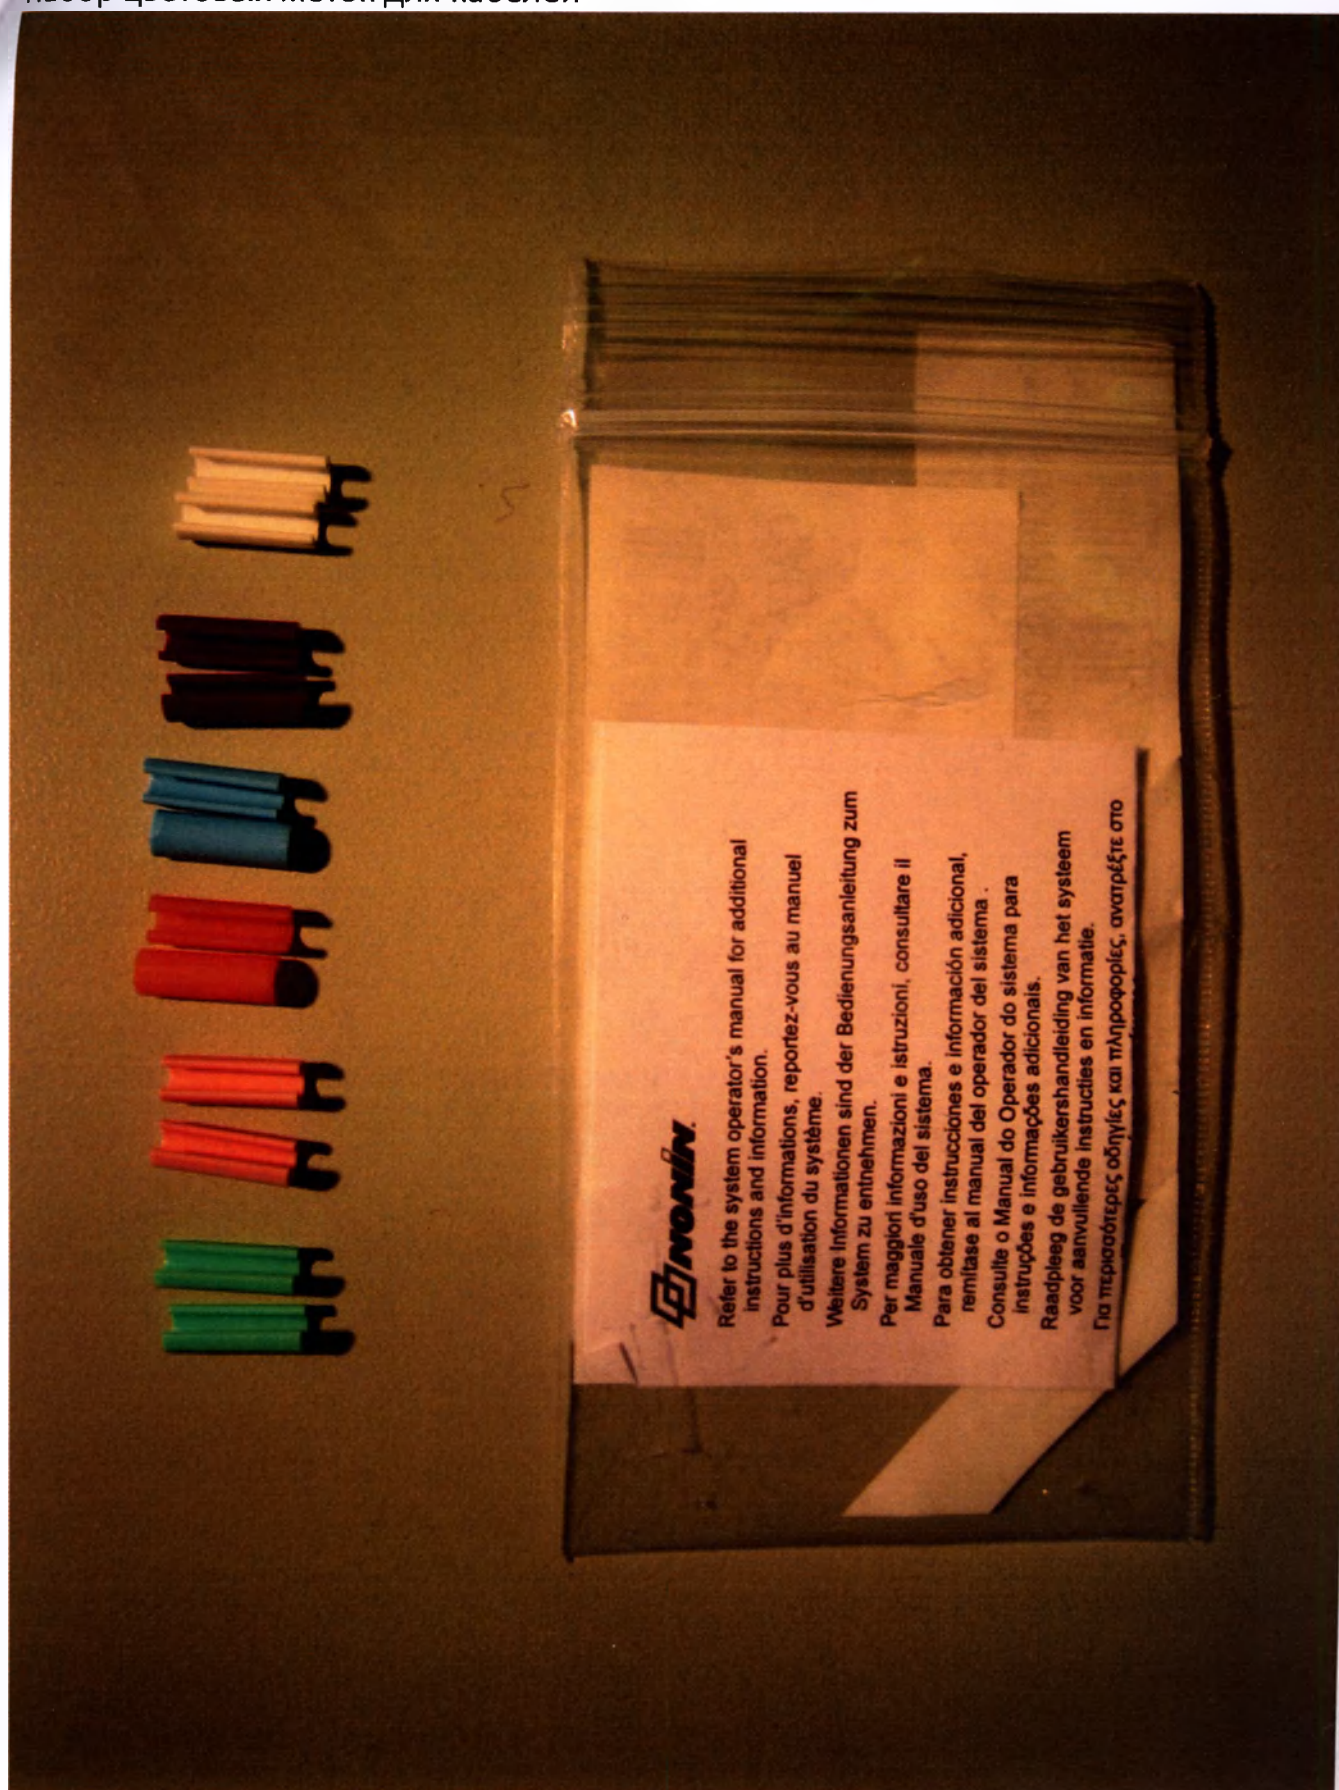

Refer to the system operator's manual for additional instructions and information.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du système.

Weitere Informationen sind der Bedienungsanleitung zum System zu entnehmen.

Per maggiori informazioni e istruzioni, consultare il Manuale d'uso del sistema.

Para obtener instrucciones e información adicional, remítase al manual del operador del sistema.

Consulte o Manual do Operador do sistema para instruções e informações adicionais.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het systeem voor aanvullende instructies en informatie.

Για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες, ανατρέξτε στο

Всего прошнуровано и пронумеровано

28 листов

Ген. директор

Шифрина Е.Б.

