


ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Автоматический анализатор осадка мочи cobas u 701
в составе, с принадлежностями»**

Производитель:

**Roche Diagnostics GmbH, "Рош Диагностикас ГмбХ",
Германия. Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim,
Germany**

Автоматический анализатор мочи cobas u 601 в составе, с принадлежностями

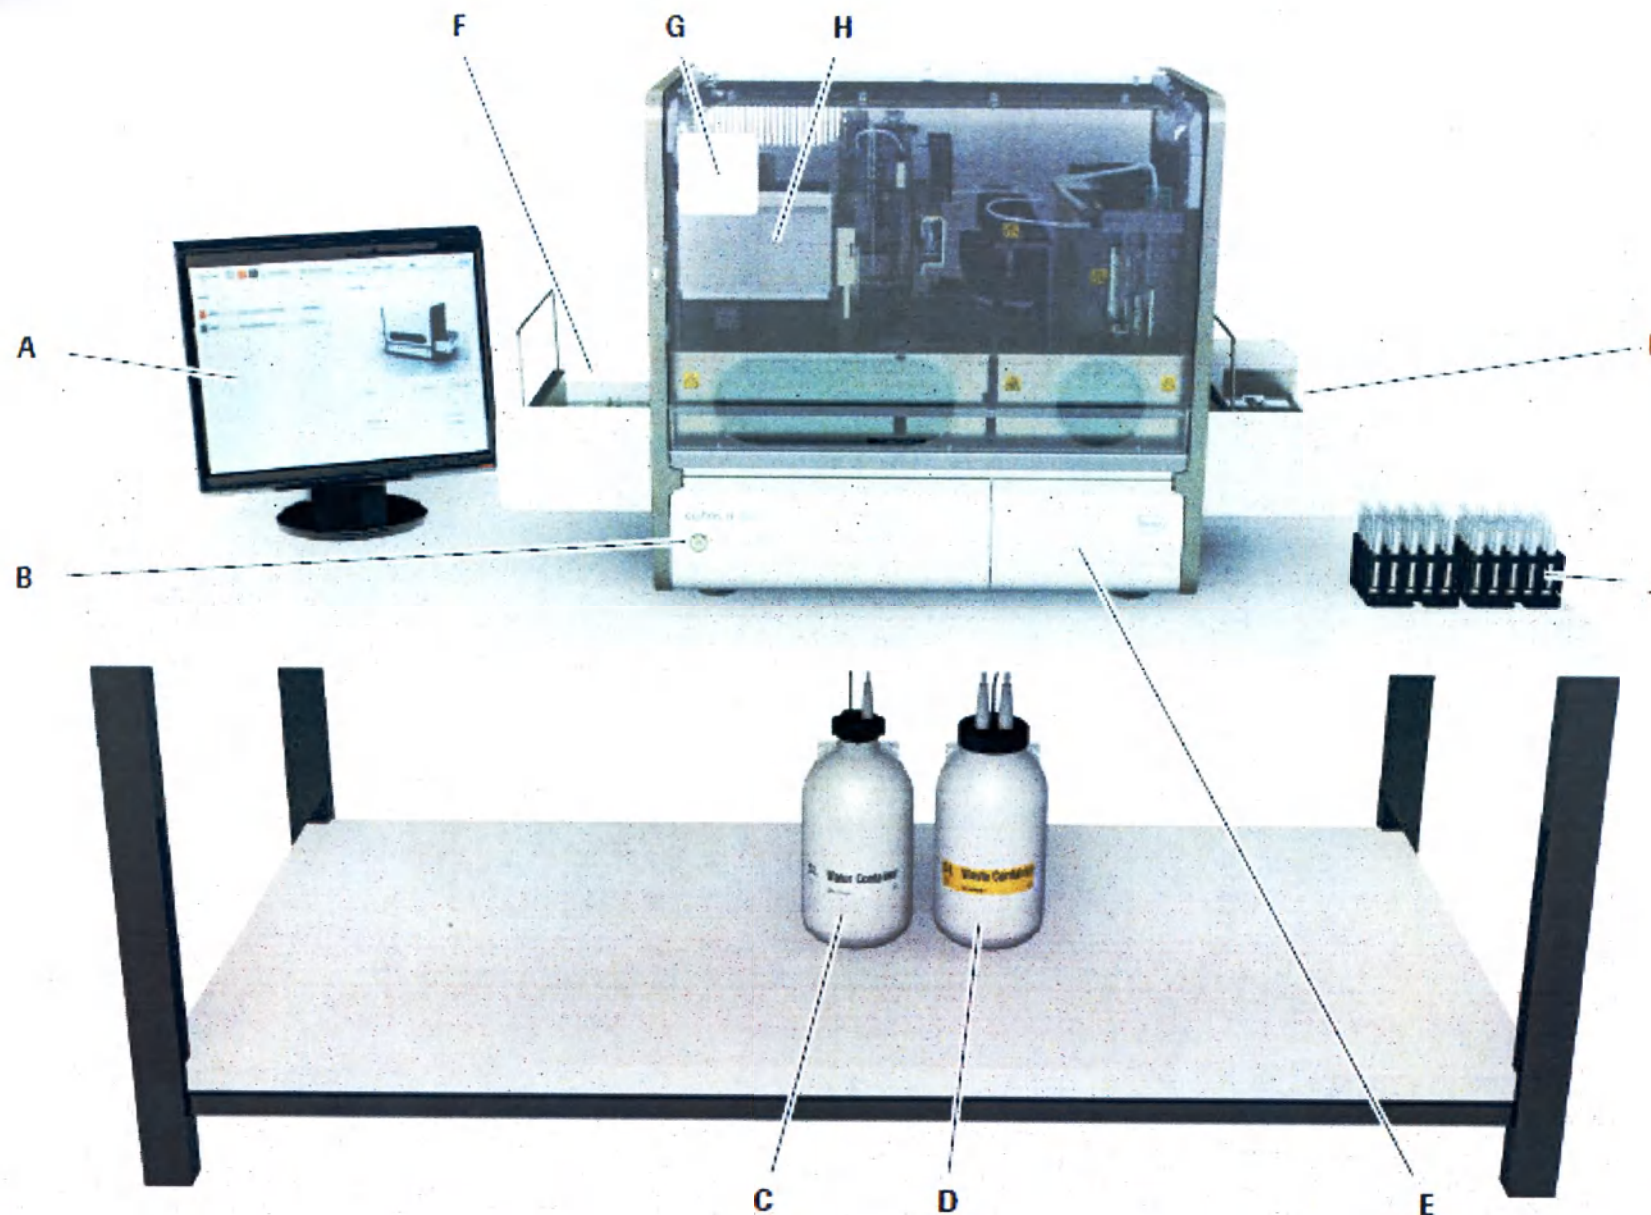





1.1. Основной блок cobas u 701





1.2. Трубка для подачи воды (Water tube)

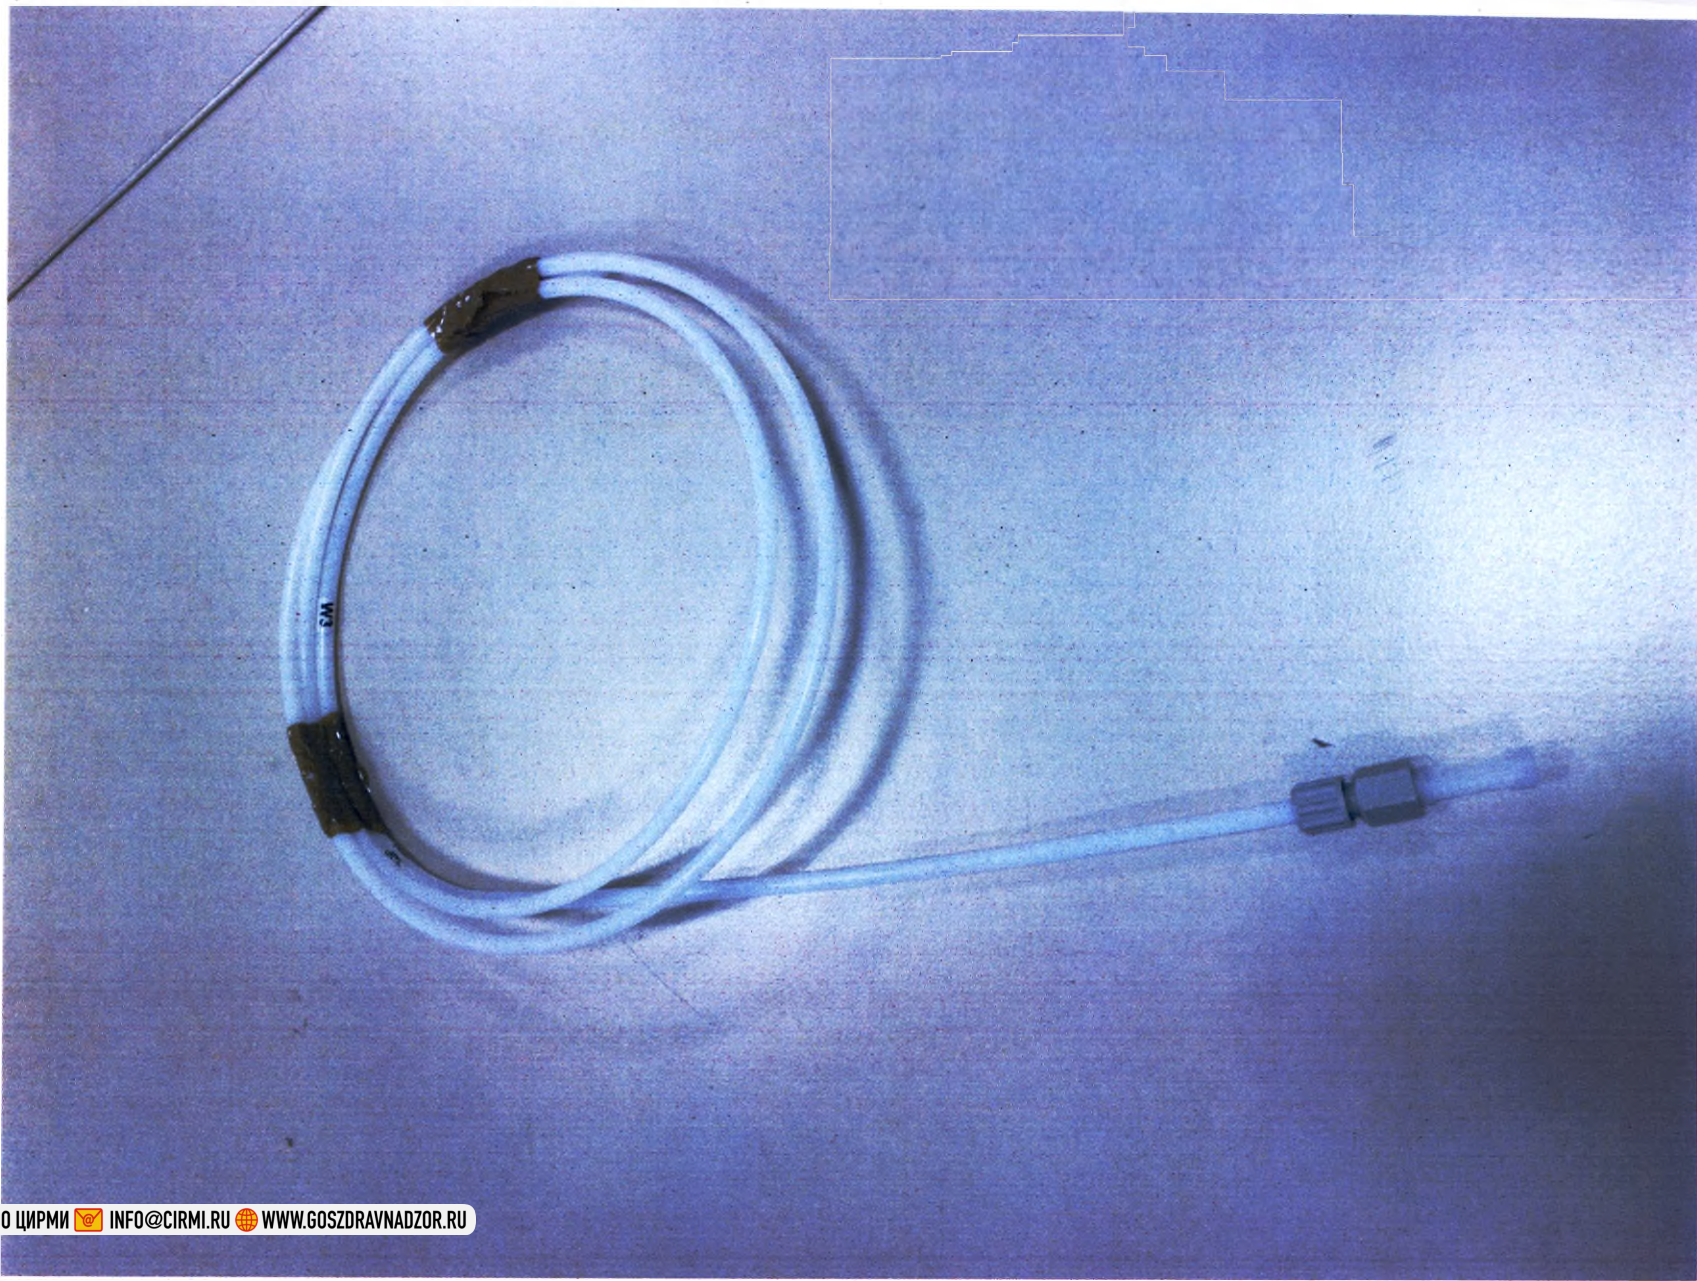



1.3. Трубка для отходов, 2 шт. (Waste tube, 2 pcs)

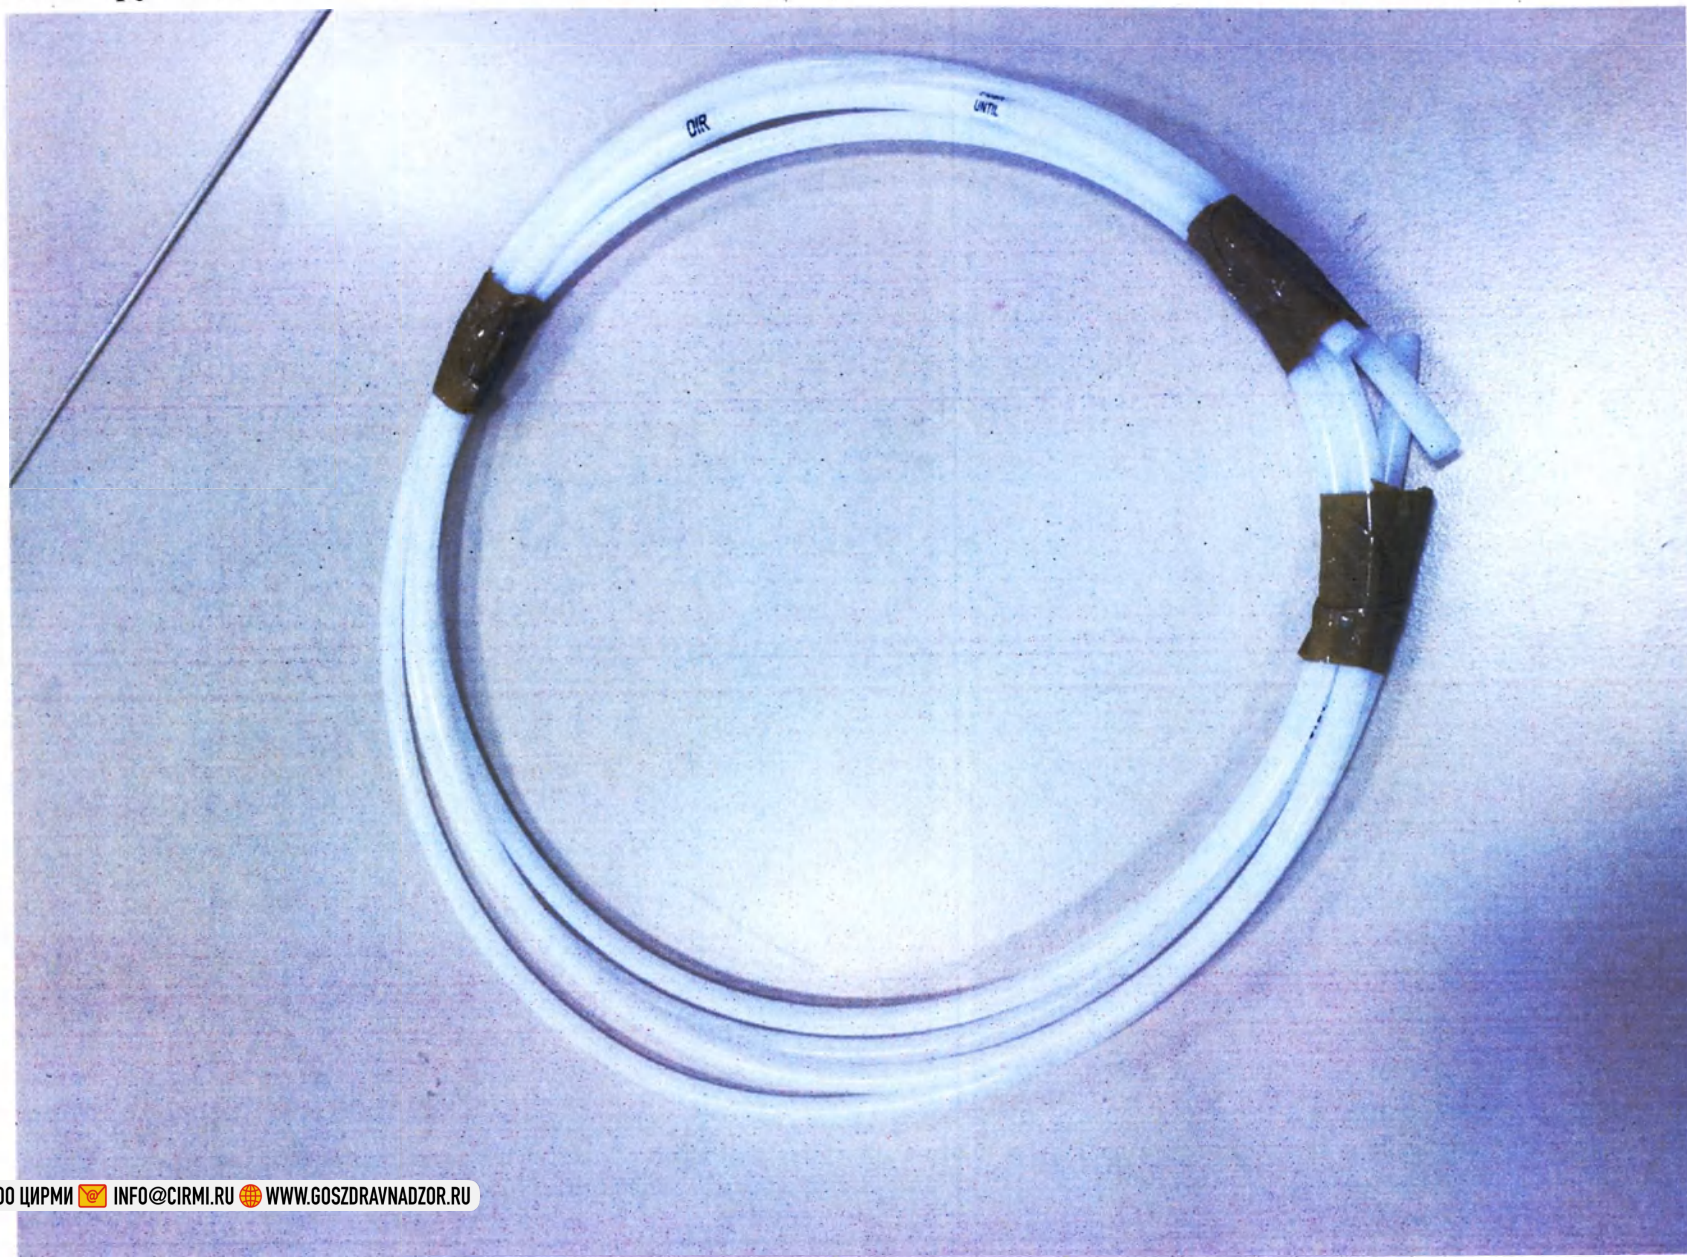

1.4. Контейнер для жидких отходов (Liquid waste container)

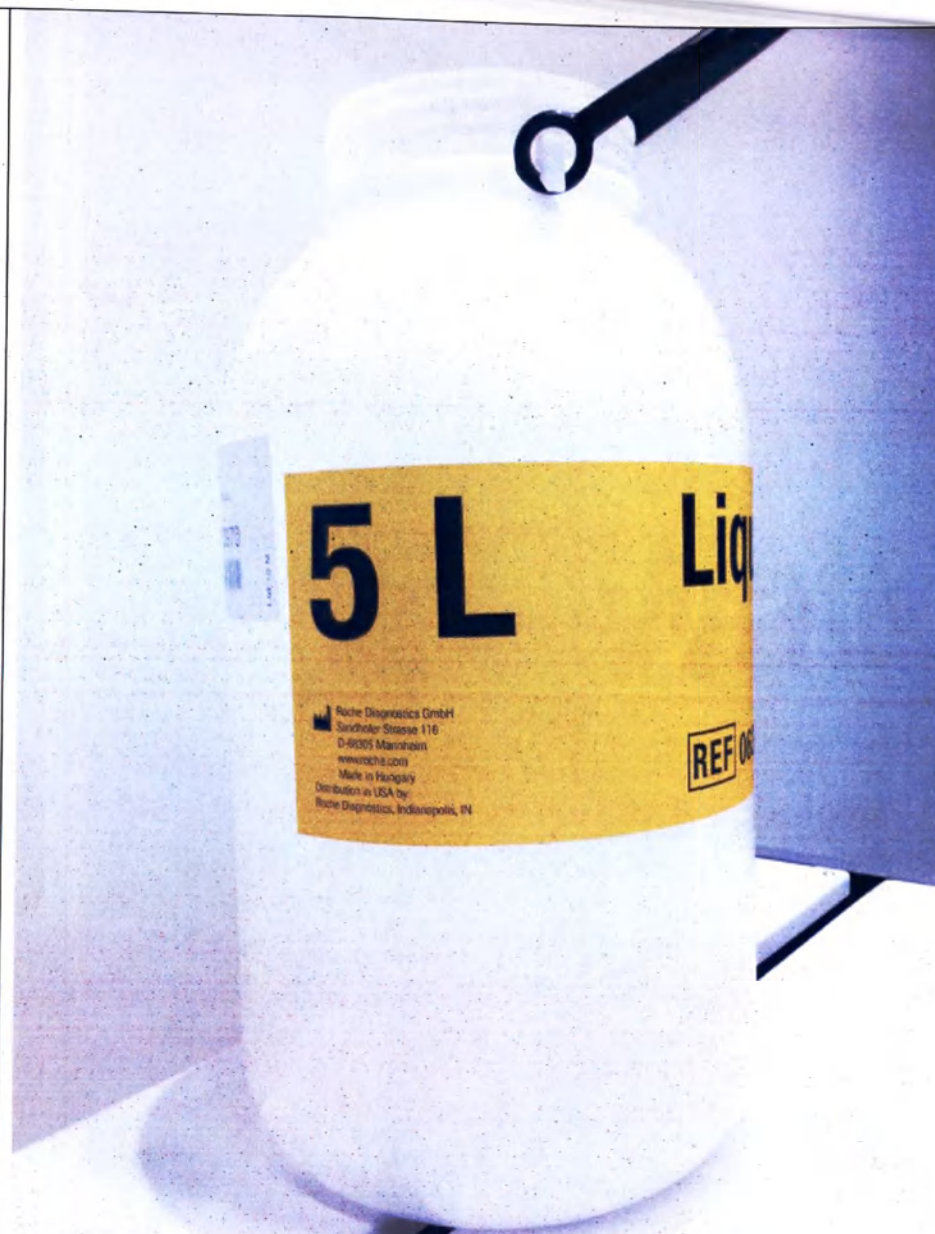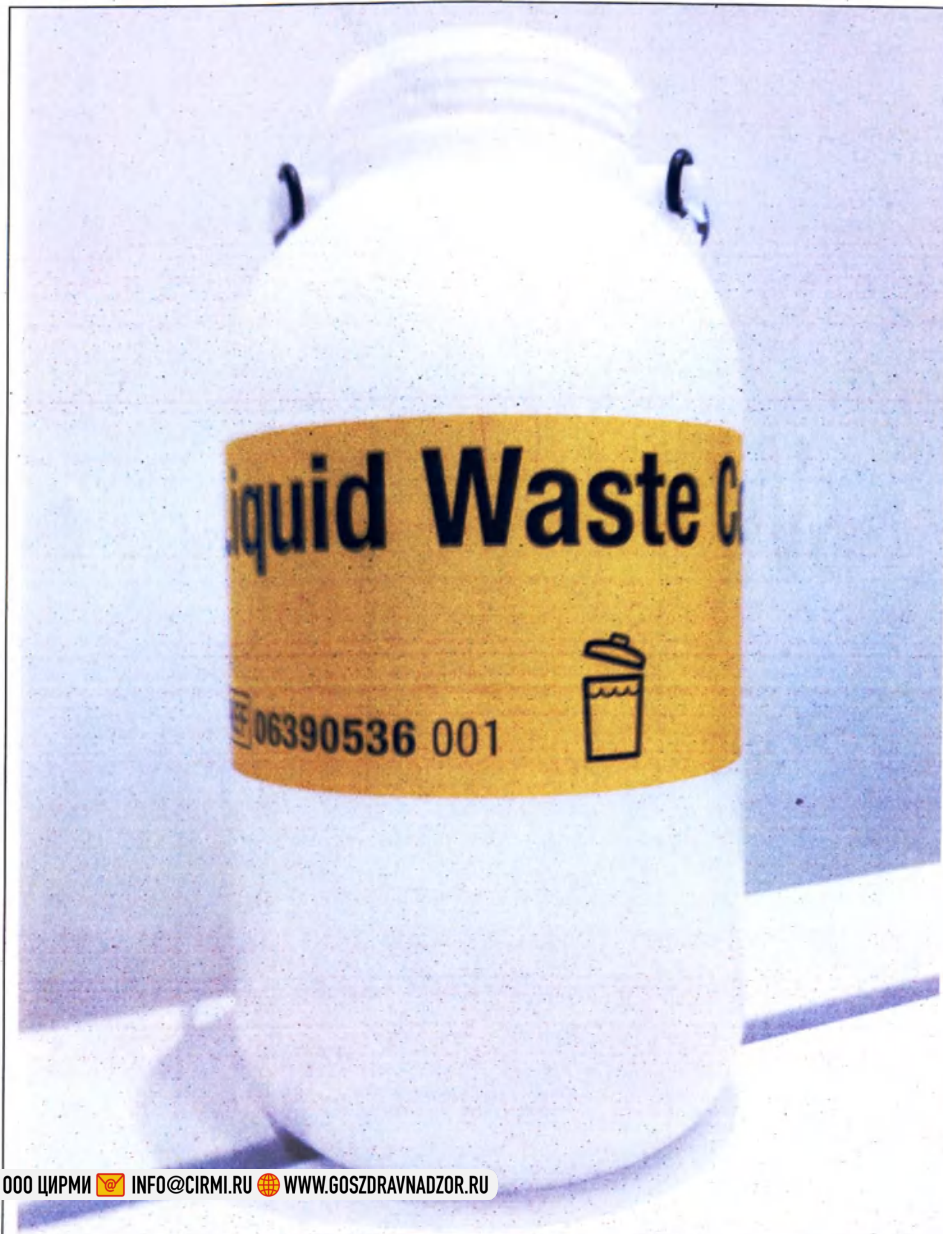


1.5. Контейнер для воды (Water container).

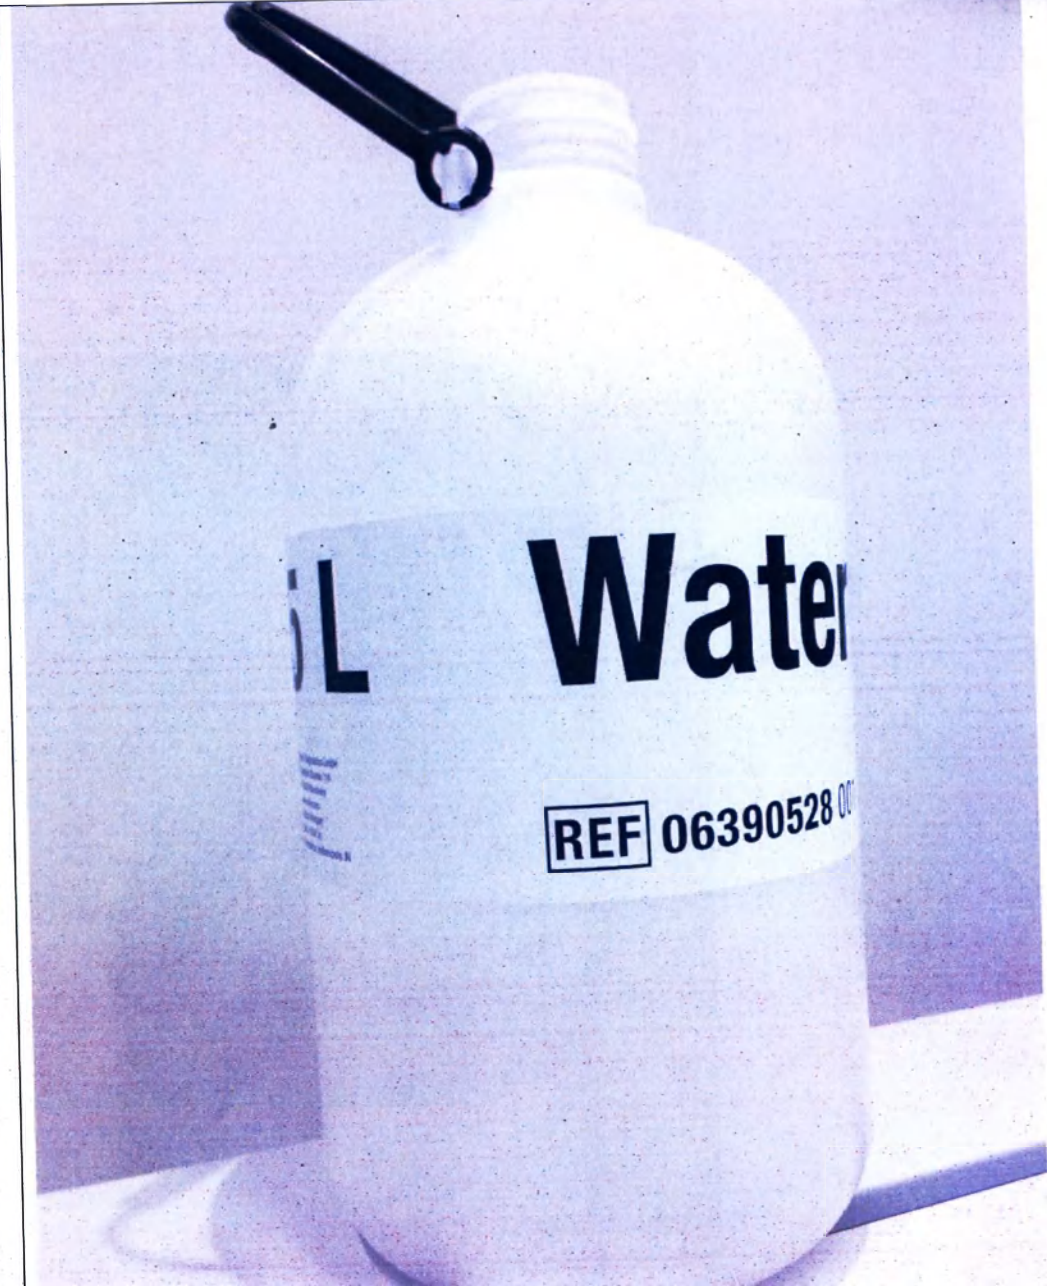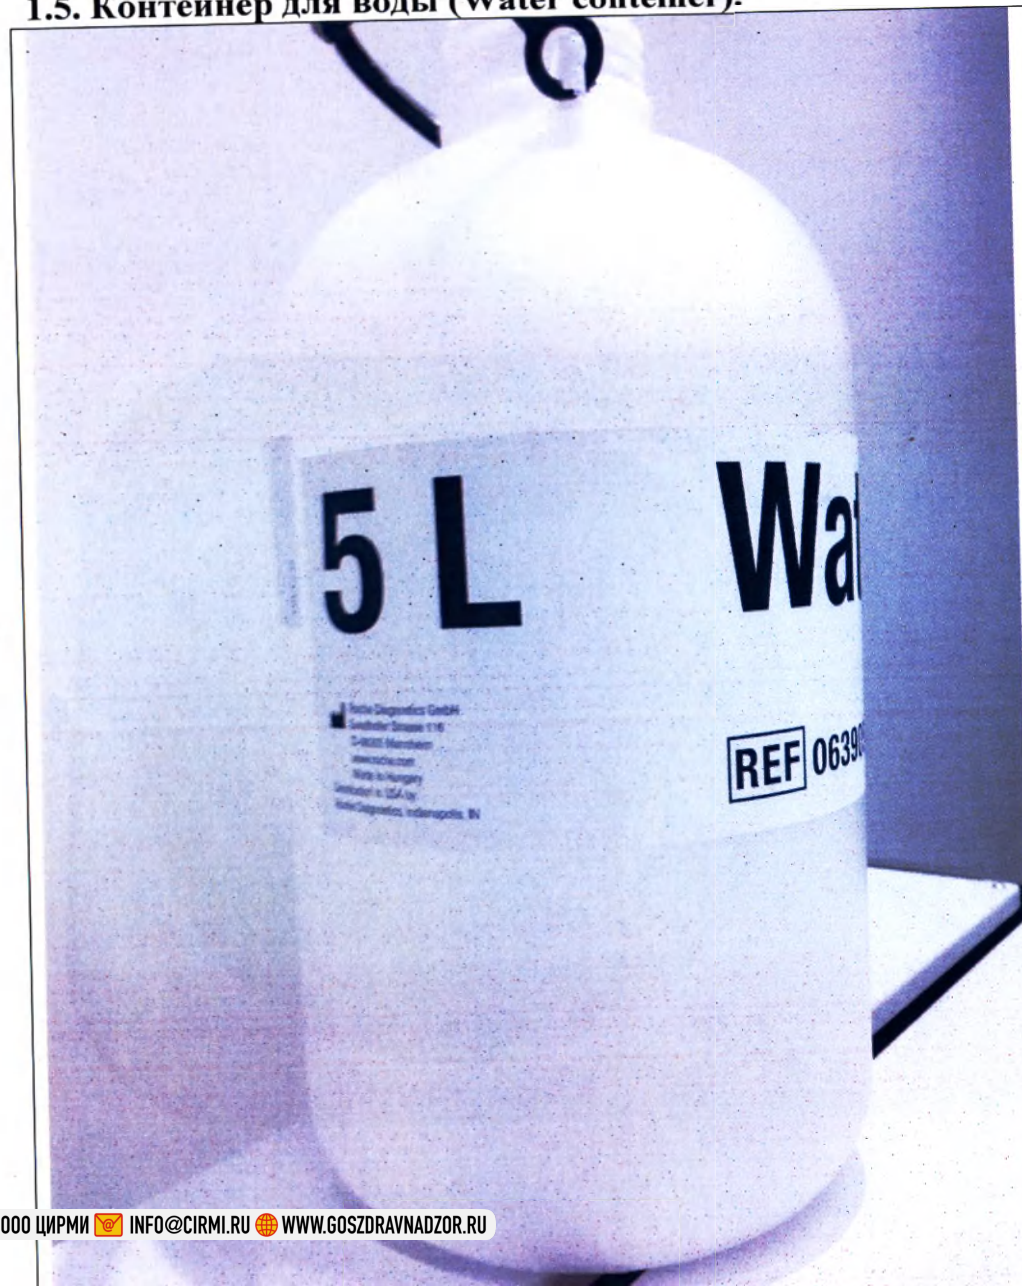

1.6. Подставка для контейнеров (Container Holder).



1.7. Игла пробозаборника (Sample probe):

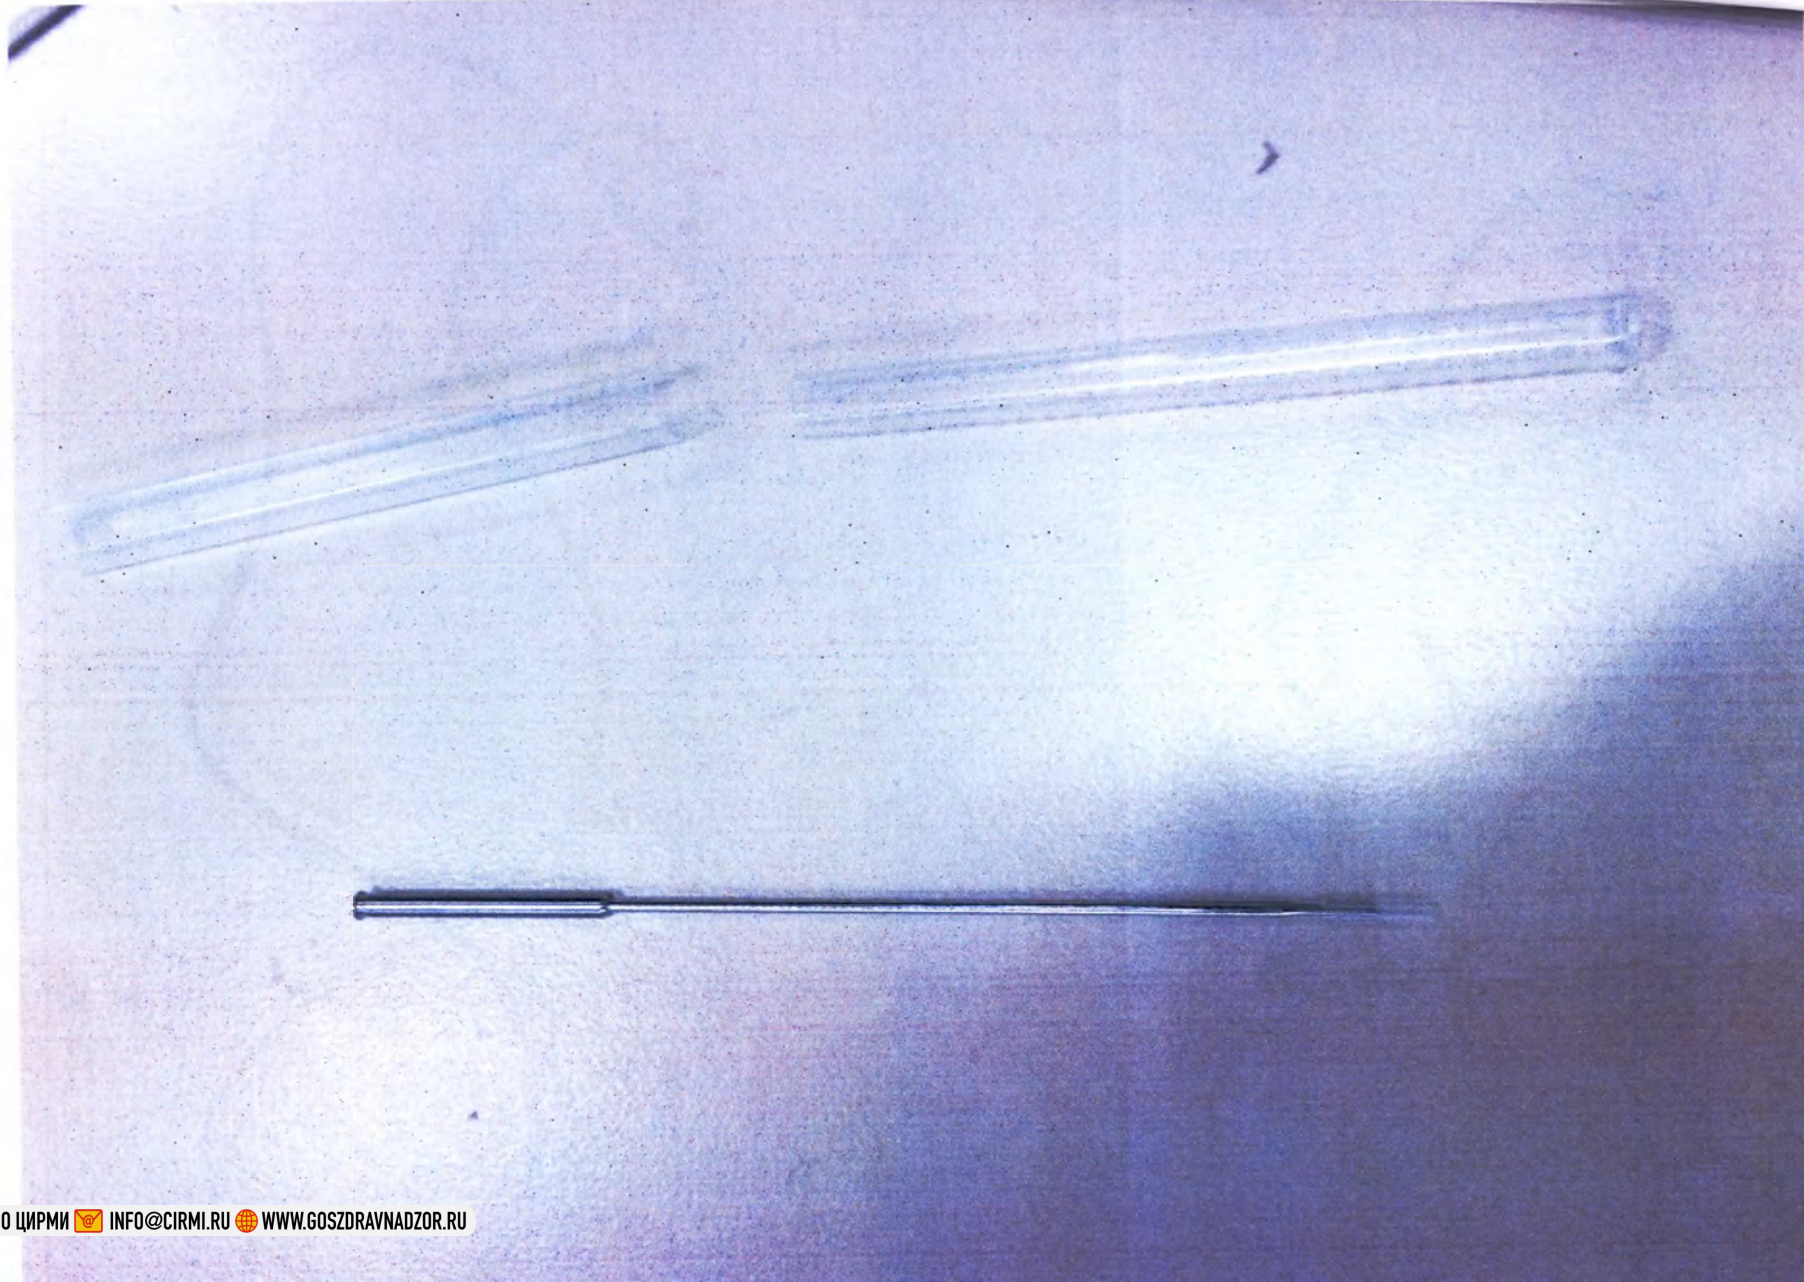

1.8. Поплавковый шток, 2 шт (Float rod, 2 pcs).



1.9. Направляющие для трубок 3 шт (Tubing guides, 3 pcs)



1.10. Референсная кювета (reference cuvette)

**Reference cuvette
cobas u 701**

REF 07127219001

COBAS and COBAS U are trademarks of Roche.




Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Made in Hungary




01

LOT


20141126

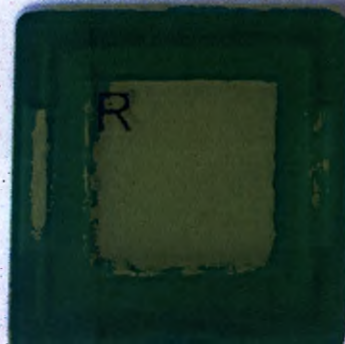


1.11. Блок промывки (pipetting stage)

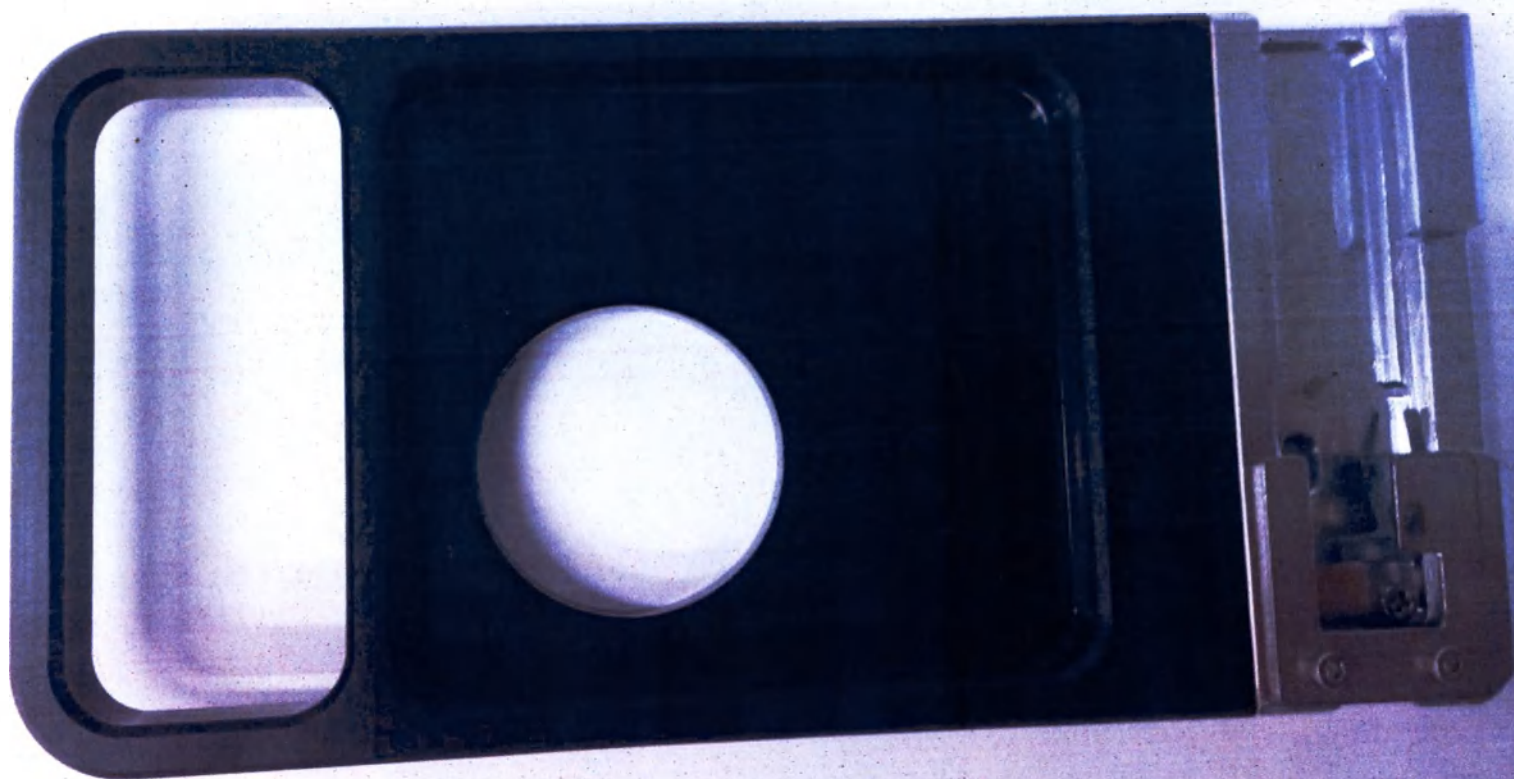


11.2. Направляющая для кюветы (cuvette guide rail)

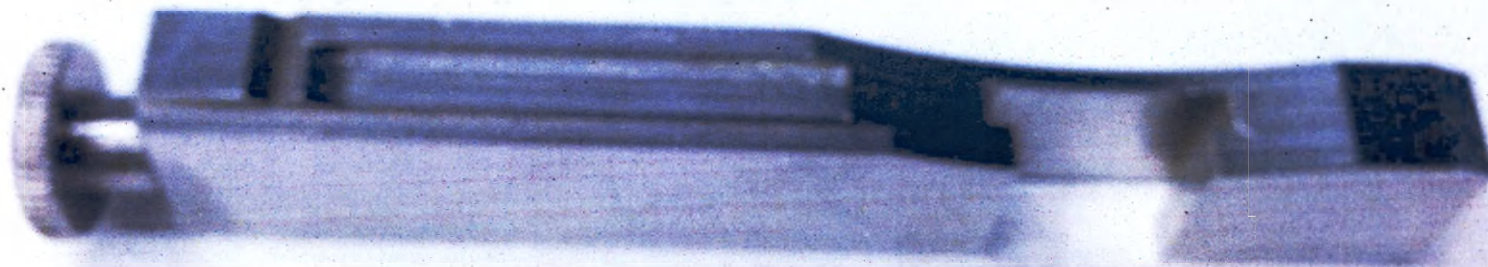


2. Набор для инсталляции cobas 6500/u 601/u 701 (Installation kit cobas 6500/u 601/u 701)
2.1. Блок загрузки штативов (Input buffer)

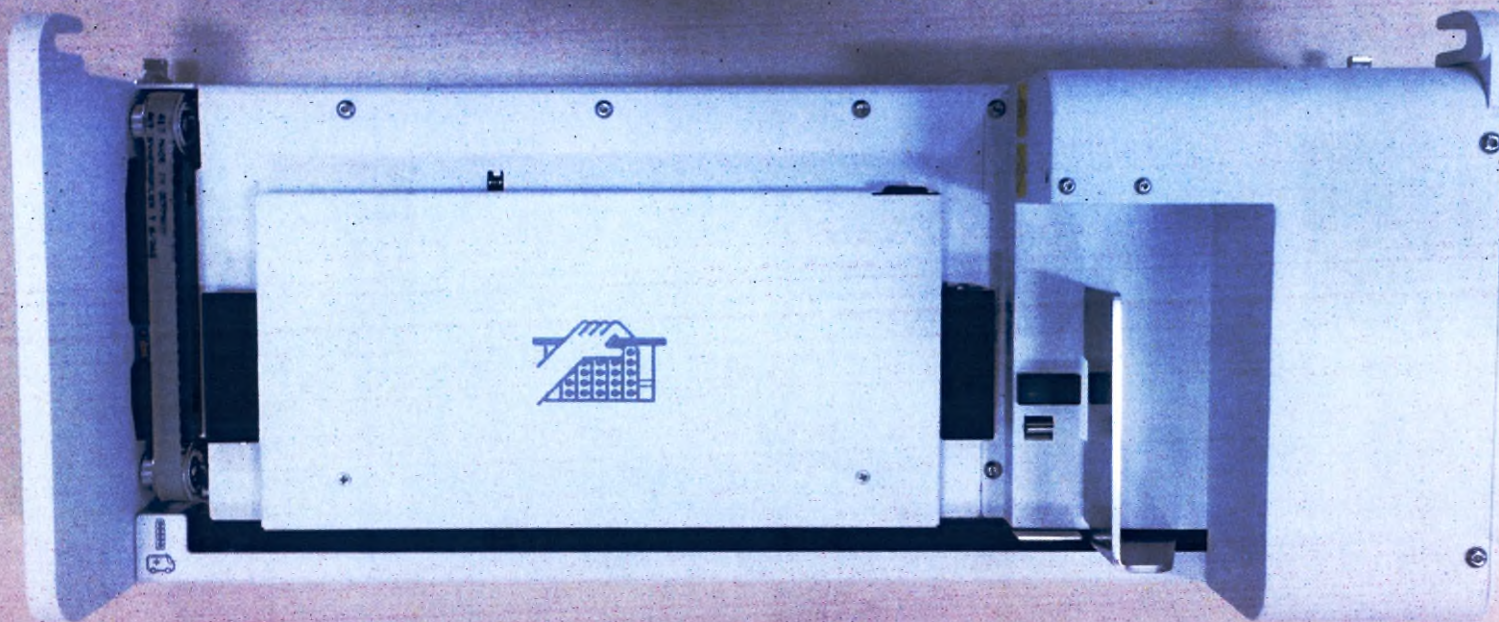


2.2. Блок разгрузки штативов (Output buffer)

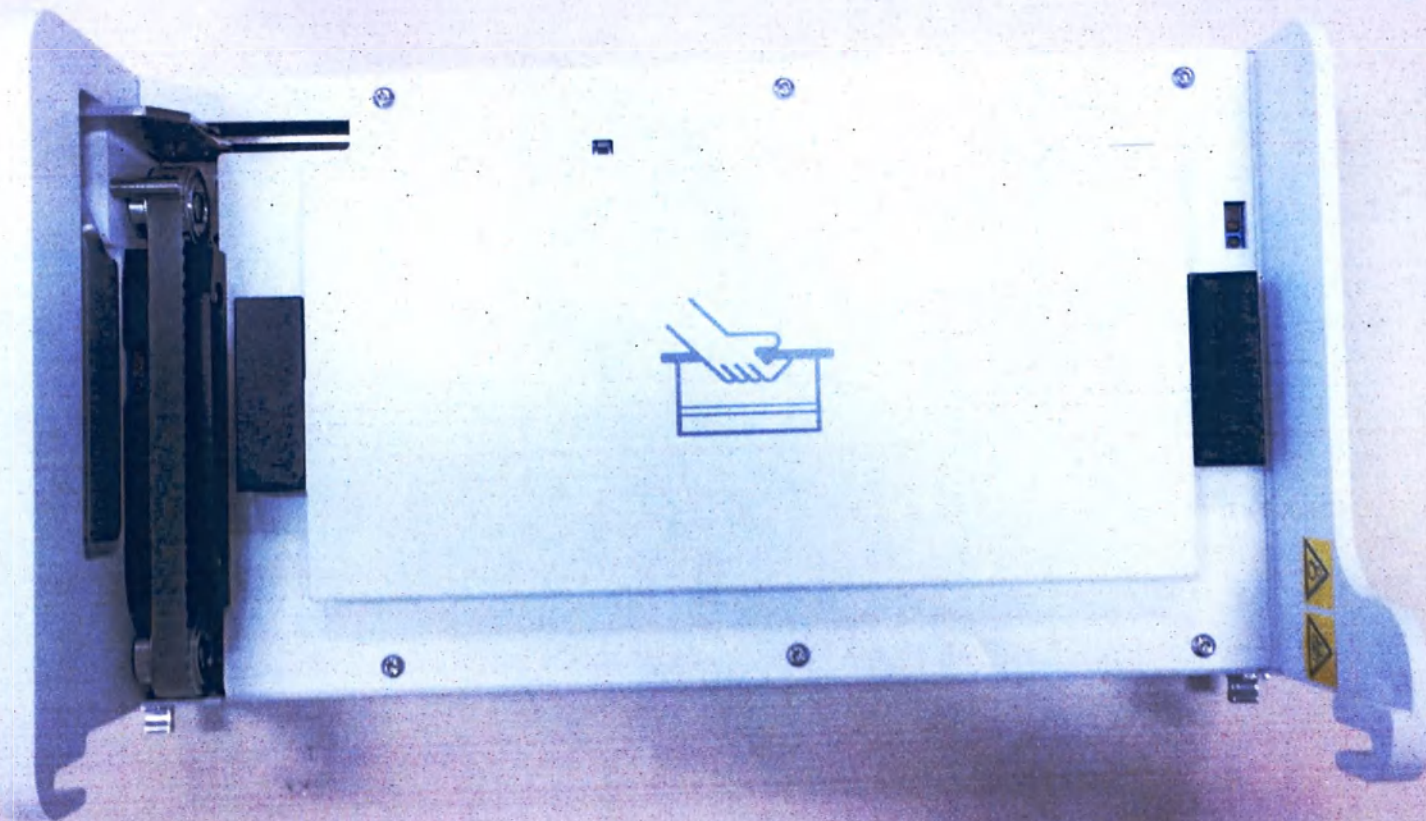

2.3. Соединительные кабели, 2 шт (Connecting cables, 2 pcs)

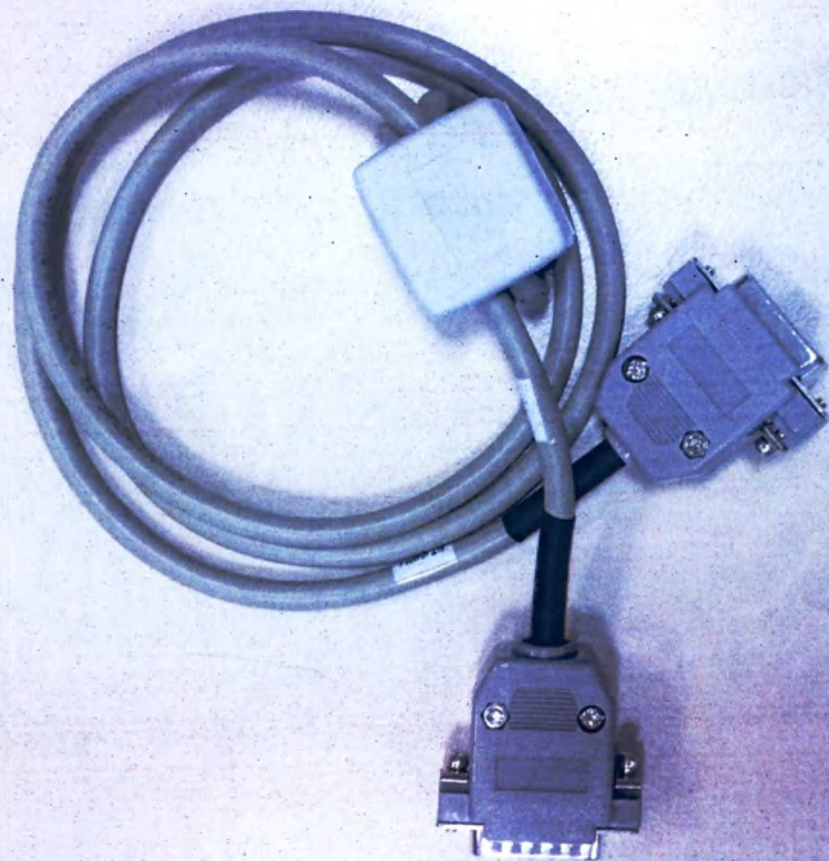

2.4. Клавиатура (Keyboard)

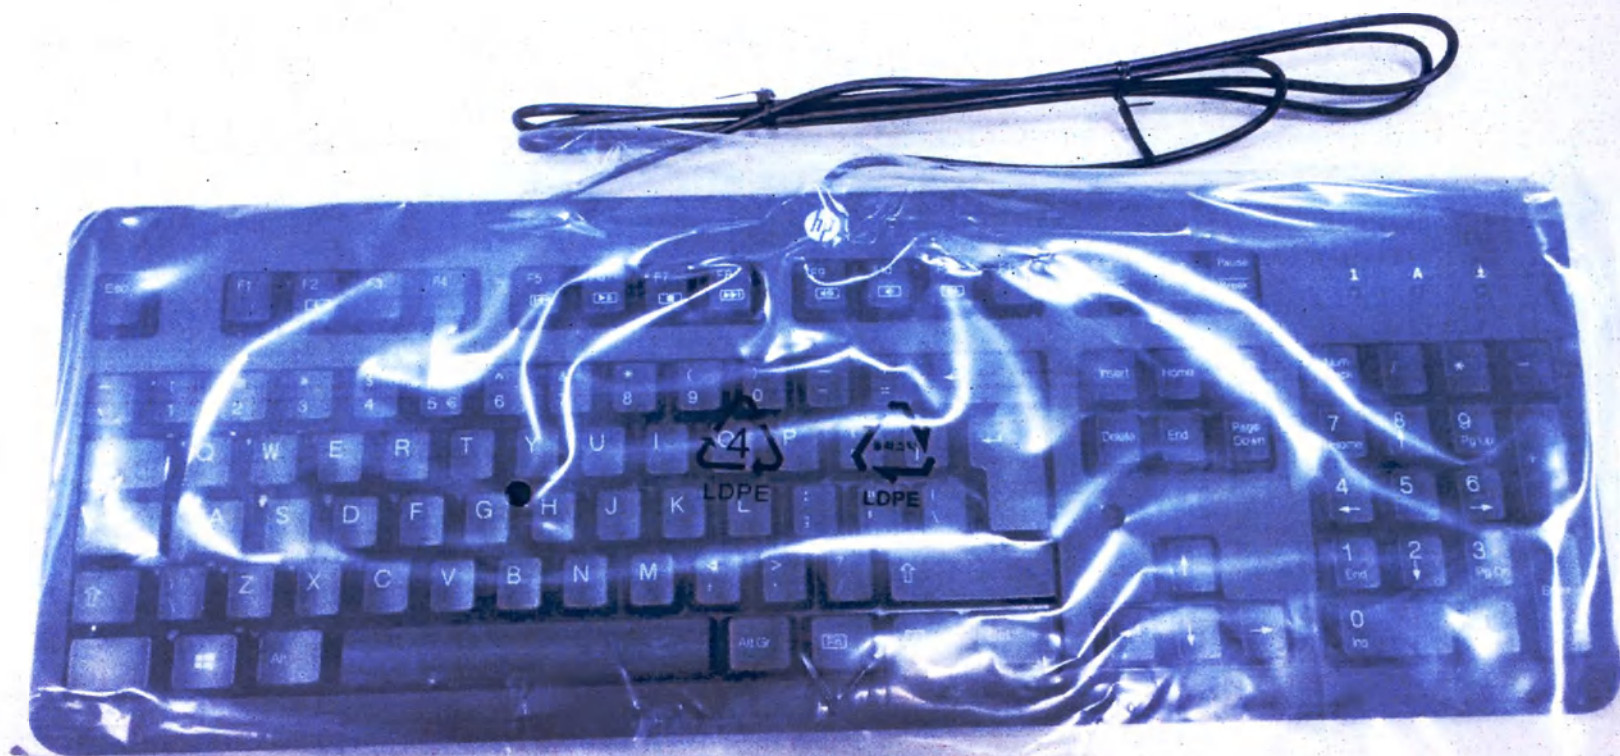

2.5. «Мышь» компьютерная (Mouse)




2.6. LAN кабель (LAN cable)




2.7. Сенсорный Монитор (Touch Screen) в комплекте

2.7.1. Сенсорный Монитор (Touch Screen)

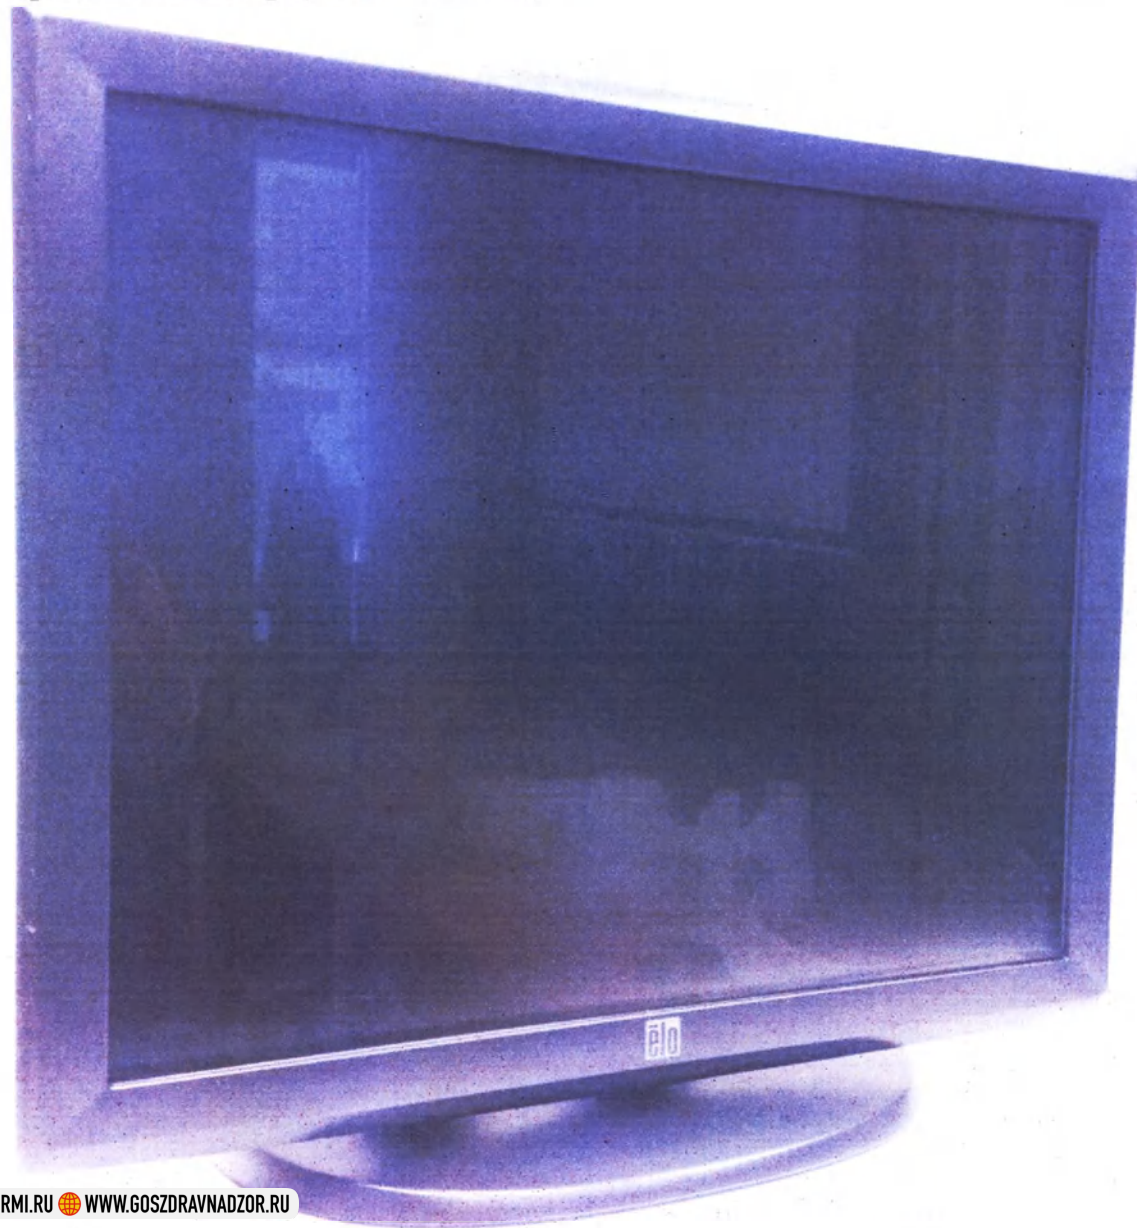

2.7.2. -кабель питания (Power cable)

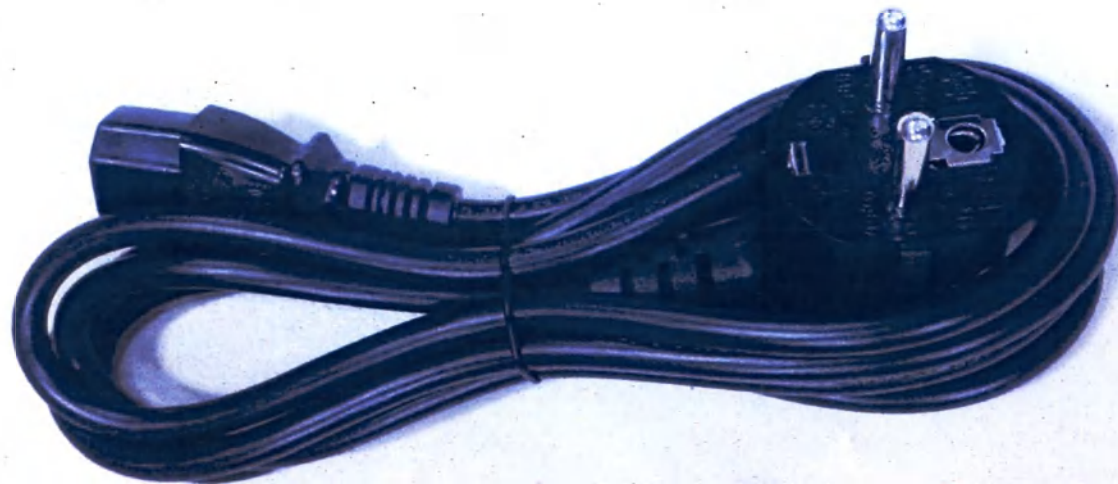

2.7.3. Блок питания (Power adapter)




2.7.4. USB кабель (USB cable)



2.7.5. кабель для подключения к анализатору/компьютеру (VGA Cable)




2.7.6. кабель для подключения к анализатору/компьютеру (connecting cable)

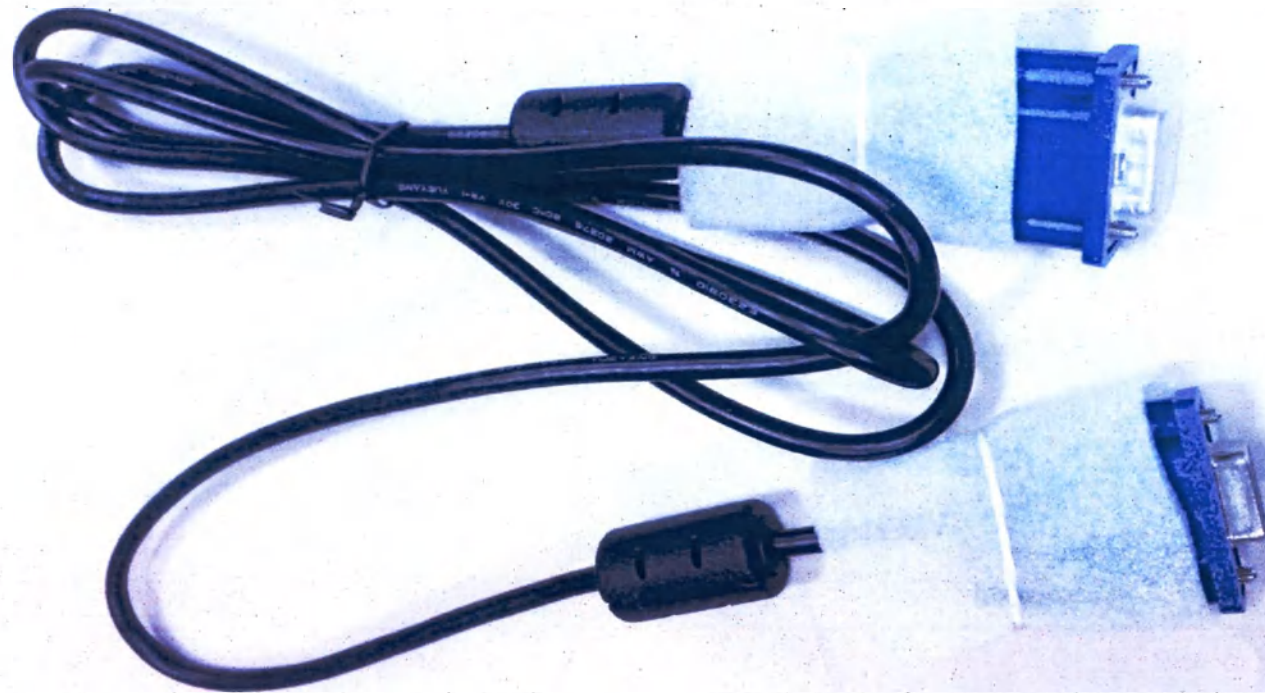

РИНАДЛЕЖНОСТИ.

3. Картонная коробка для отходов, 1x30 шт (Waste box, 1x30 pcs)

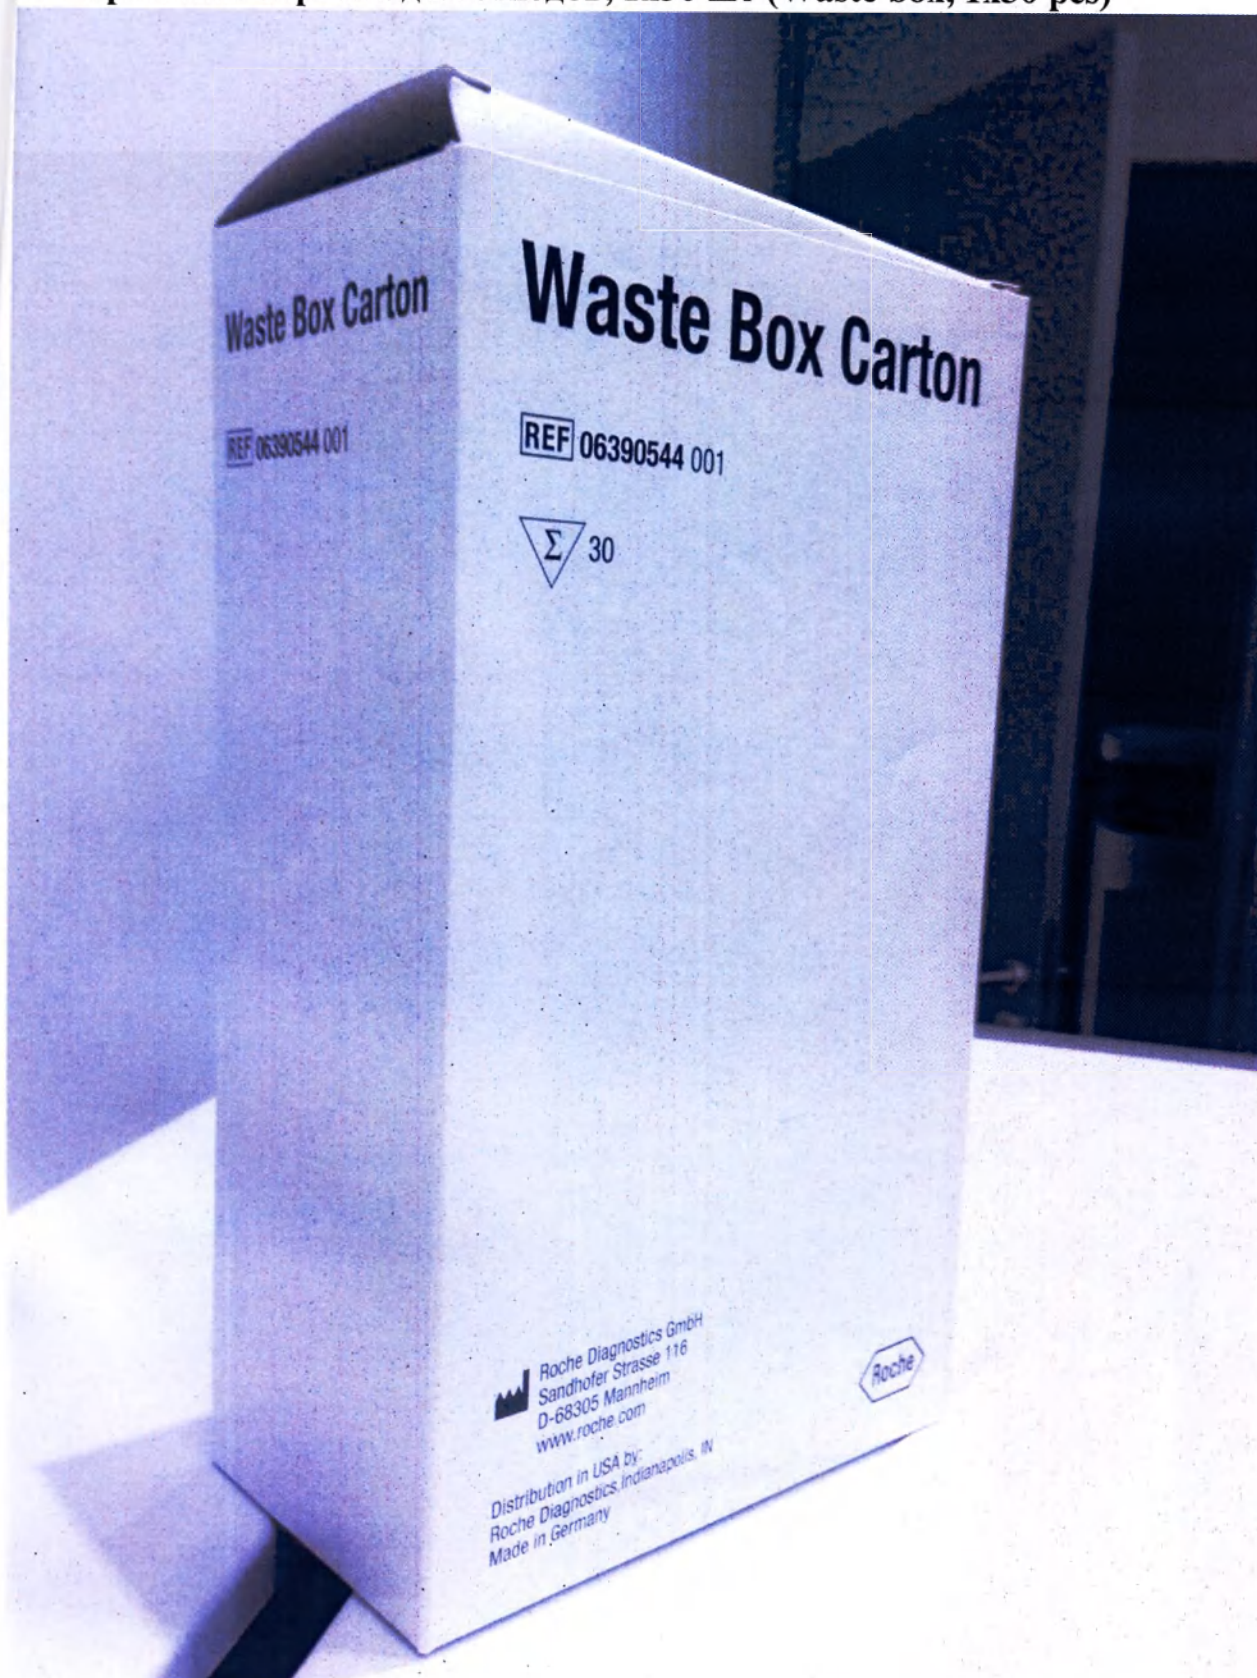


4. Поднос для штативов на 75 позиций, складной (Rack tray, 75 pos, collapsible)




5. Штатив для проб RD 0001-0050 серый, 1x50 шт (RD standard rack 0001-0050, 1x50 pcs)



6. Штатив для промывки, зеленый, 1x2 шт (STD-rack, Wash W999, green, 1x2 pcs)

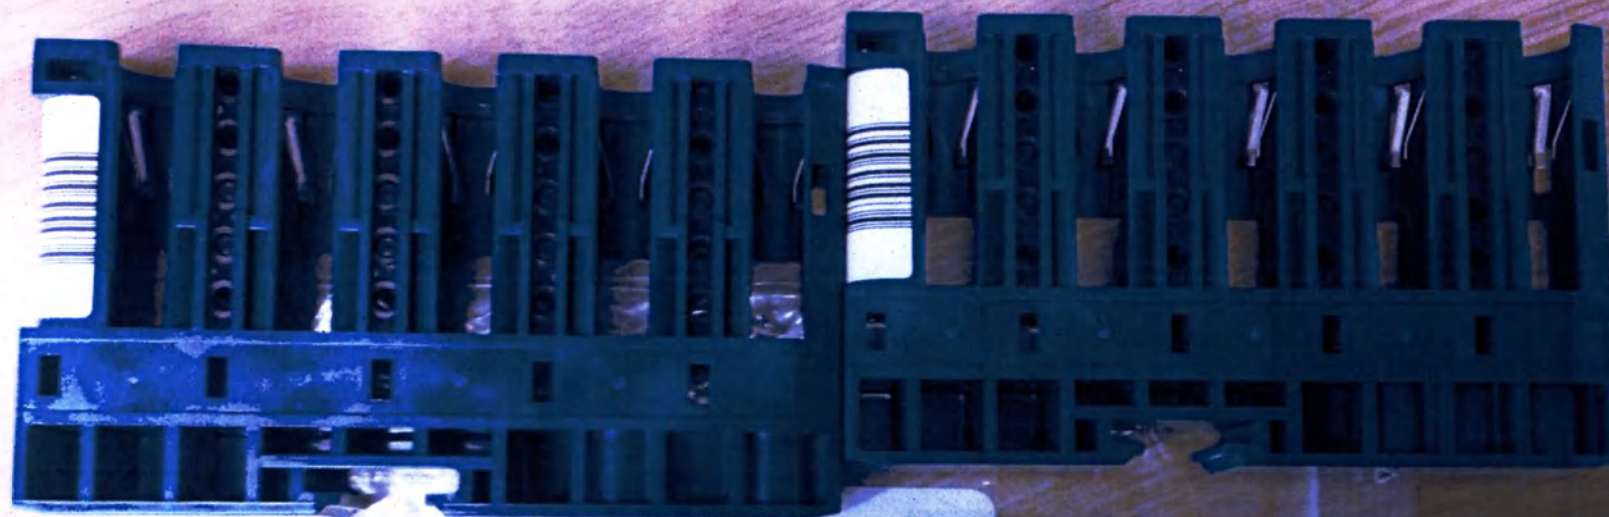

			
Mat. No. 12025728001		Inspected by TW	
STD-RACK, WASH W999 GREEN (2 PCS)			
Visual ID: W999, Barcode ID: 10999			
1 Series of 2 Racks		Lot No. _____	
Country of Origin: Japan			

7. Штатив для контроля качества, белый, 1x10 шт (STD-rack, Control Q001-Q0010, white, 1x10)





Всего пронумеровано
прошнуровано и
скреплено печатью
32/мз 400 8/мз
Лучина И.А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

29 СЕН 2015