


ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Автоматический анализатор мочи cobas u 601 в
составе, с принадлежностями»**


Производитель:

Roche Diagnostics GmbH, "Рош Diagnostикс ГмбХ",
Германия. Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim,
Germany

Автоматический анализатор мочи Cobas u 601 в составе, с принадлежностями

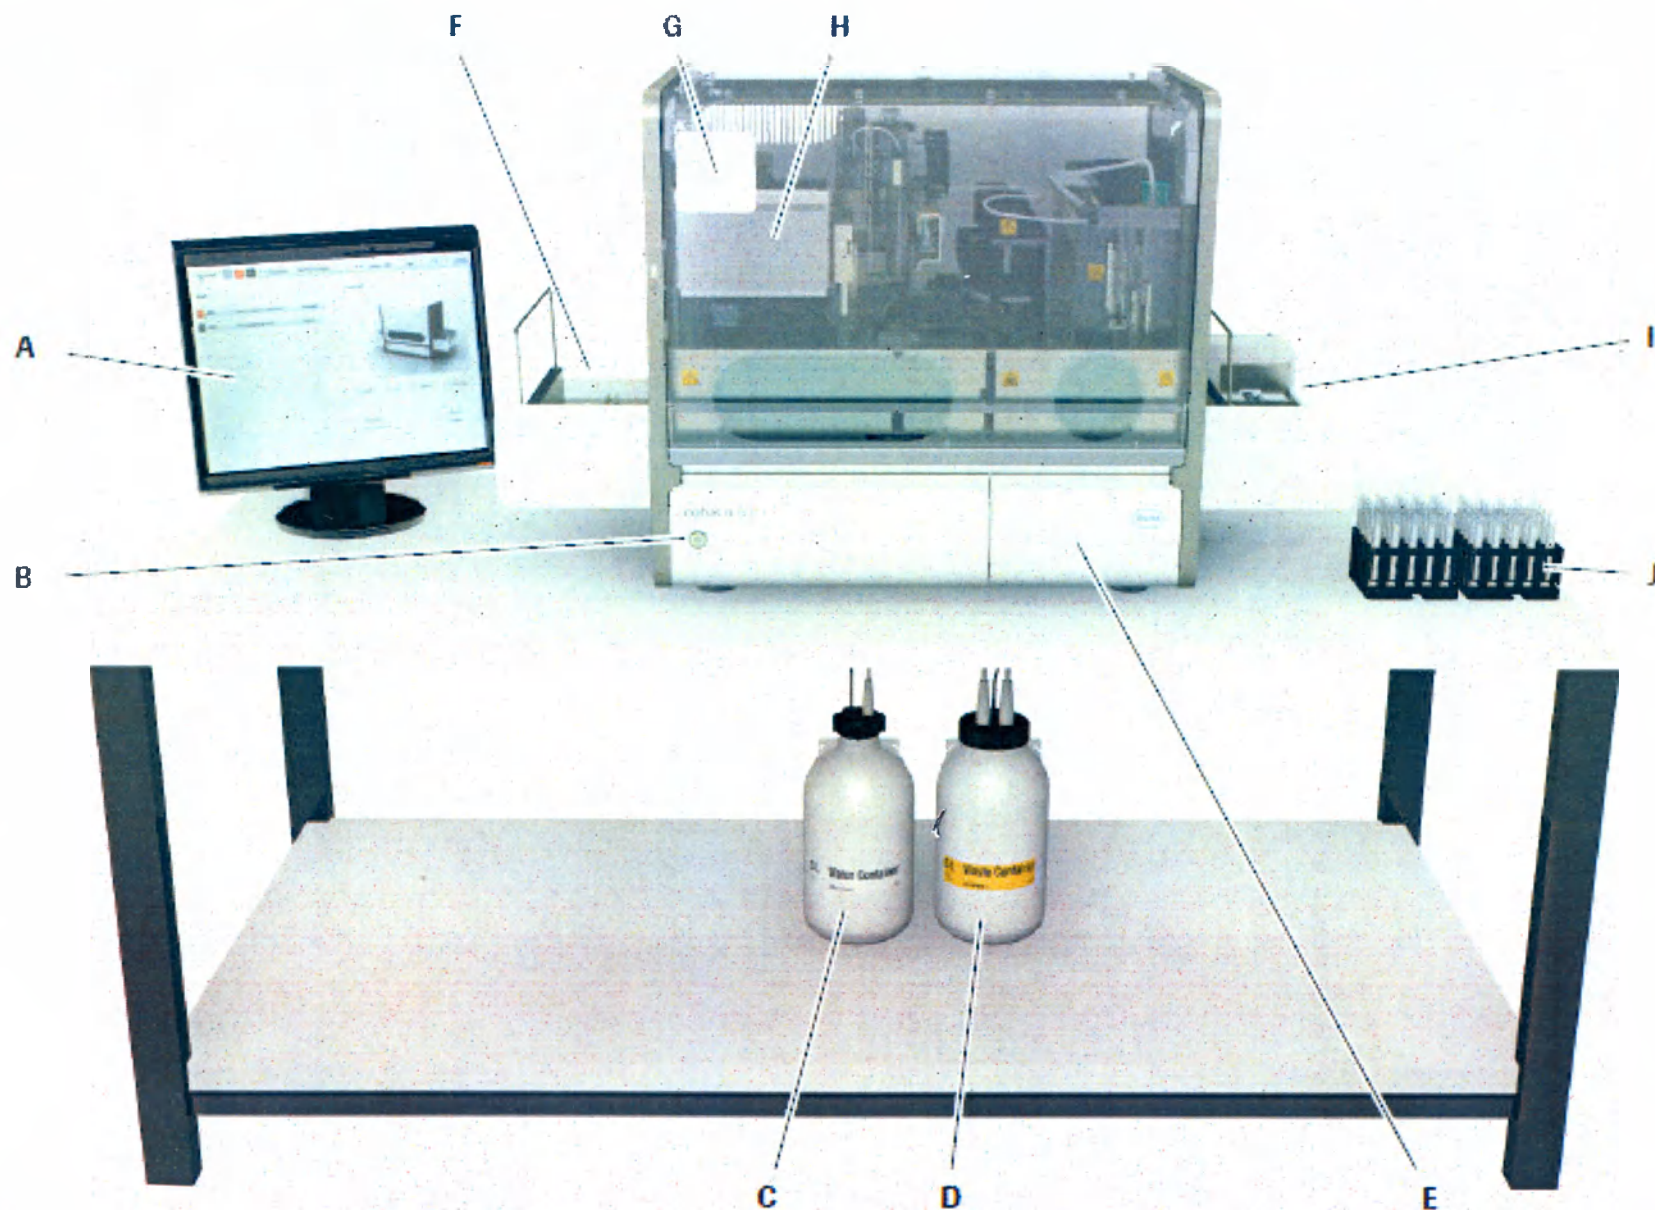


Автоматический анализатор осадка cobas u 601, общий вид

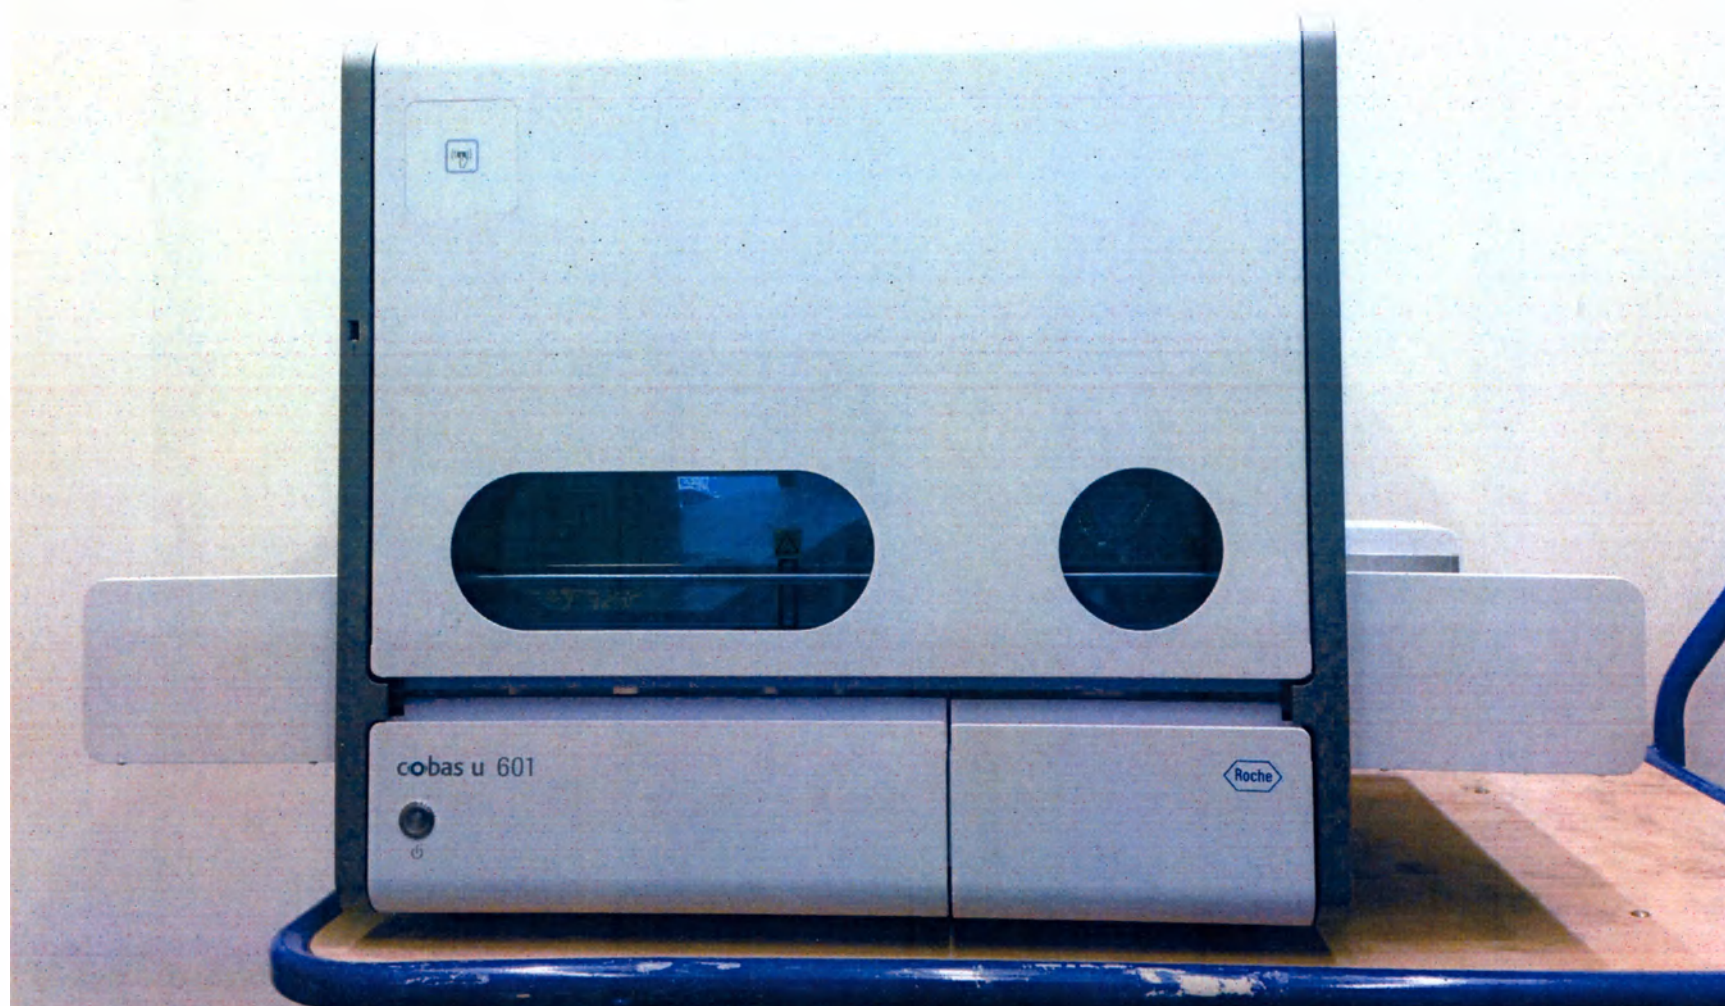


1.1. Основной блок cobas u 601



1.2. Трубка для подачи воды (Water tube)

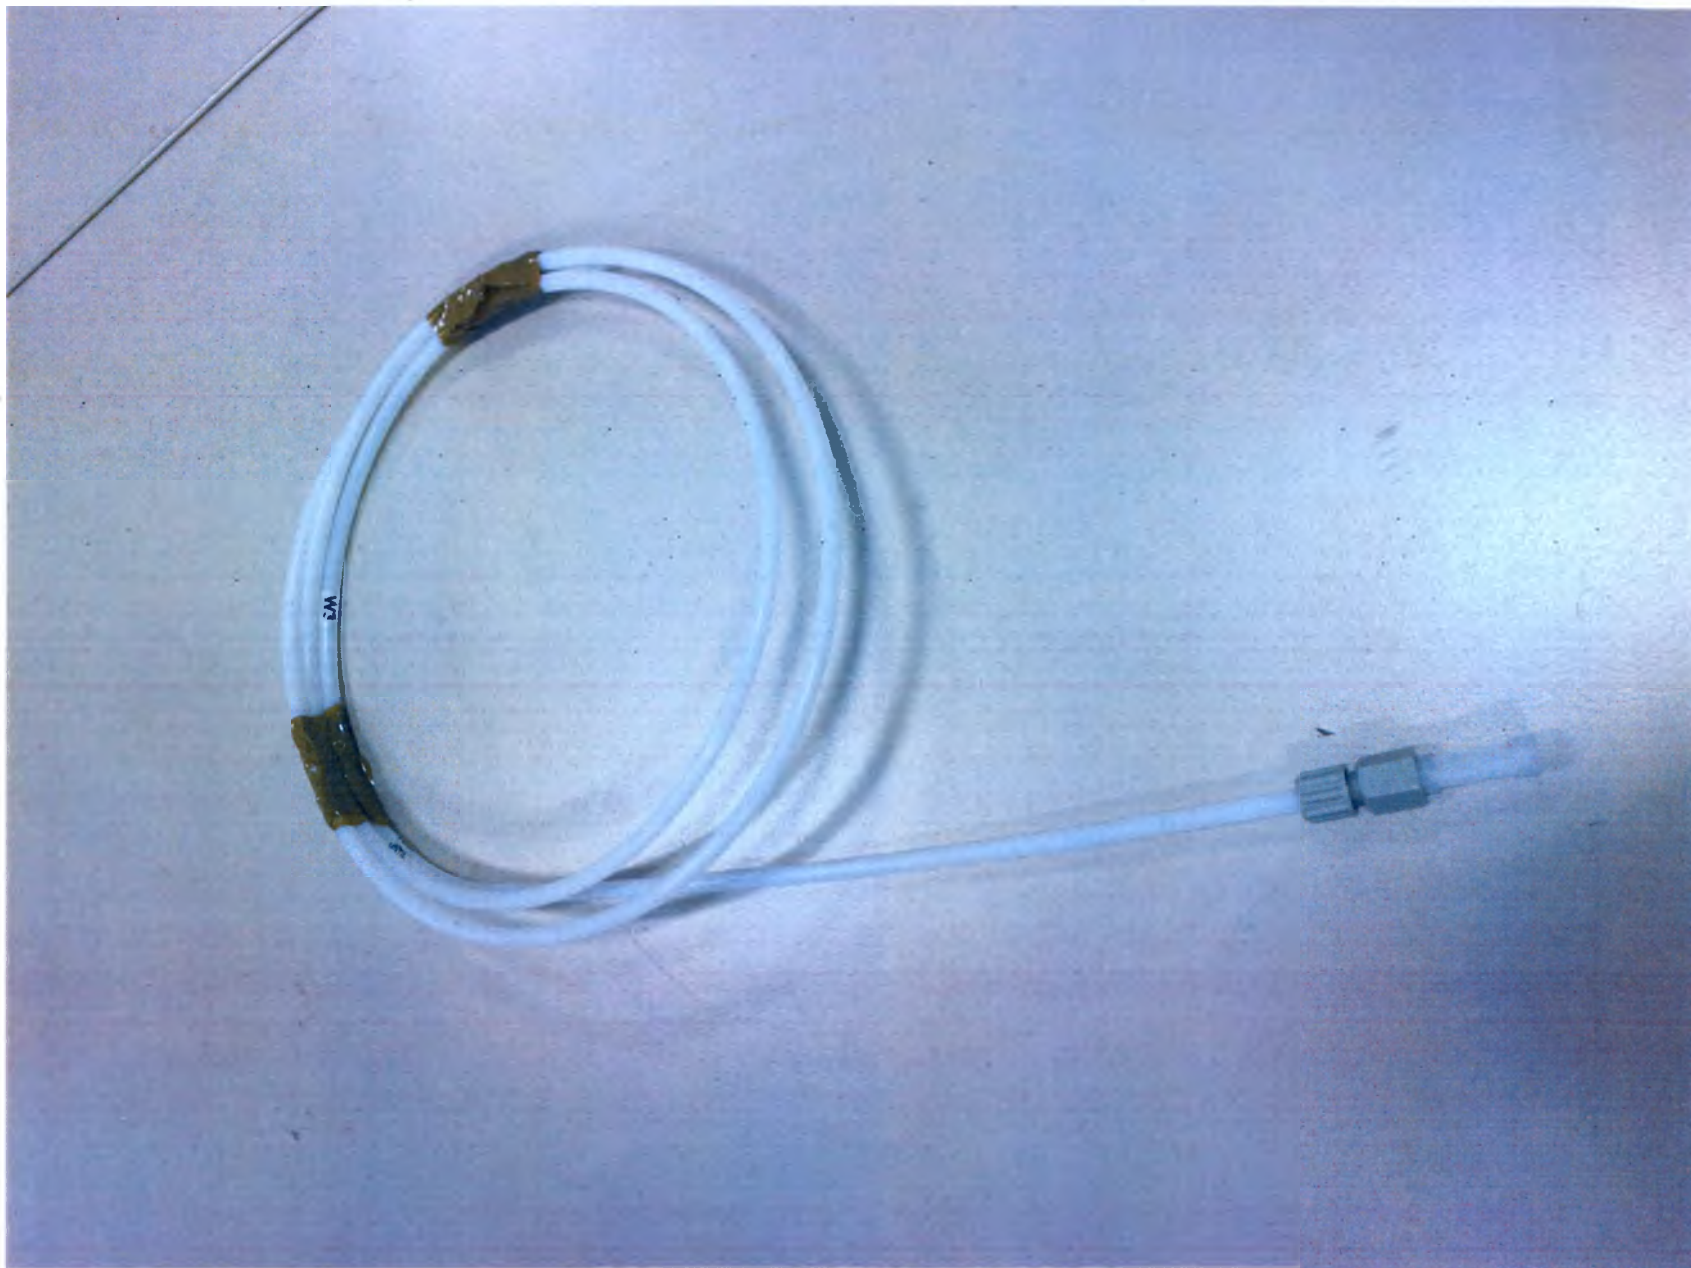



1.3. Трубка для отходов, 2 шт. (Waste tube, 2 pcs)

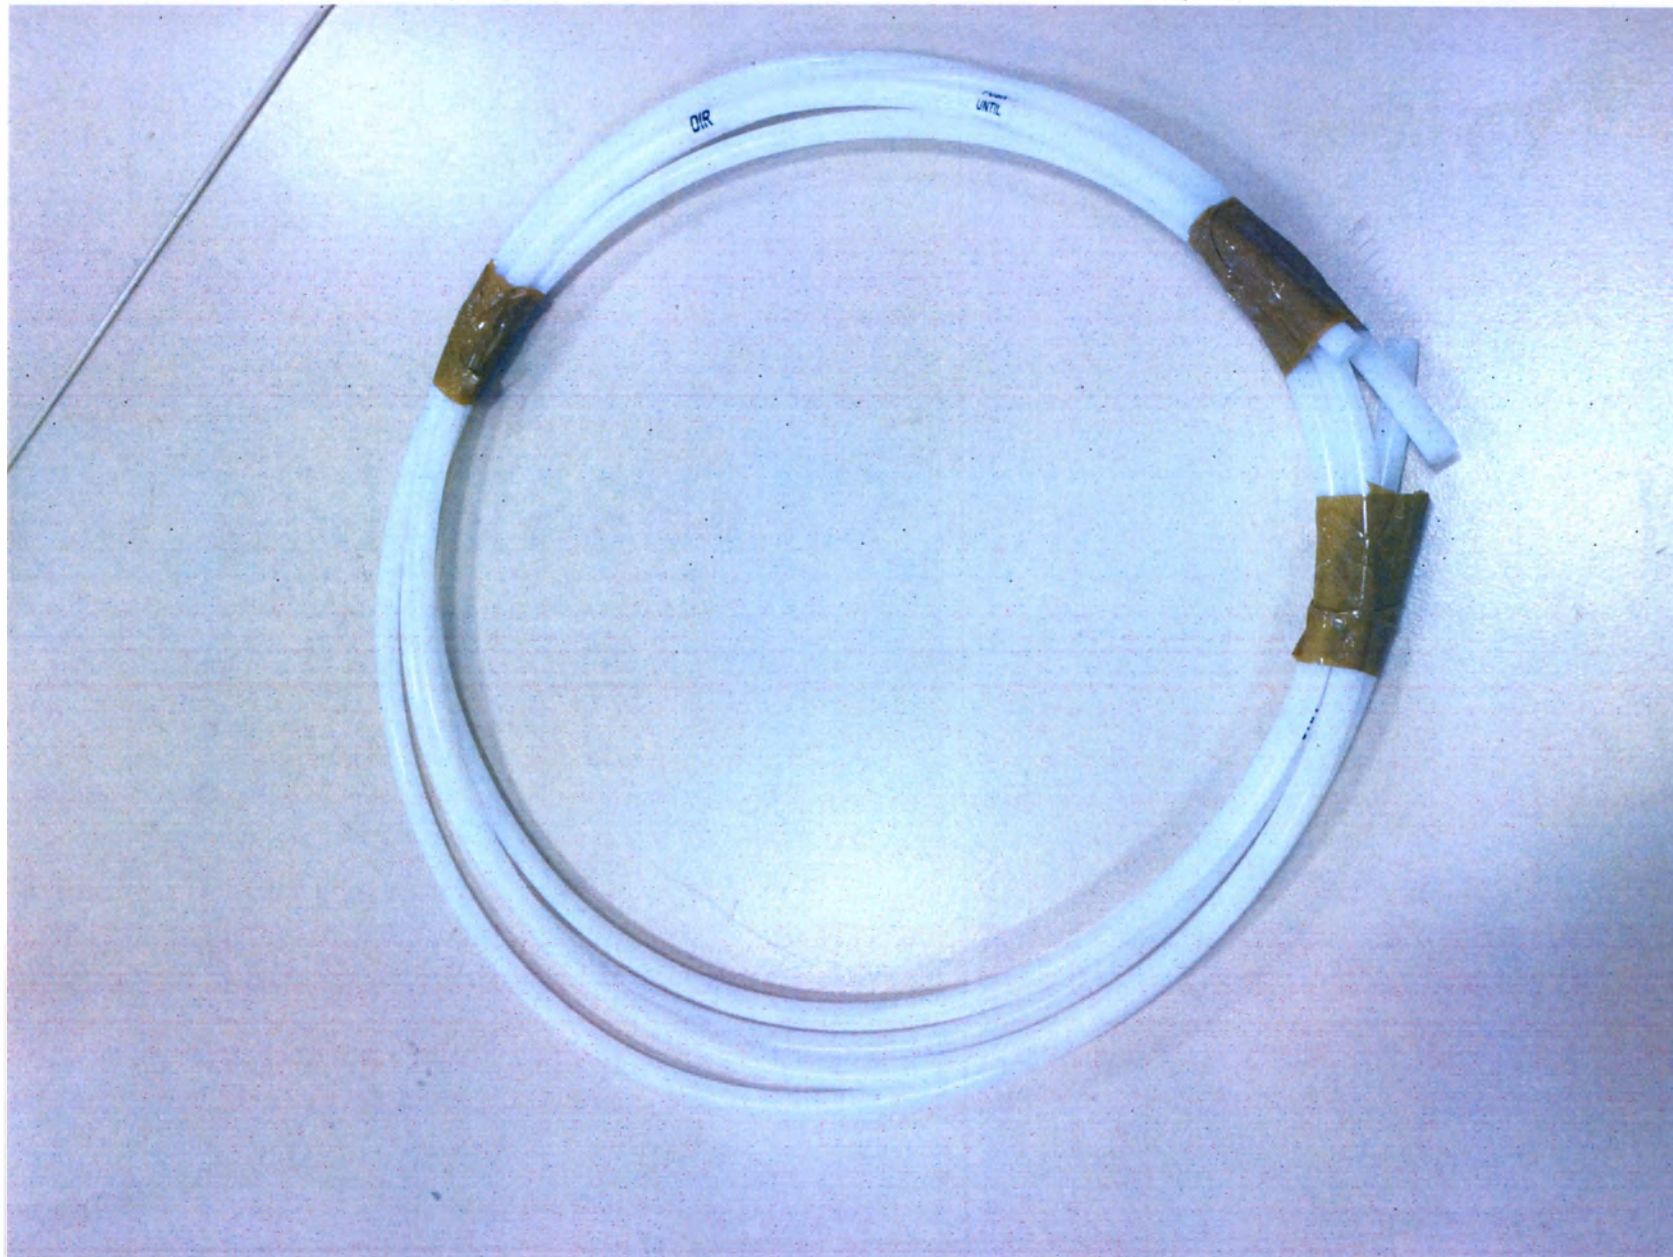

1.4. Контейнер для жидких отходов (Liquid waste container)




1.5. Контейнер для воды (Water container).

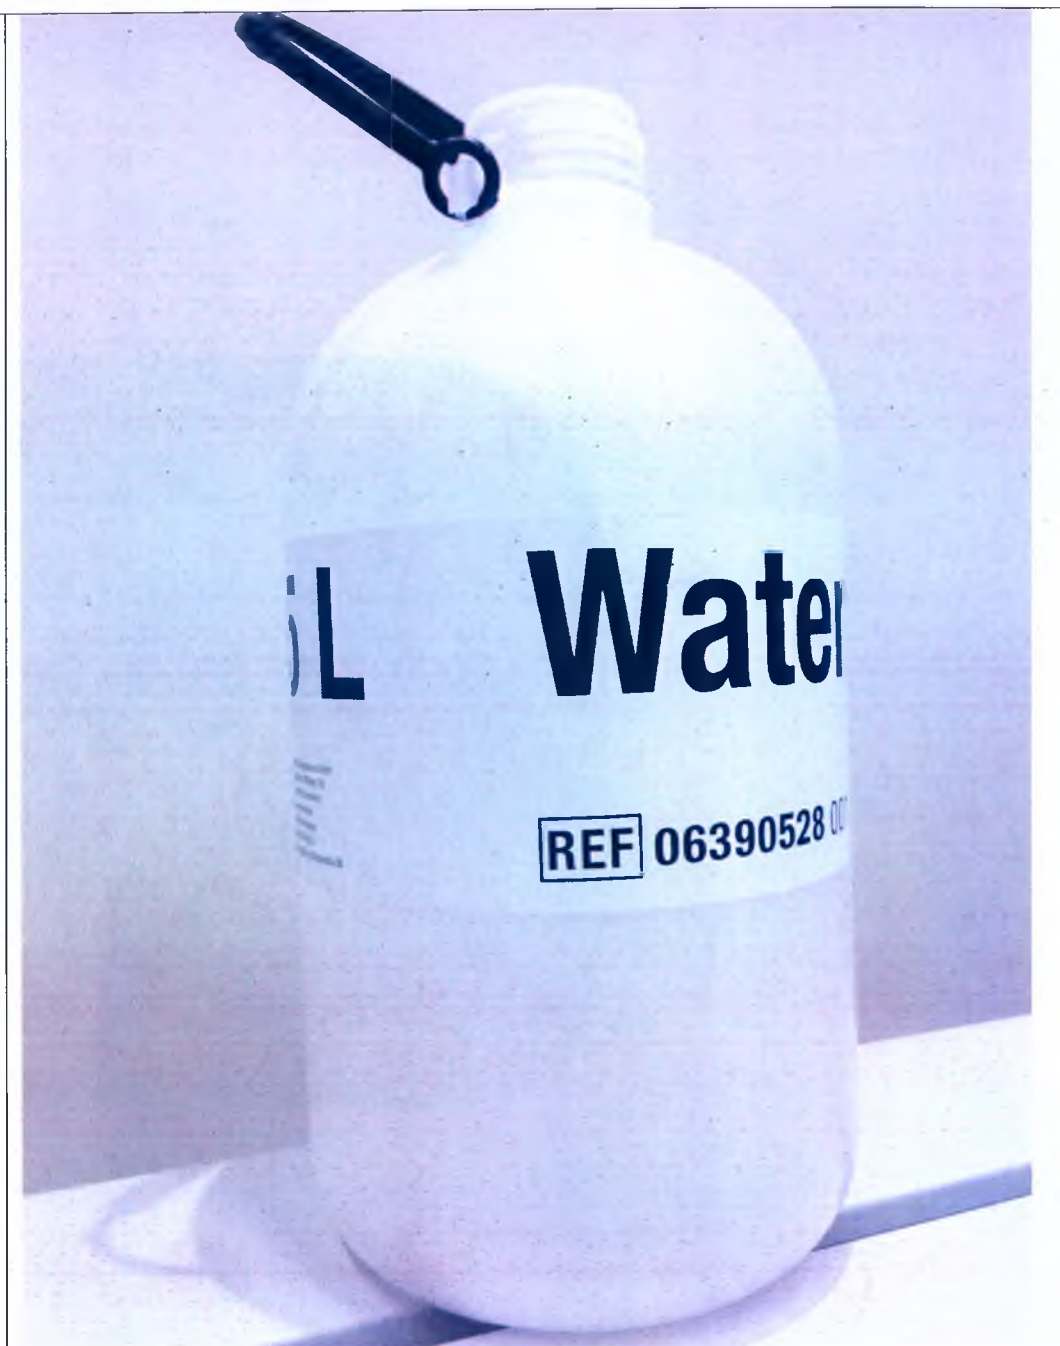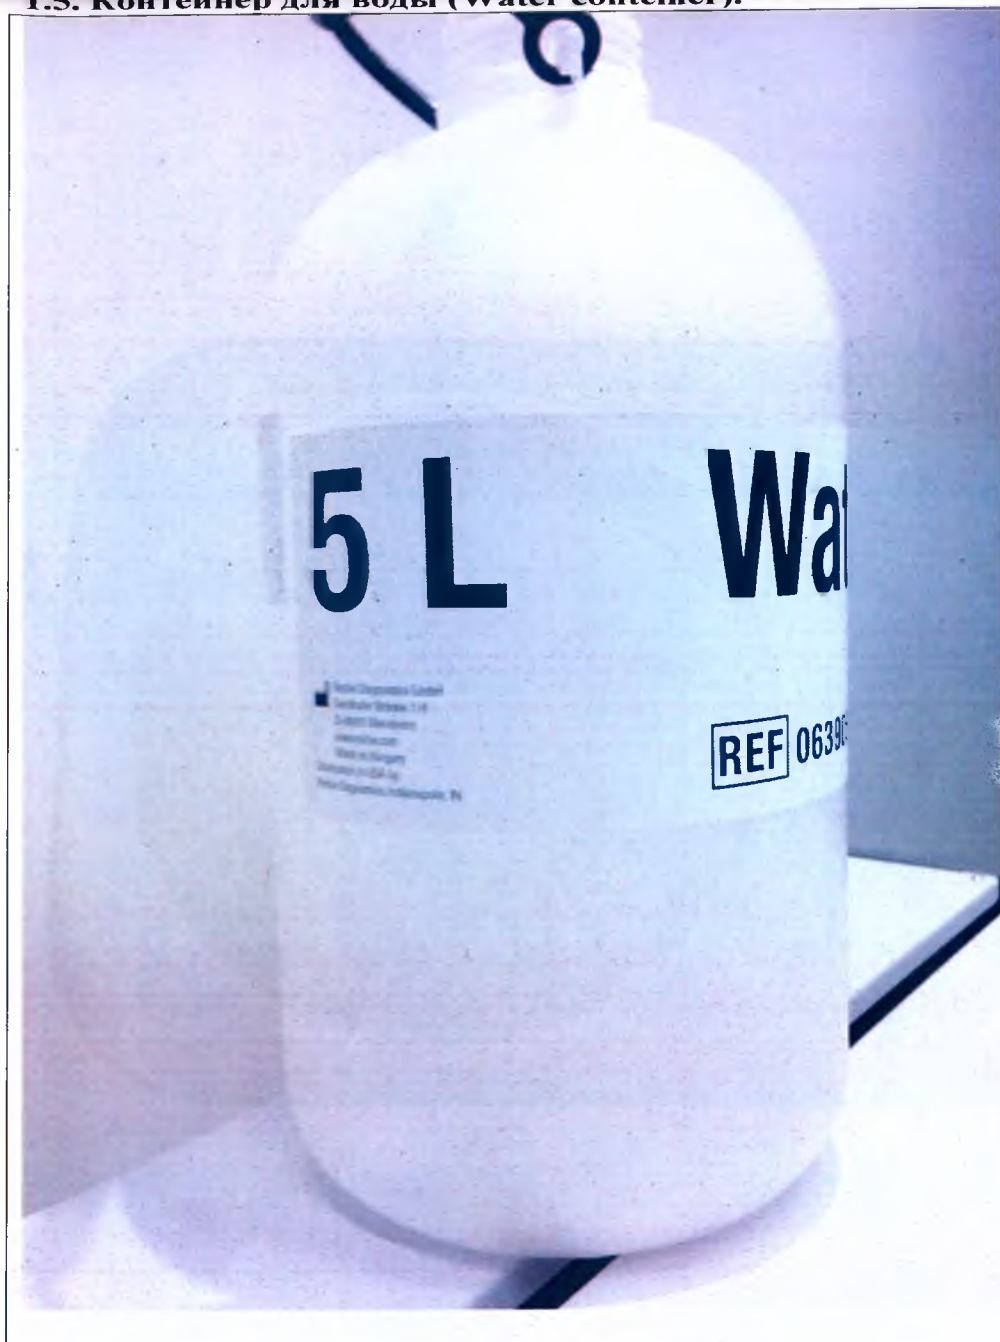

1.6. Подставка для контейнеров (Container Holder).



1.7. Игла пробозаборника (Sample probe).

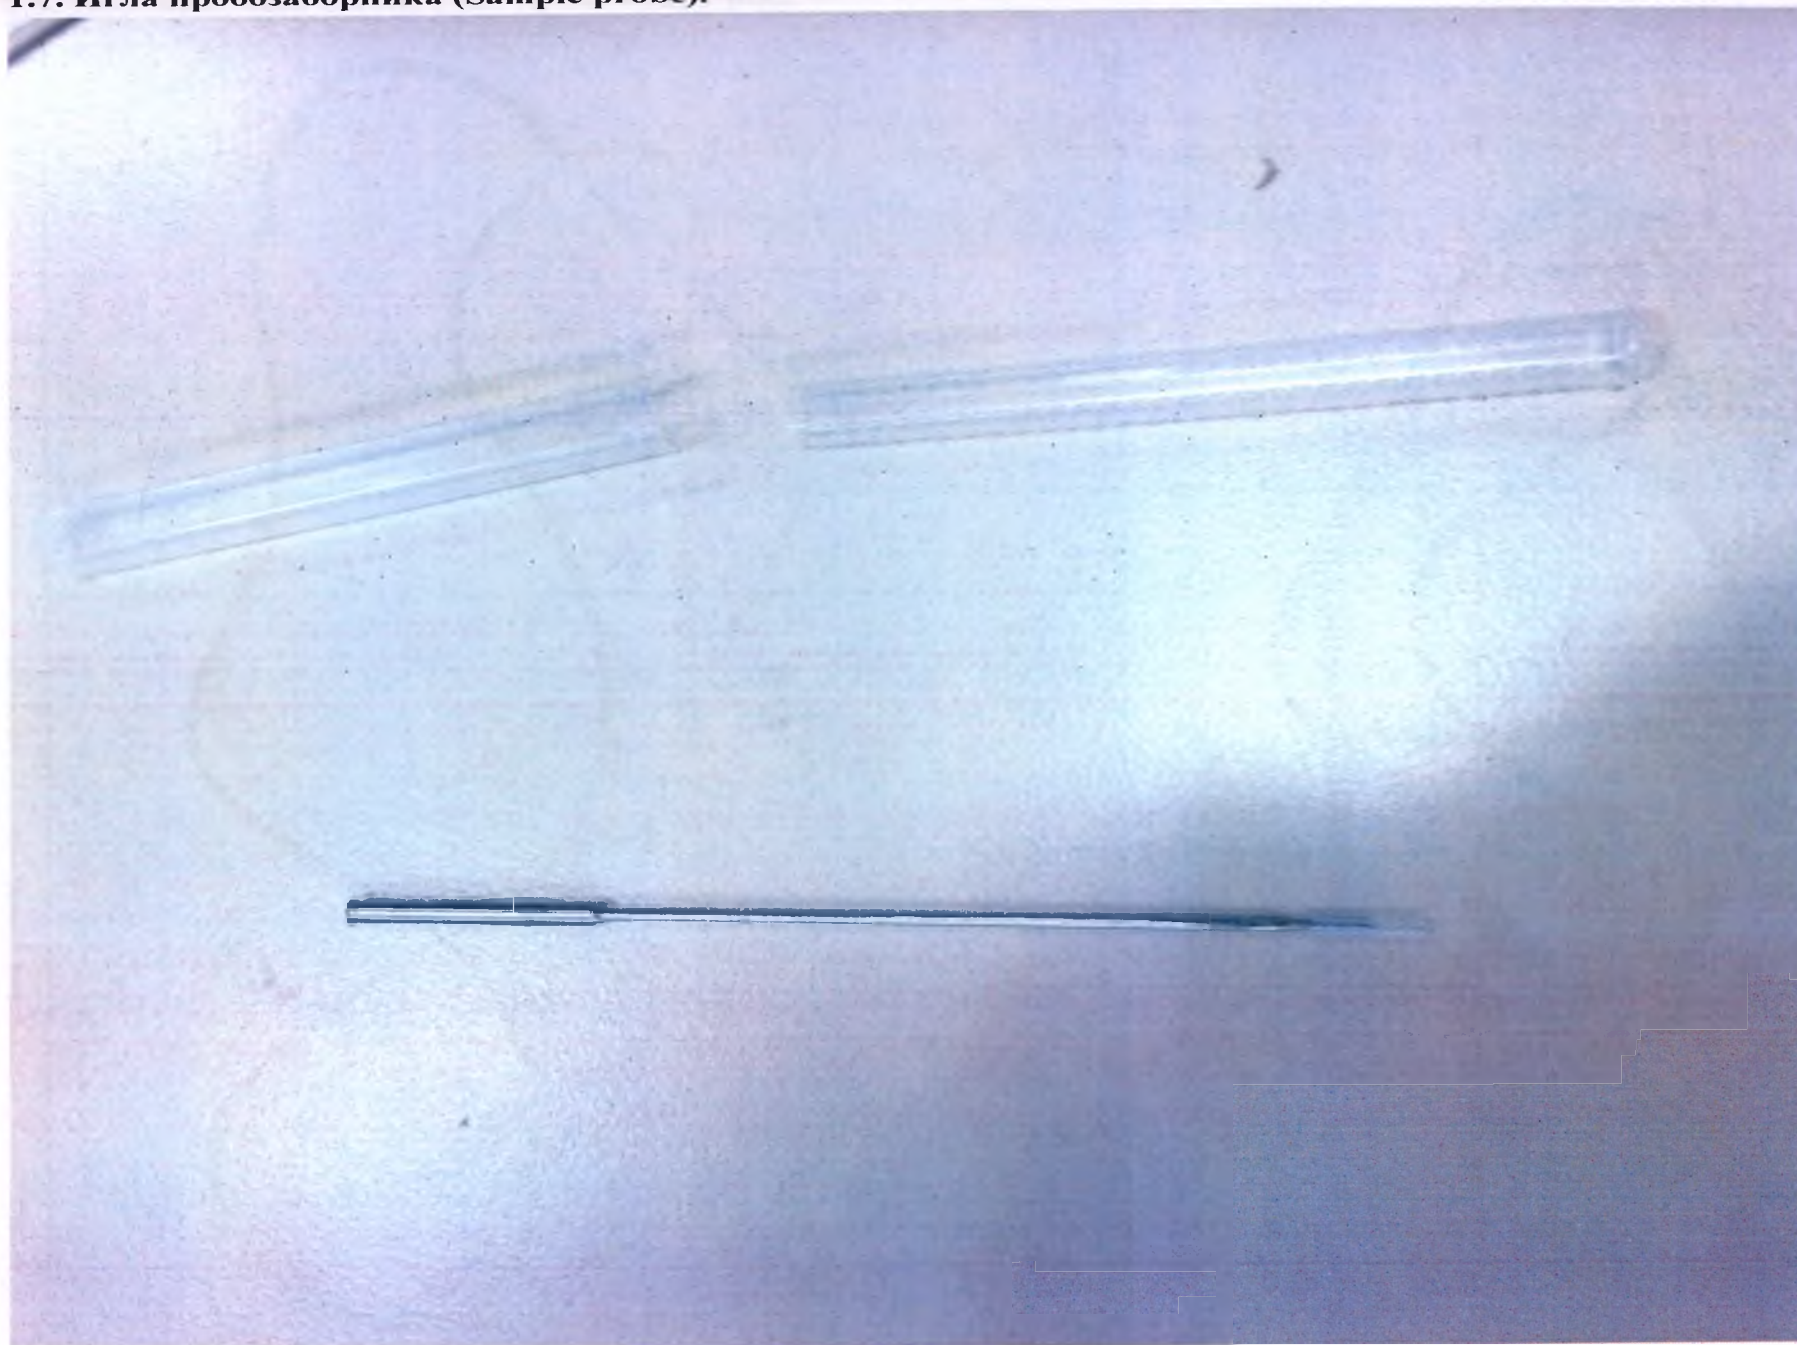

1.8. Поплавковый шток, 2 шт (Float rod, 2 pcs).




1.9. Направляющие для трубок 3 шт (Tubing guides, 3 pcs)



1.10. Поддон для тест-полосок (Test strip tray)




1.11. Транспортер тест-полосок (Test strip transporter)

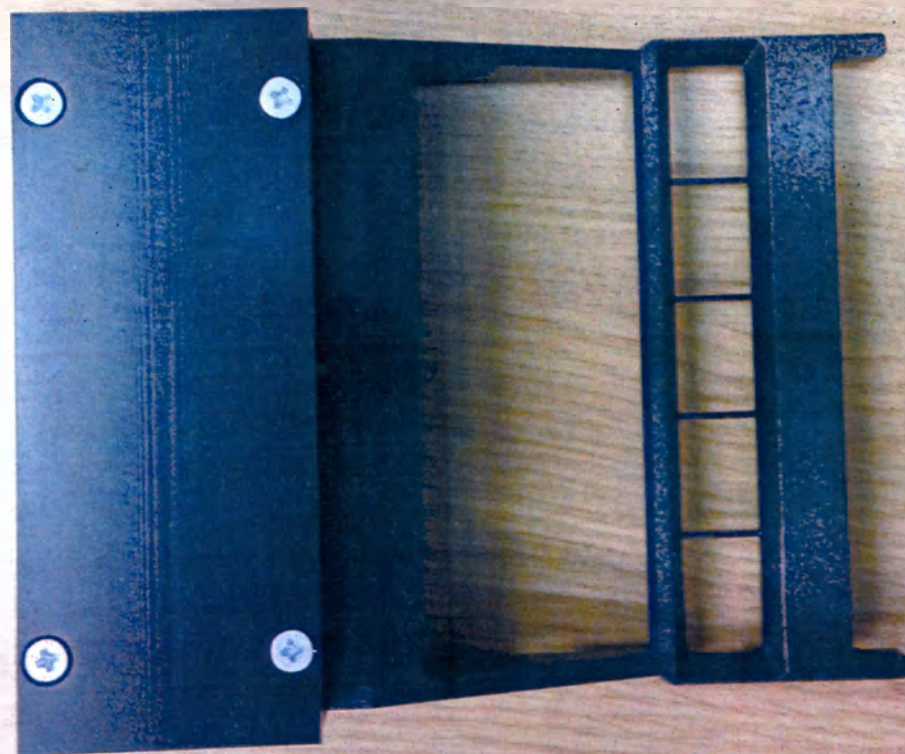


2. Набор для инсталляции cobas 6500/u 601/u 701 (Installation kit cobas 6500/u 601/u 701)


2.1. Блок загрузки штативов (Input buffer)

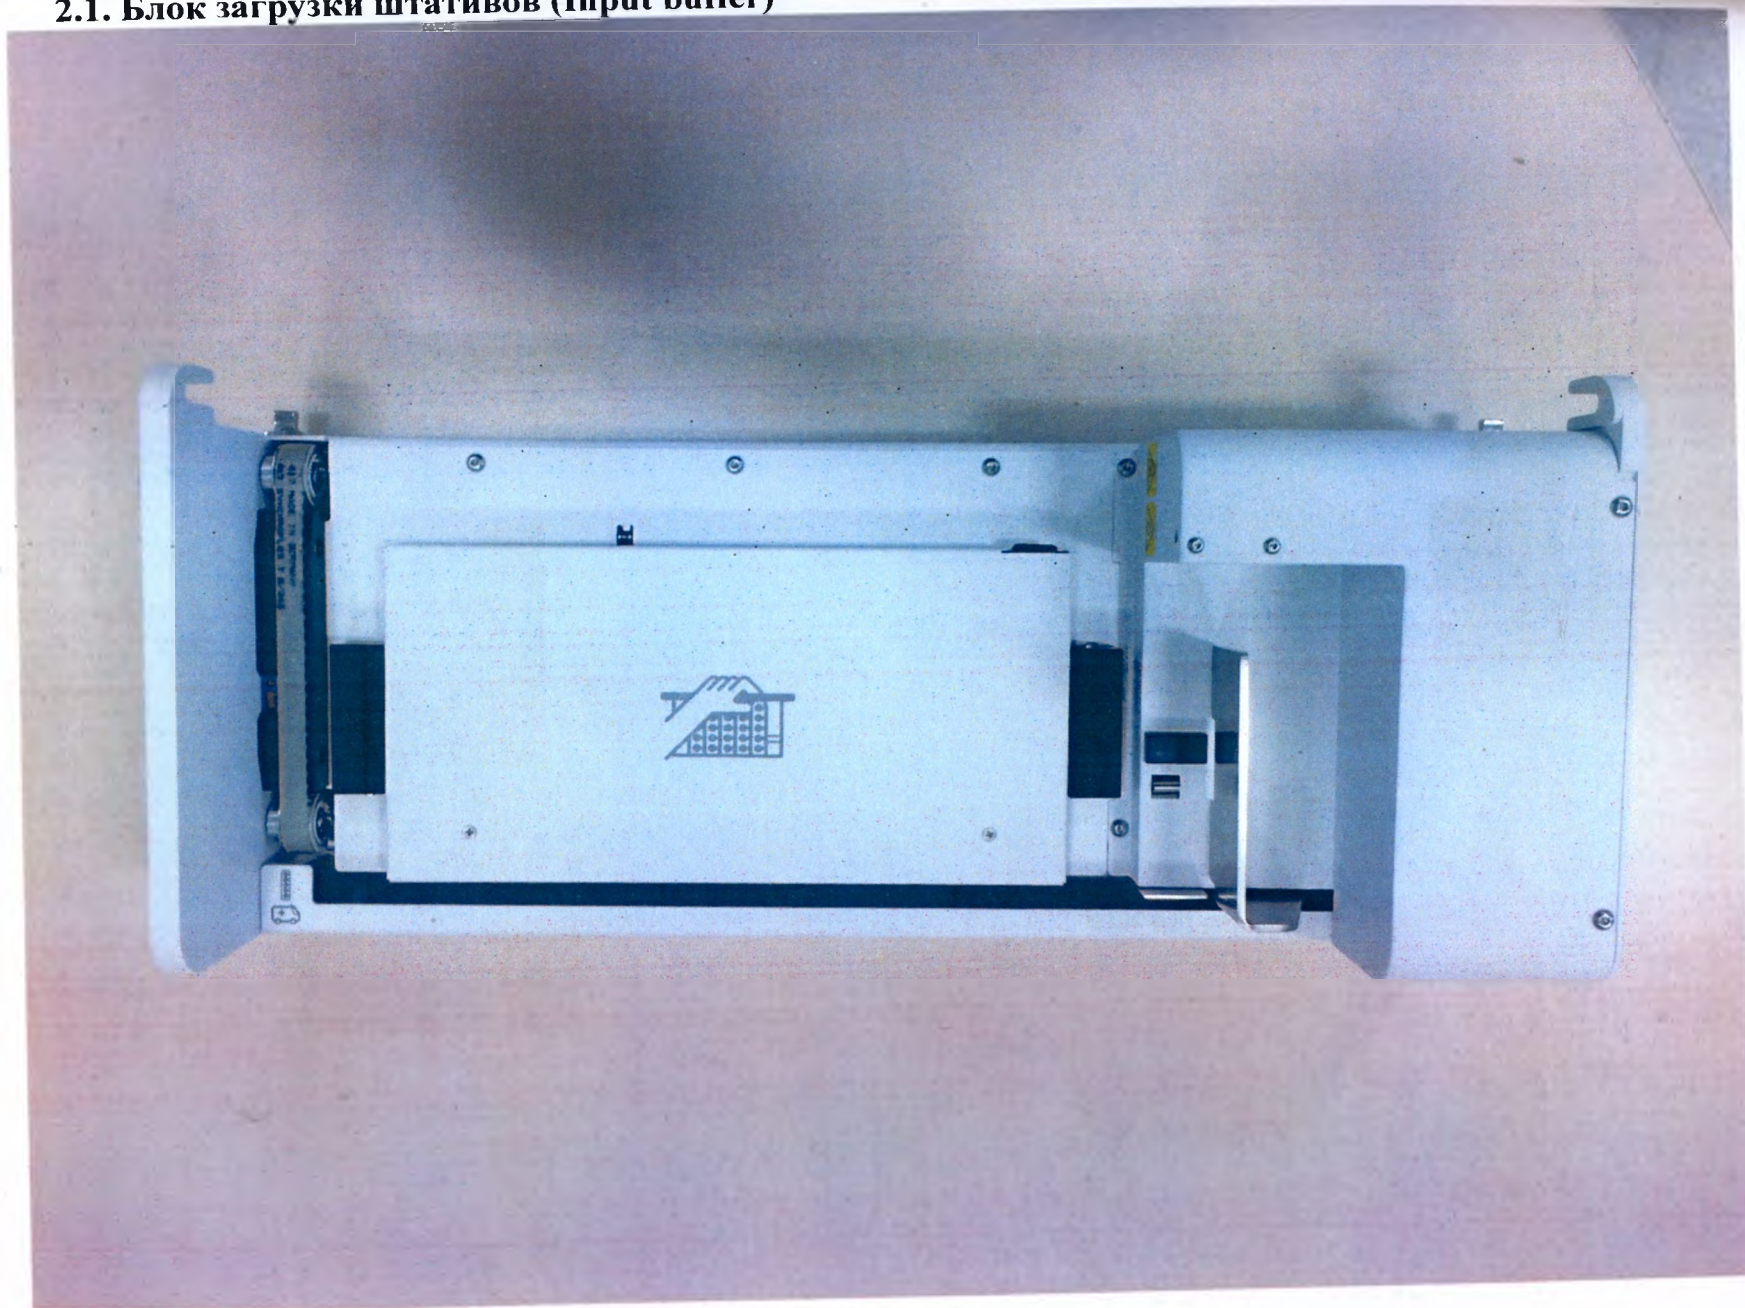

2.2. Блок разгрузки штативов (Output buffer)

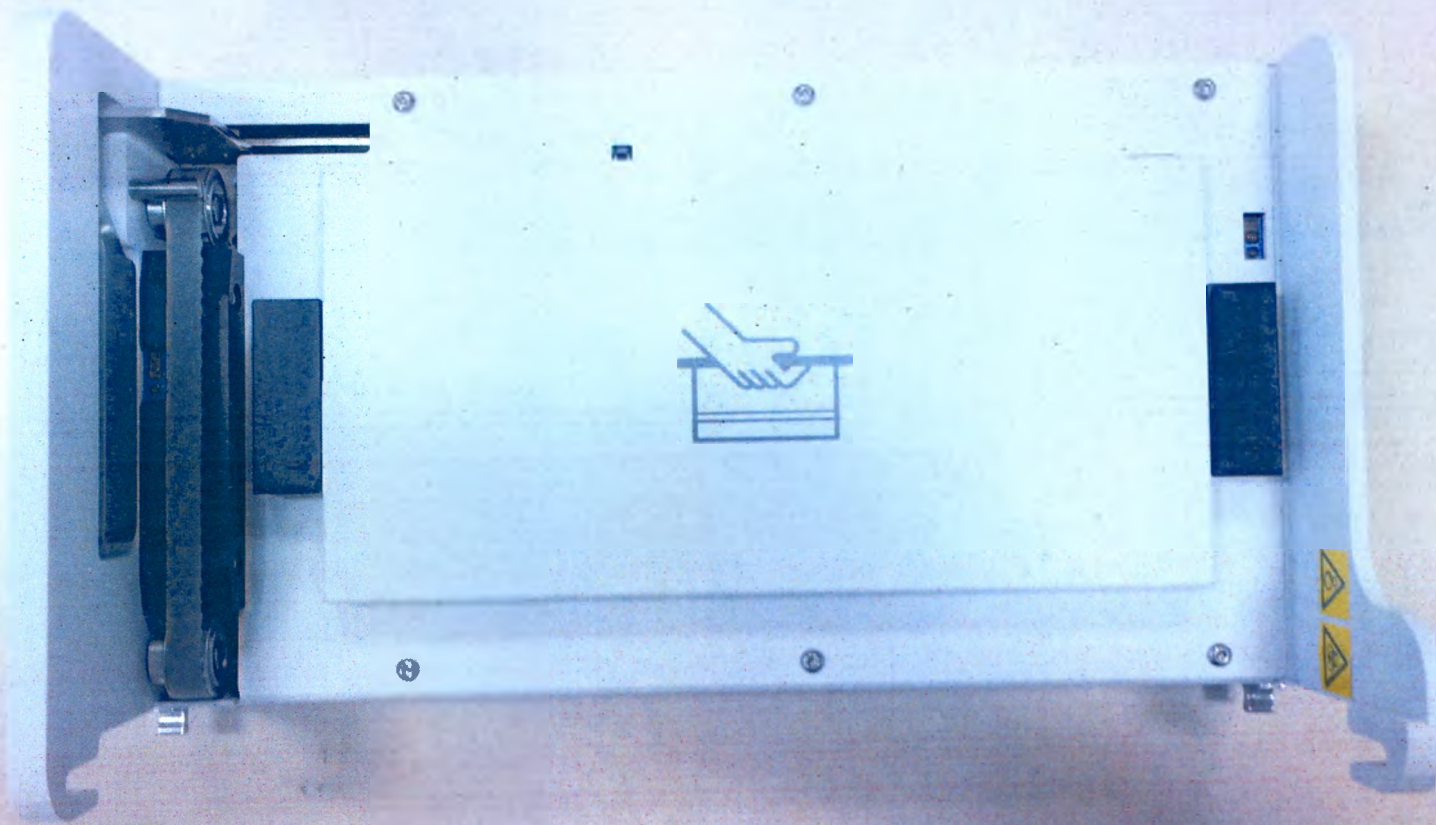

2.3. Соединительные кабели, 2 шт (Connecting cables, 2 pcs)

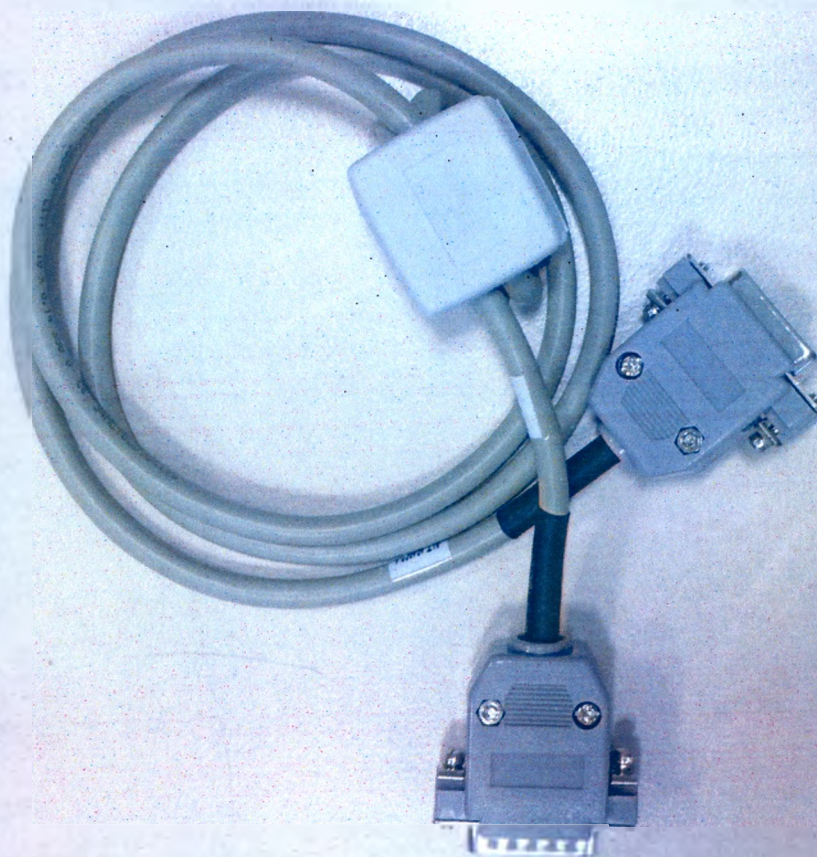

2.4. Клавиатура (Keyboard)



2.5. «Мышь» компьютерная (Mouse)



2.6. LAN кабель (LAN cable)




2.7. Сенсорный Монитор (Touch Screen) в комплекте:

2.7.1. Сенсорный монитор (Touch Screen)



2.7.2. -кабель питания (Power cable)

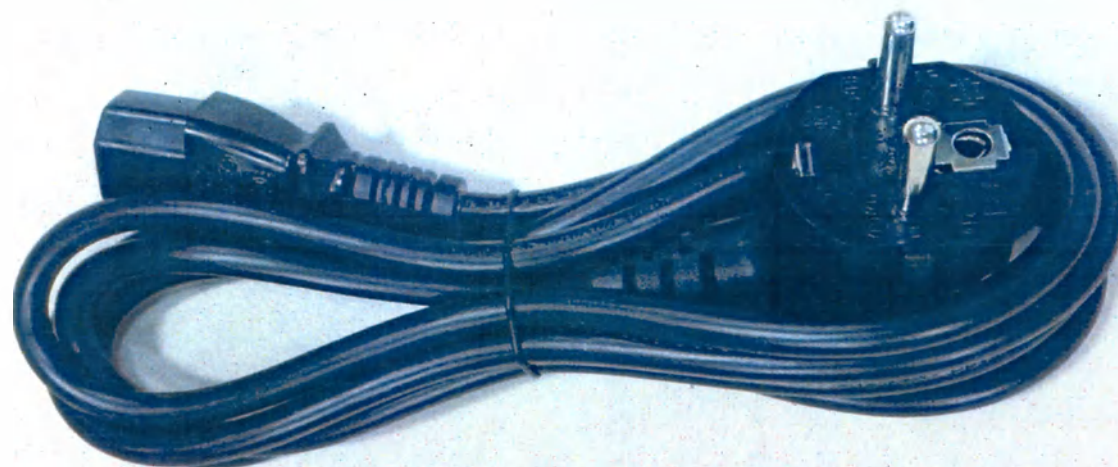

2.7.3. Блок питания (Power adapter)




2.7.4. USB кабель (USB cable)



2.7.5. кабель для подключения к анализатору/компьютеру (VGA Cable)




2.7.6. кабель для подключения к анализатору/компьютеру (connecting cable)

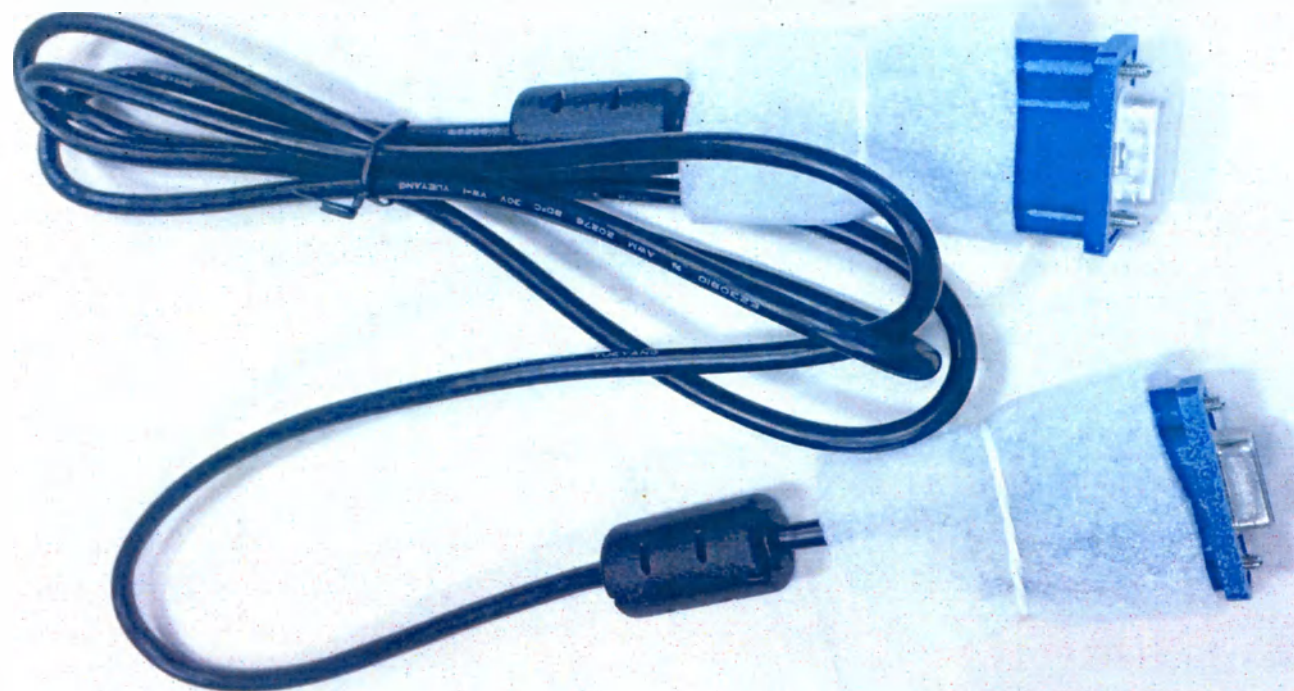


НАДЛЕЖНОСТИ.

калибровочные тест-полоски cobas u 1x25 шт (cobas u calibration strip, 1x25

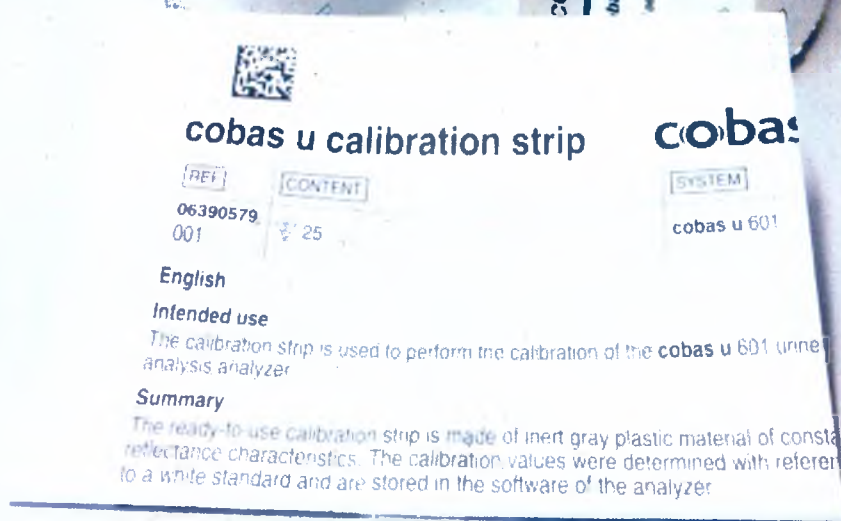

Картонная коробка для отходов, 1x30 шт (Waste box, 1x30 pcs)

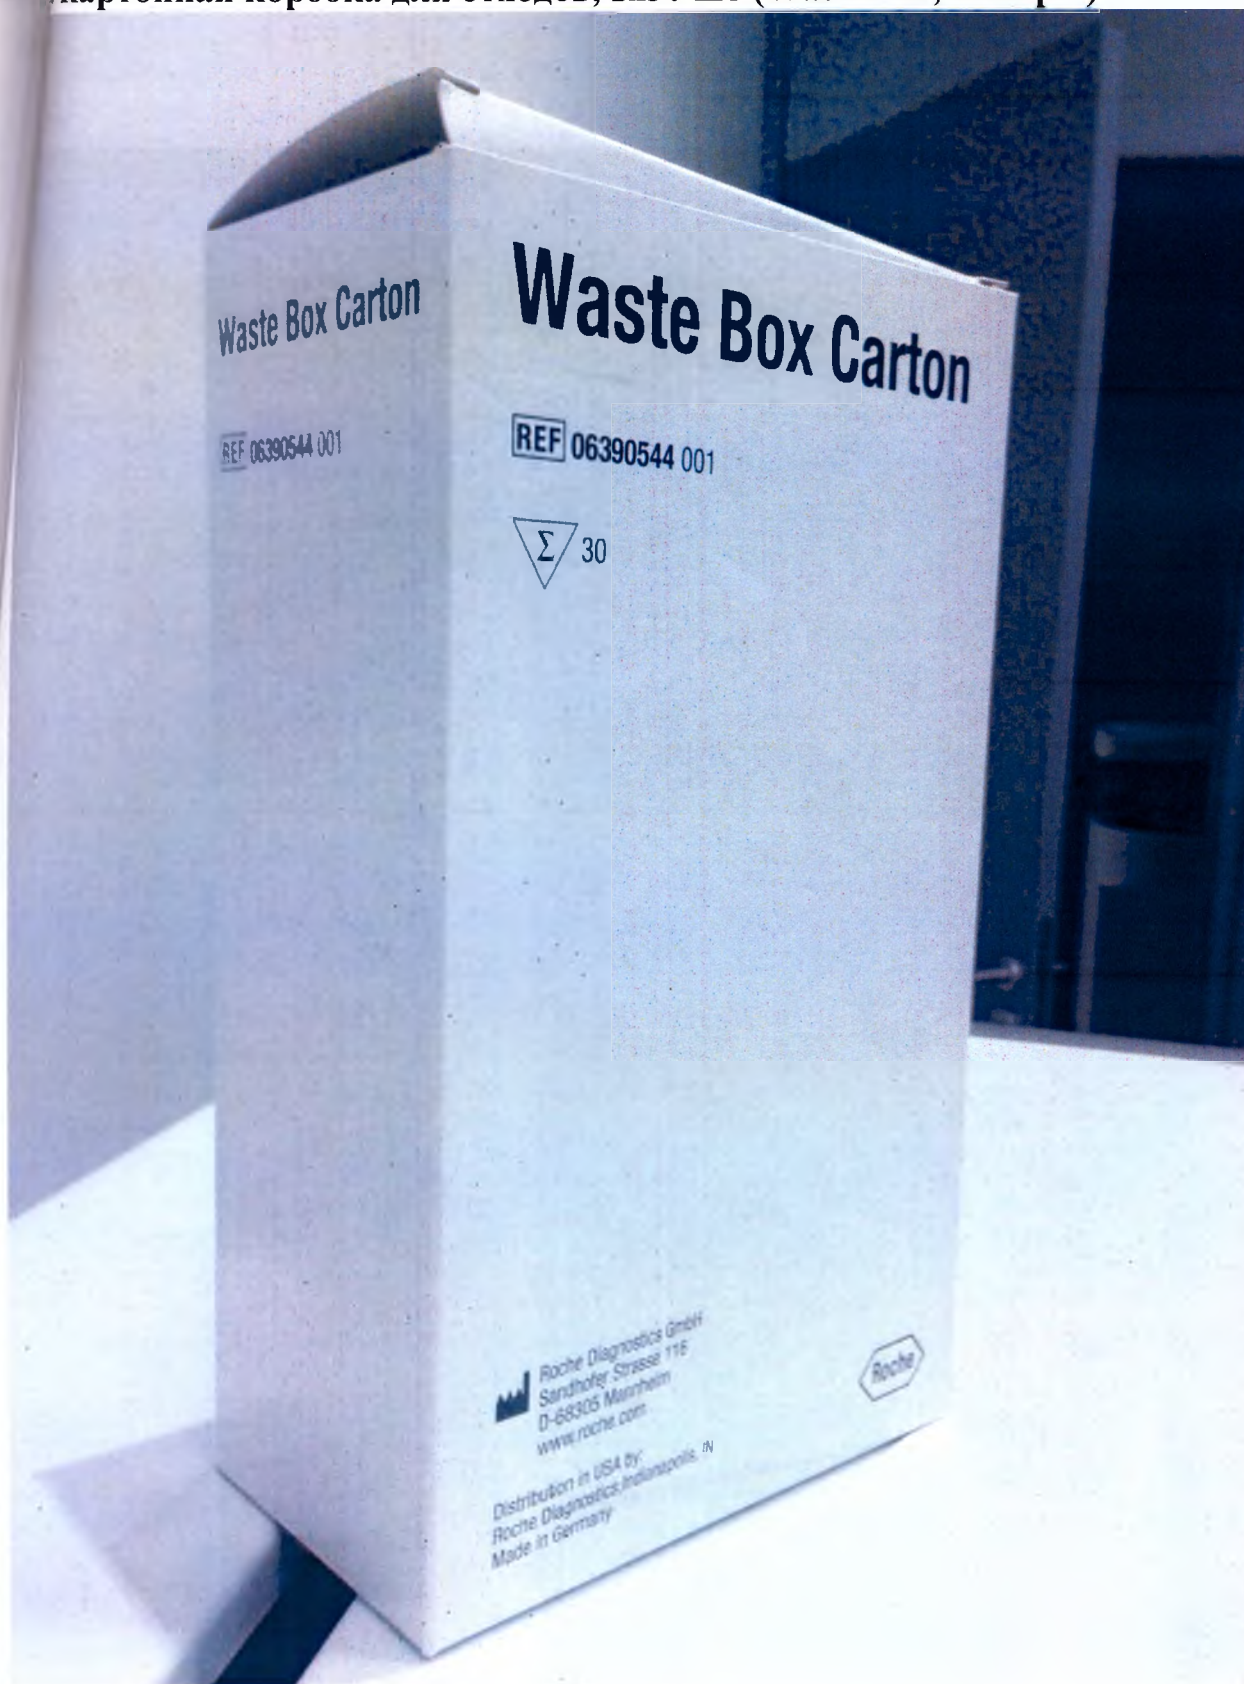


4. Поднос для штативов на 75 позиций, складной (как tray, 75 pos, складной)



5. Штатив для проб RD 0001-0050 серый, 1x50 шт (RD standard rack 0001-0050, 1x50 шт)



6. Штатив для промывки, зеленый, 1x2 шт (STD-rack, Wash W999, green, 1x2 pcs)

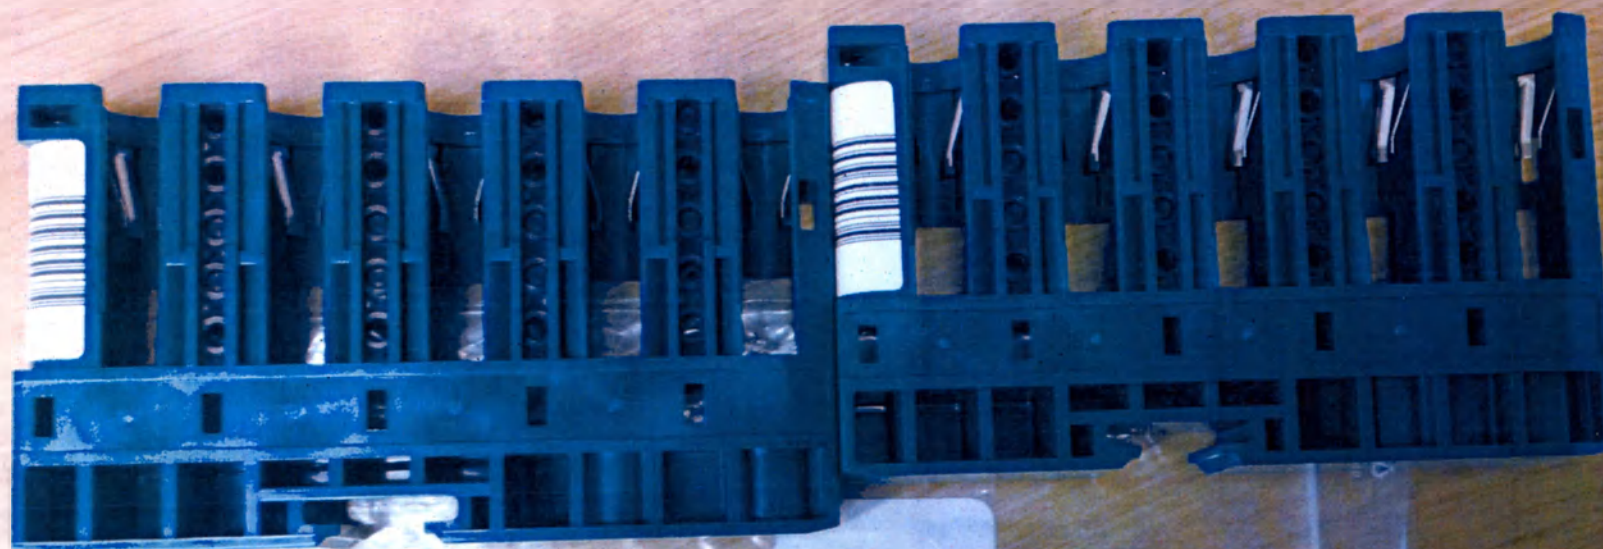

		Roche Diagnostics	
Mat. No. 12025728001		Inspected by TW	
STD-RACK, WASH W999 GREEN (2 PCS)			
Visual ID: W999 Barcode ID: 10999			
1 Series of 2 Racks		Lot No. _____	
Country of Origin: Japan			

7. Штатив для контроля качества, белый, 1x10 шт (STD-RACK,



Лучина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

29 СЕН 2015

Лучина



его пронумеровано,
рошнуровано и
скреплено печатью

32 (тридцать два)

лист(ов)