

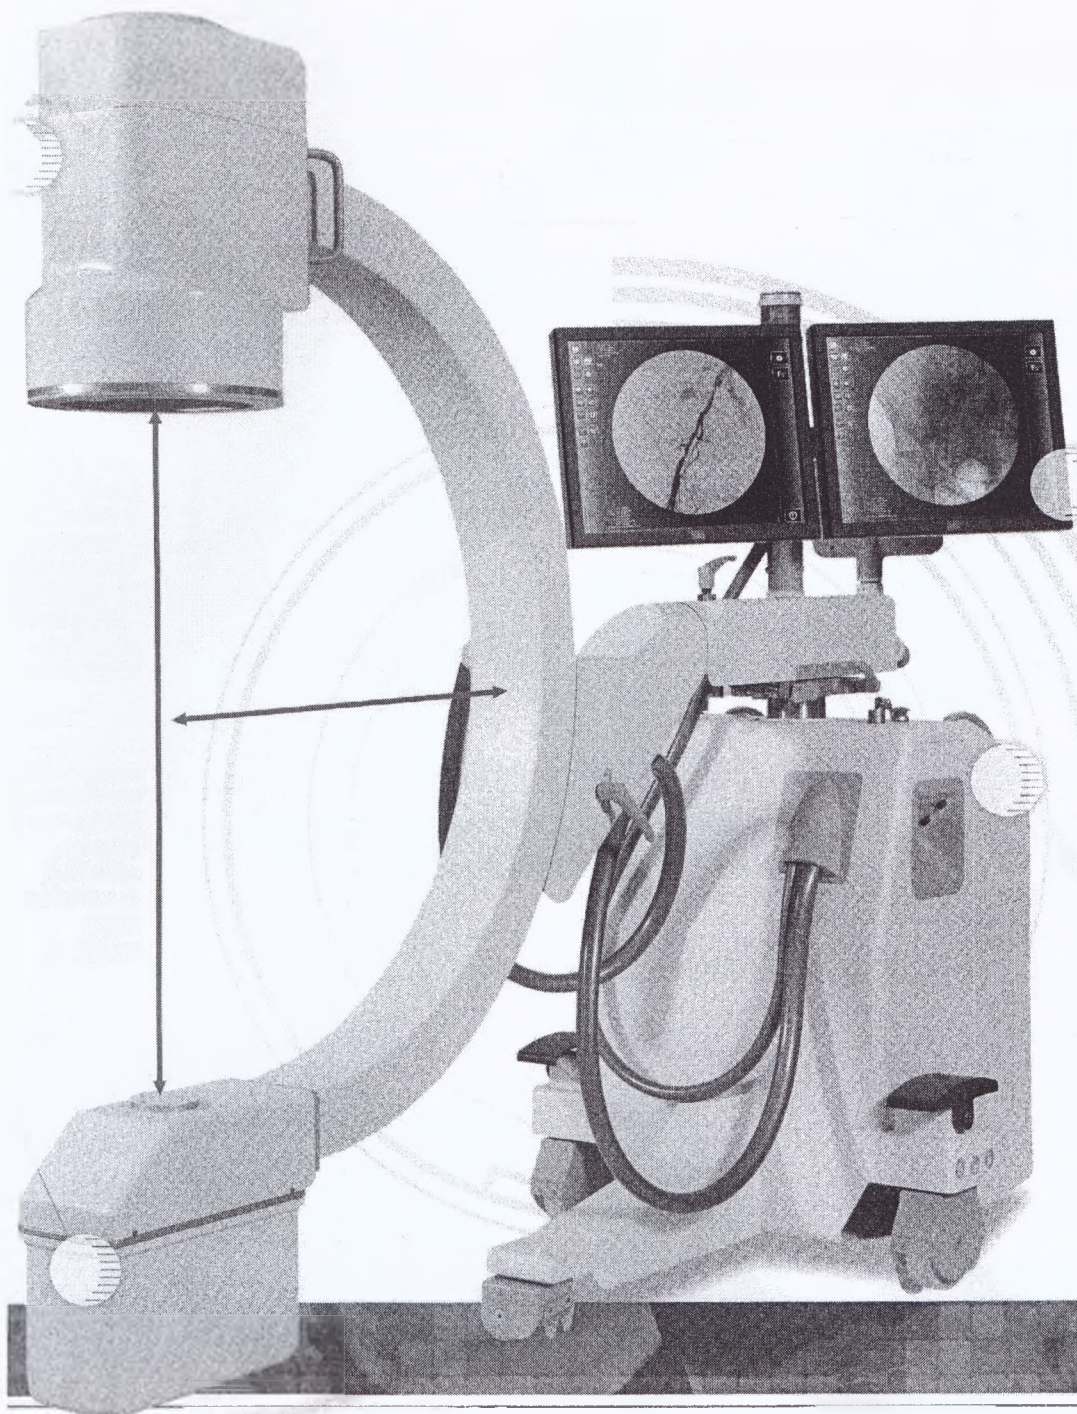


Рис. 1 Внешний вид аппарата. Крепление видеомониторов на станине штатива



Рис. 2 Внешний вид аппарата. Крепление видеомониторов на тележке

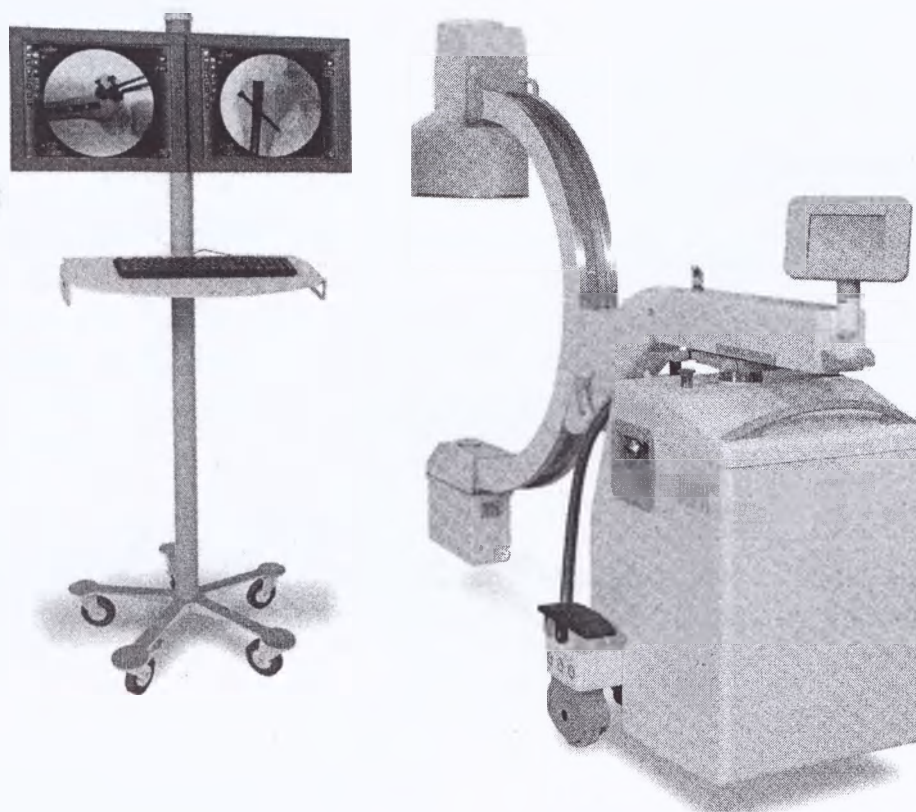


Рис. 3 Внешний вид аппарата. Крепление видеомониторов на стойке

«ГАММАРЕНТ-СИ». Аппарат рентгенохирургический передвижной со штативом «С-дуга». Руководство по эксплуатации.