



**Стимулятор магнитный «Нейро-МС» по ТУ 9442-063-13218158-2015
в максимальной комплектации (комплектация для парной стимуляции)**



Монофазный блок магнитного стимулятора «Нейро-МС», NS063201.001-01



Заглушка разъема расширения, NS063105.001



Педаль, NS063353.001



Индуктор кольцевой 100 мм «ИК-03-100», NS063304.001



Индуктор двойной 100 мм «ИД-03-100», NS063304.008



Индуктор кольцевой 125 мм «ИК-03-125», NS063304.002




Кабель соединительный для парной стимуляции, NS063103.007



Кабель выравнивания потенциалов, NS058103.032-050



**Кабель сетевой CEE 7/7 — IEC C13, 220 В, 10 А, 1.8 м
(3G×0.75 кв. мм)**

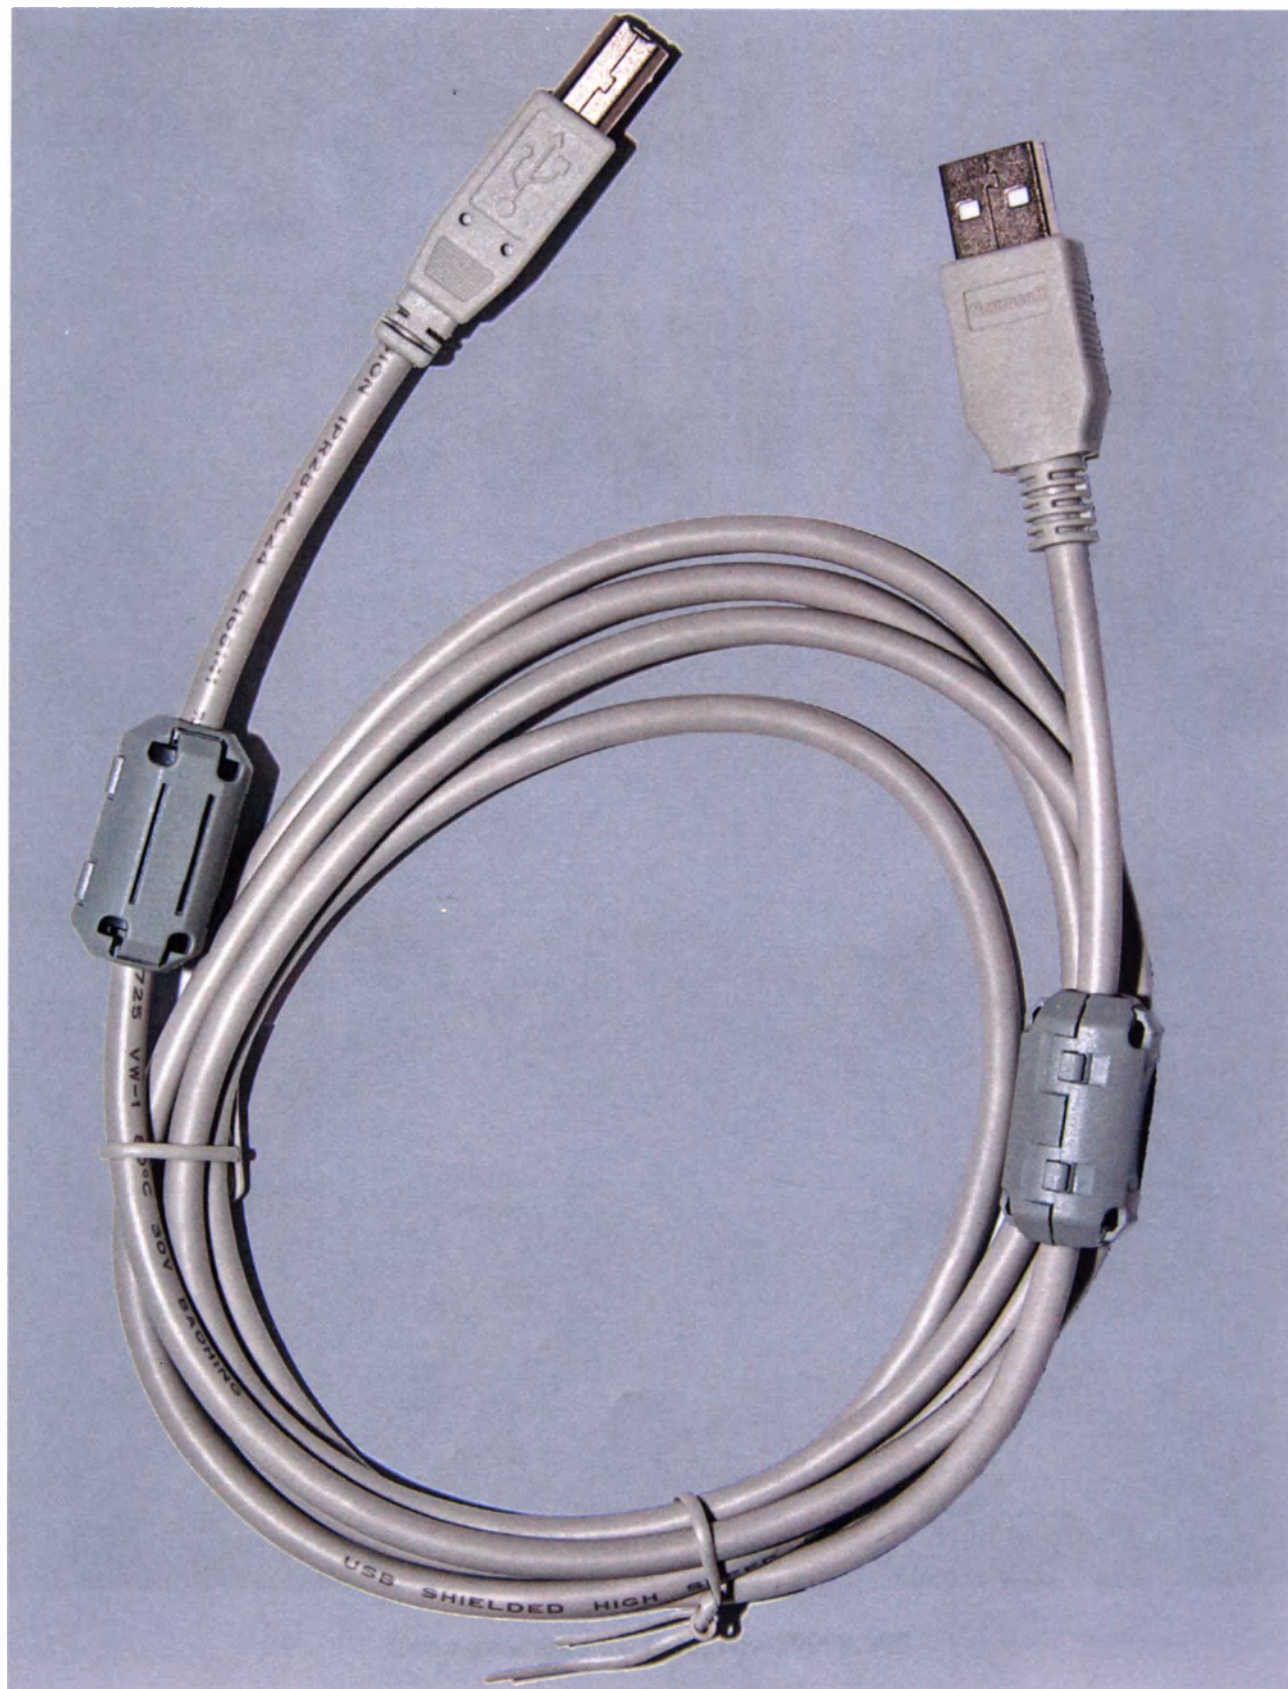

Кабель USB (A→B), NS007103.005




Стол-тележка «СТ-2», NS059998.005



Кронштейн для позиционирования индуктора в нерабочем состоянии «К-8»,



Индуктор двойной угловой 100 мм «ИДУ-03-100», NS063304.011

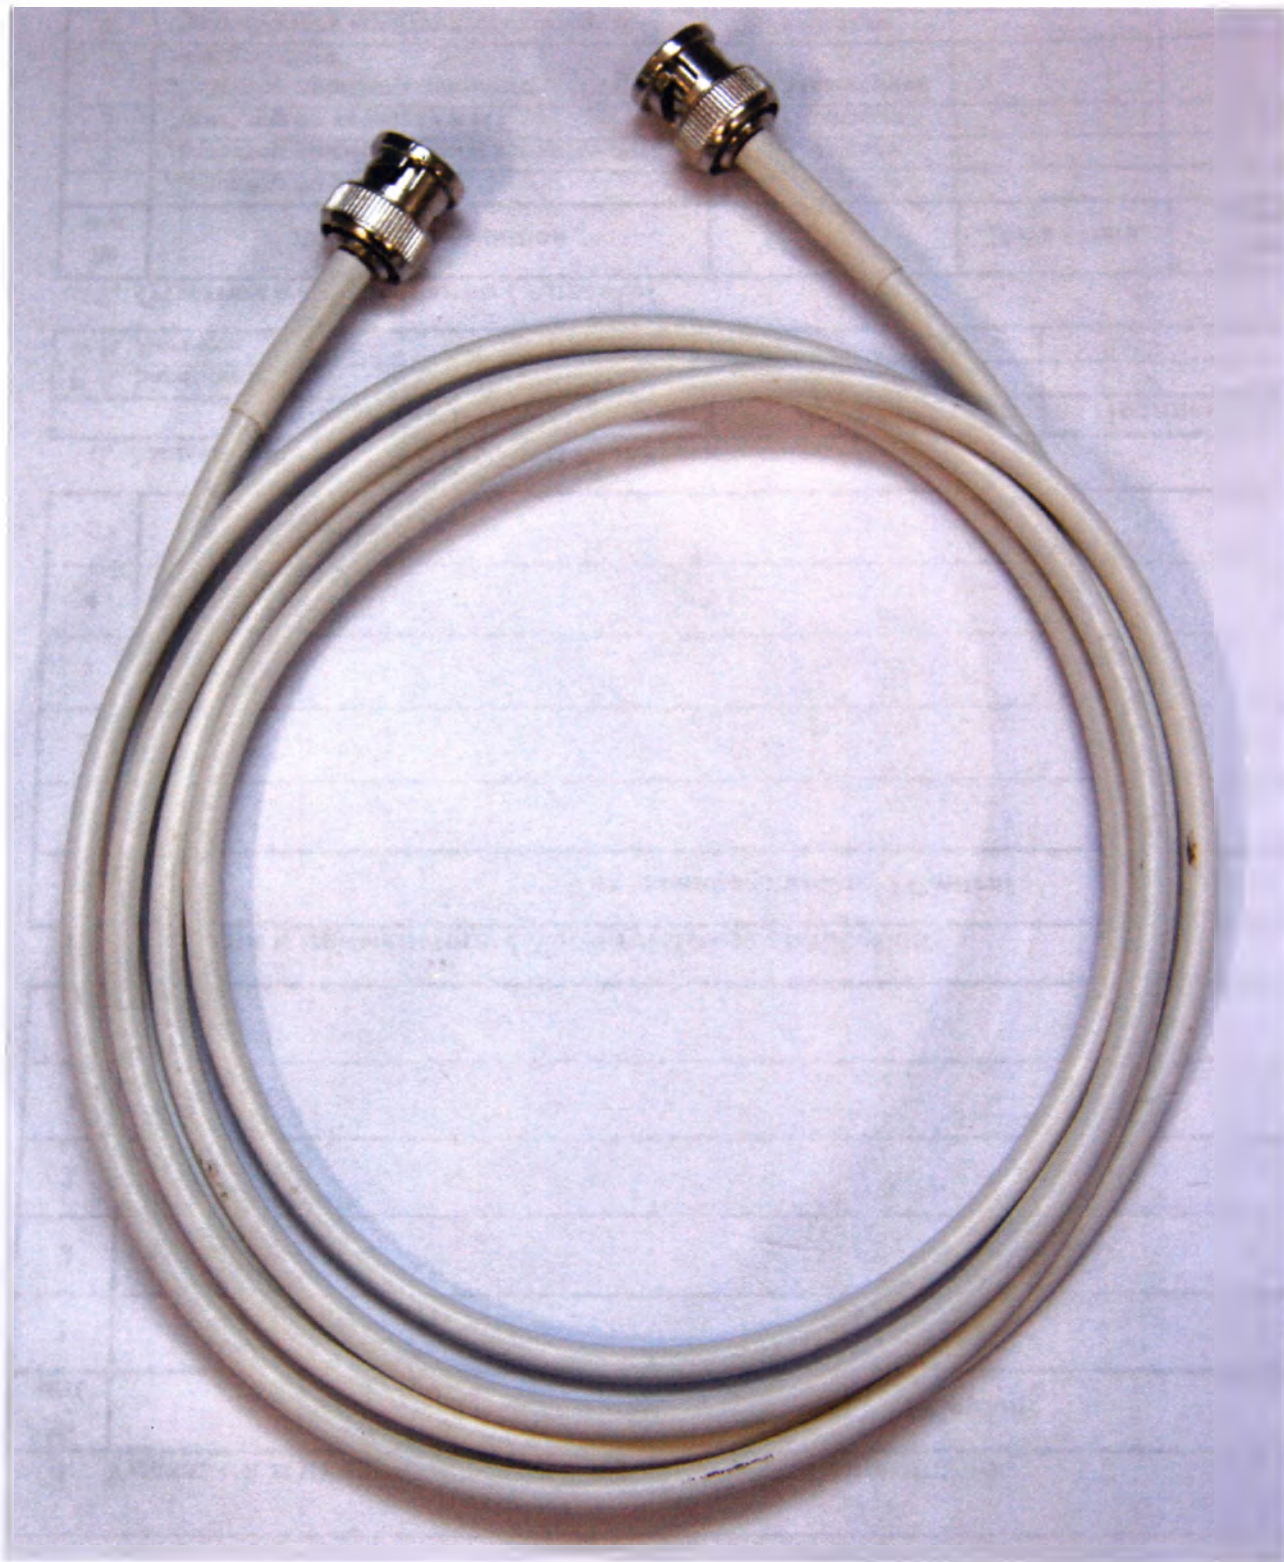

Кабель синхронизации BNC – BNC, NS063103.009



Кронштейн для позиционирования индуктора «К-7», NS016998.018



Кронштейн «Fisso» для позиционирования индуктора «К-3», NS016998.012



ПРОШНУРОВАНО
ПРОНУМЕРОВАНО
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕЧАТЬЮ
НА 18 ЛИСТАХ

Handwritten signature in blue ink.