

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «МедТехКомплект»

Трофименко А.Г.

«1» марта 2016 г.



Фотографии медицинского изделия:

«Микроскоп медицинский стереоскопический для лабораторных исследований Nikon SMZ, варианты исполнения: Nikon SMZ18, Nikon SMZ25, с принадлежностями», производства:

«Никон Корпорейшн», Япония / Nikon Corporation, Japan, Shinagawa Intercity
Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-6290, Japan, tel/fax: +81-3-6433-3600, e-mail: info@mufg.jp

Список фото

на медицинское изделие: «Микроскоп медицинский стереоскопический для лабораторных исследований Nikon SMZ, варианты исполнения: Nikon SMZ18, Nikon SMZ25, с принадлежностями»,

производства: «Никон Корпорейшн», Япония / Nikon Corporation, Japan, Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-6290, Japan, tel/fax: +81-3-6433-3600, e-mail: info@mufg.jp:

1. Микроскоп медицинский стереоскопический для лабораторных исследований Nikon SMZ, вариант исполнения: Nikon SMZ18;
2. Микроскоп медицинский стереоскопический для лабораторных исследований Nikon SMZ, вариант исполнения: Nikon SMZ25;
3. Оптический блок микроскопа Nikon SMZ18;
4. Оптический блок микроскопа Nikon SMZ25;
5. Тубус наклоняемый тринокулярный P2-TERG 100;
6. Тубус наклоняемый тринокулярный P2-TERG 50;
7. Тубус тринокулярный P2-TL100;
8. Окуляр C-W 10х;
9. Окуляр AZ-W10х;
10. Окуляр C-W 15х;
11. Окуляр C-W 20х;
12. Окуляр C-W 30х;
13. Основание плоское P2-PB;
14. Основание для светодиодного диаскопического освещения P2-DBL LED;
15. Основание P2-DBF для оптоволоконного диаскопического осветителя;
16. Штатив плоский P-PS32;
17. Объектив P2-SHR Plan Apo 0.5X;
18. Объектив P2-SHR Plan Apo 1X;
19. Объектив P2-SHR Plan Apo 1.6X;
20. Объектив P2-SHR Plan Apo 2X;
21. Блок фокусировки P2-FU;
22. Блок фокусировки моторизованный P2-MFU;
23. Блок управления P2-CTLB;
24. Блок релейный P2-RLY;
25. Кабель релейный P2-RLYC;
26. Адаптер SU-AC AC;
27. Кабель сетевой;
28. Окуляр-микрометр C-FC;
29. Окуляр-микрометр C-FM;
30. Сетка окулярная фотошаблона C-FP;
31. Насадка для окуляра C-W 10х;
32. Револьвер кодированный P2-RNI2 Intelligent Nosepiece;
33. Адаптер фокусирующий P2-FM;
34. AC Адаптер 2;
35. Источник света светодиодный C-FLED2 LED;

36. Модуль крепления блока фокусировки P2-FMDN;
37. Осветитель коаксиальный эпископический P2-CI;
38. Осветитель кольцевой оптоволоконный P2-FIR;
39. Световод двухплечный C-FDF;
40. Держатель световода двухплечного C-FIDH;
41. Осветитель кольцевой светодиодный P2-FIRL LED;
42. Кабель AZLED-PCE;
43. Насадка эпифлуоресцентная моторизованная P2-EFLM;
44. Насадка эпифлуоресцентная P2-EFLI;
45. Осветитель эпифлуоресцентный оптоволоконный Intensilight C-HGFI;
46. Осветитель эпифлуоресцентный оптоволоконный моторизованный Intensilight C-HGFIE;
47. Лампа ртутная C-LHGFI;
48. Блок управления C-HGFIE-C;
49. Световод C-HGFIF15;
50. Световод C-HGFIF30;
51. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров P2-EFL GFP-B;
52. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров P2-EFL GFP-L;
53. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров P2-EFL RFP;
54. Куб P2-EFLBF с полупрозрачным зеркалом для светлого поля;
55. Куб P2-EFLC для крепления флуоресцентных фильтров;
56. Светофильтр цветокорректирующий компенсационный NCB11;
57. Светофильтр нейтральный ND4;
58. Светофильтр нейтральный ND16;
59. Модуль темного поля светодиодный P-DF LED;
60. Экран защитный P-DF;
61. Набор P2-POL для простой поляризации в составе:
 - поляризатор;
 - анализатор.
62. Столик предметный P-SXY46;
63. Столик скользящий C-SSL DIA;
64. Столик наклоняемый C-TRS;
65. C-mount TV адаптер A;
66. C-mount адаптер 0.55x;
67. C-mount адаптер 0.7x;
68. DS-F F-mount адаптер;
69. DS-F2.5 F-mount адаптер 2.5x;
70. Адаптер тубусный LV-TV;
71. Камера цифровая специализированная DS-Qi2;
72. Камера цифровая специализированная DS-Ri2;
73. Камера цифровая специализированная DS-Fi1c;
74. Камера цифровая специализированная DS-Fi2;
75. Камера цифровая специализированная DS-Vi1;
76. Блок управления DS-L3 камерой цифровой специализированной;
77. Блок управления DS-U3 камерой цифровой специализированной;
78. Кабель интерфейсный для камеры серии DS;

- 79. Ключ электронный;
- 80. Блок управления P2-CTLA;
- 81. Пульт дистанционного управления P2-RC;
- 82. Переключатель ножной AZ-FSW;
- 83. Педаль захвата изображений AZ-HRC;
- 84. Руководство по эксплуатации.

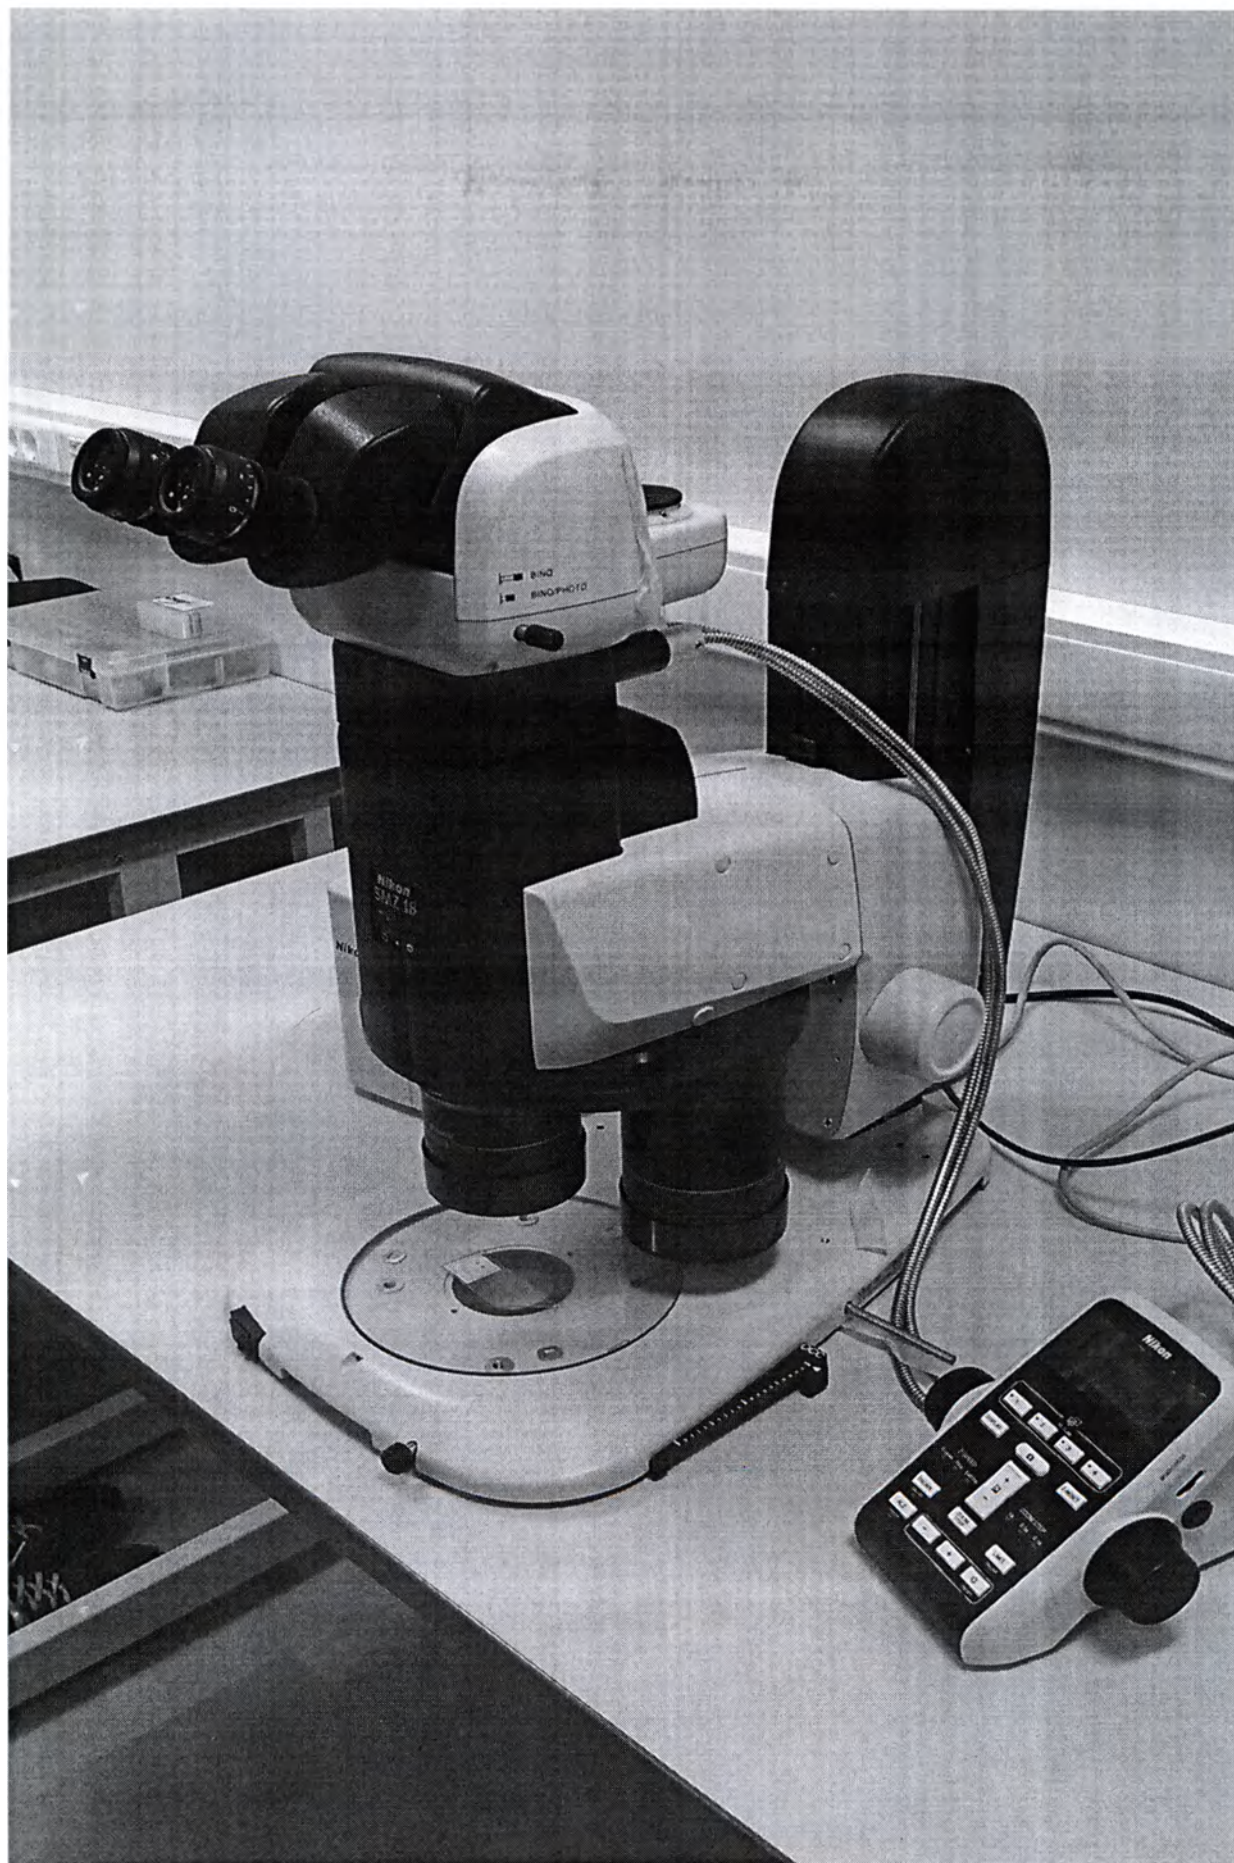


Рис.1

Микроскоп медицинский стереоскопический для лабораторных исследований Nikon SMZ, вариант исполнения: Nikon SMZ18.

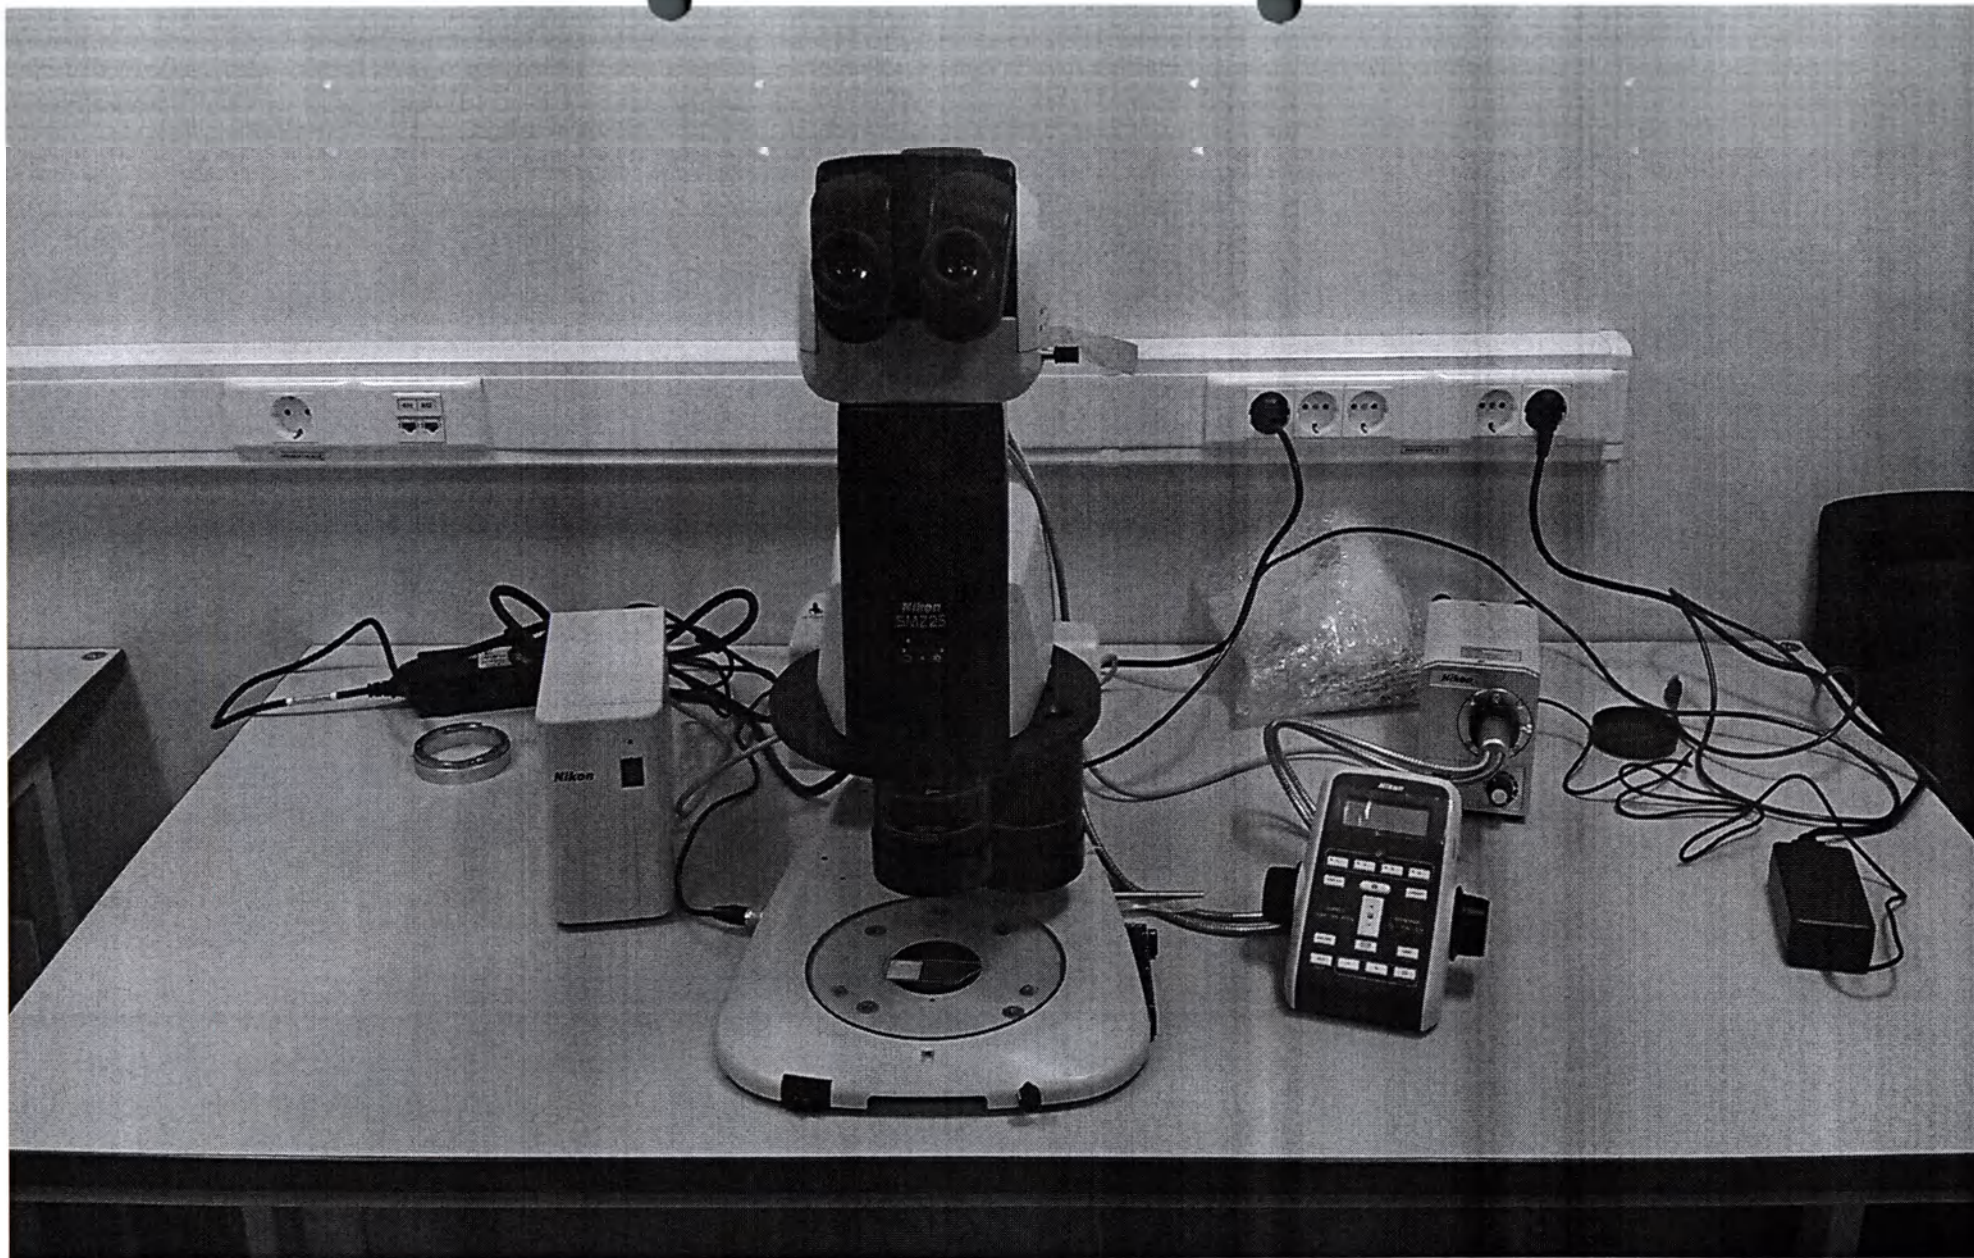


Рис.2

Микроскоп медицинский стереоскопический для лабораторных исследований Nikon SMZ, вариант исполнения: Nikon SMZ25



Рис.3 - Оптический блок микроскопа Nikon SMZ18



Рис.4 - Оптический блок микроскопа Nikon SMZ25



Рис.5

Тубус наклоняемый тринокулярный P2-TERG 100



Рис.6

Тубус наклоняемый тринокулярный P2-TERG 50

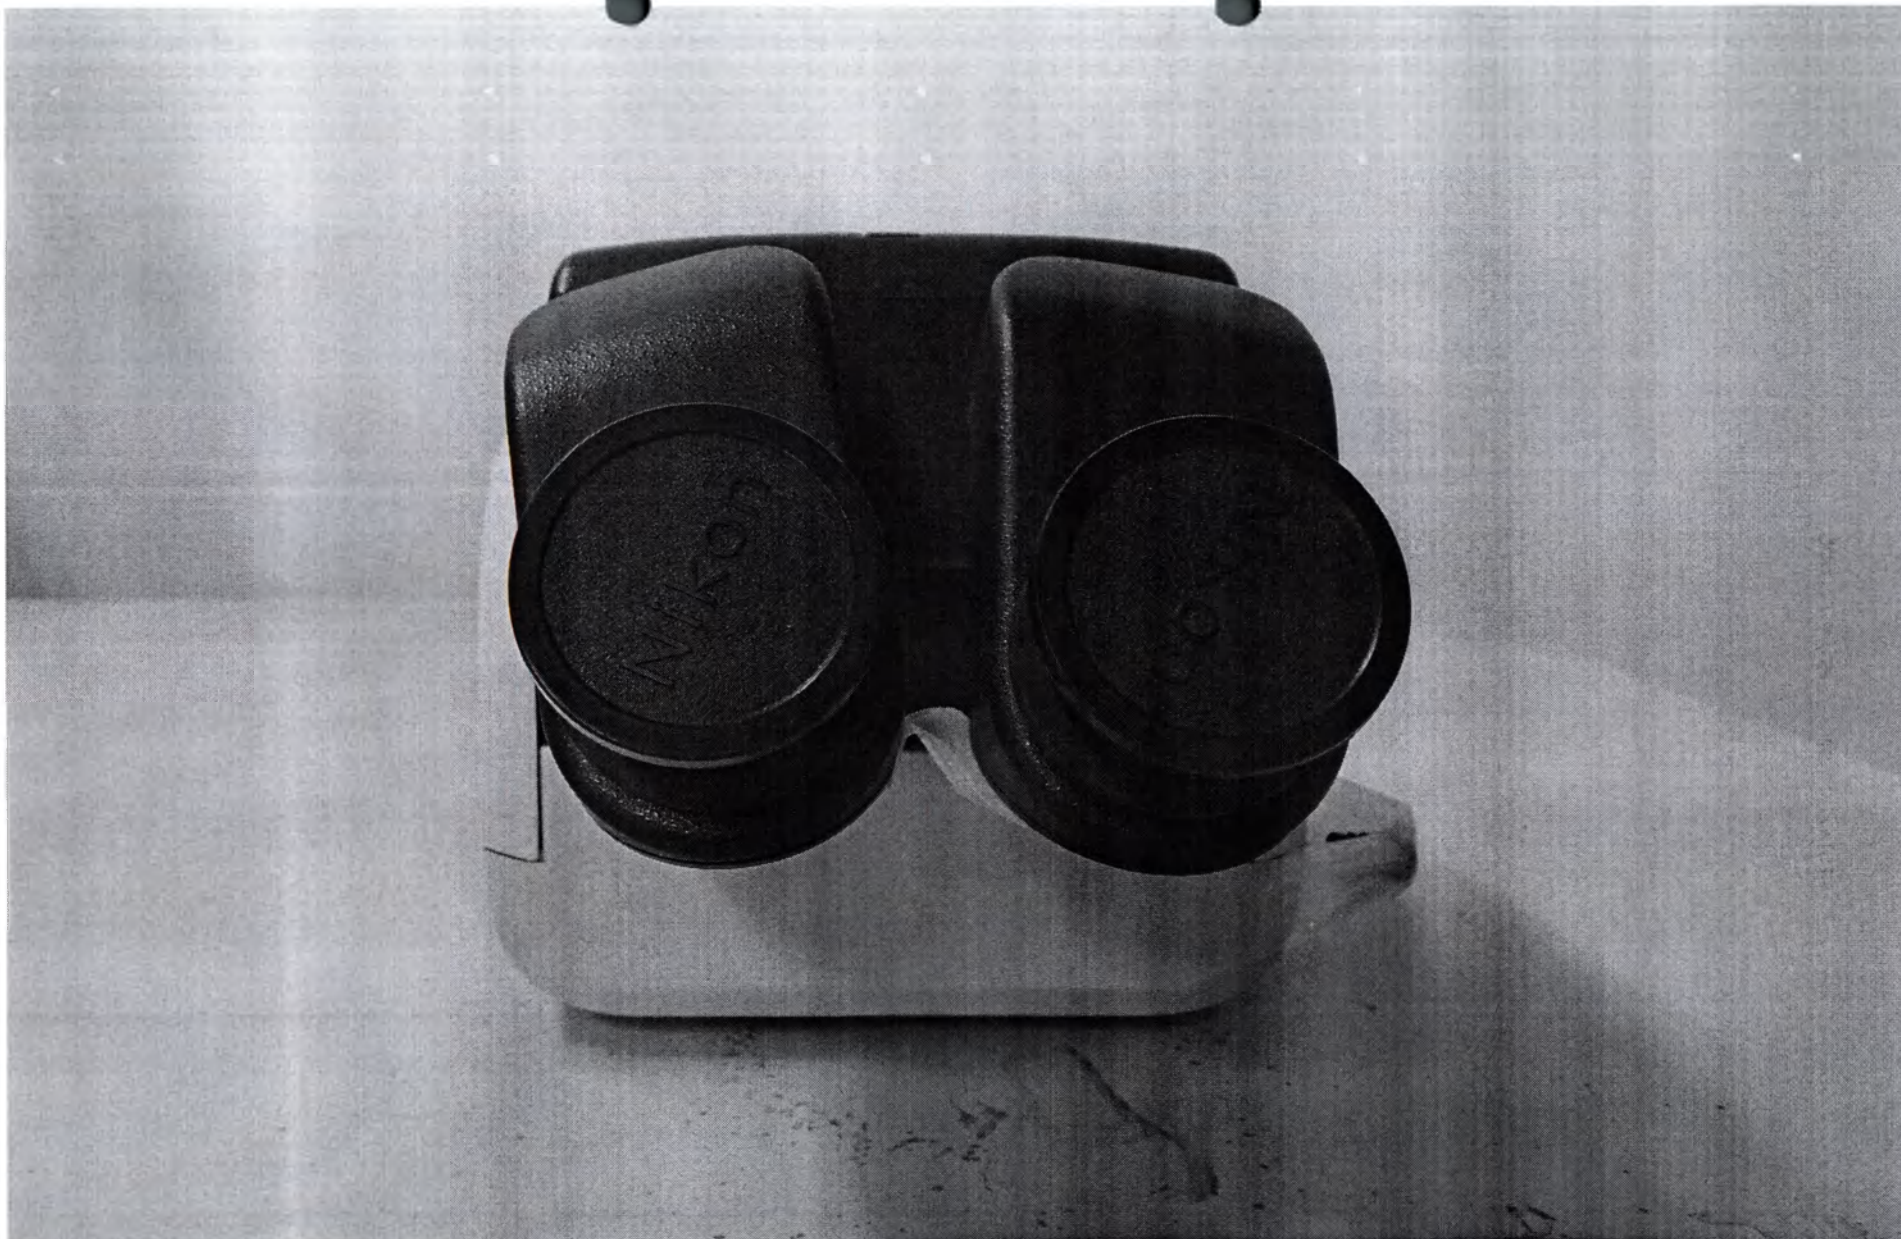


Рис.7

Тубус тринокулярный P2-TL100



Рис.8
Окуляр C-W 10x

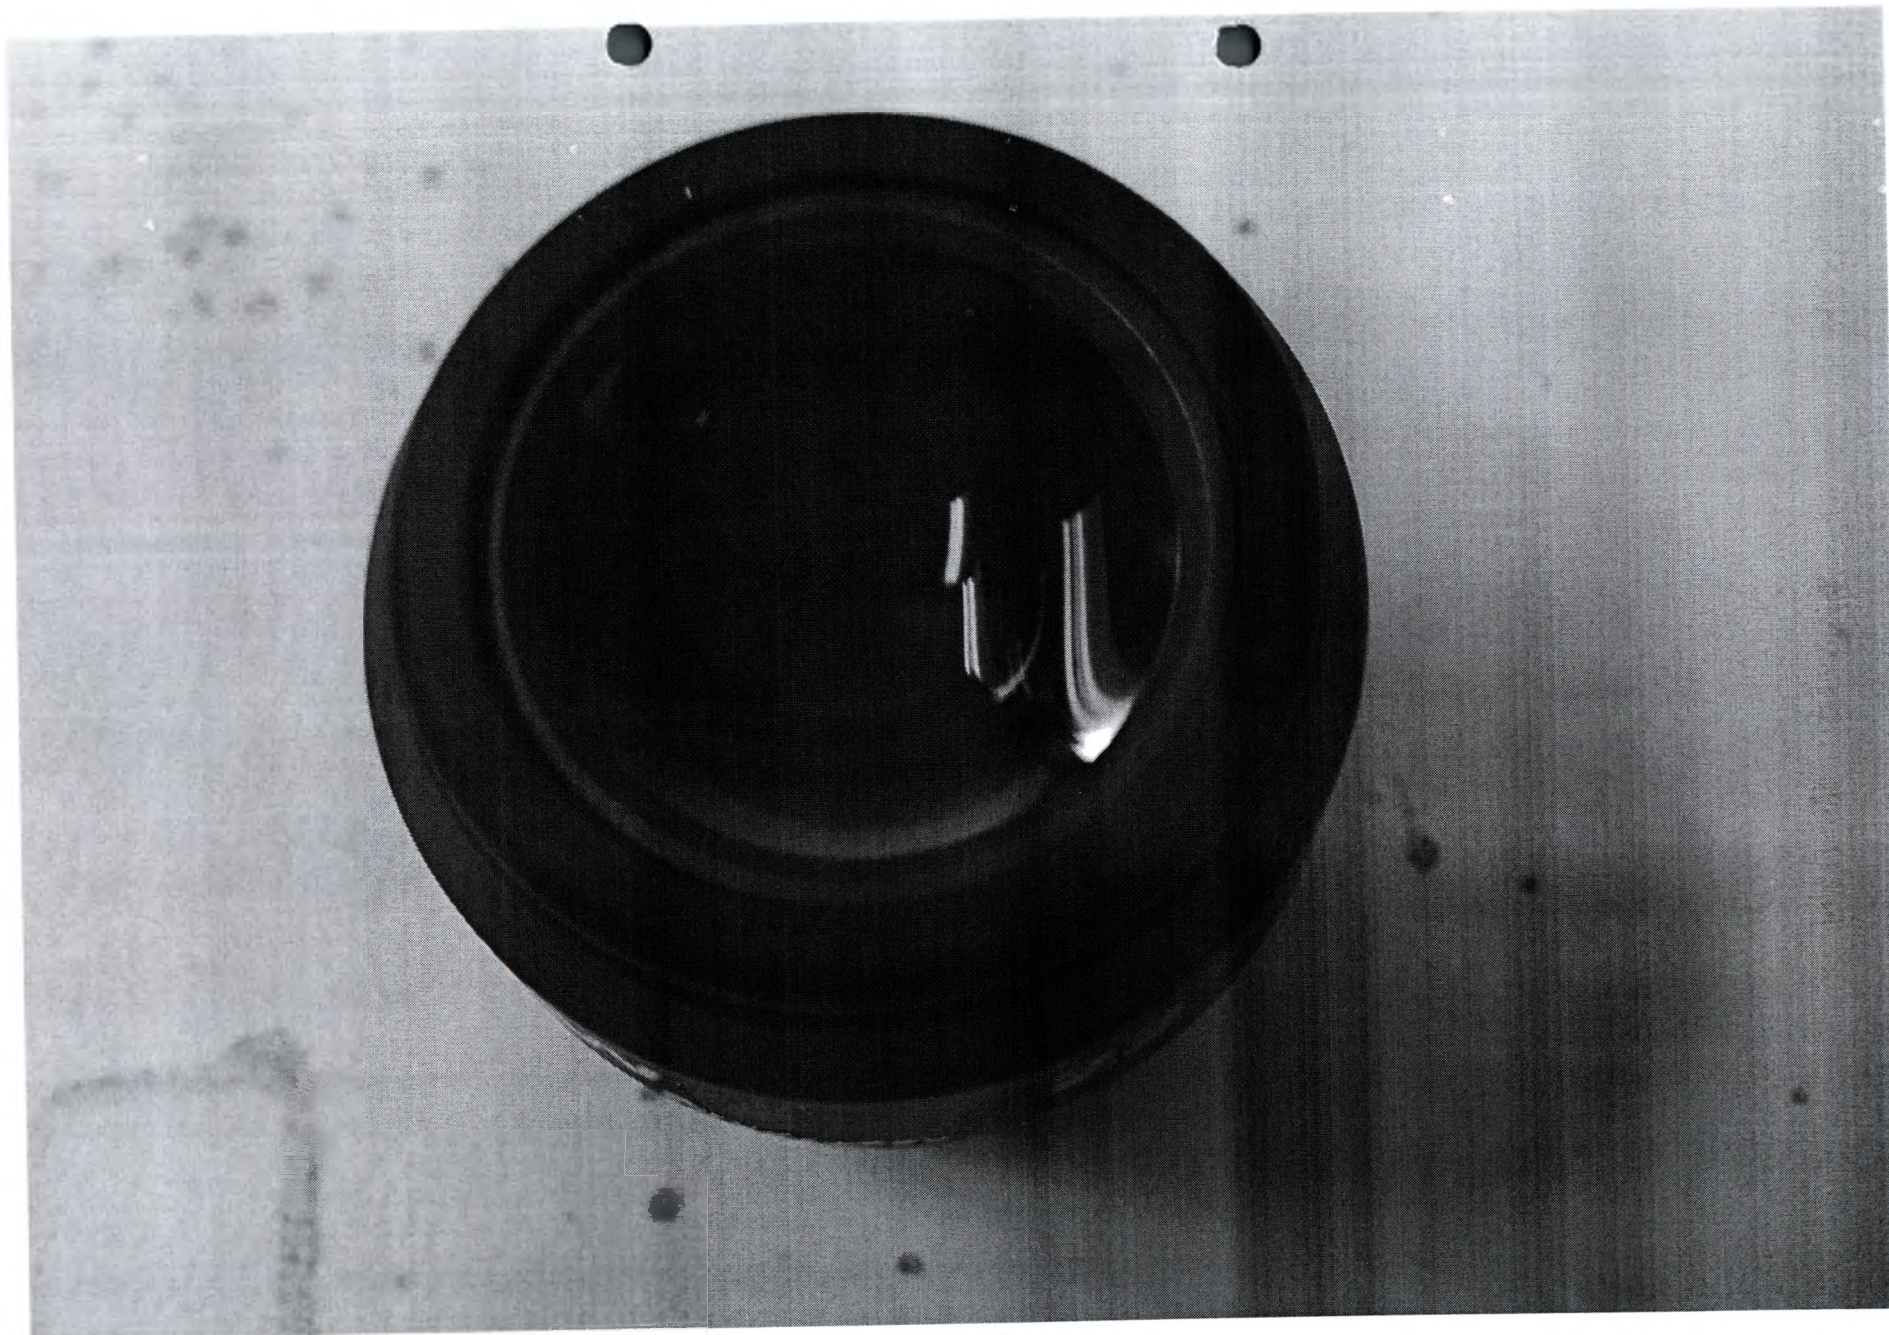


Рис.9
Окуляр AZ-W10x

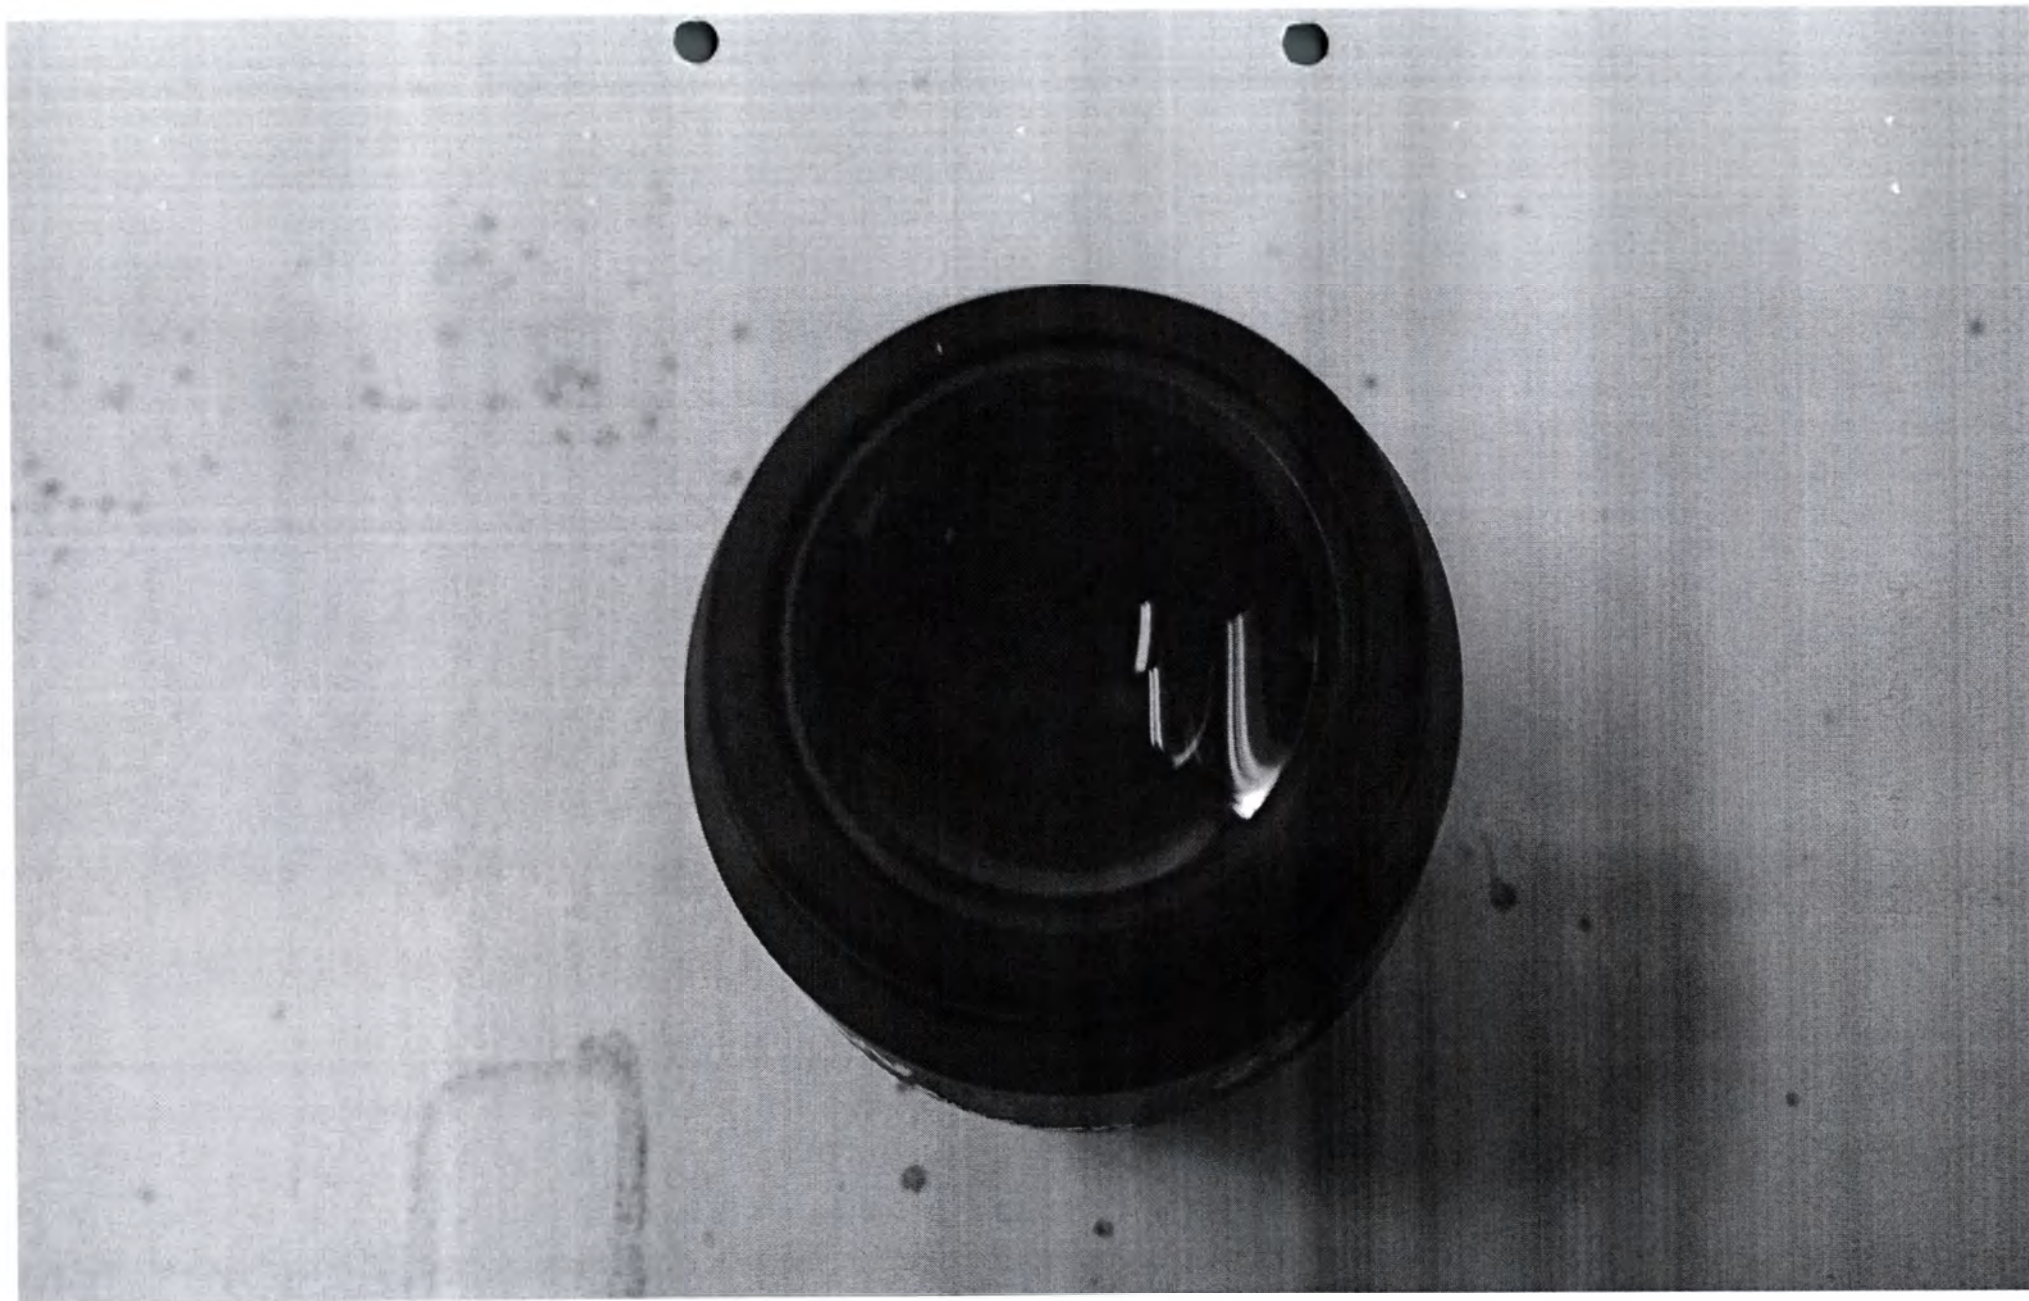


Рис.10
Окуляр С-W 15х

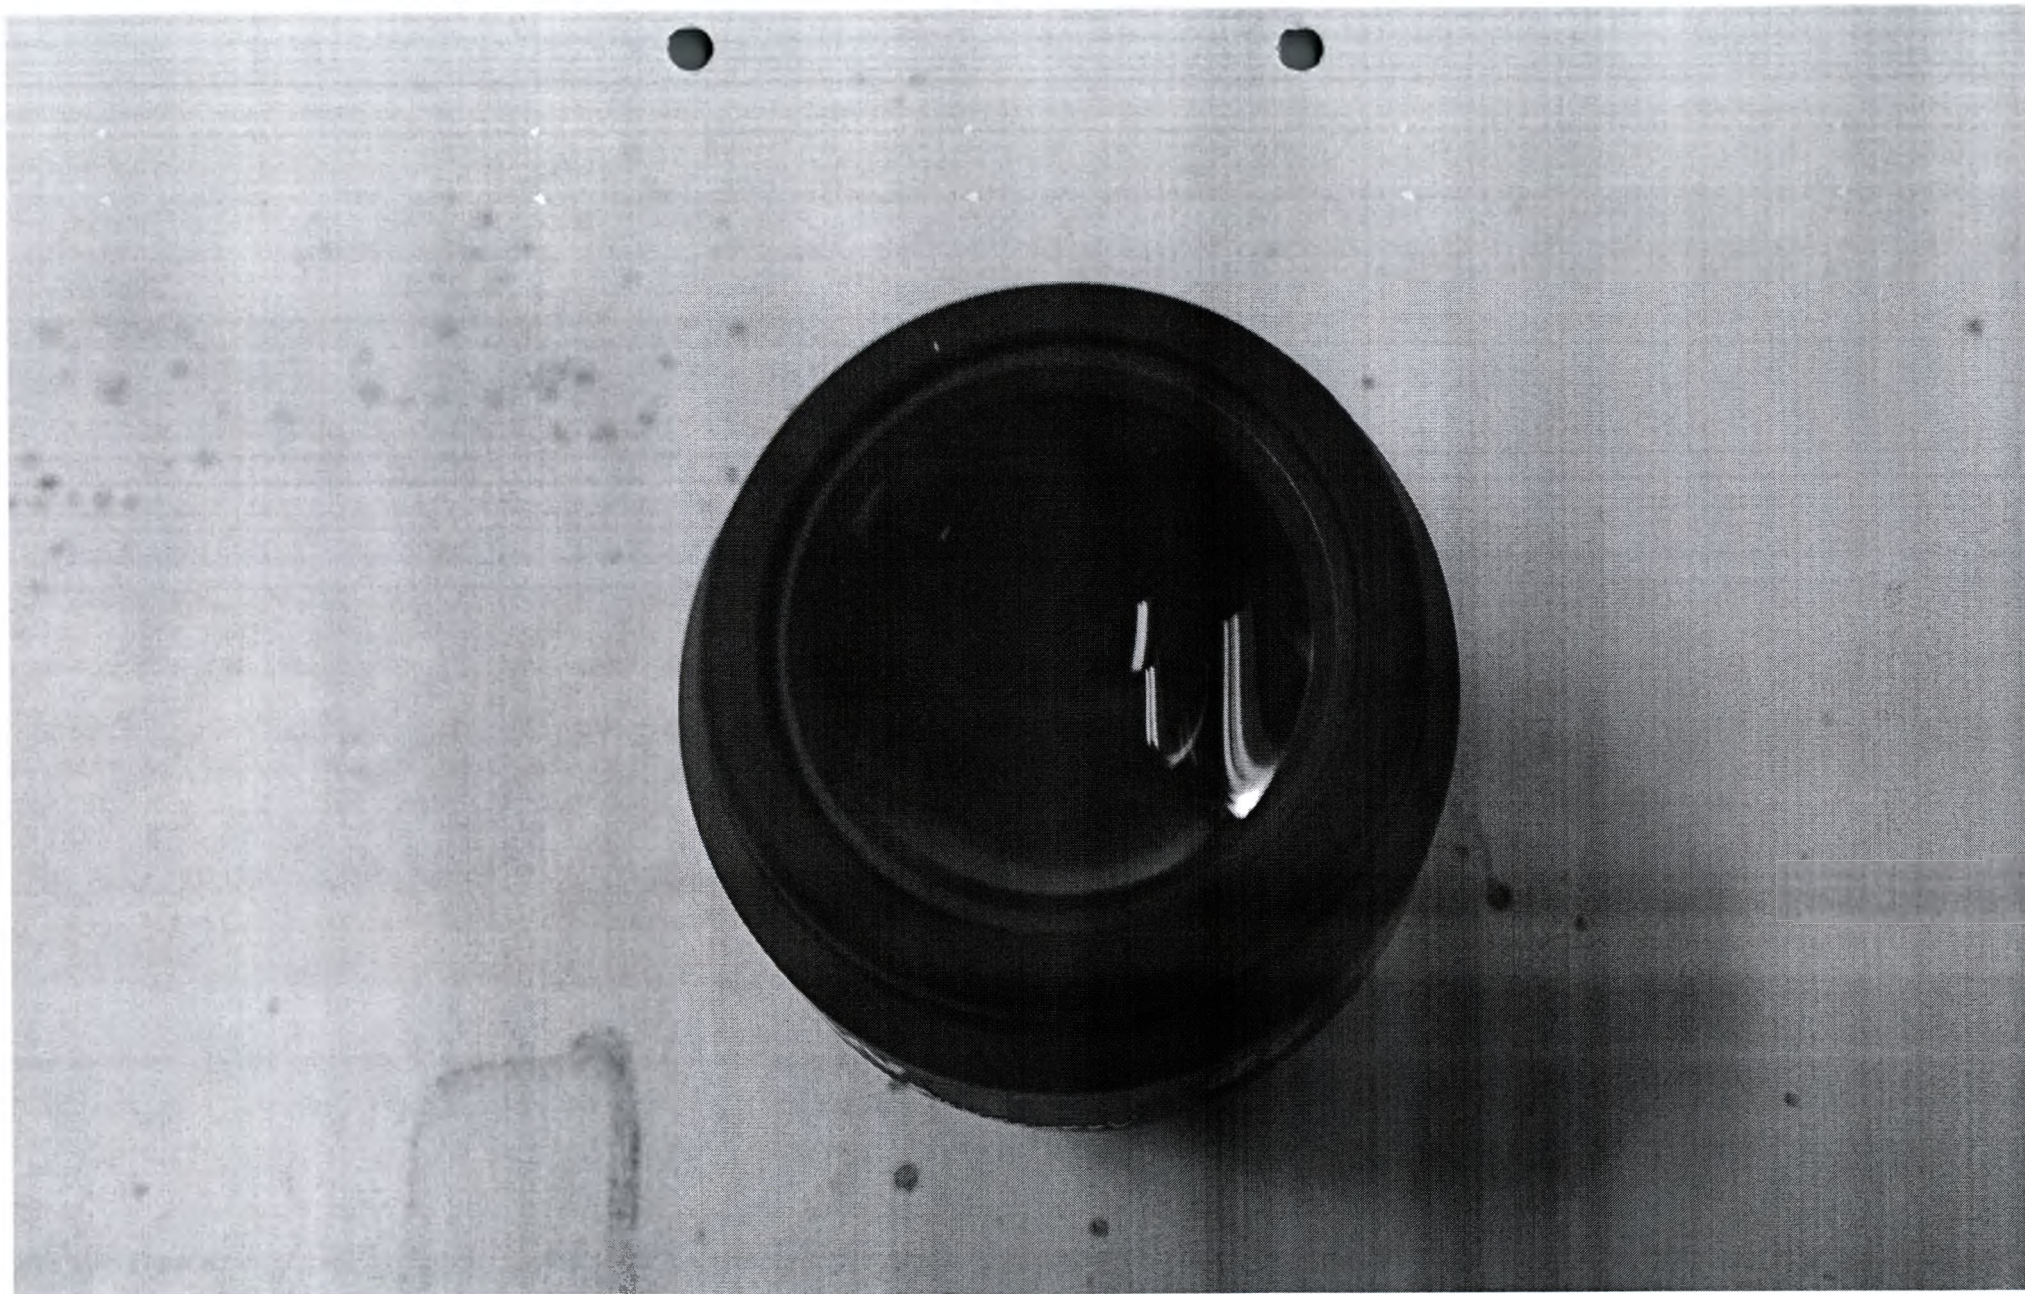


Рис.11
Окуляр С-В 30х

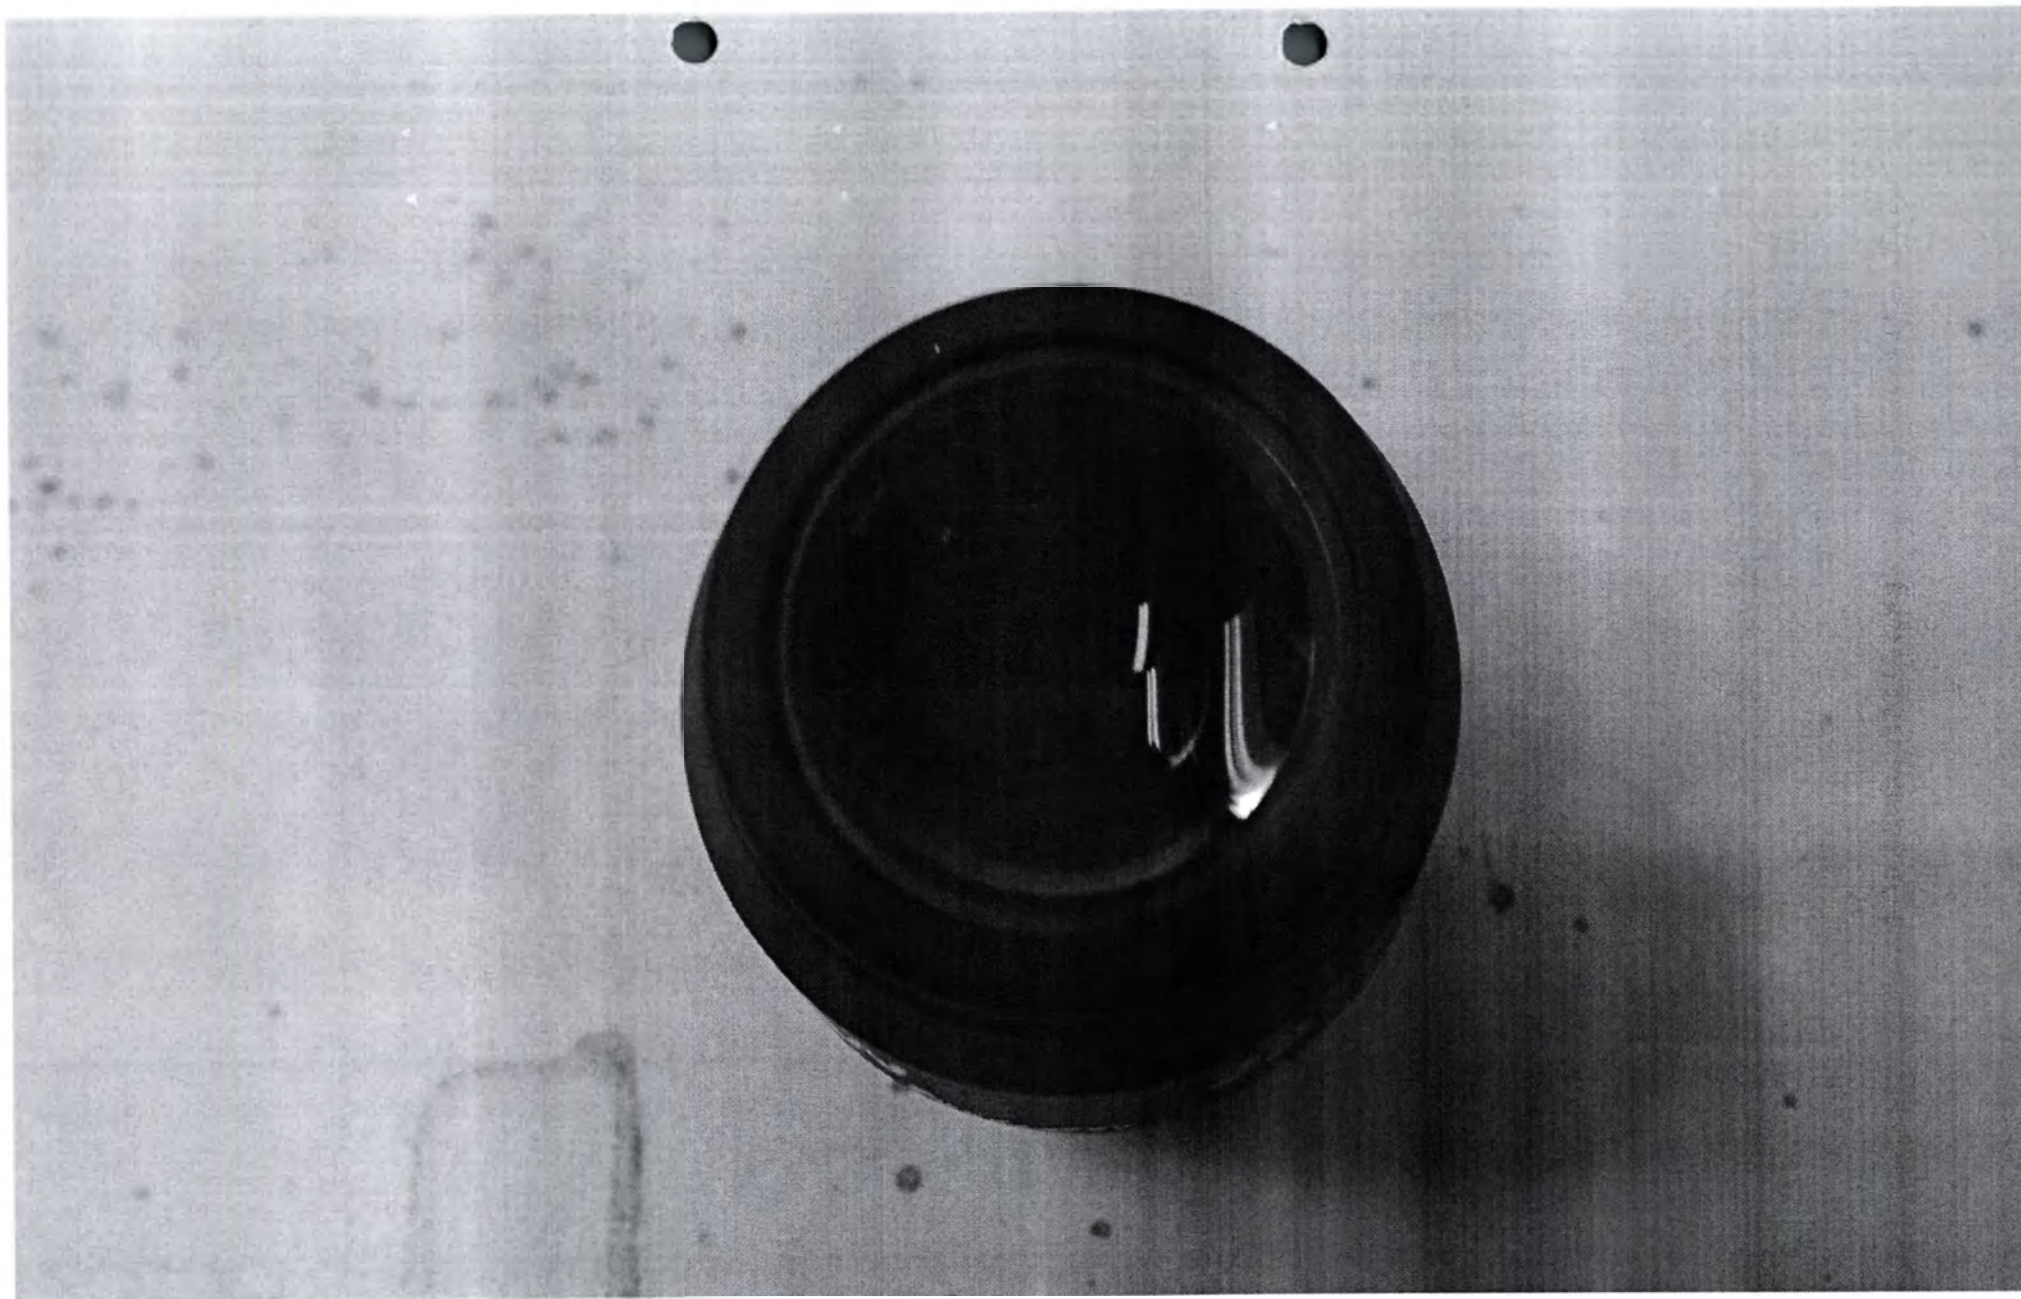


Рис.12
Окуляр С-W 20х

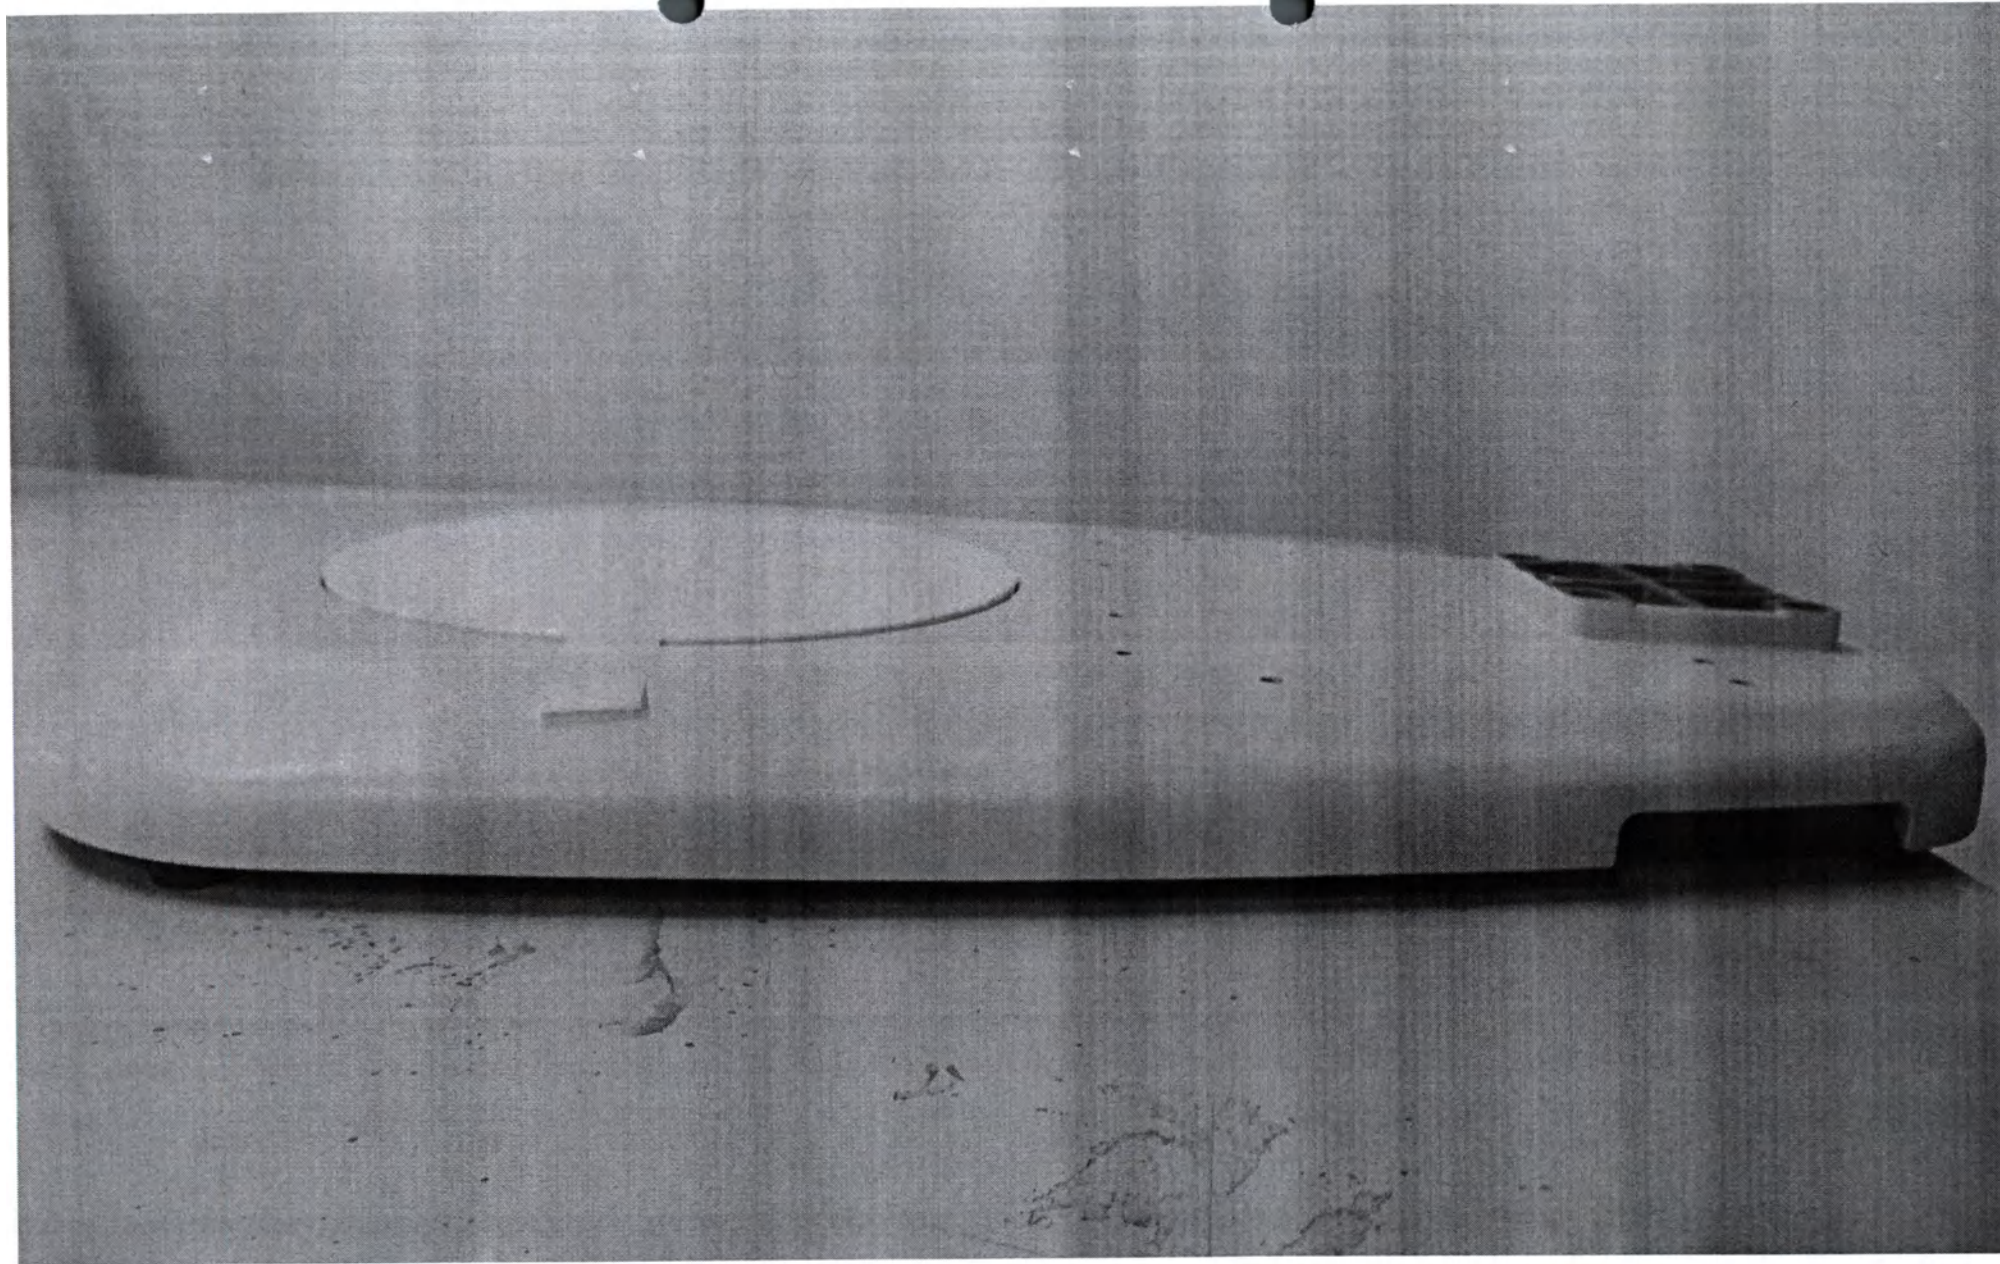


Рис.13

Основание плоское Р2-РВ.

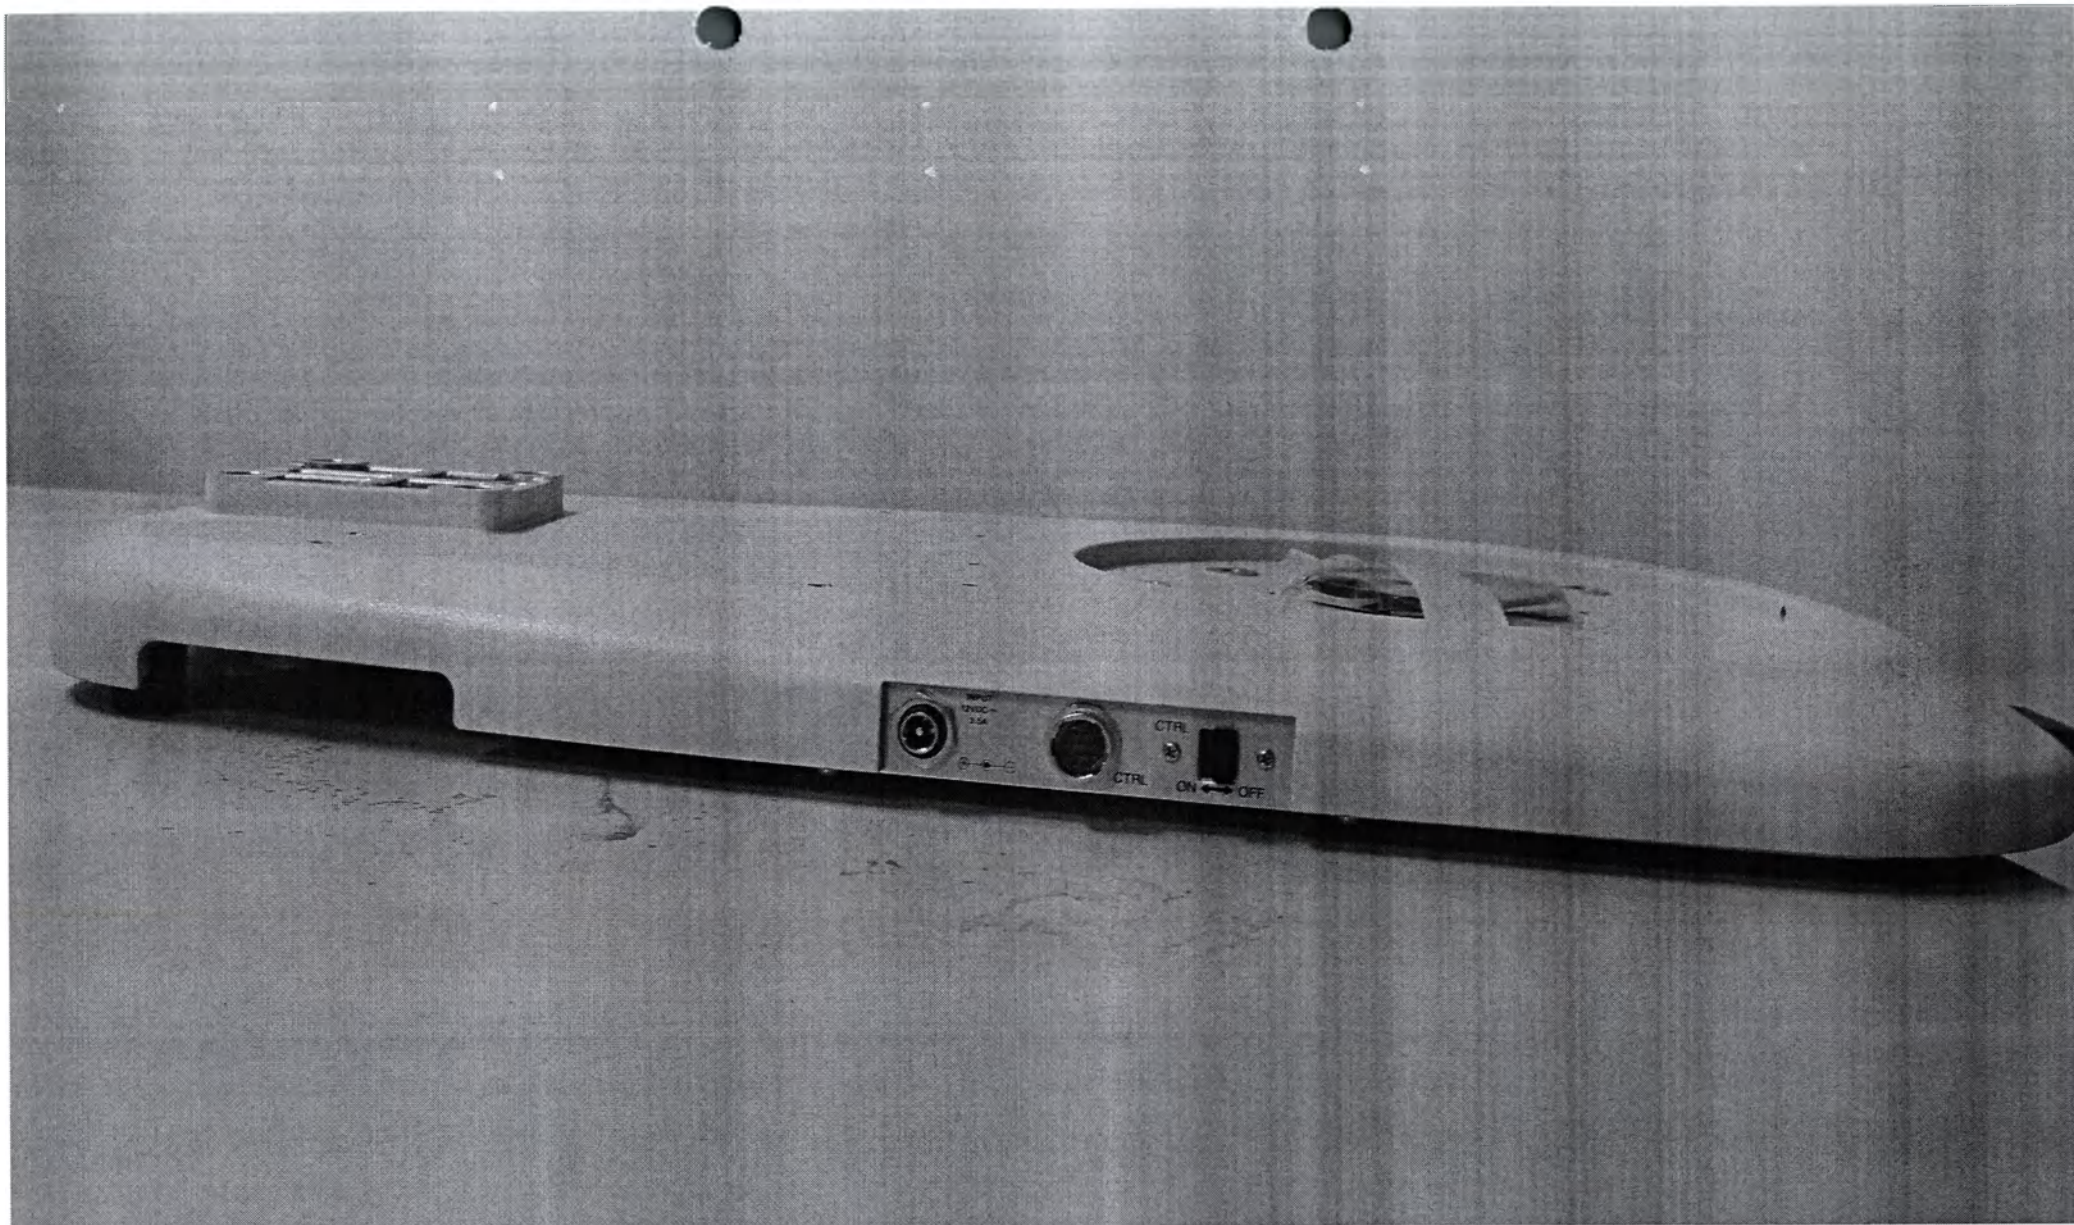


Рис.14

Основание для светодиодного диаскопического освещения P2-DBL LED

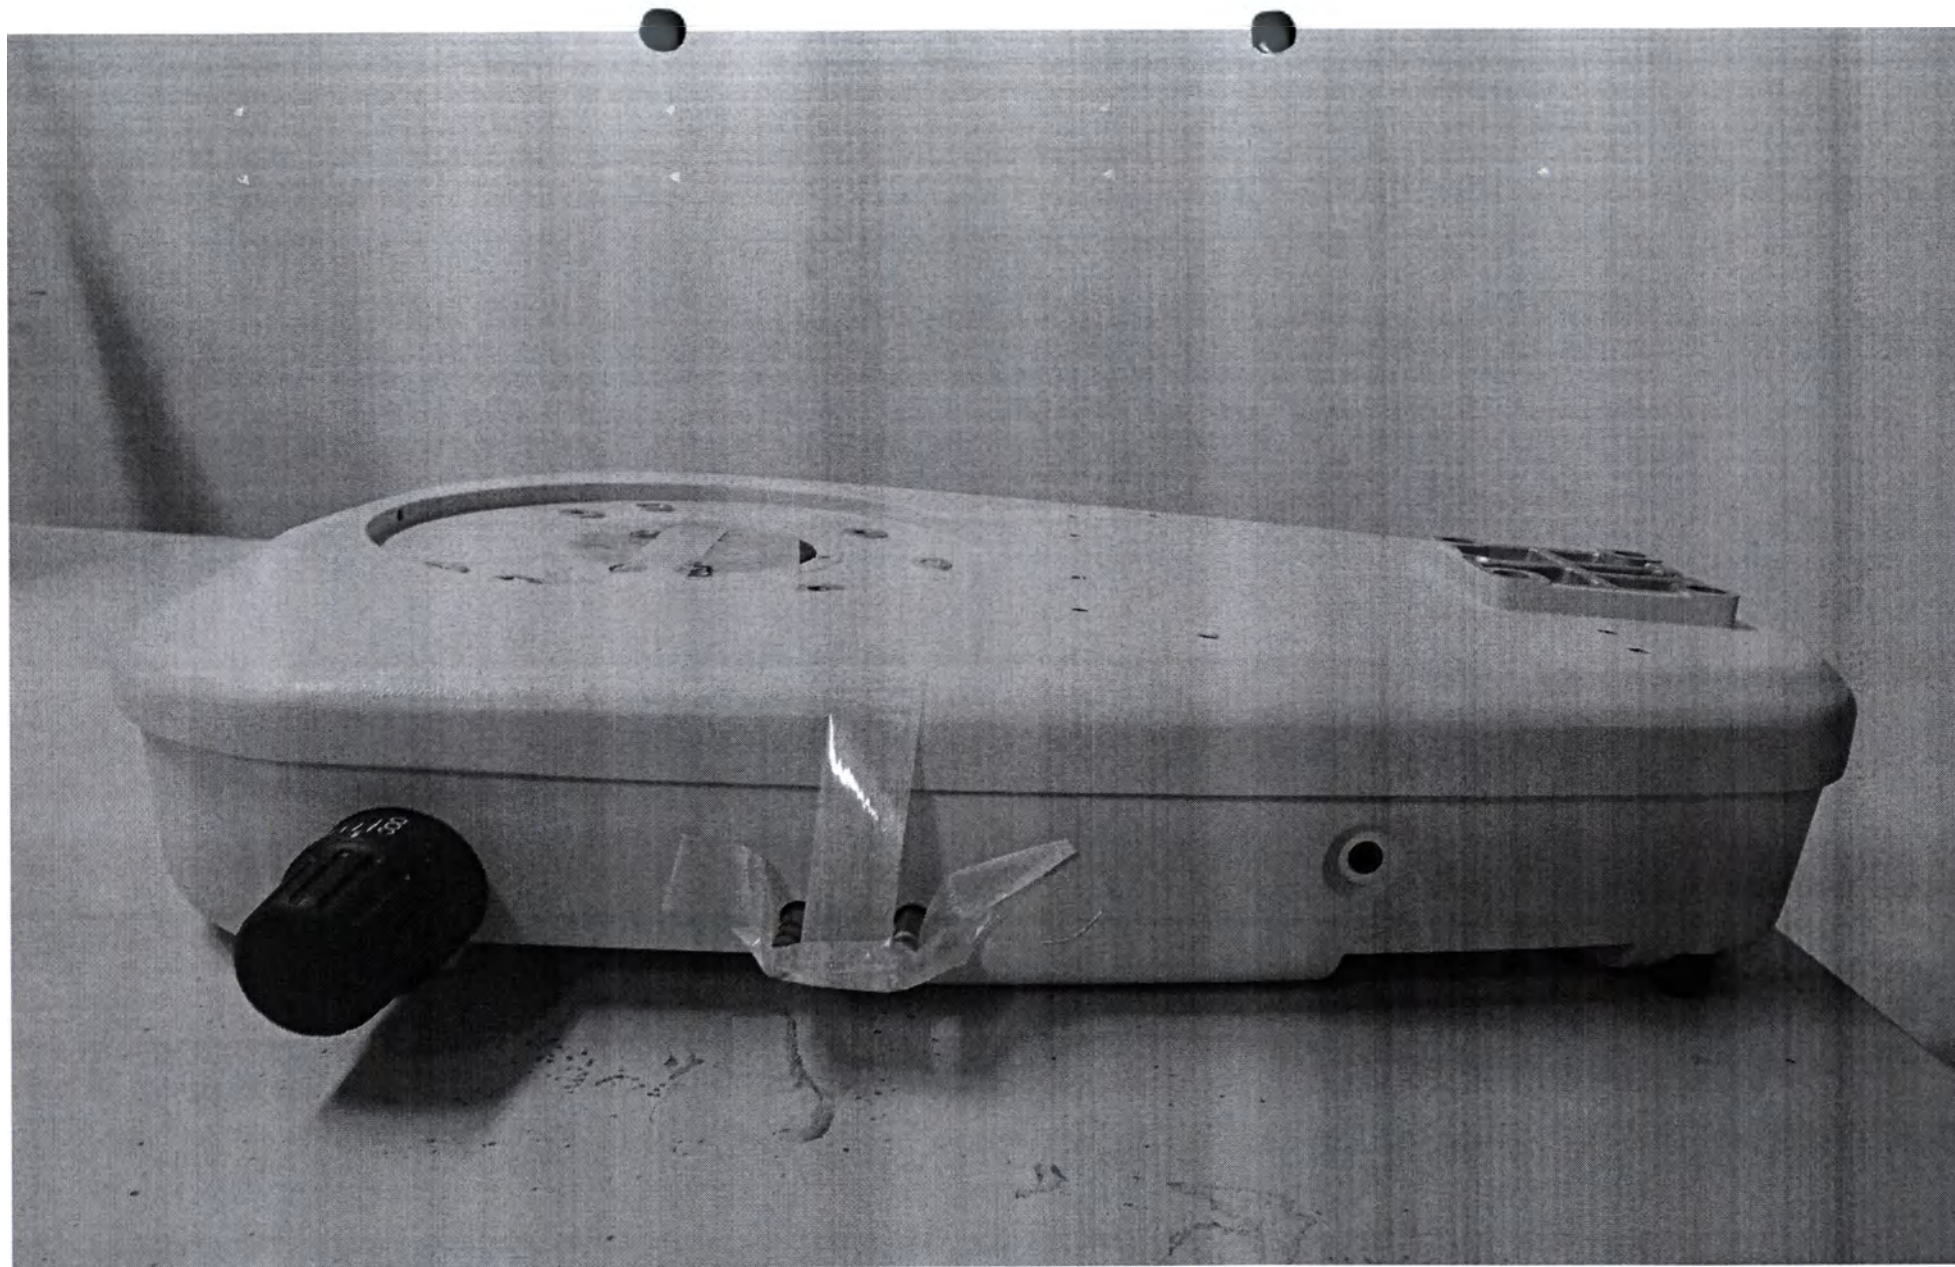


Рис.15

Основание P2-DBF для оптоволоконного диаскопического осветителя

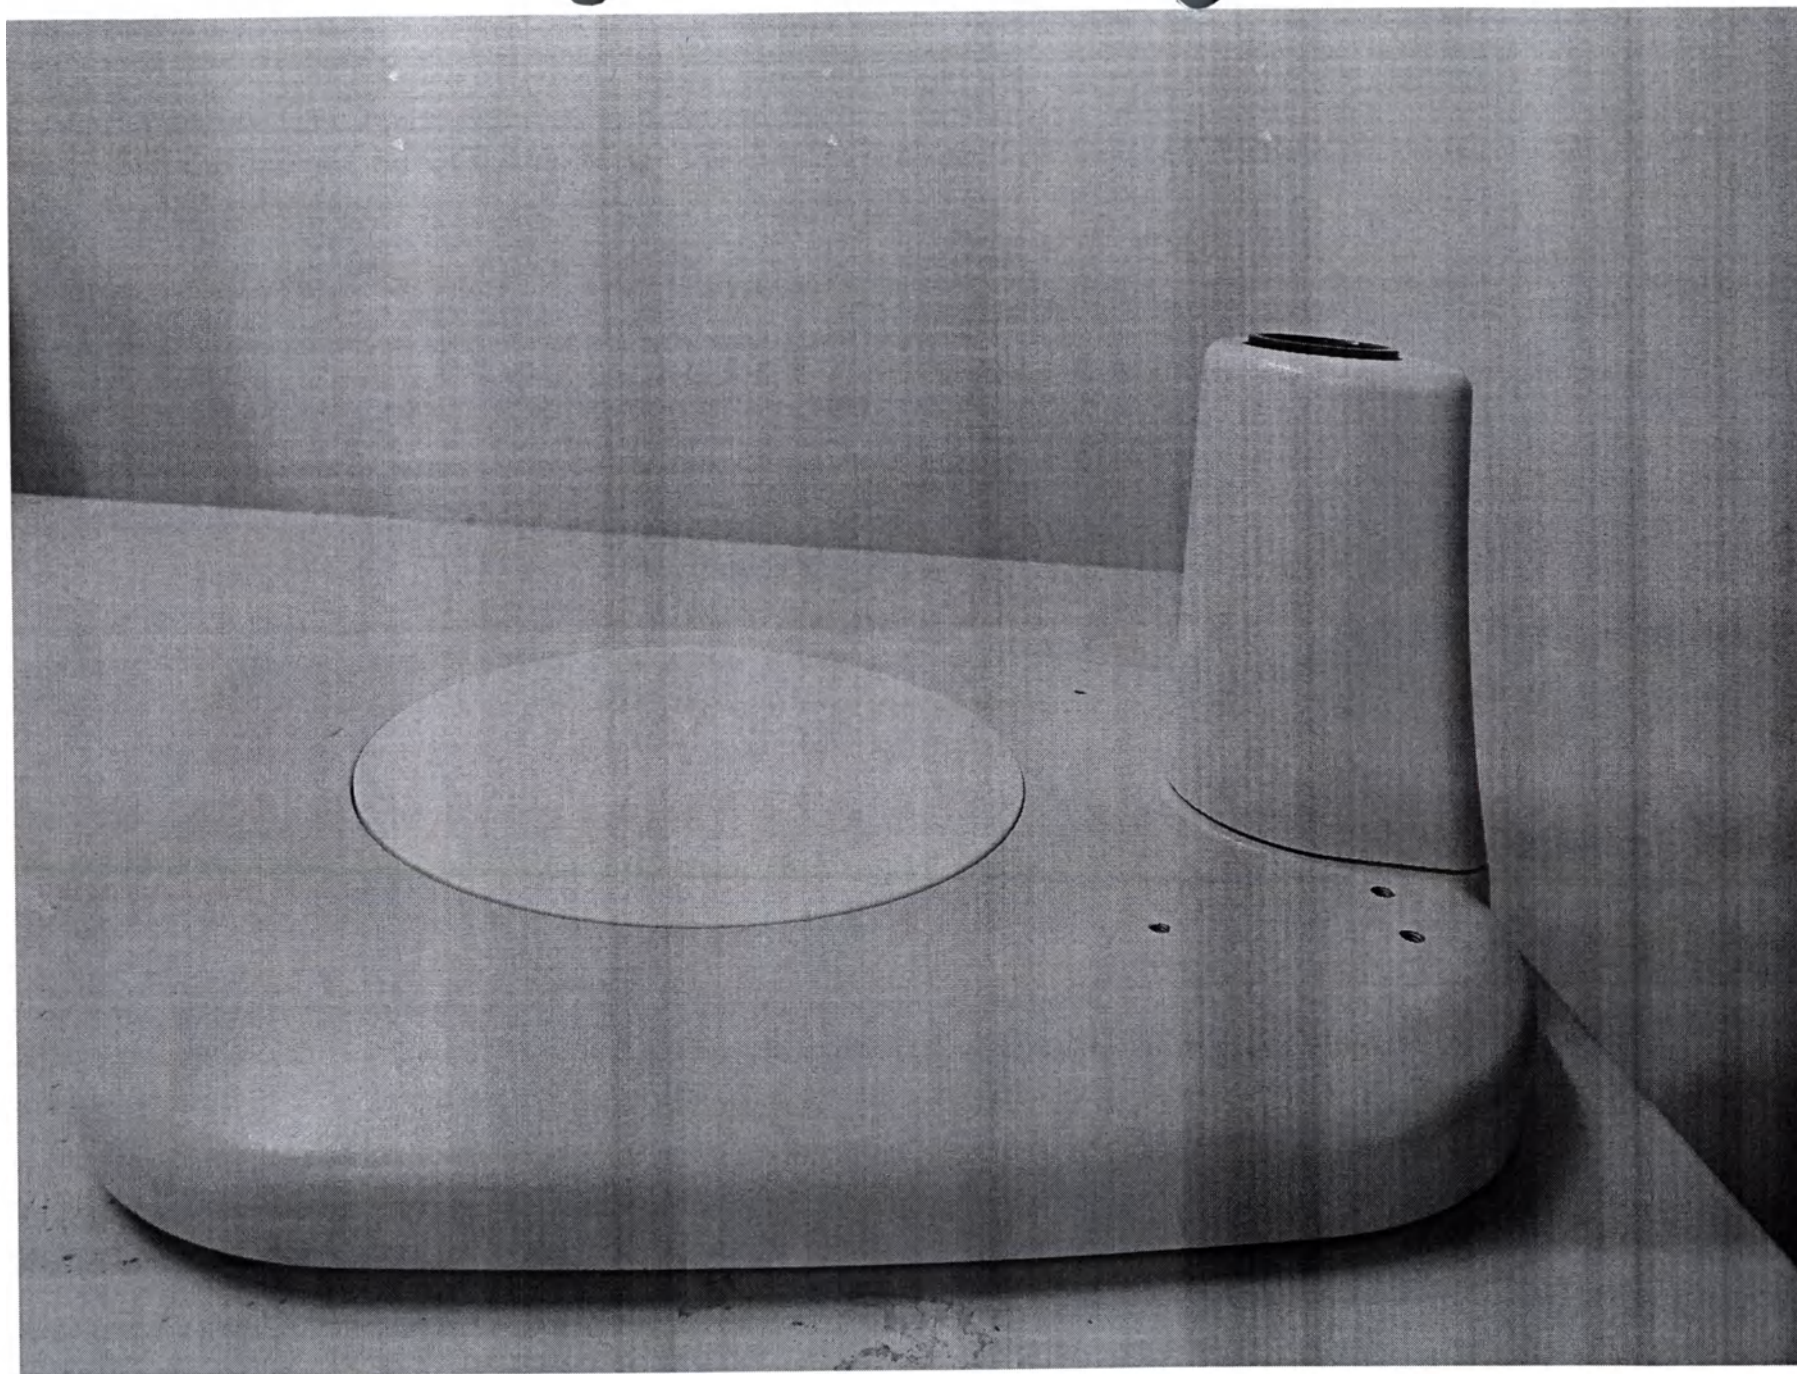


Рис.16 - Штатив плоский Р-PS32

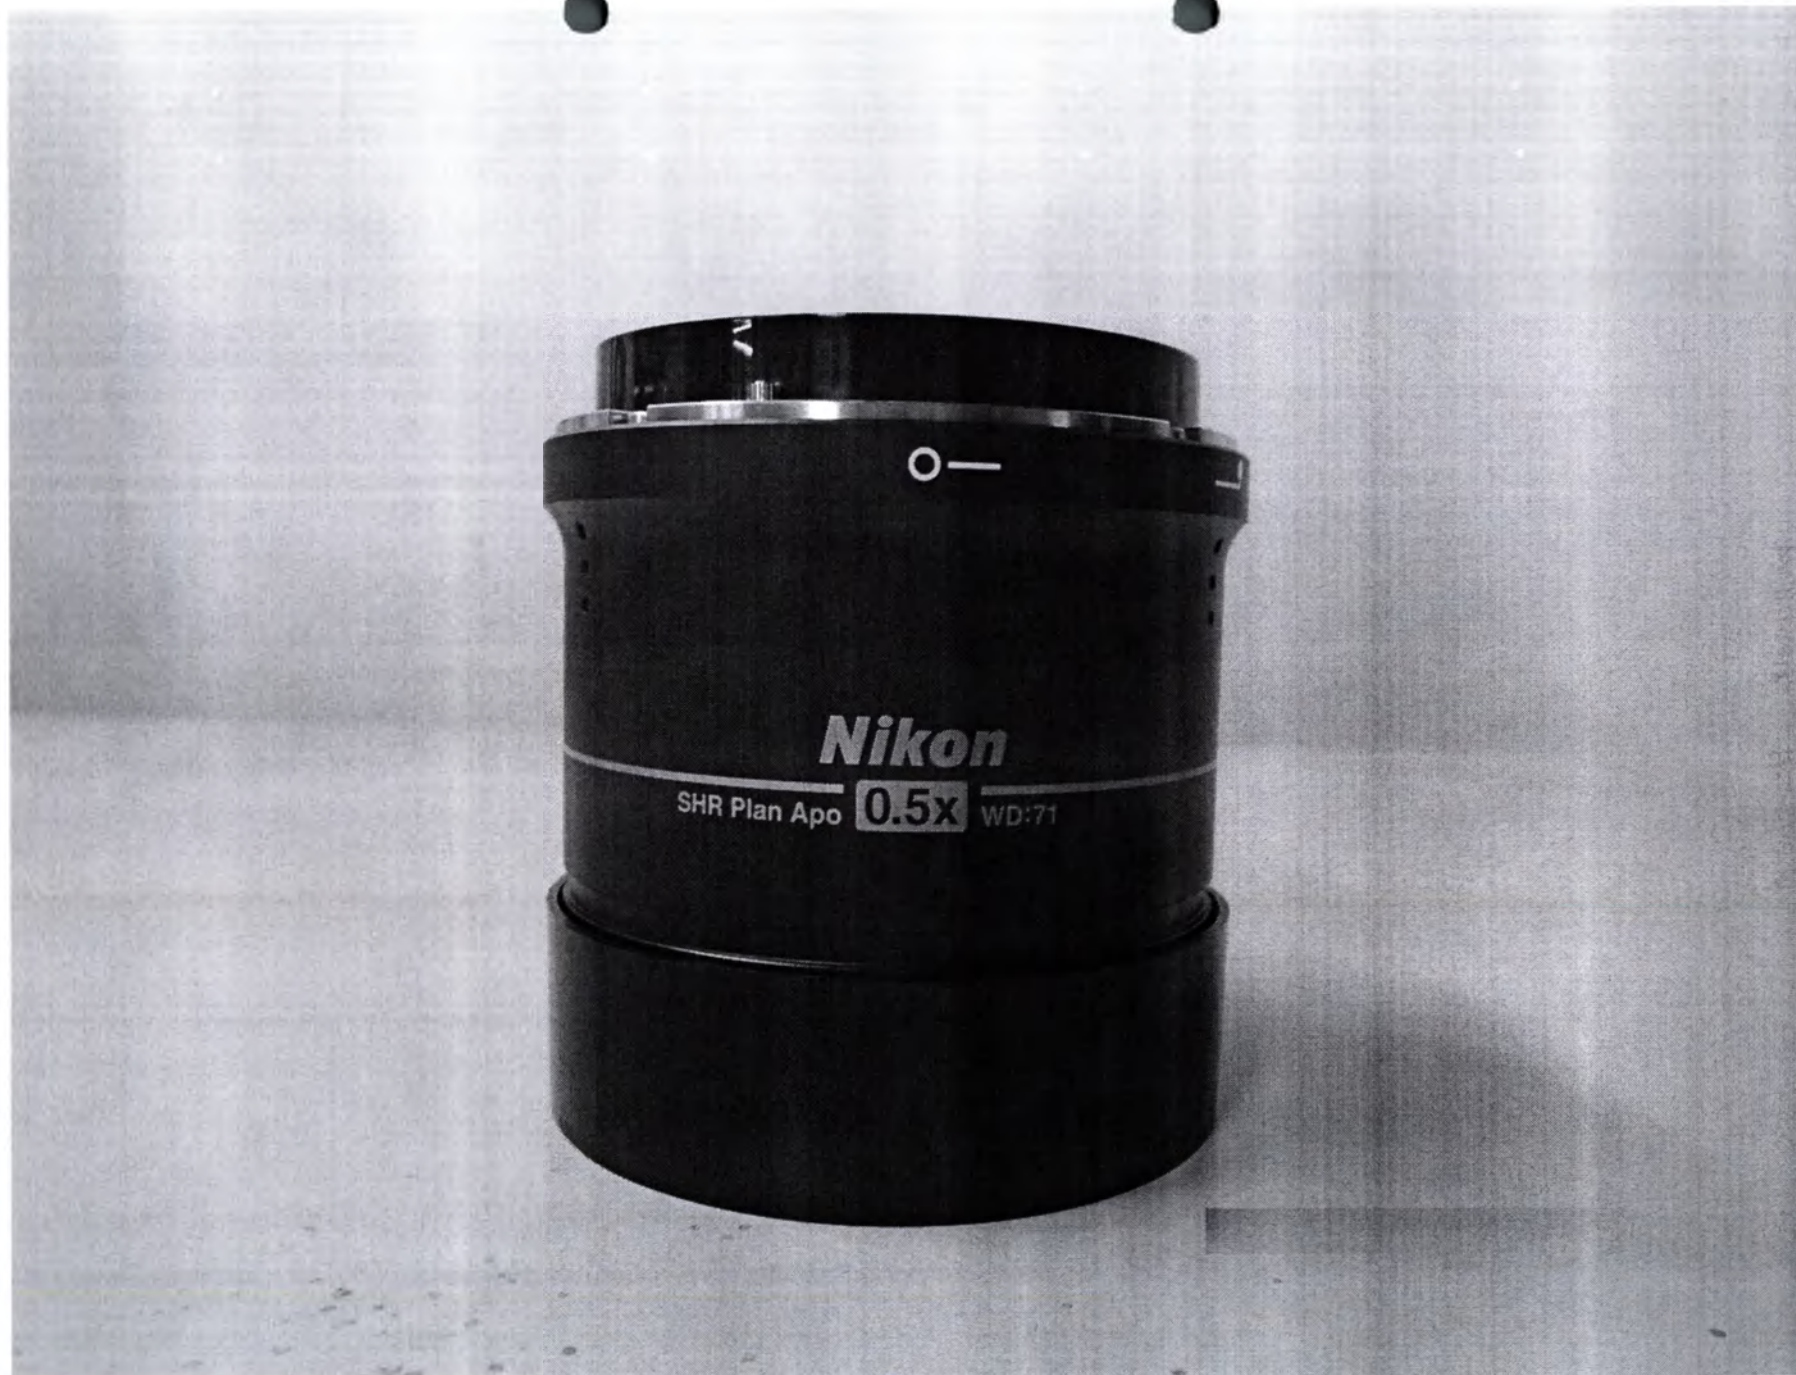


Рис.17 - Объектив P2-SHR Plan Apo 0.5X

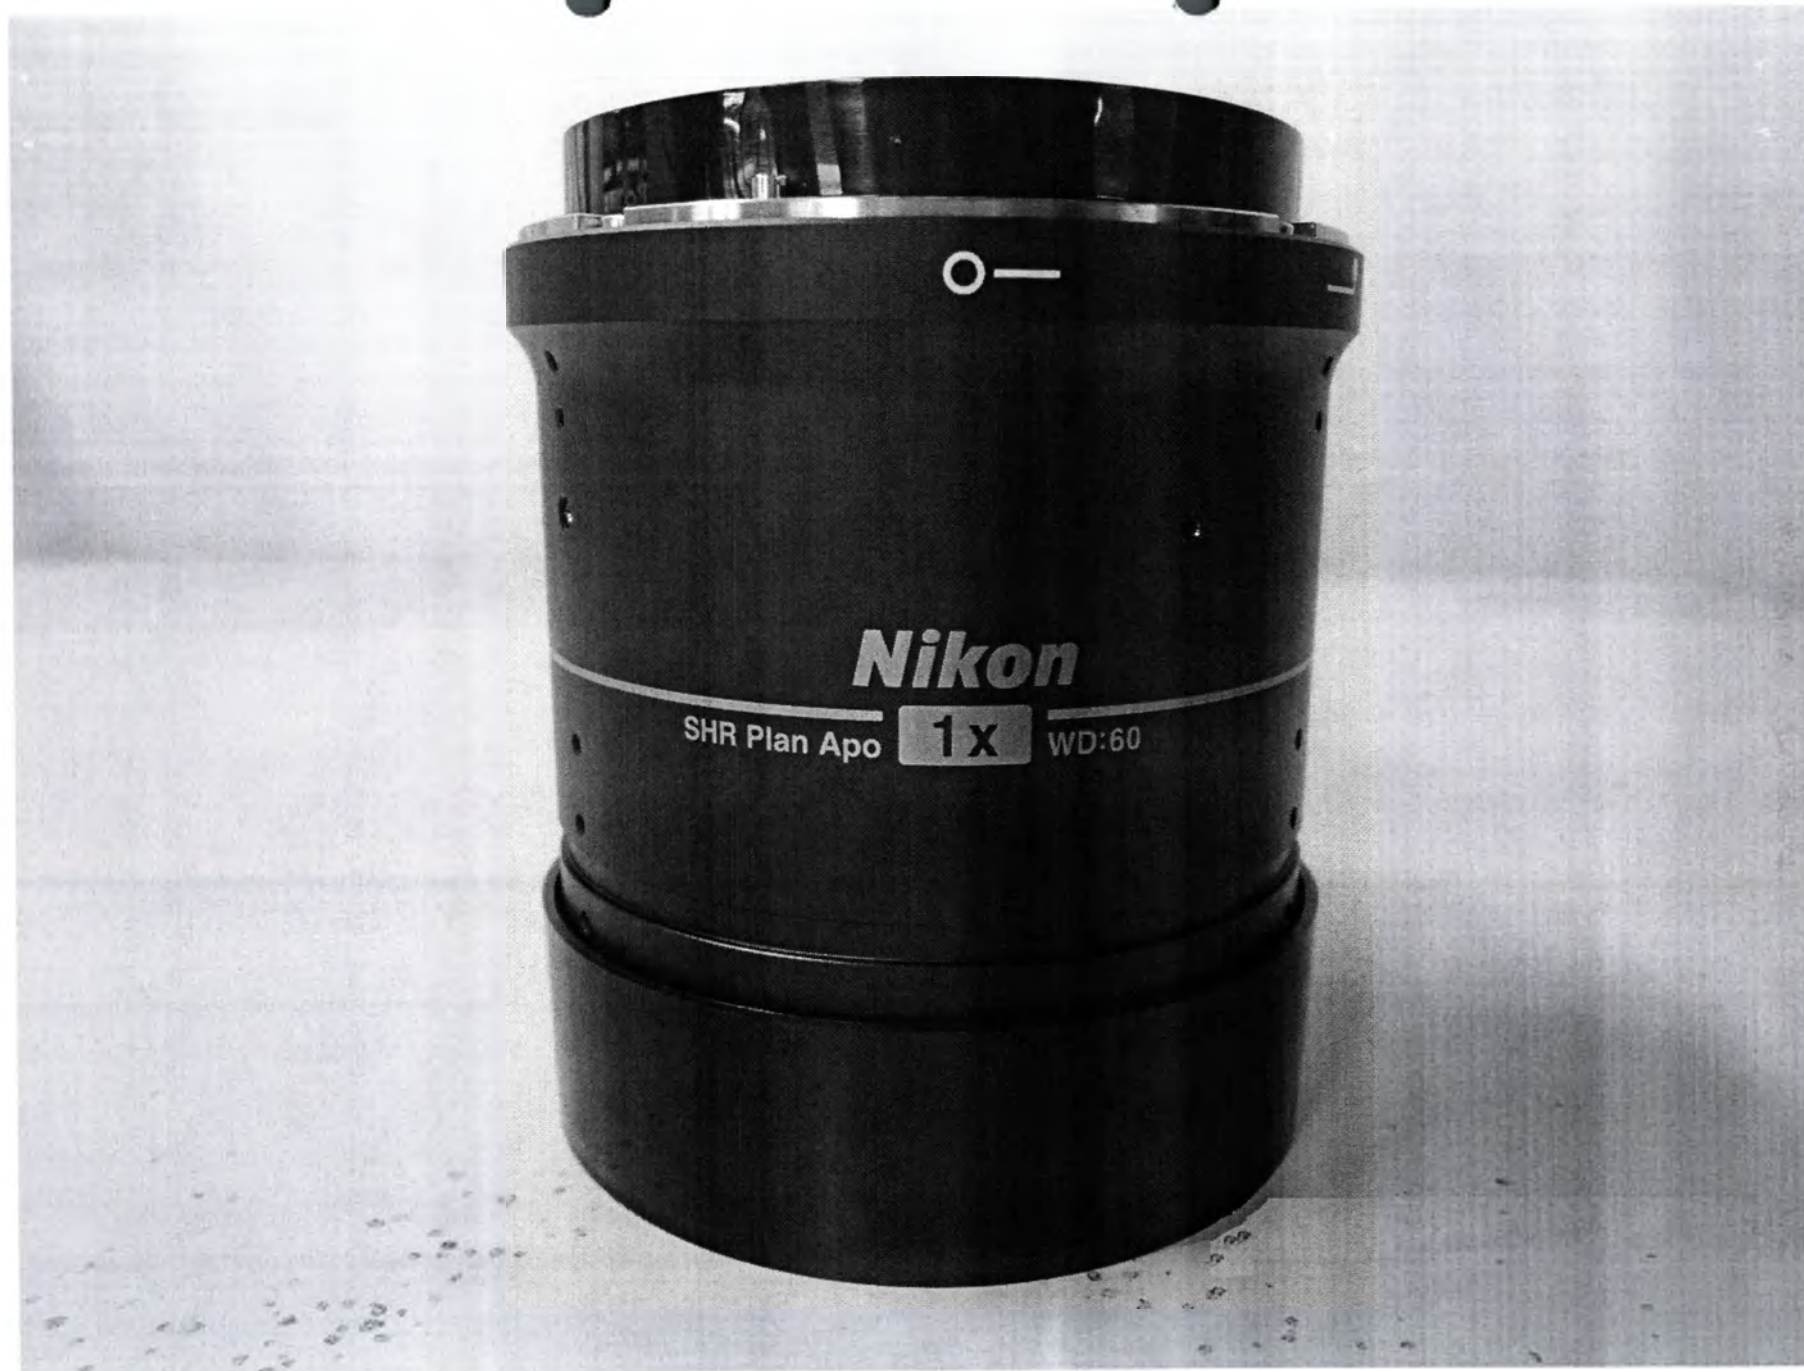


Рис.18 - Объектив P2-SHR Plan Apo 1X



Рис.19 - Объектив P2-SHR Plan Apo 1.6X.

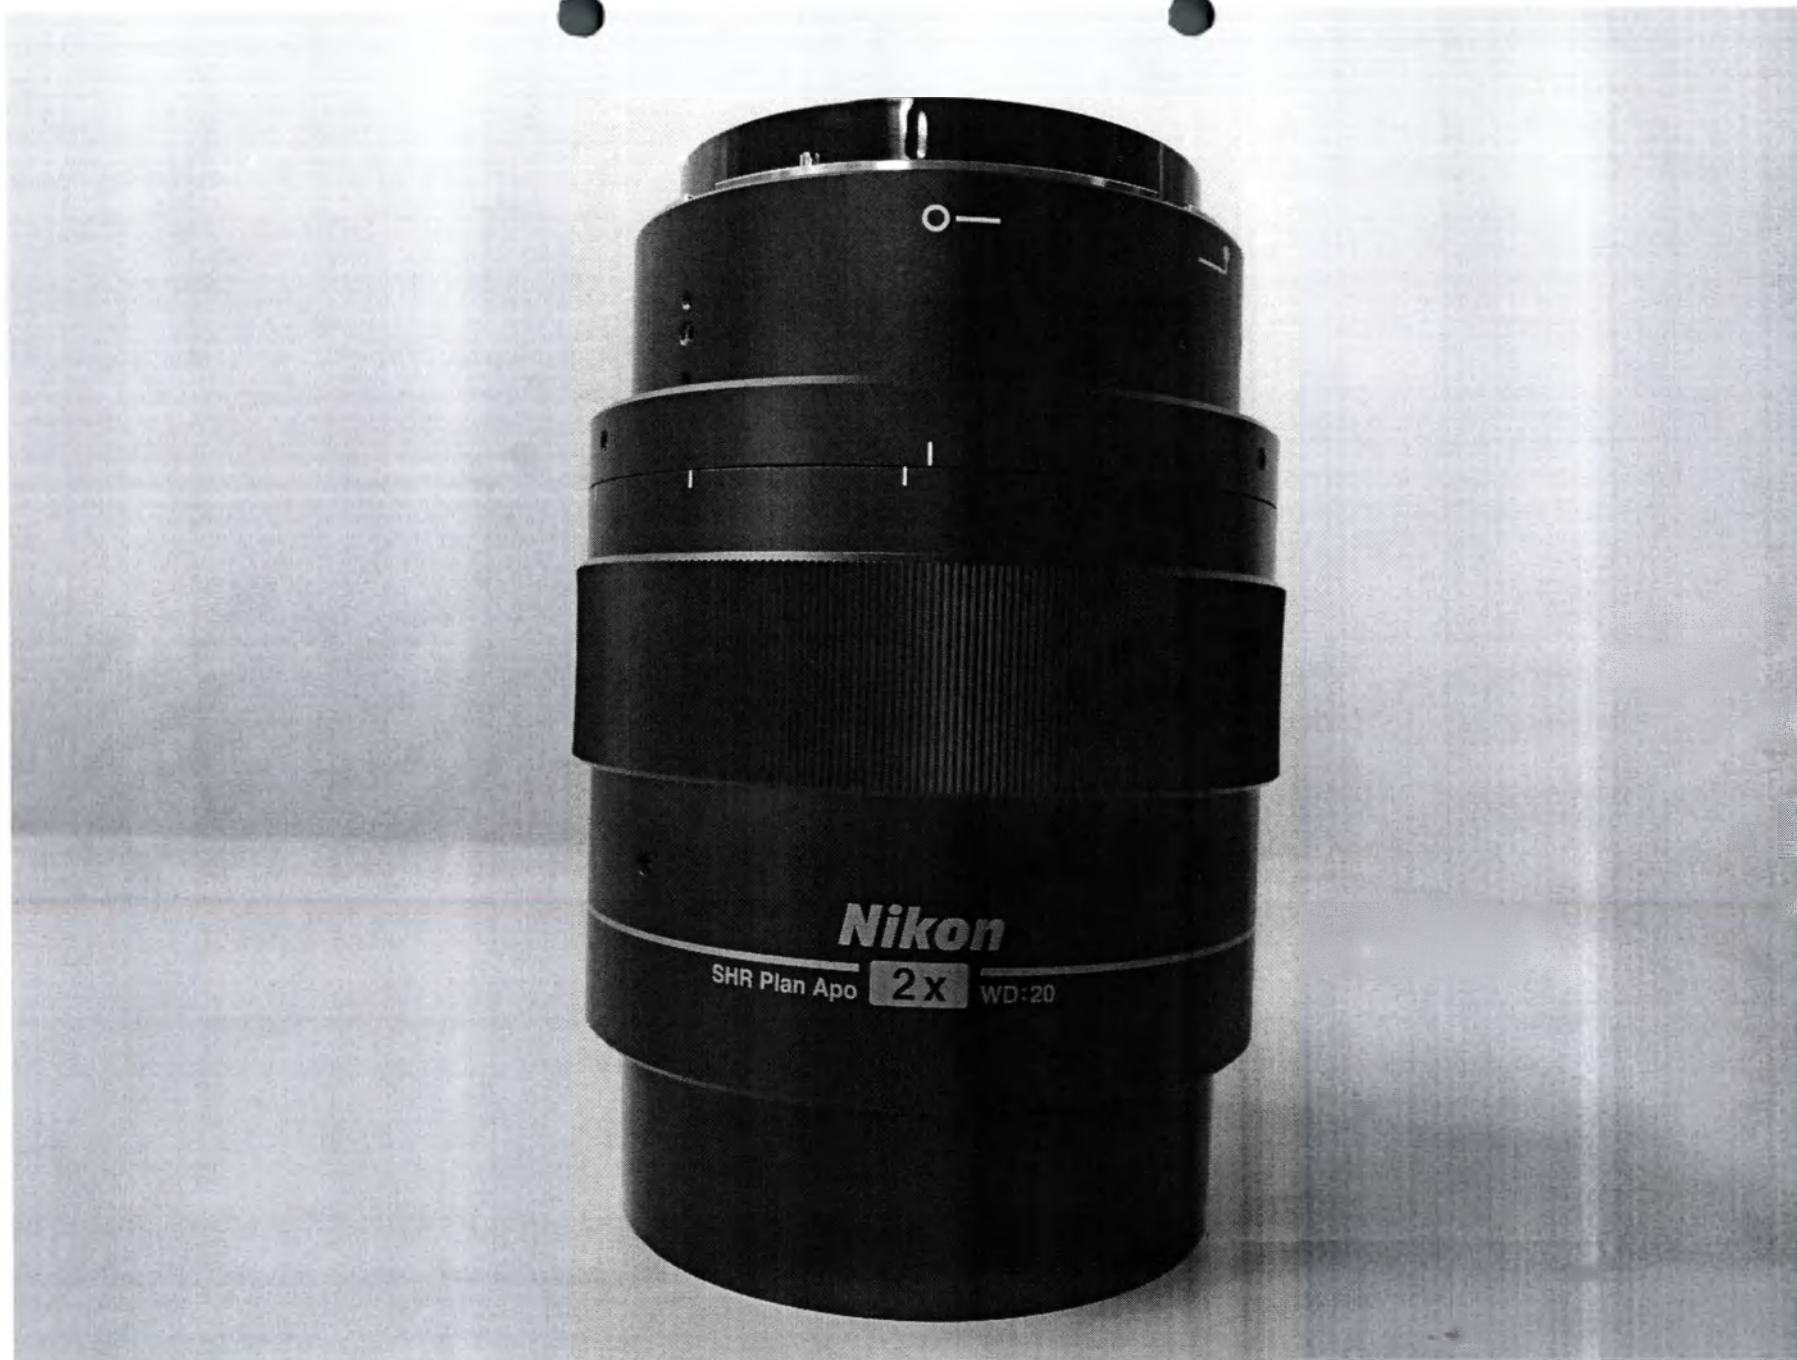


Рис.20 - Объектив P2-SHR Plan Apo 2X.

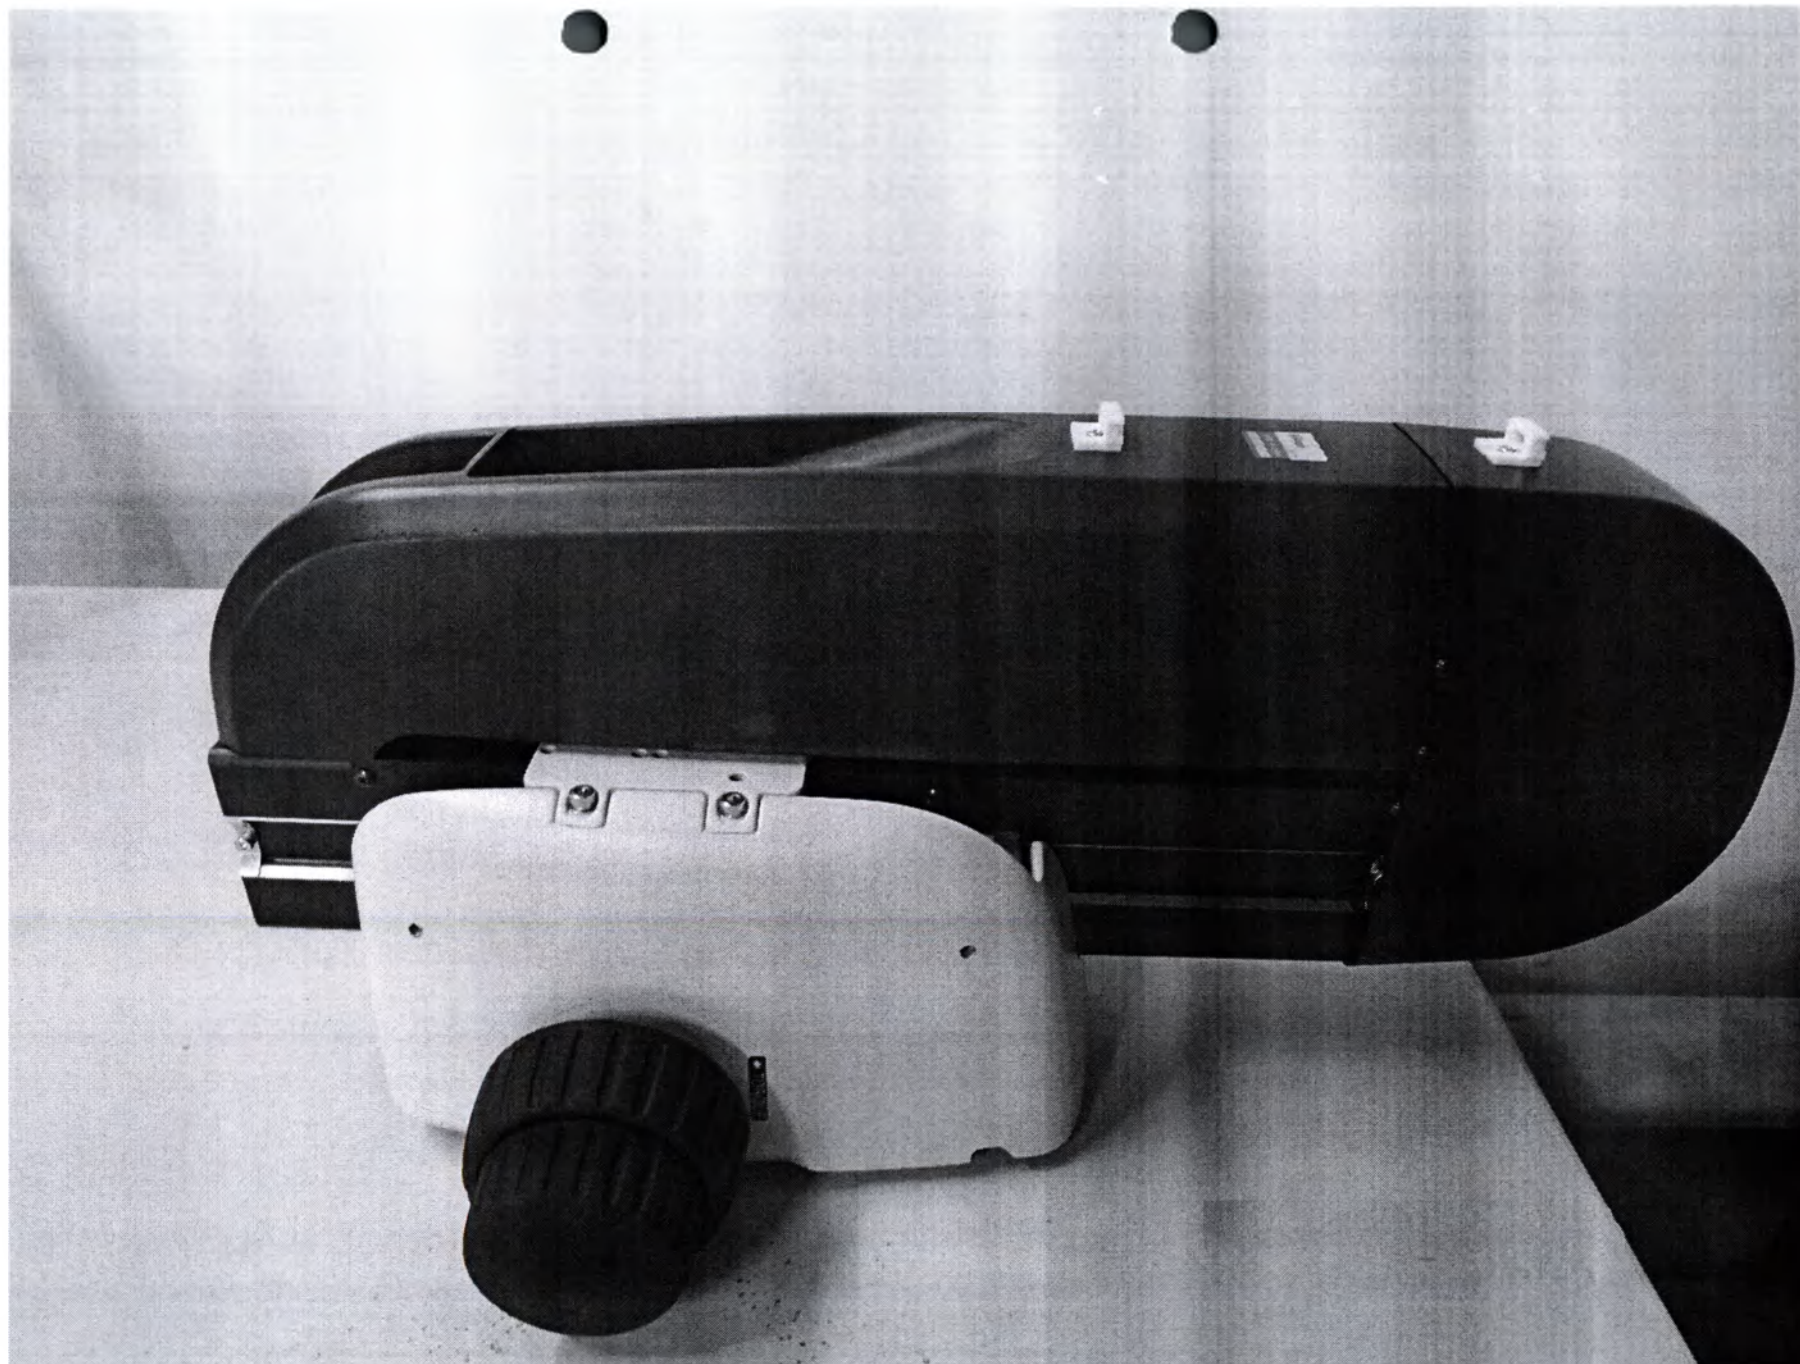


Рис.21 -Блок фокусировки P2-FU.

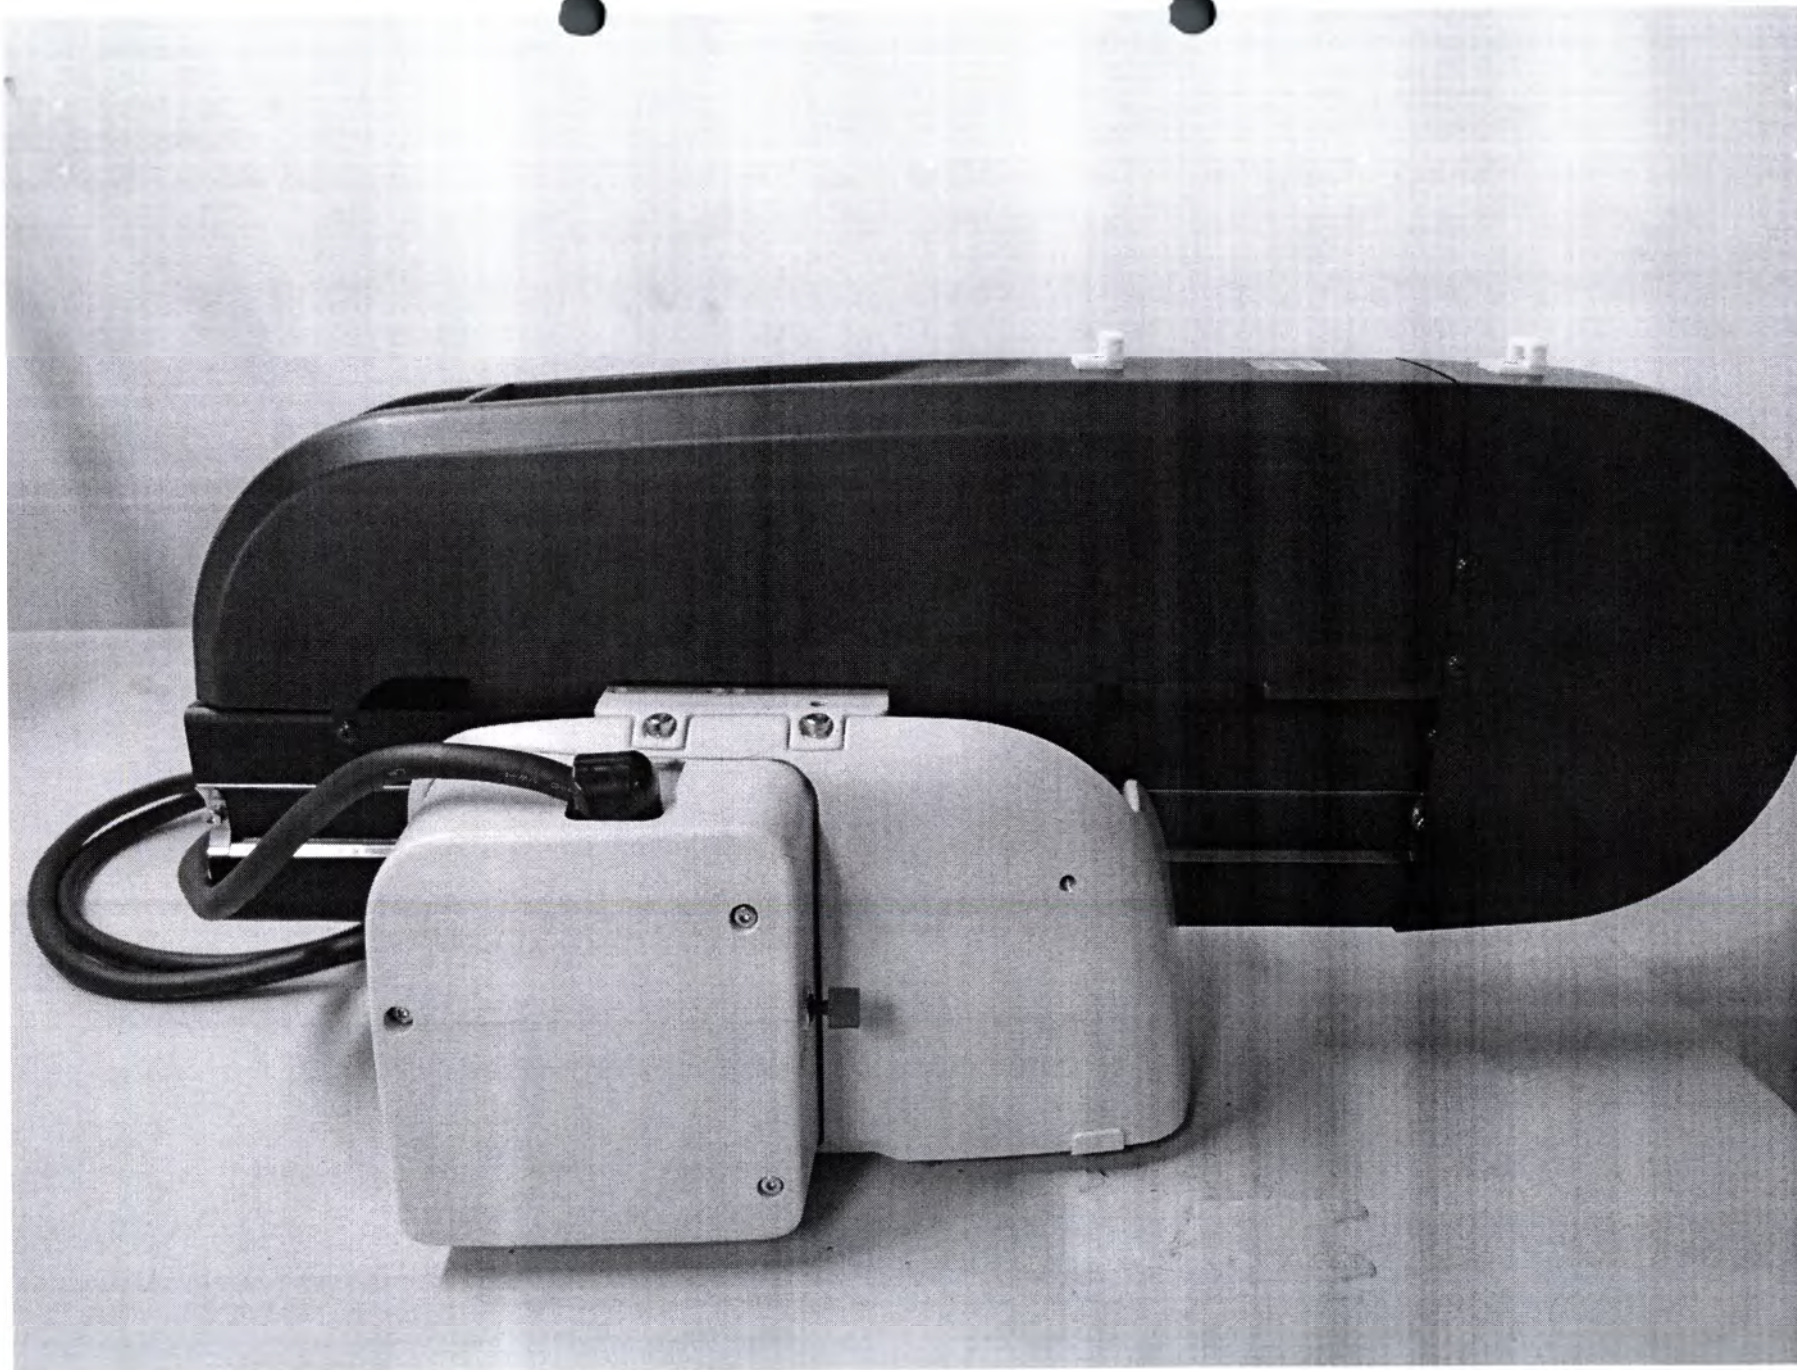


Рис.22 - Блок фокусировочный моторизованный P2-MFU.

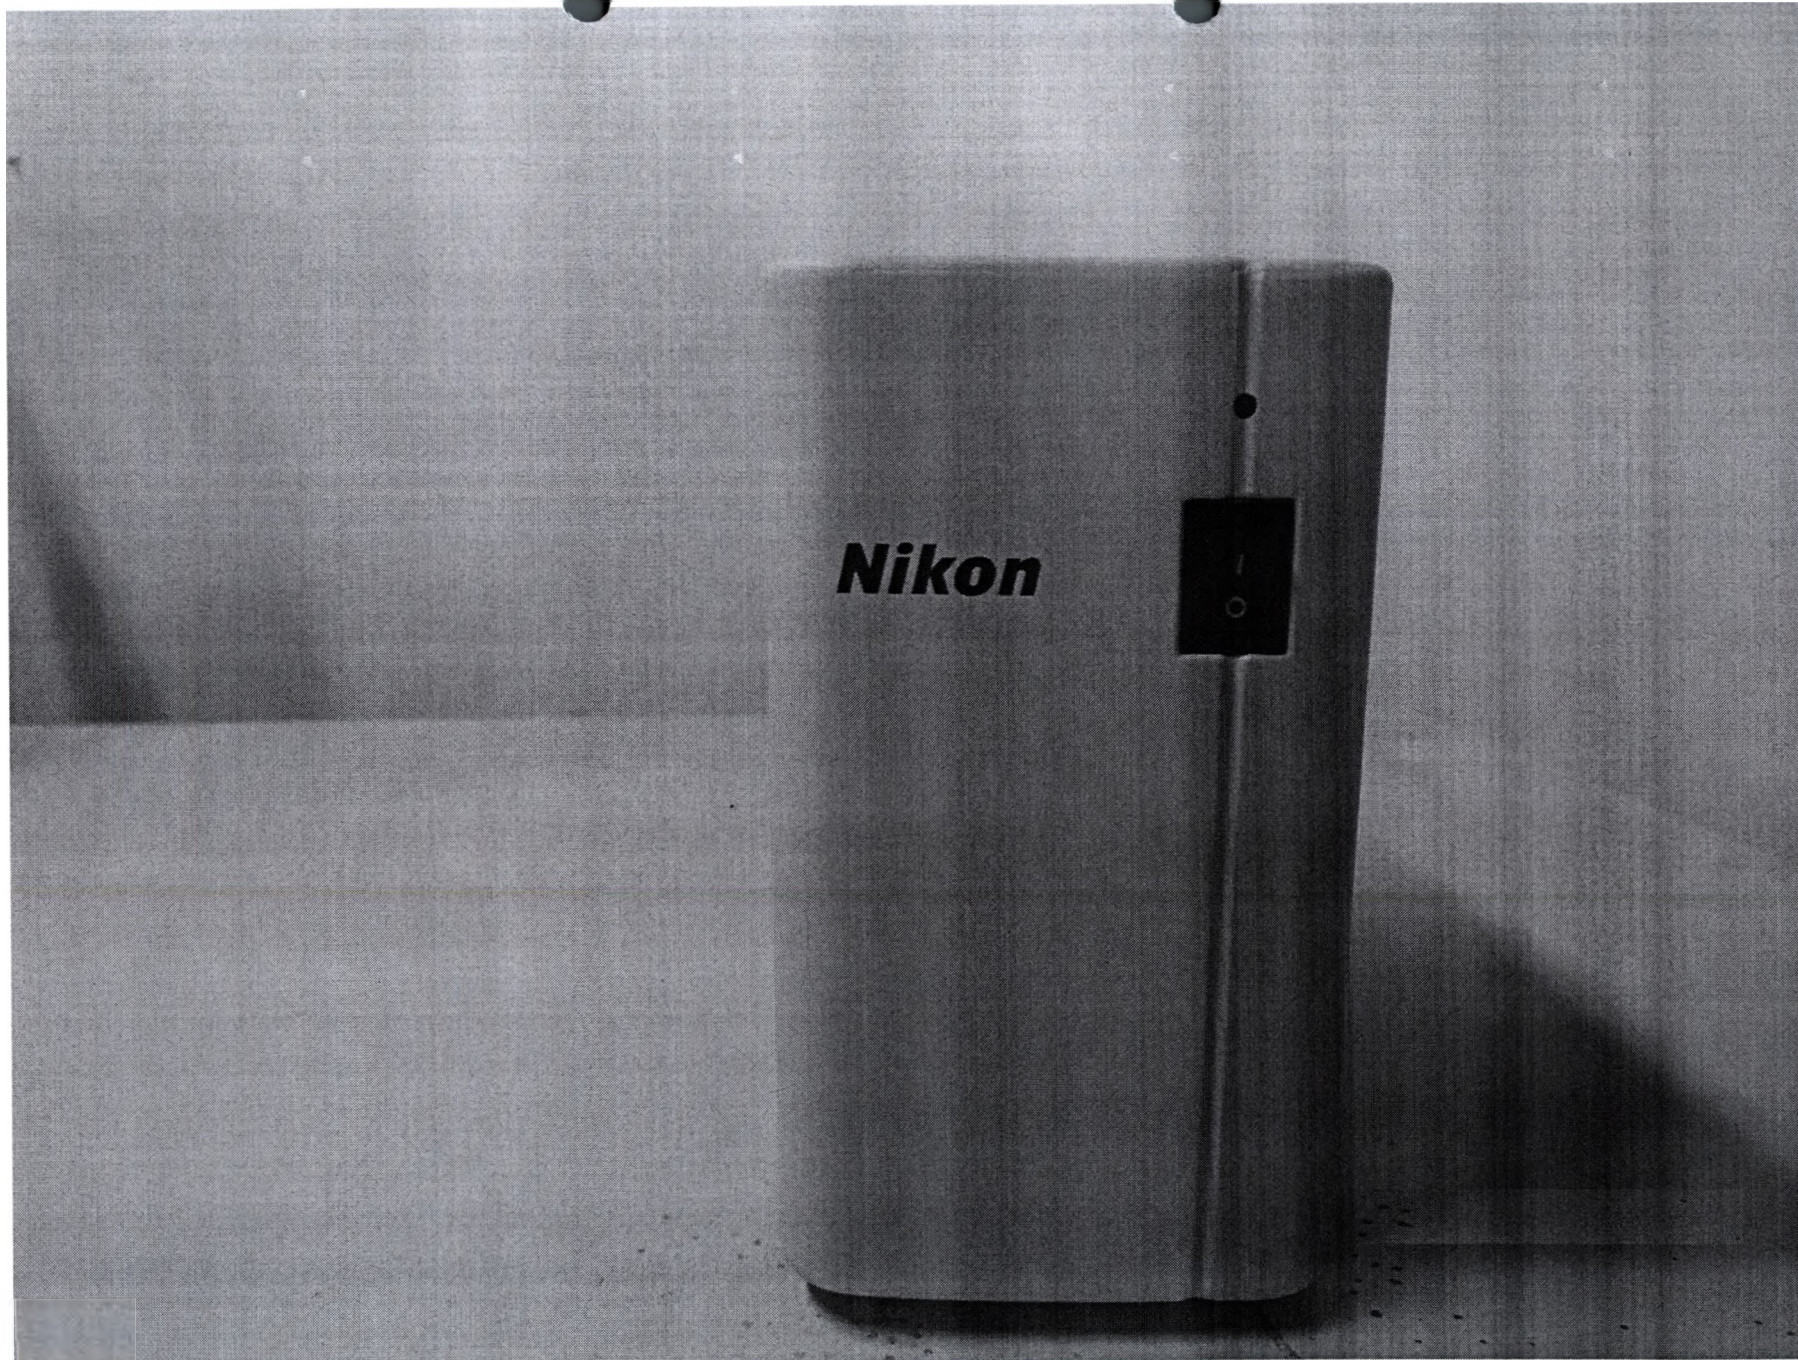


Рис.23 - Блок управления P2-CTLB.

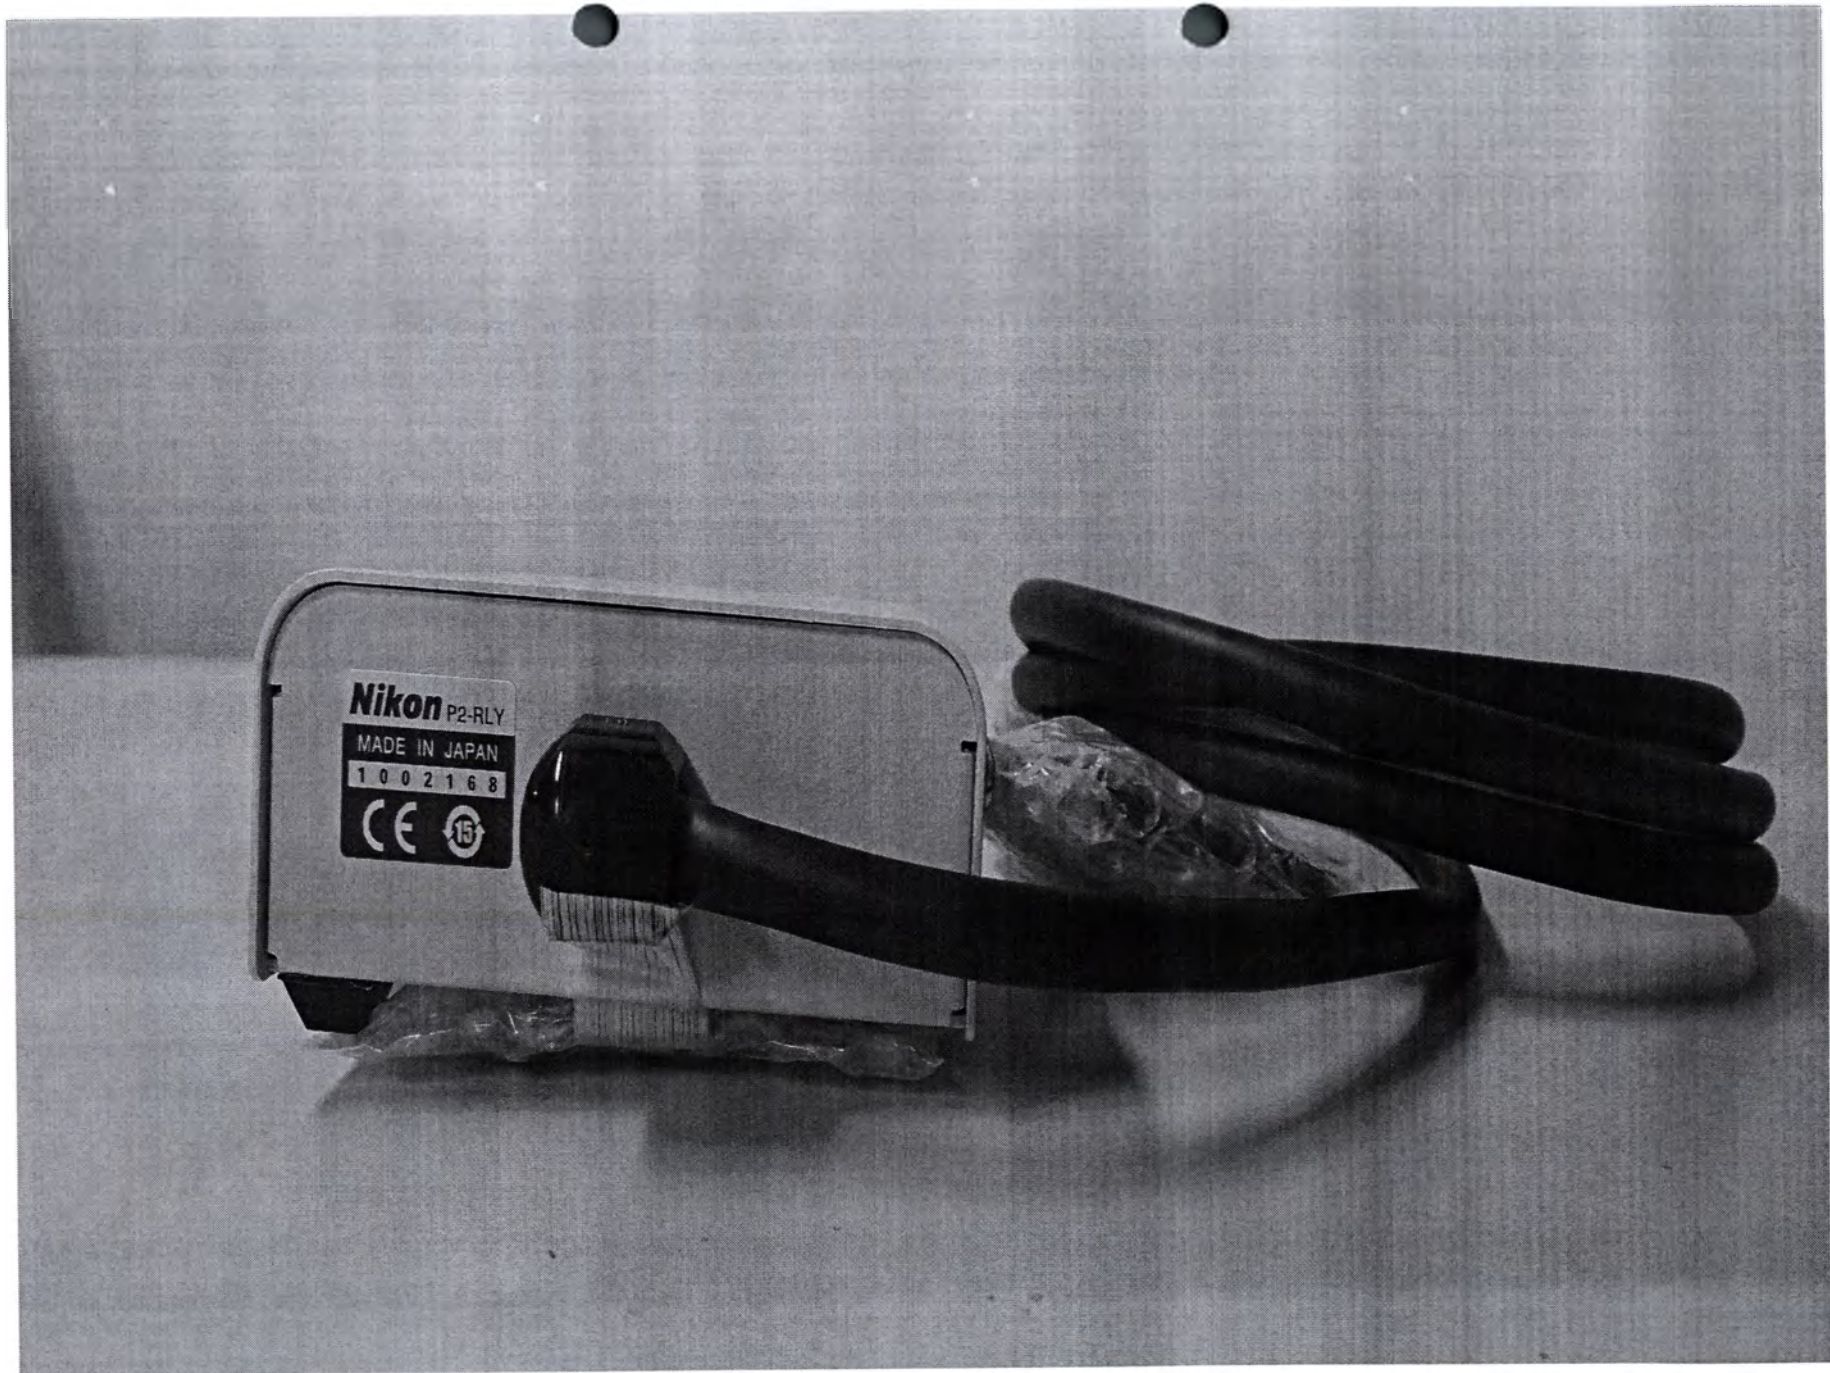


Рис.24 -Блок релейный P2-RLY

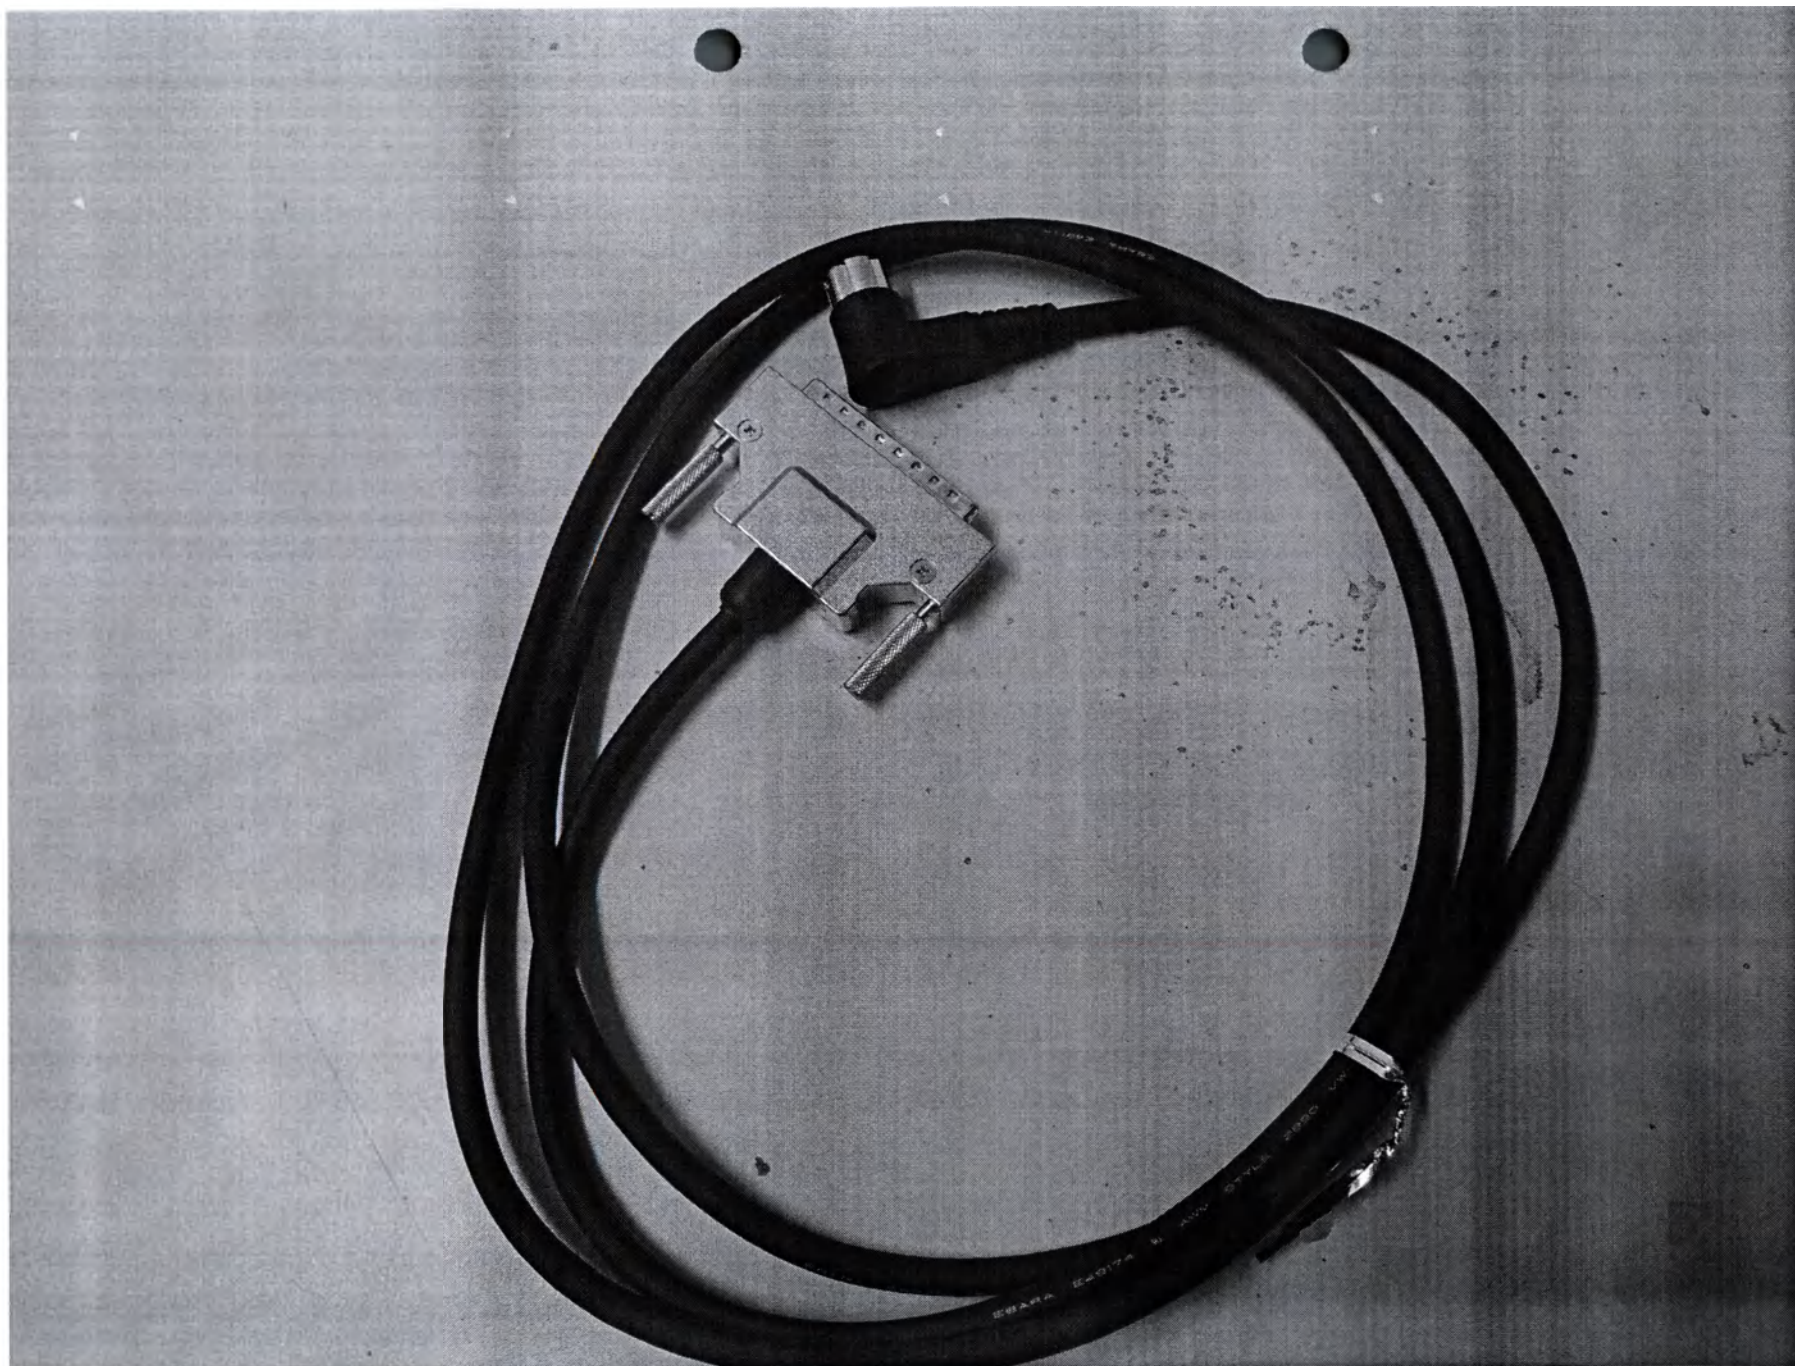


Рис.25 - Кабель релейный P2-RLYC

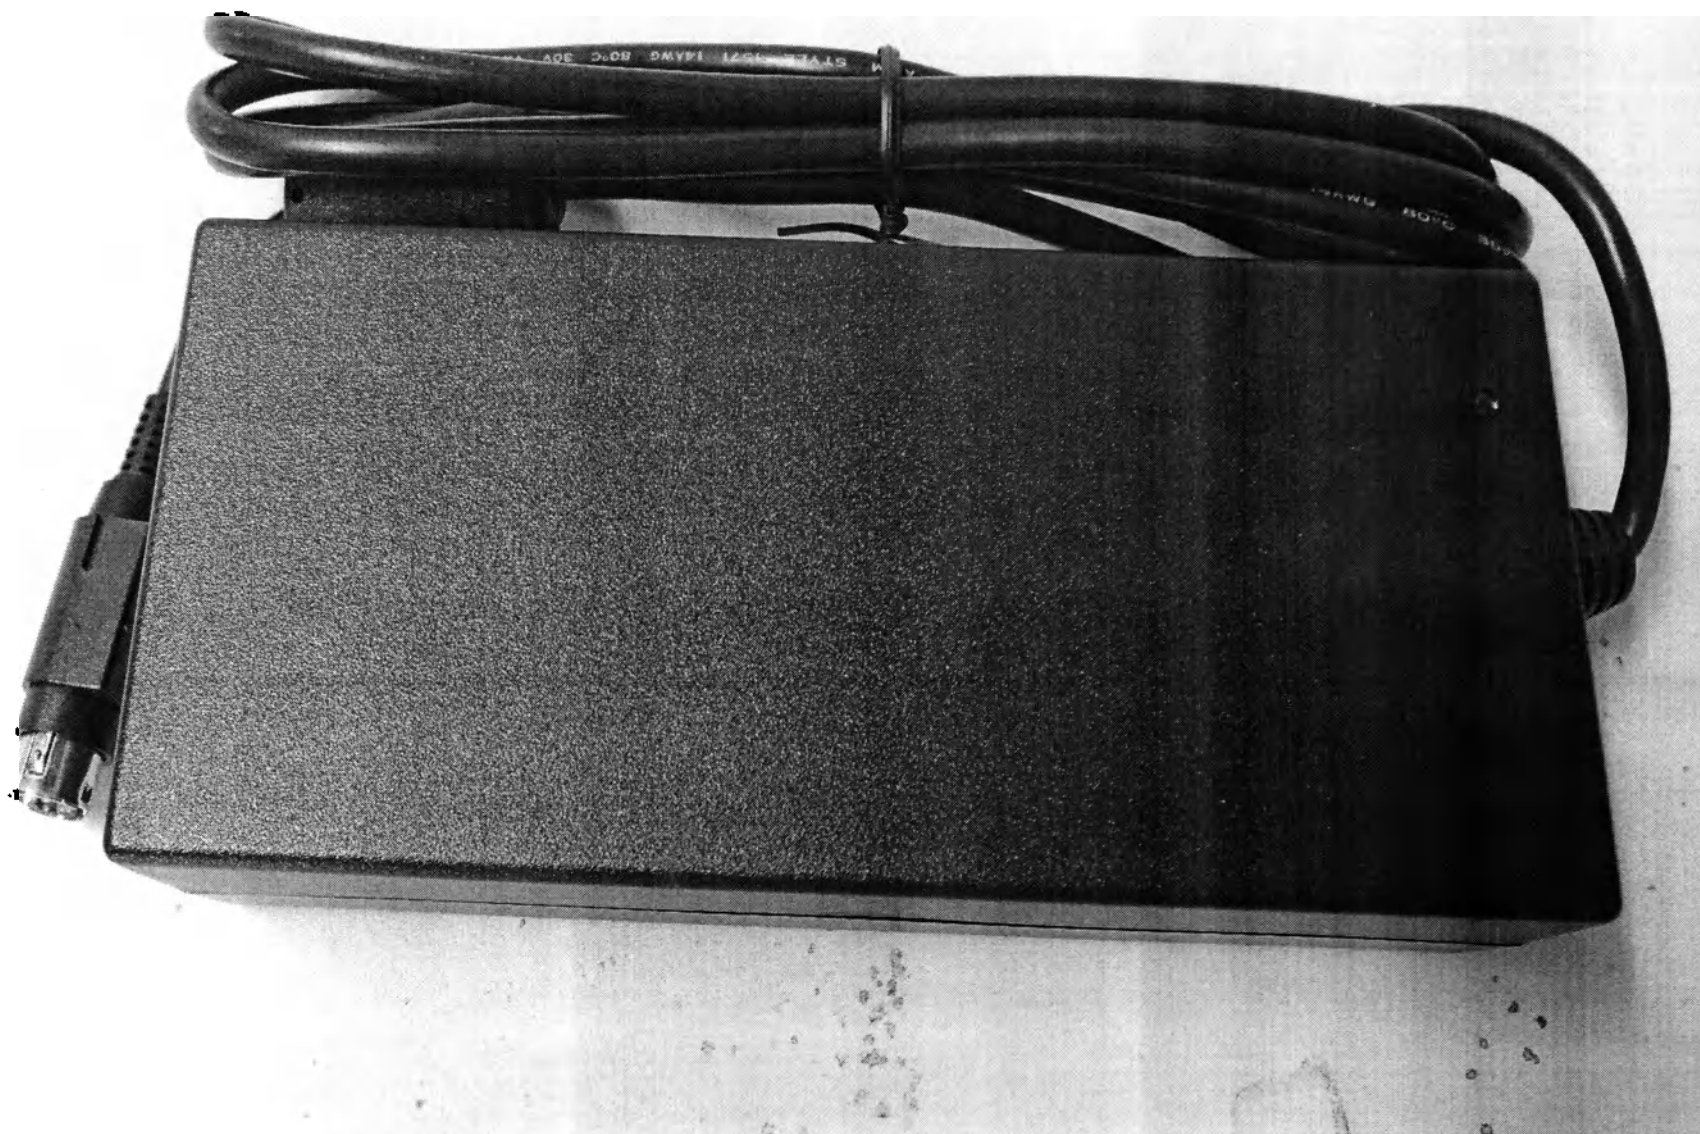


Рис.26 - Адаптер SU-AC AC

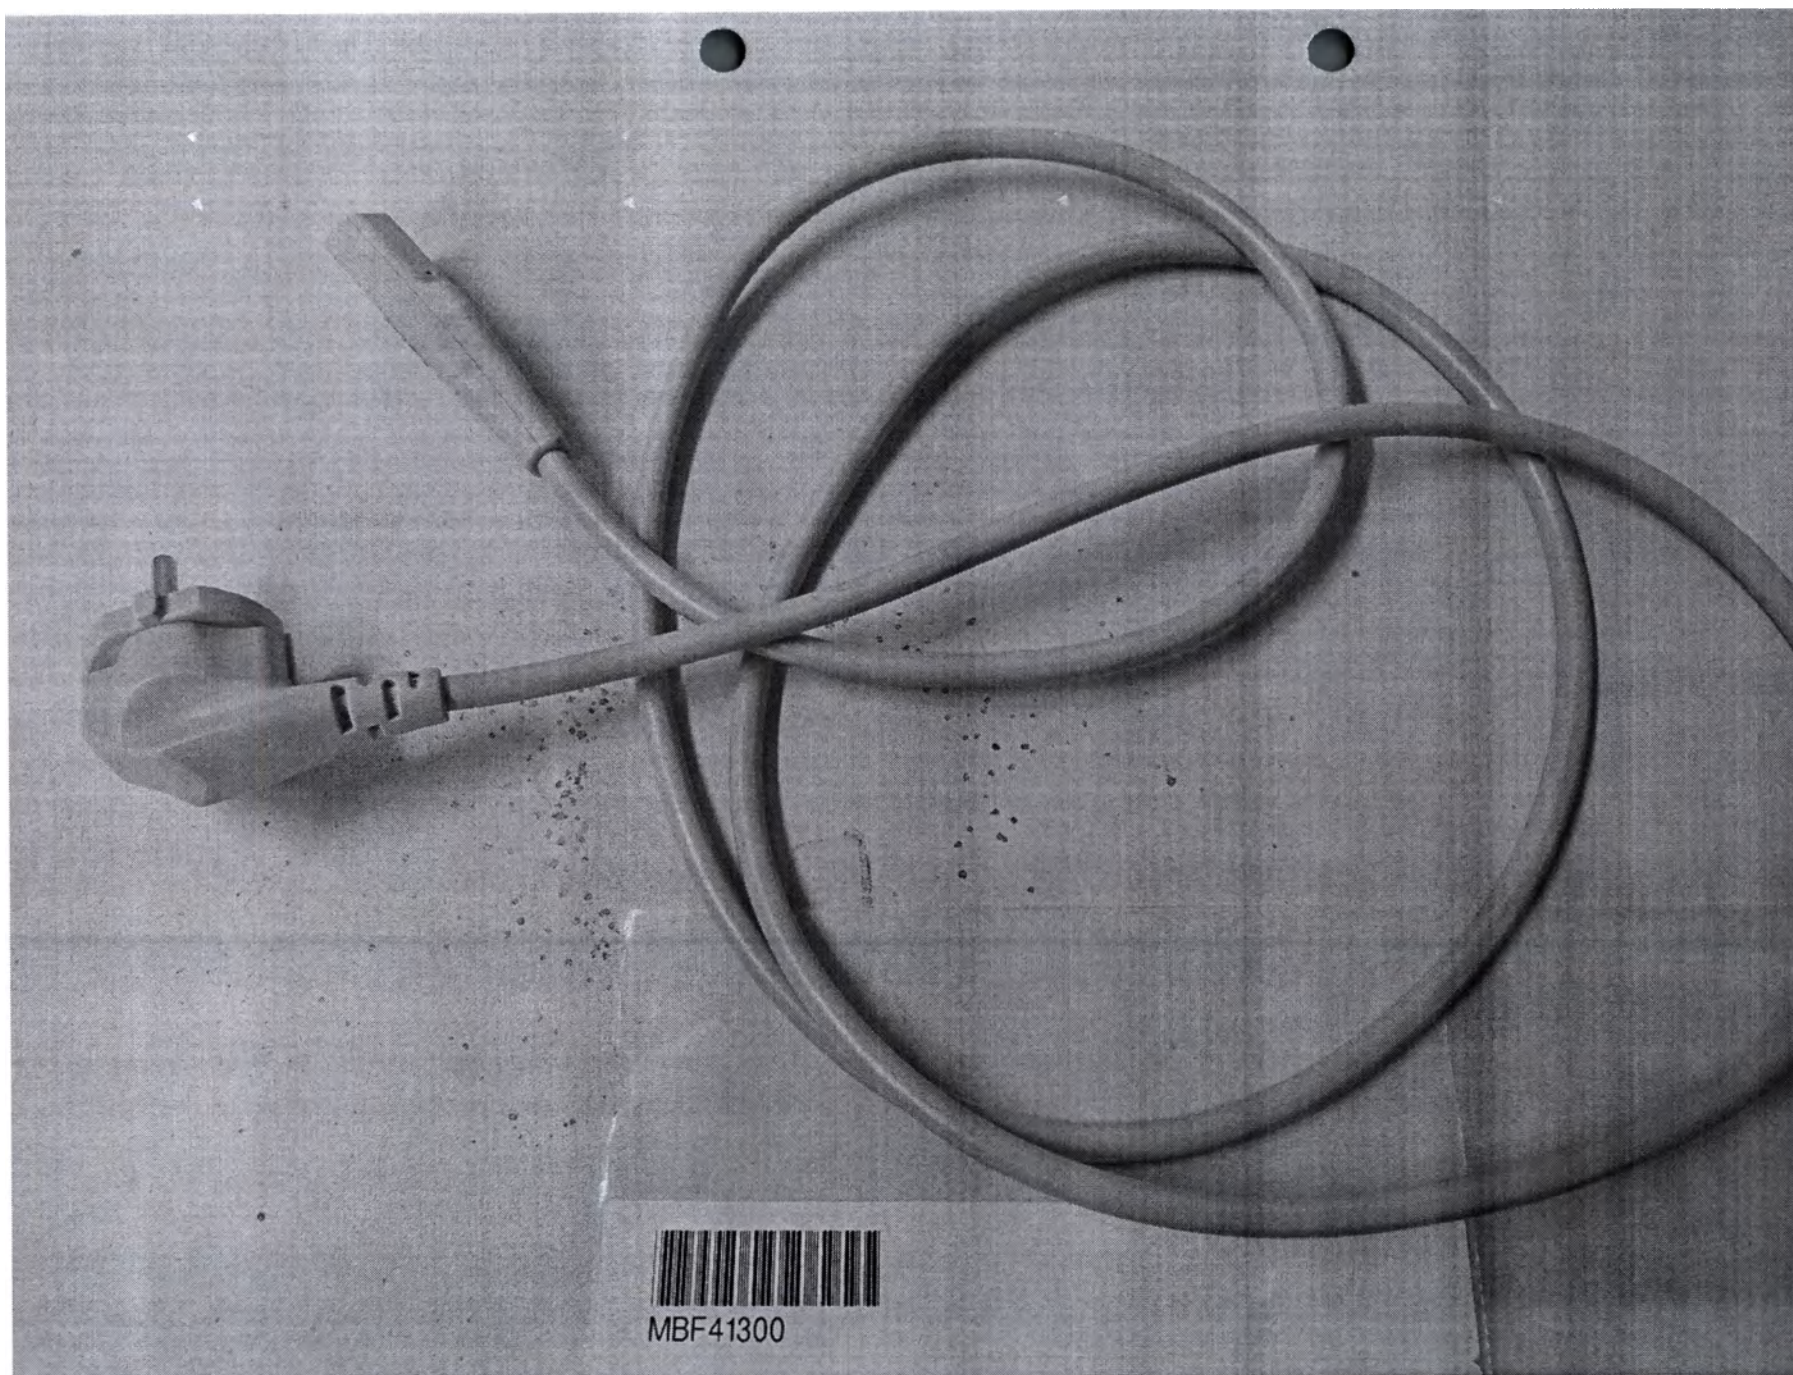


Рис.27 - Кабель сетевой



Рис.28 -Окуляр-микрометр С-FC

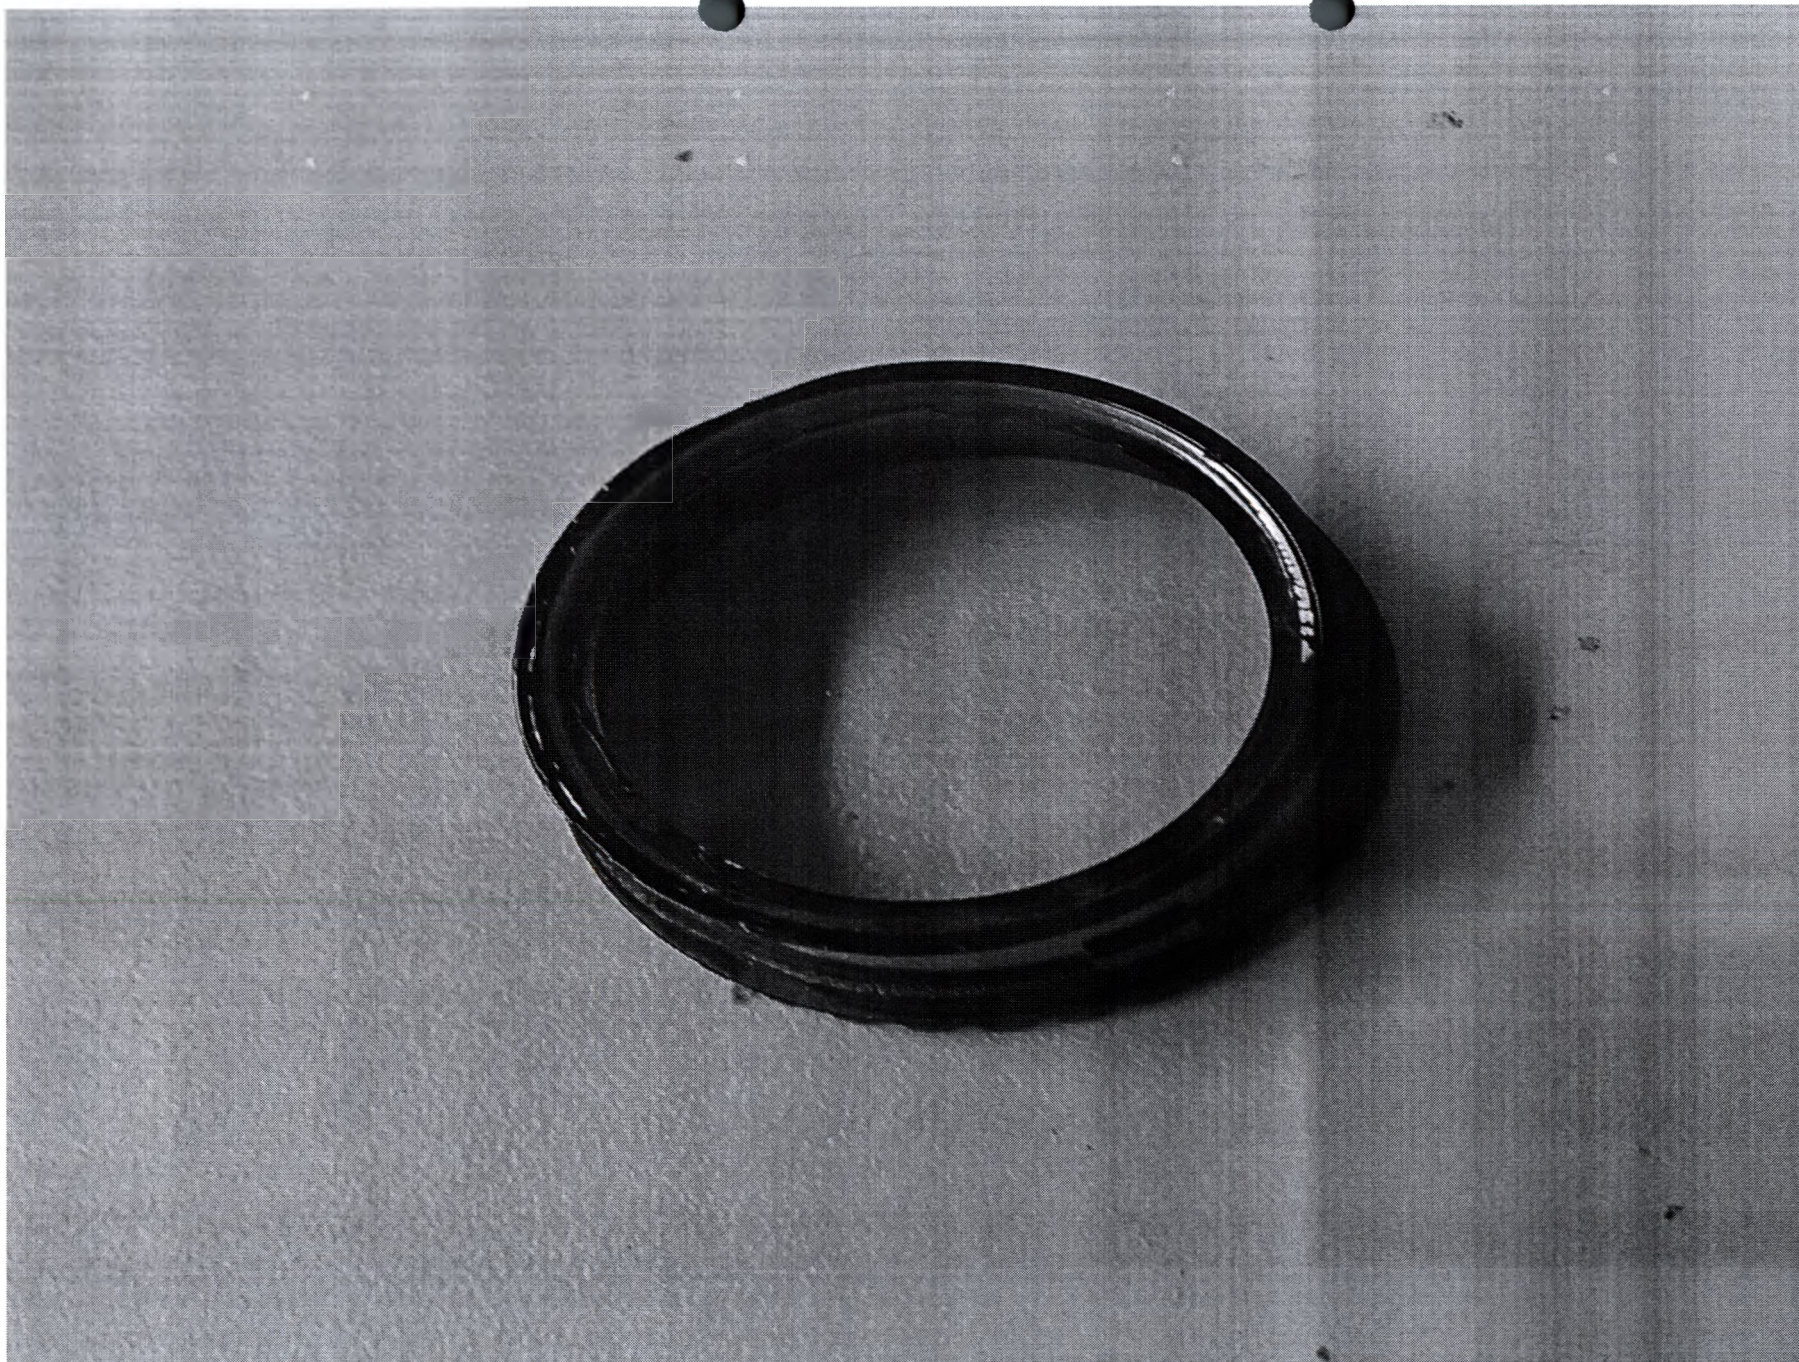


Рис.29 - Окуляр-микрометр С-ФМ.

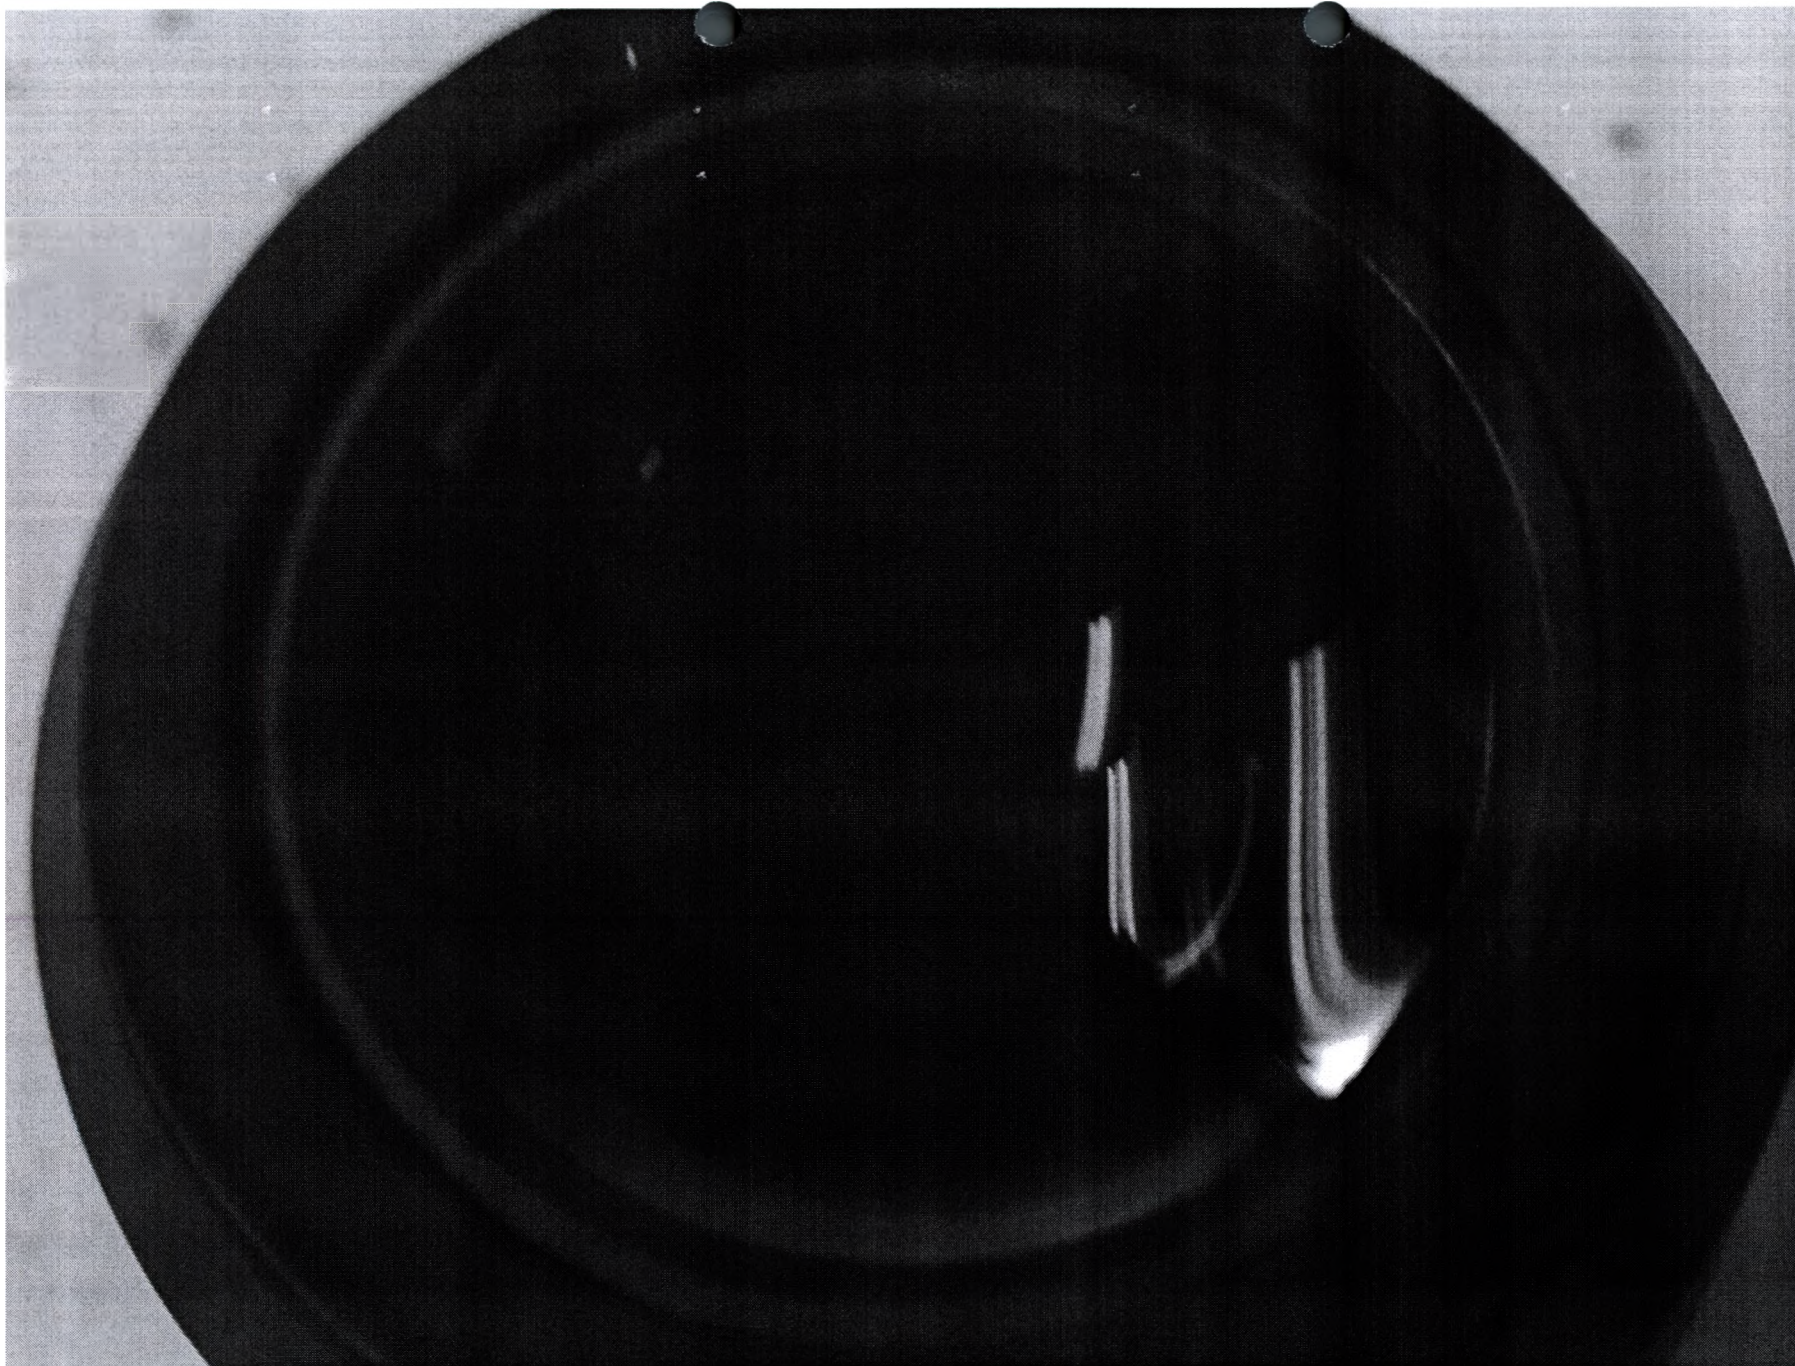


Рис.30 - Сетка окулярная фотошаблона С-ФР

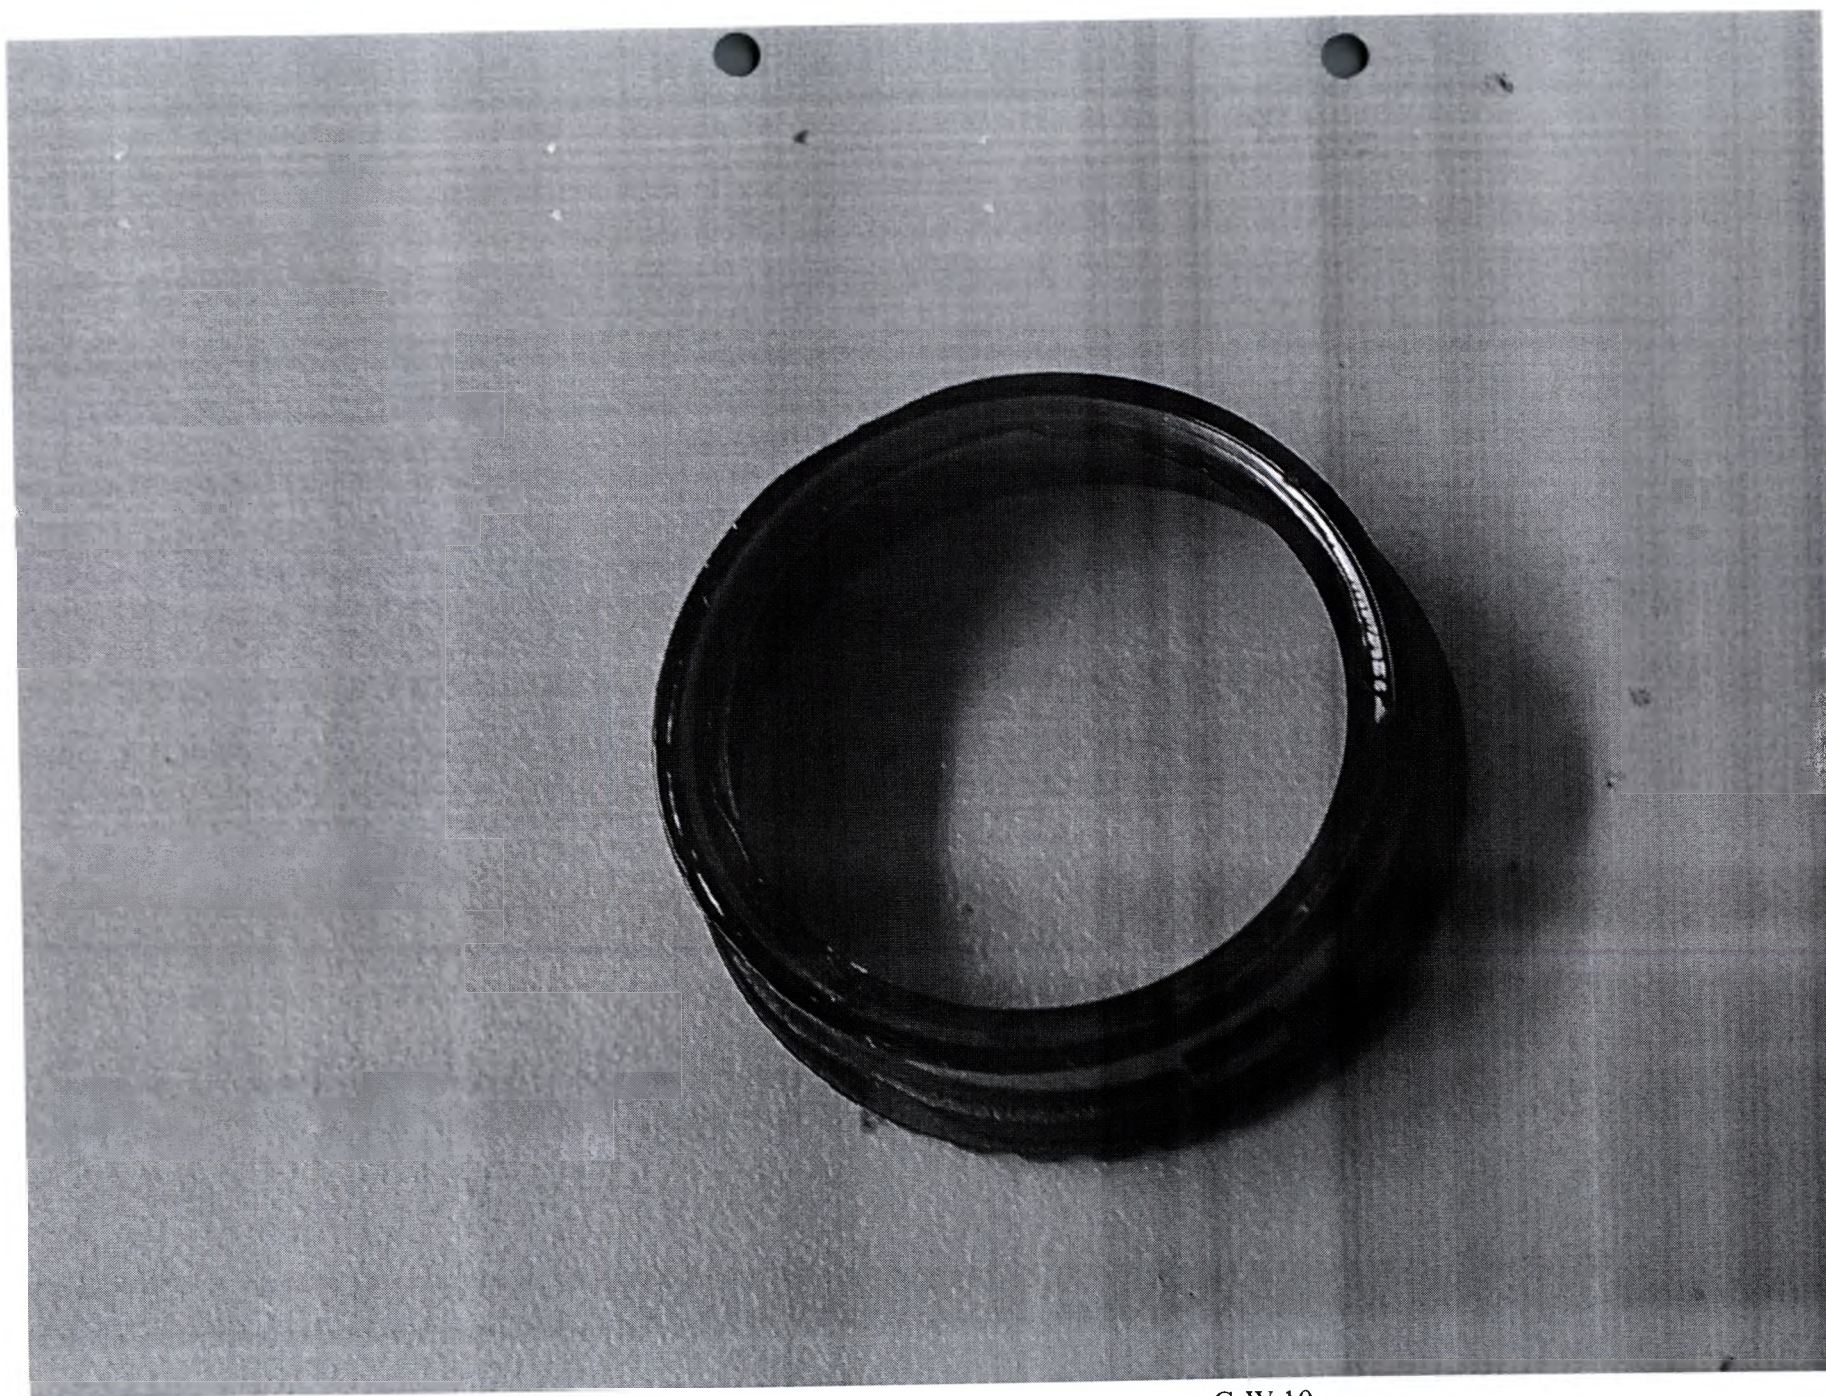


Рис.31- Насадка для окуляра С-В 10х

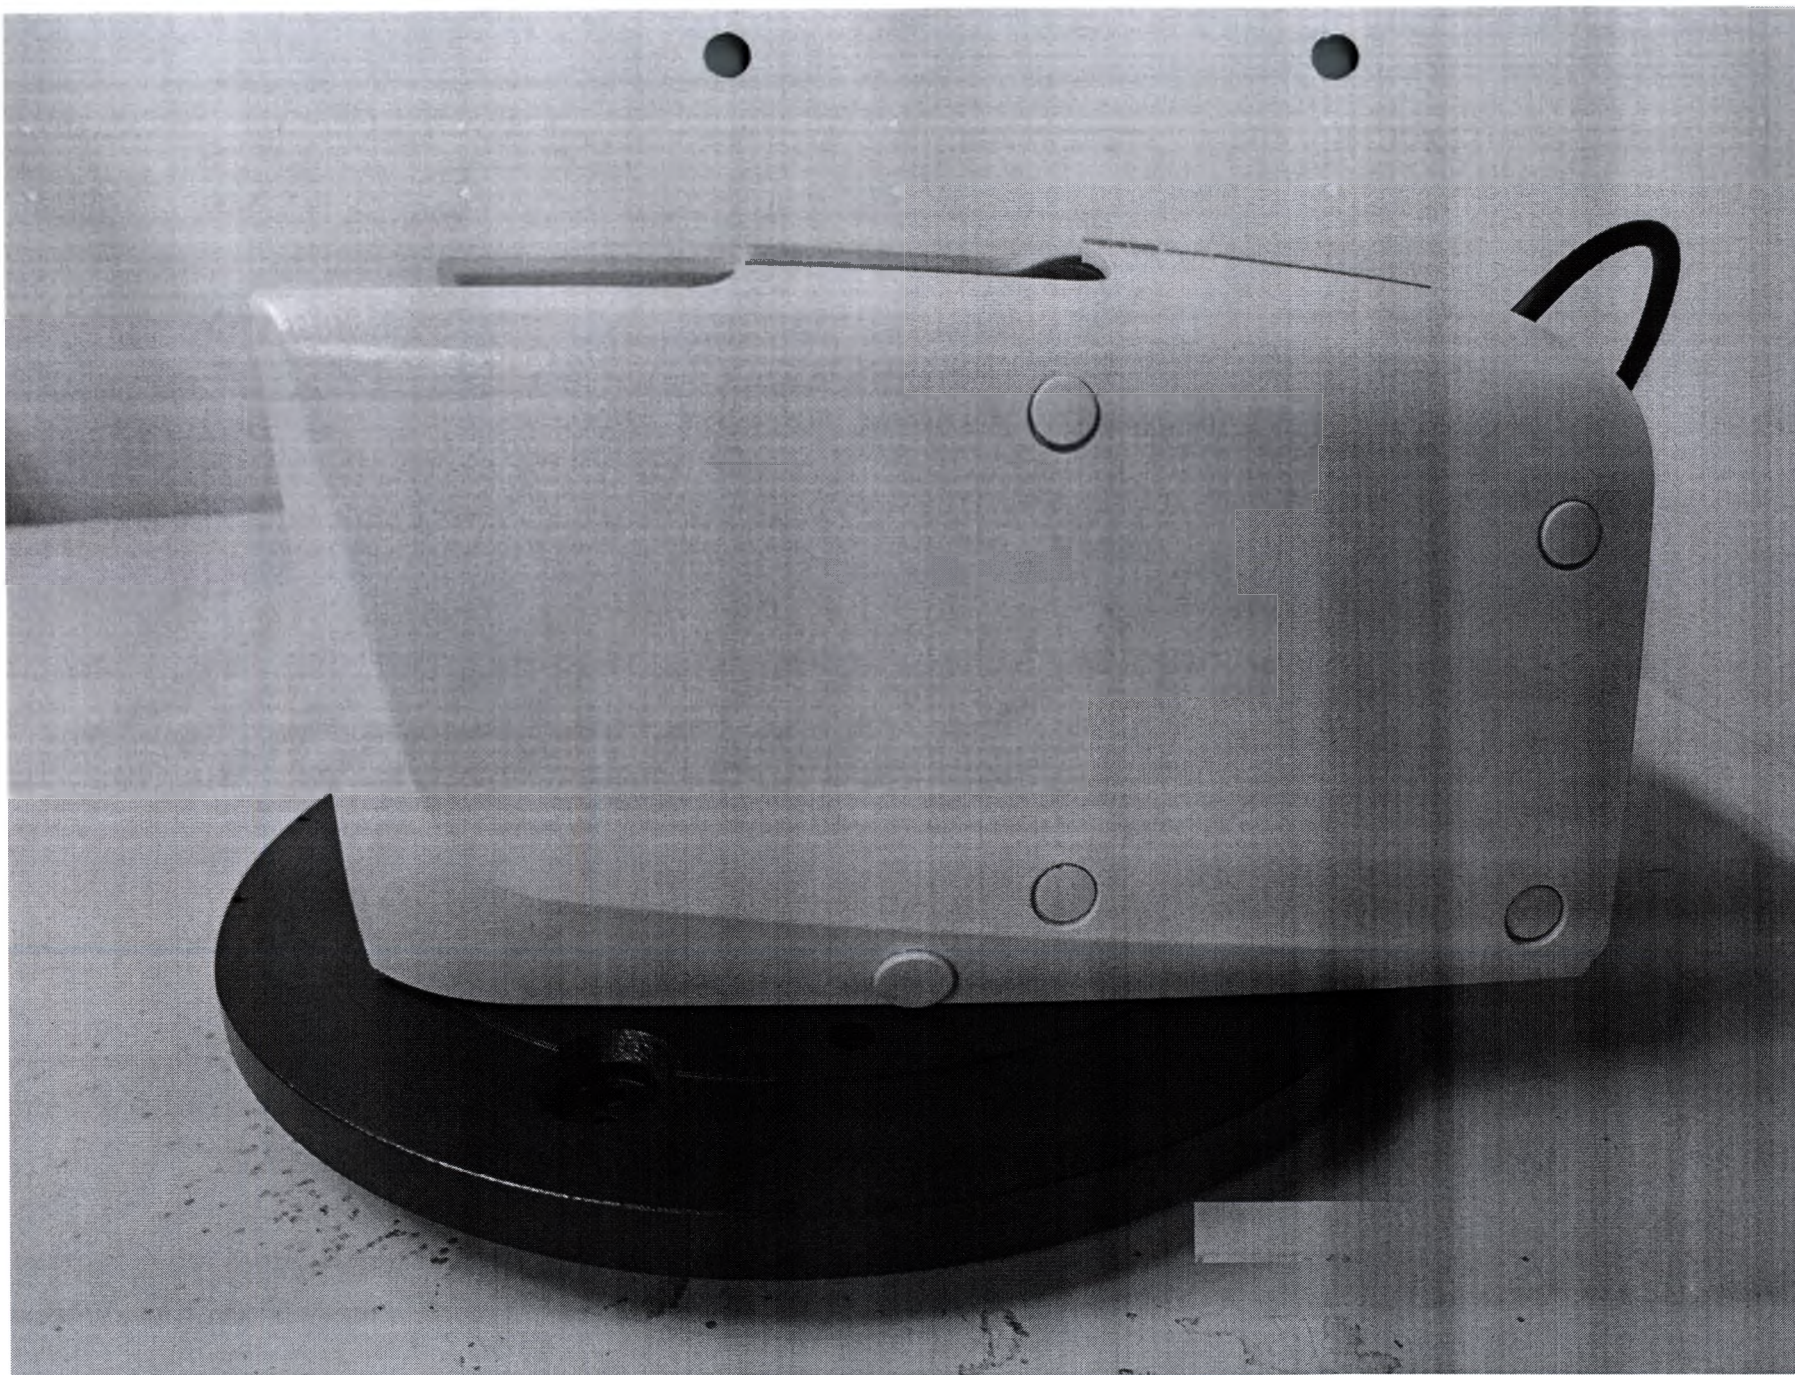


Рис.32 - Револьвер кодированный P2-RNI2 Intelligent Nosepiece

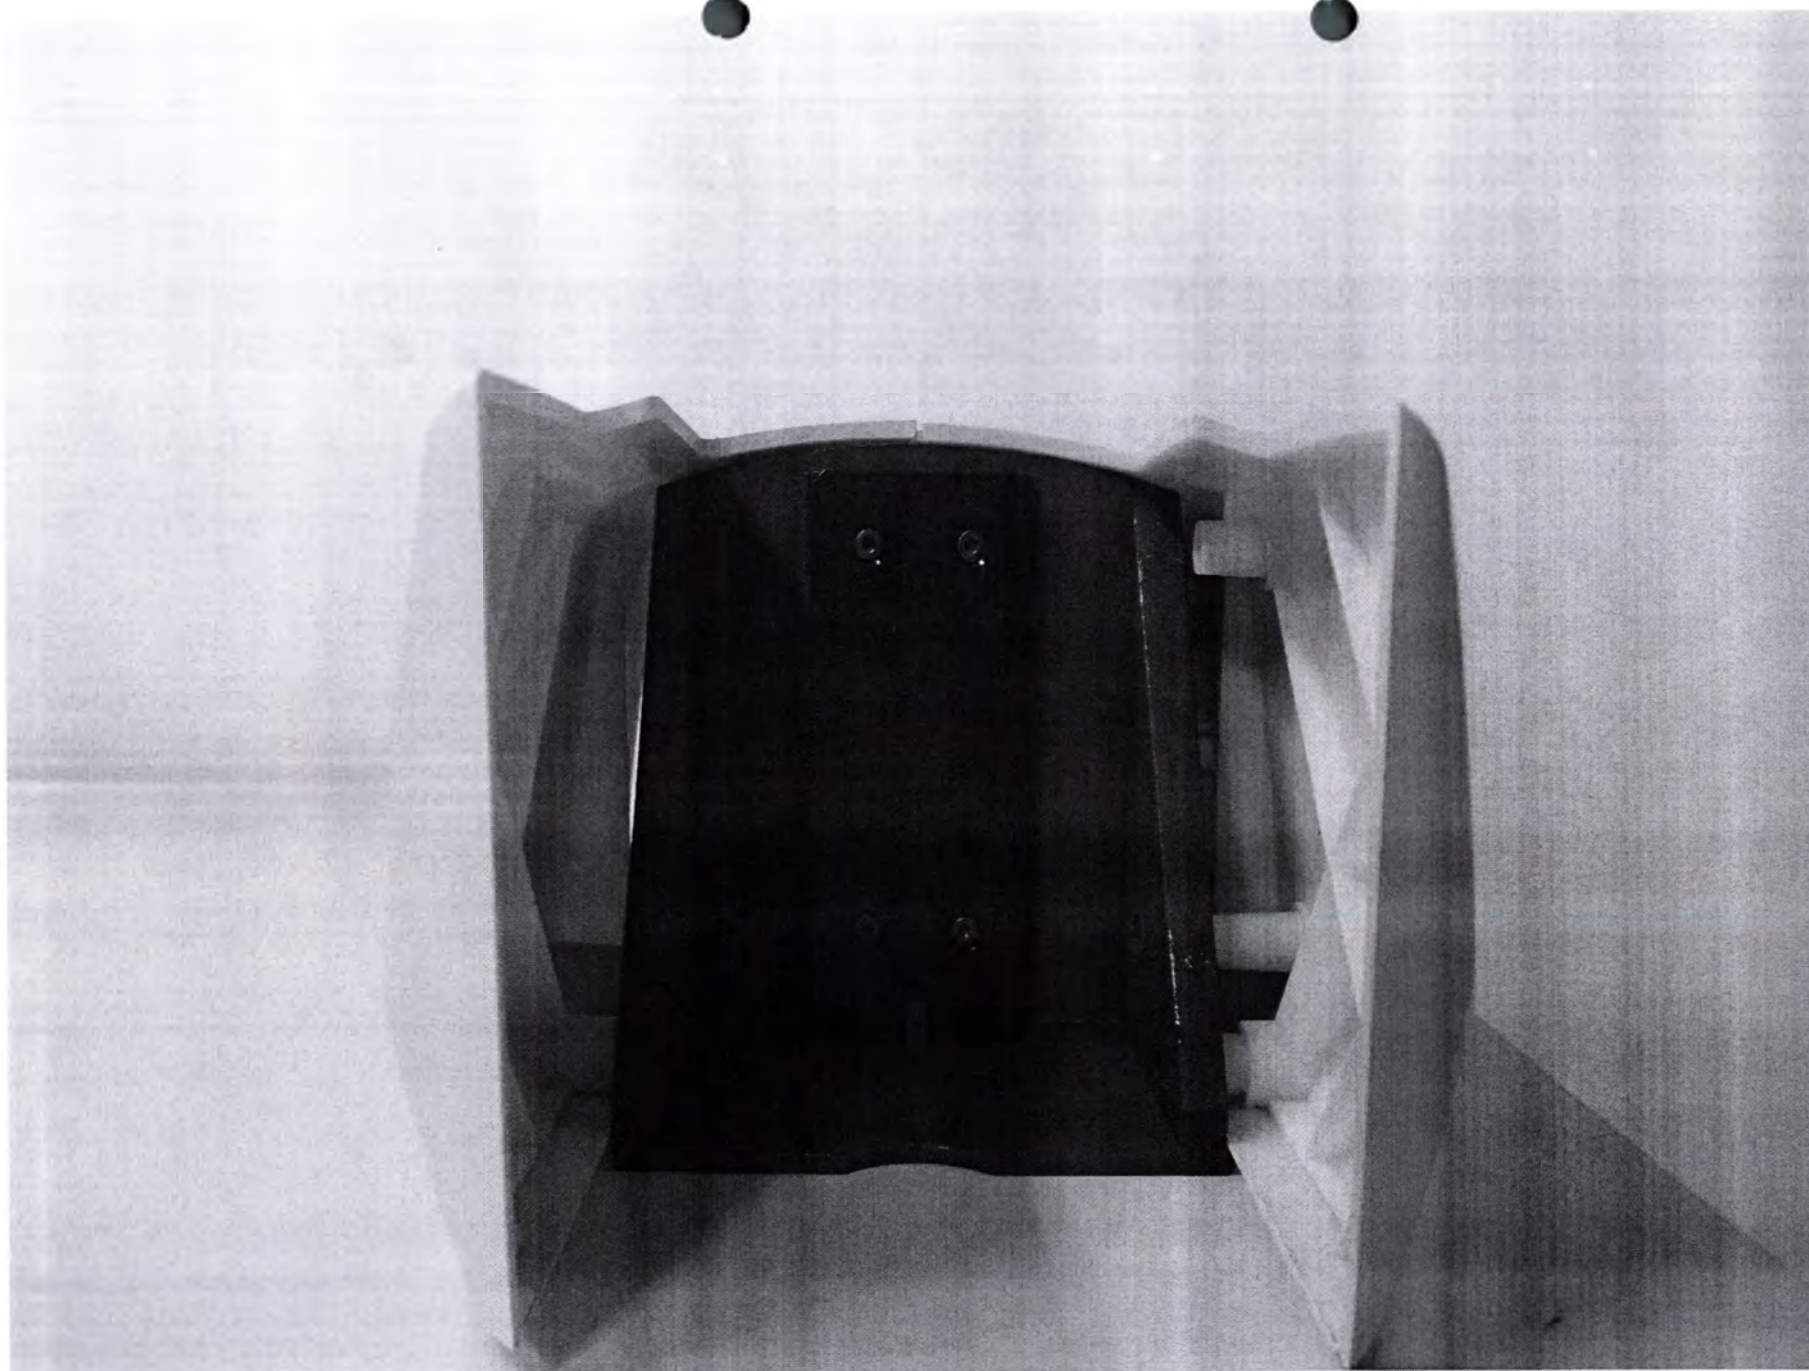


Рис.33 - Адаптер фокусировочный P2-FM

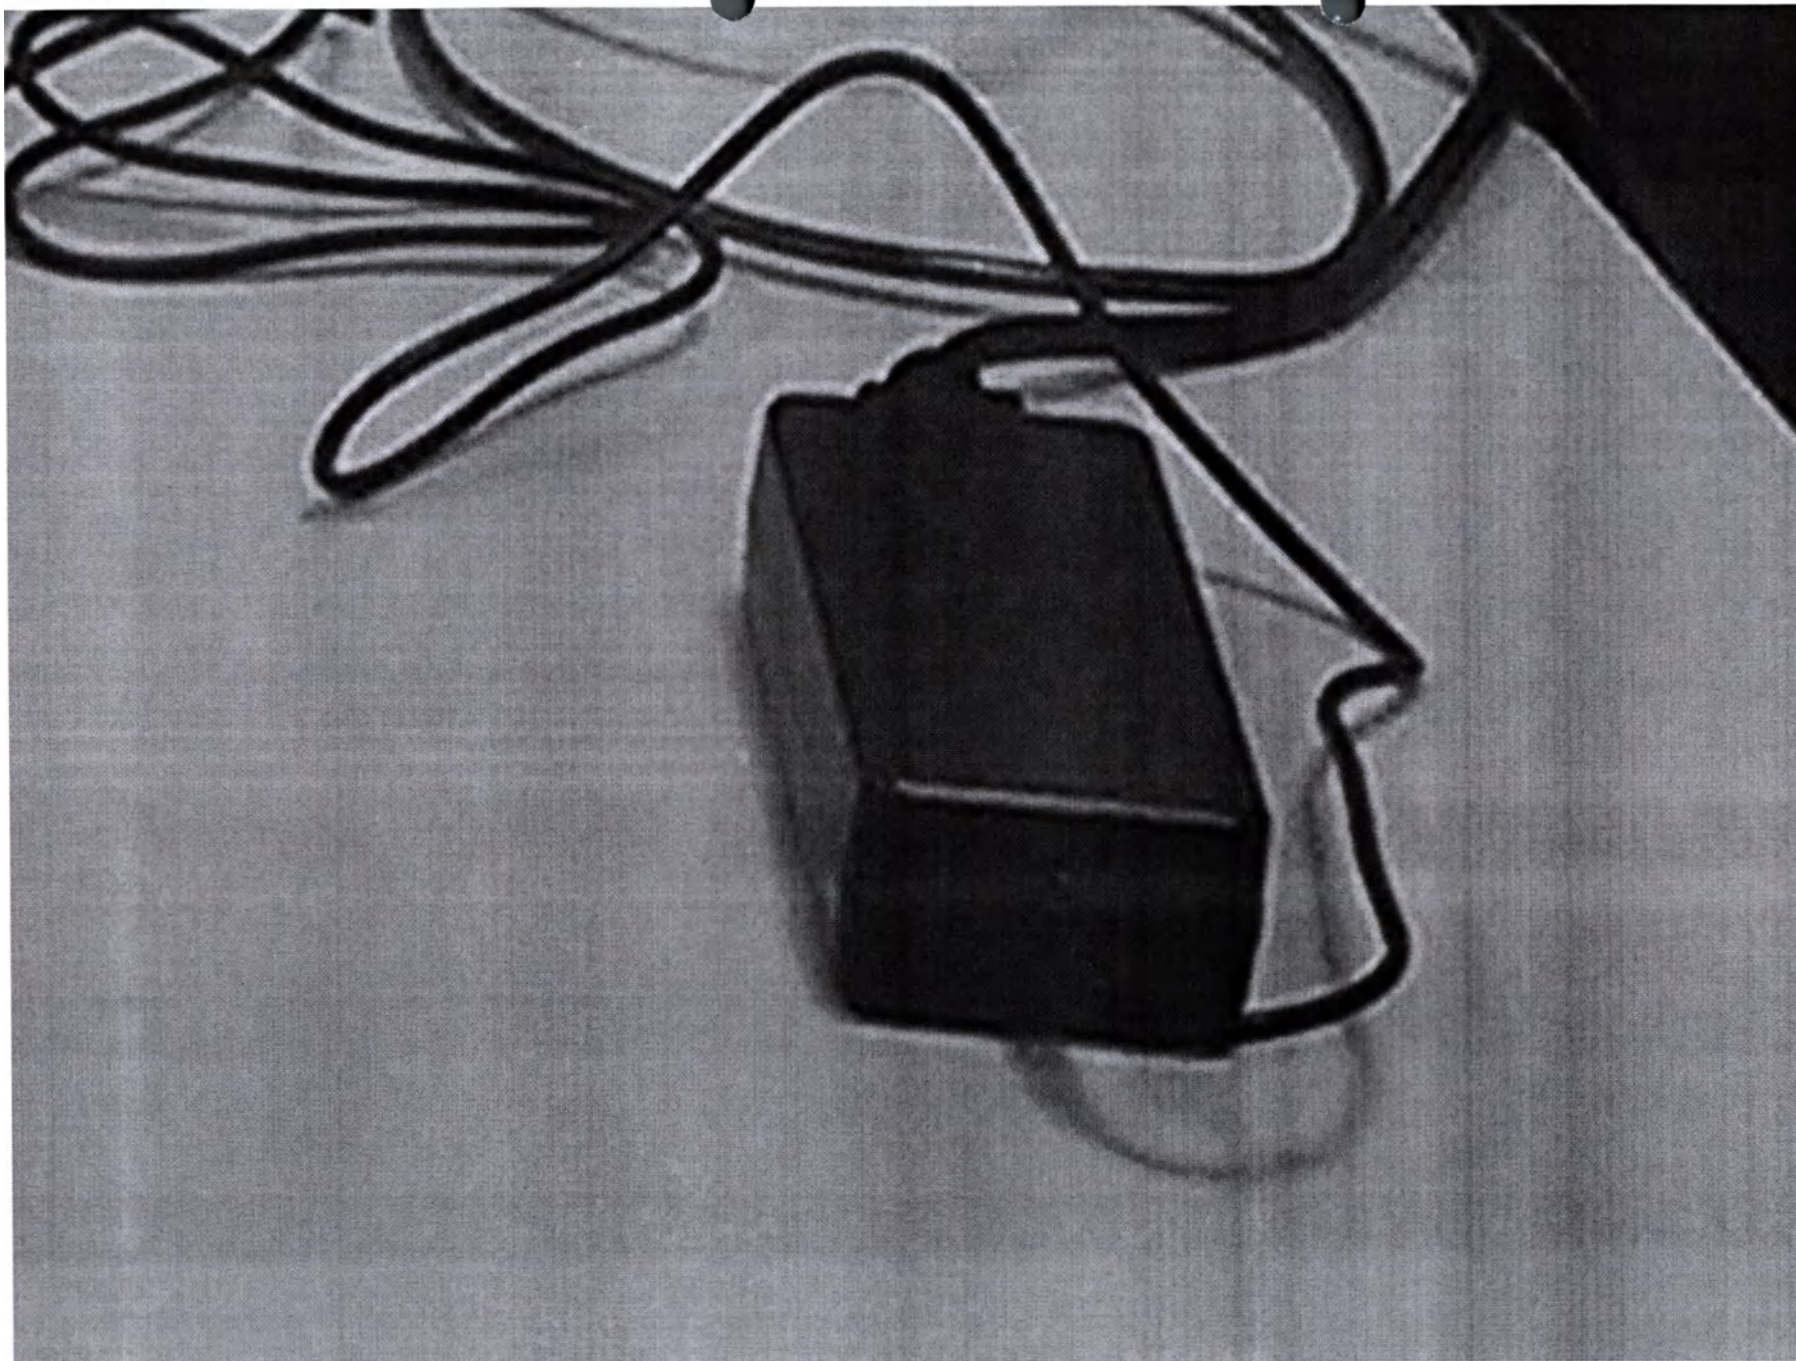


Рис.34 - АС Адаптер 2

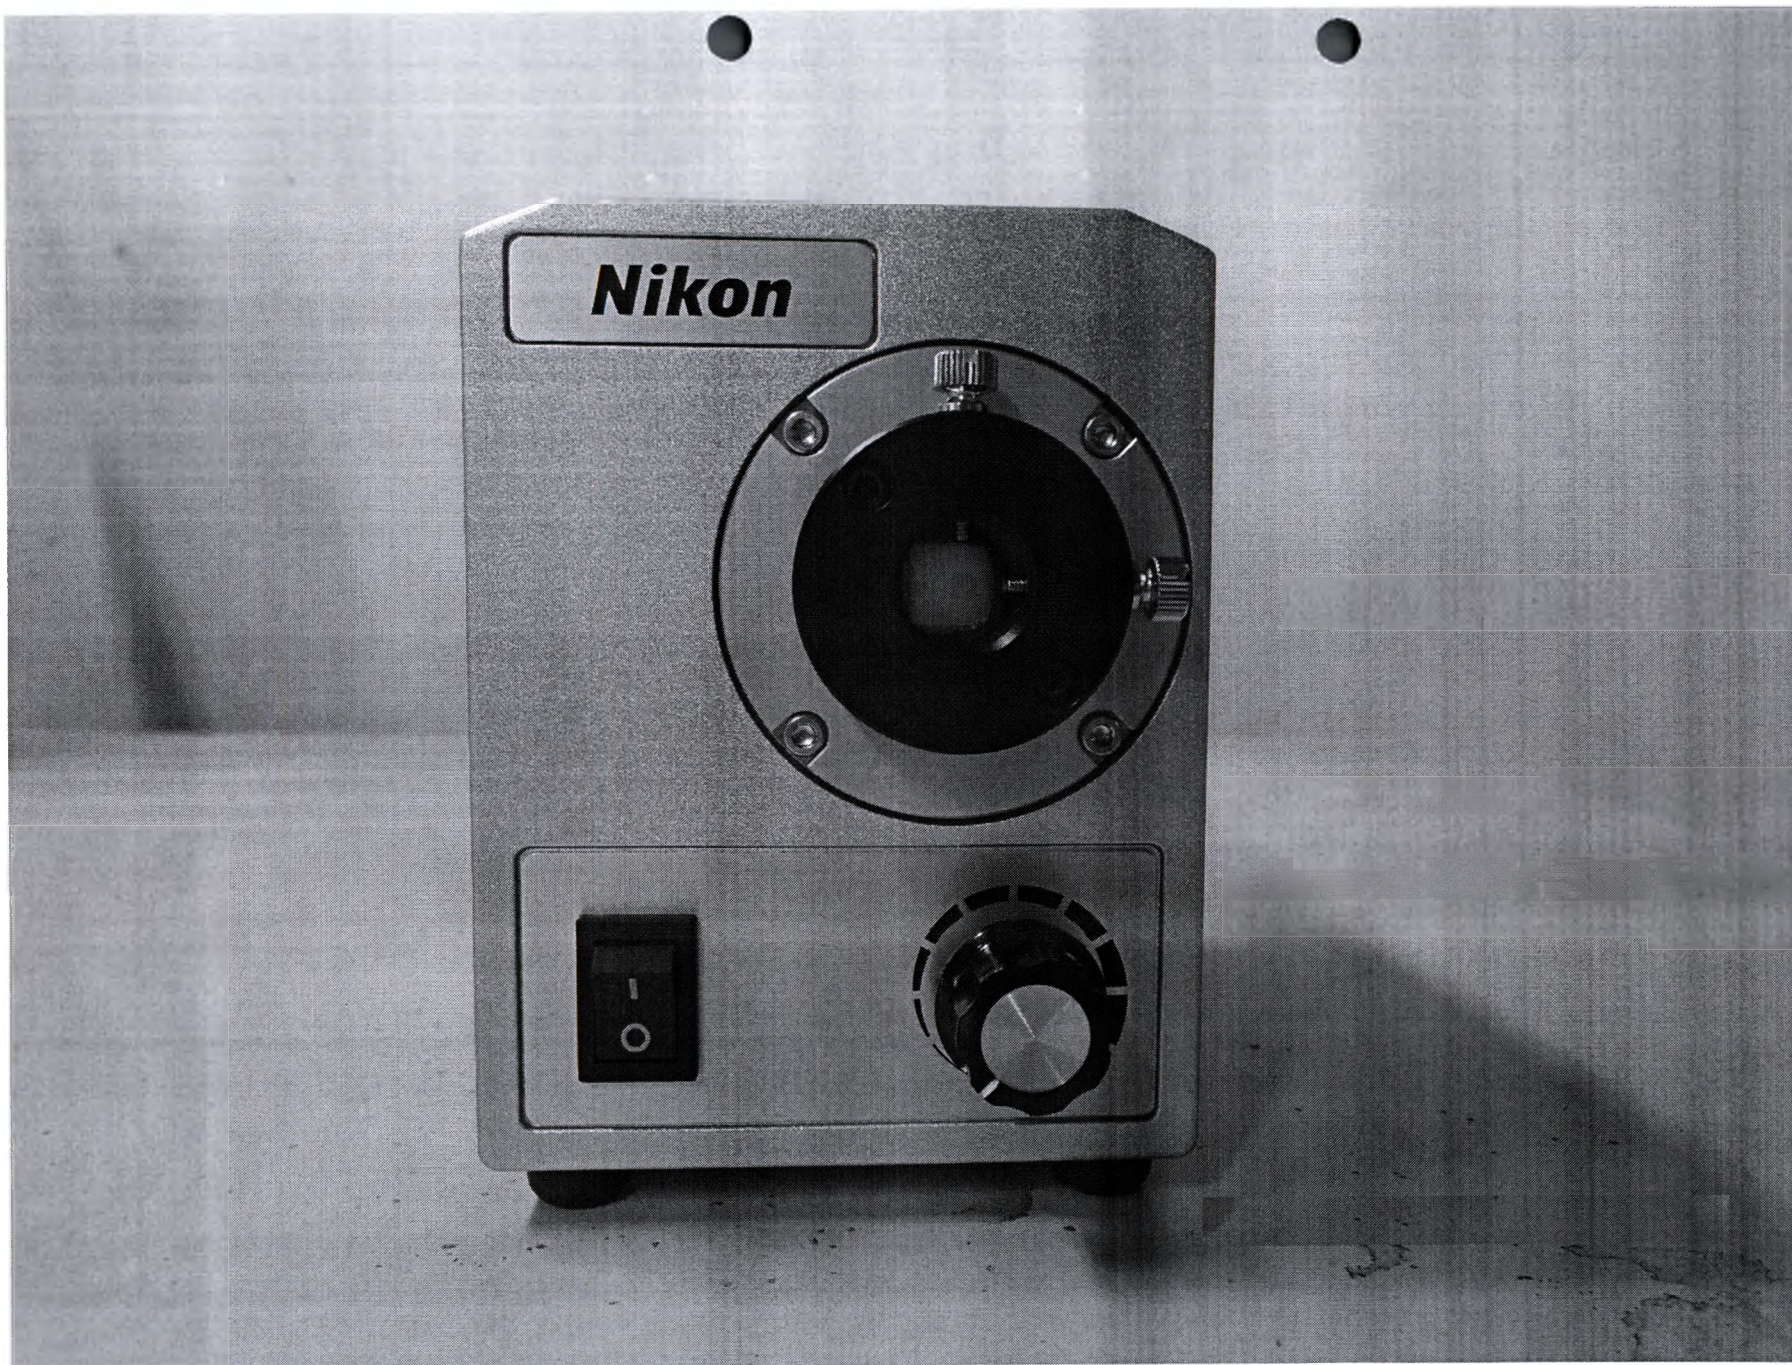


Рис.35 - Светодиодный источник света C-FLED2 LED

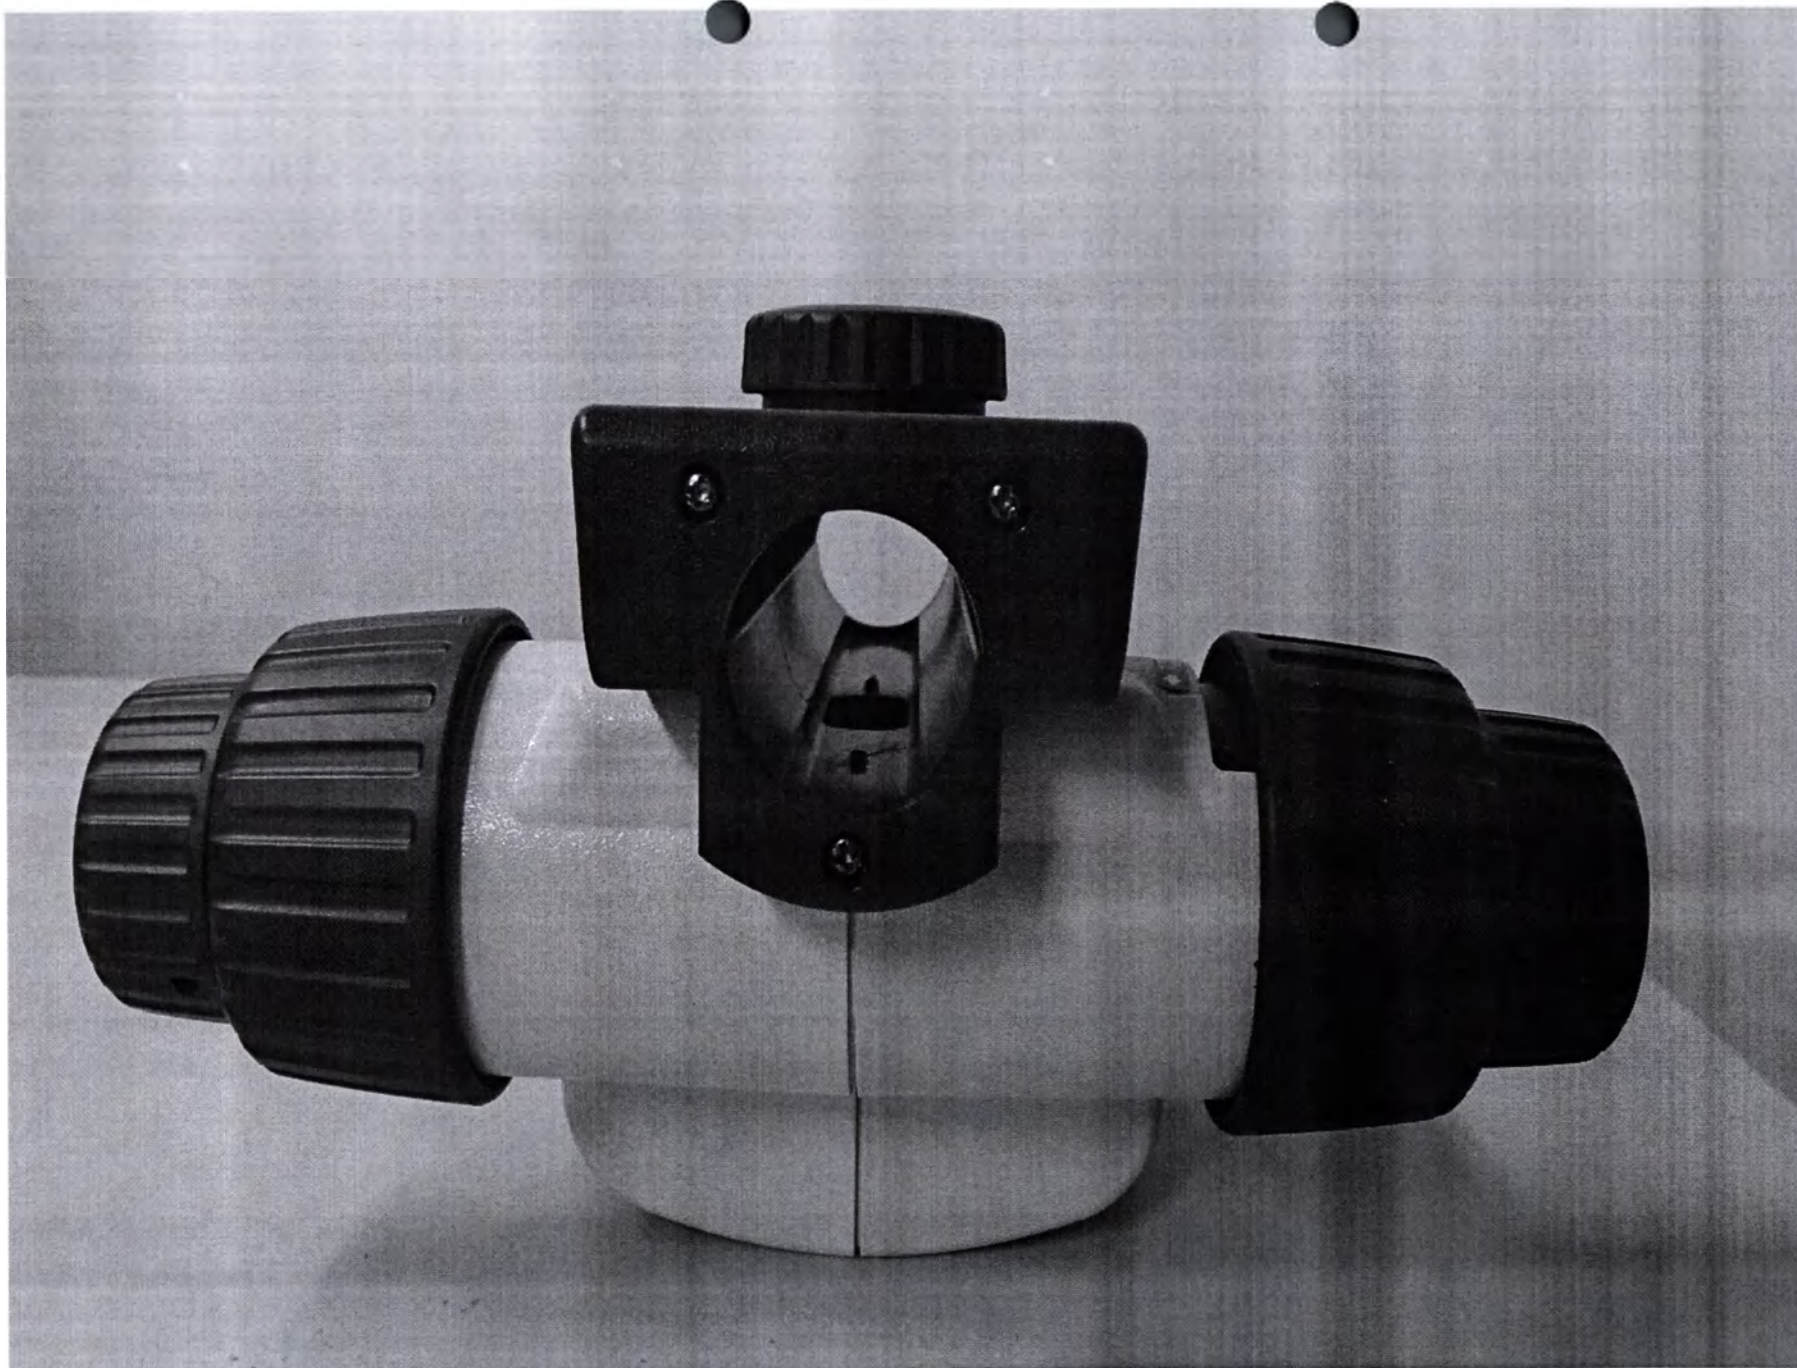


Рис.36 - Модуль крепления блока фокусировки P2-FMDN

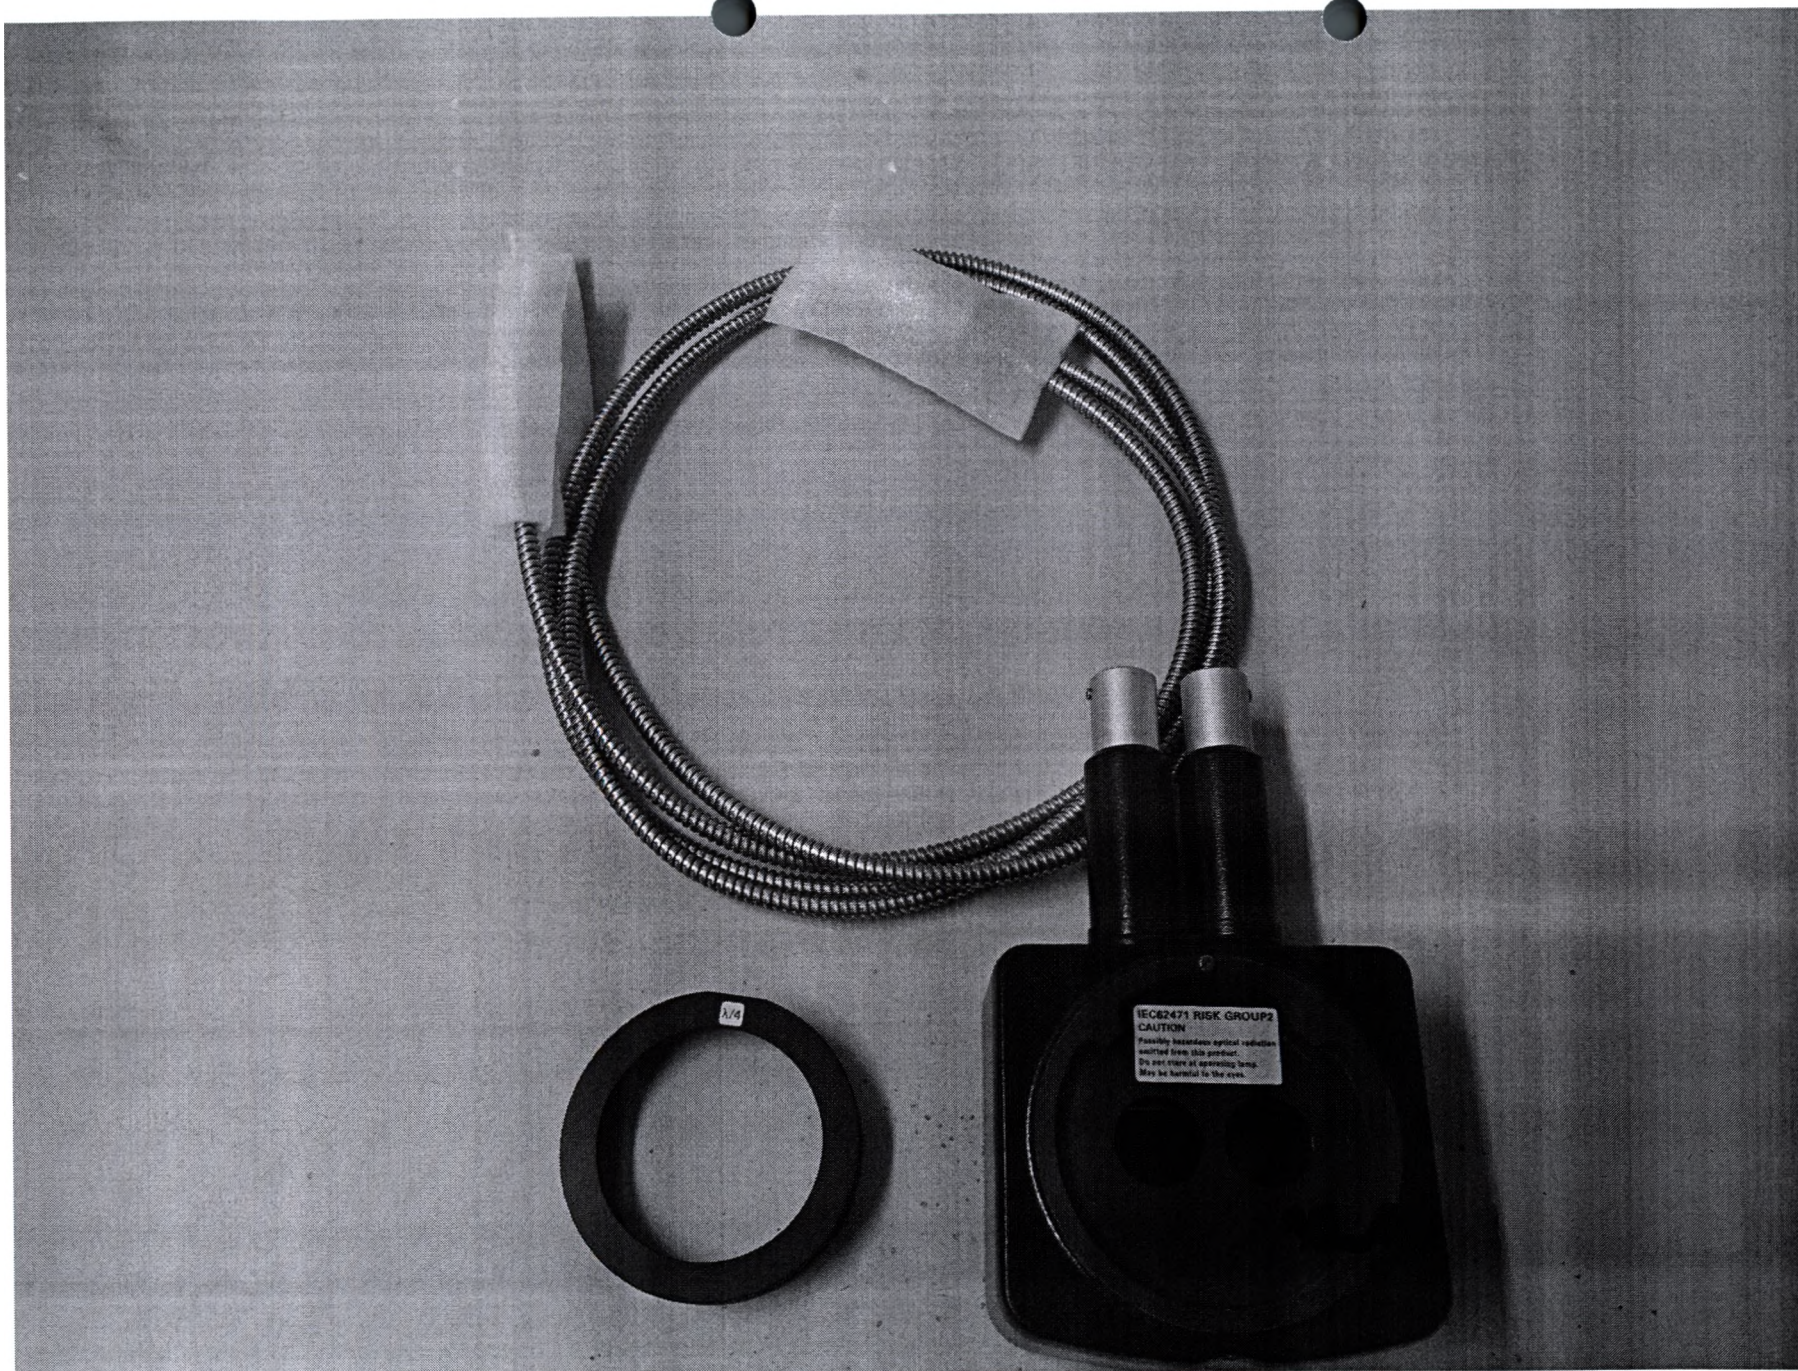


Рис.37 - Осветитель коаксиальный эпiscoпический P2-CI

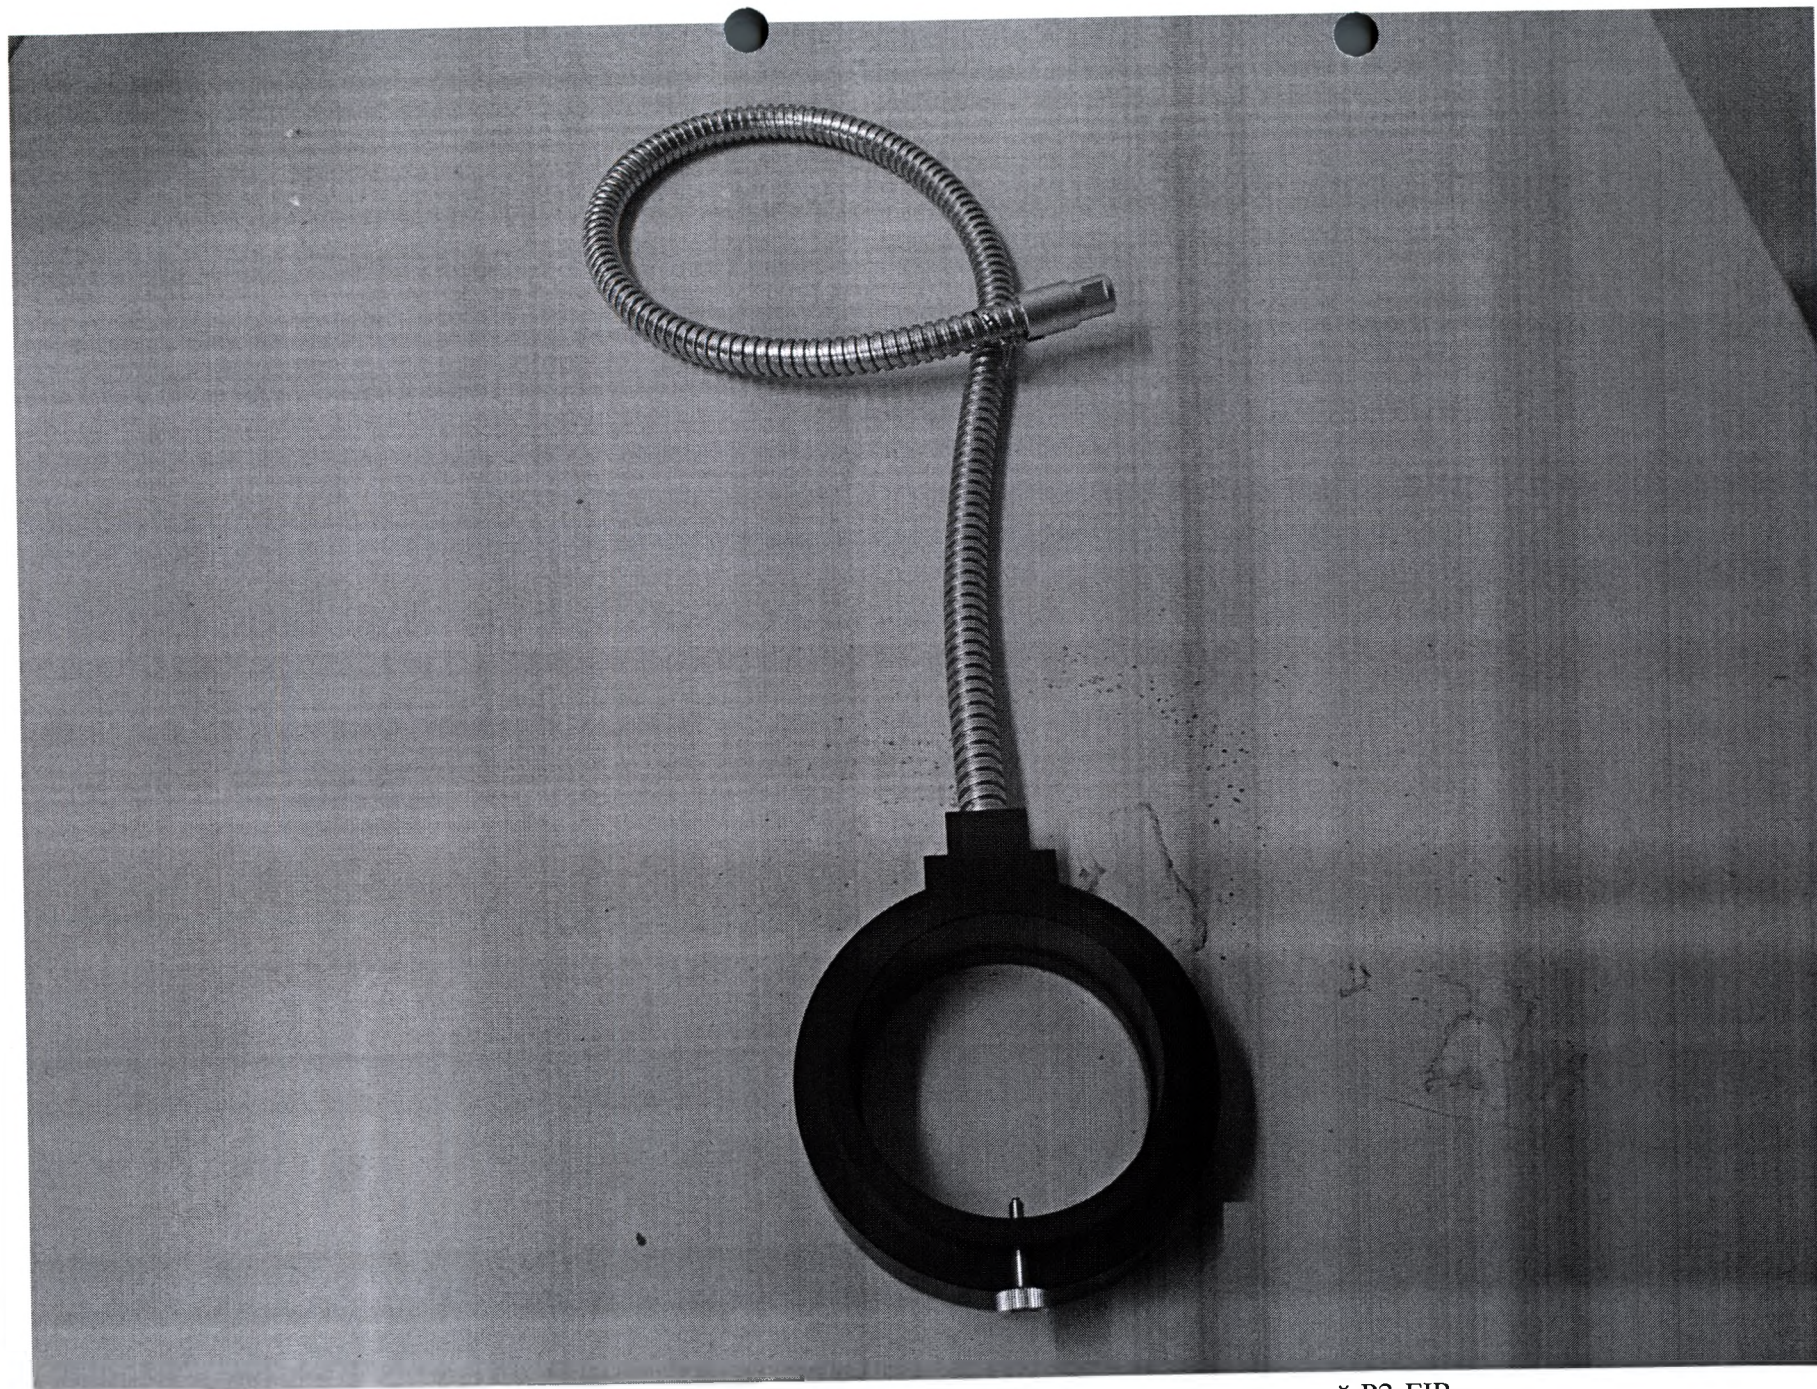


Рис.38 - Осветитель кольцевой оптоволоконный P2-FIR

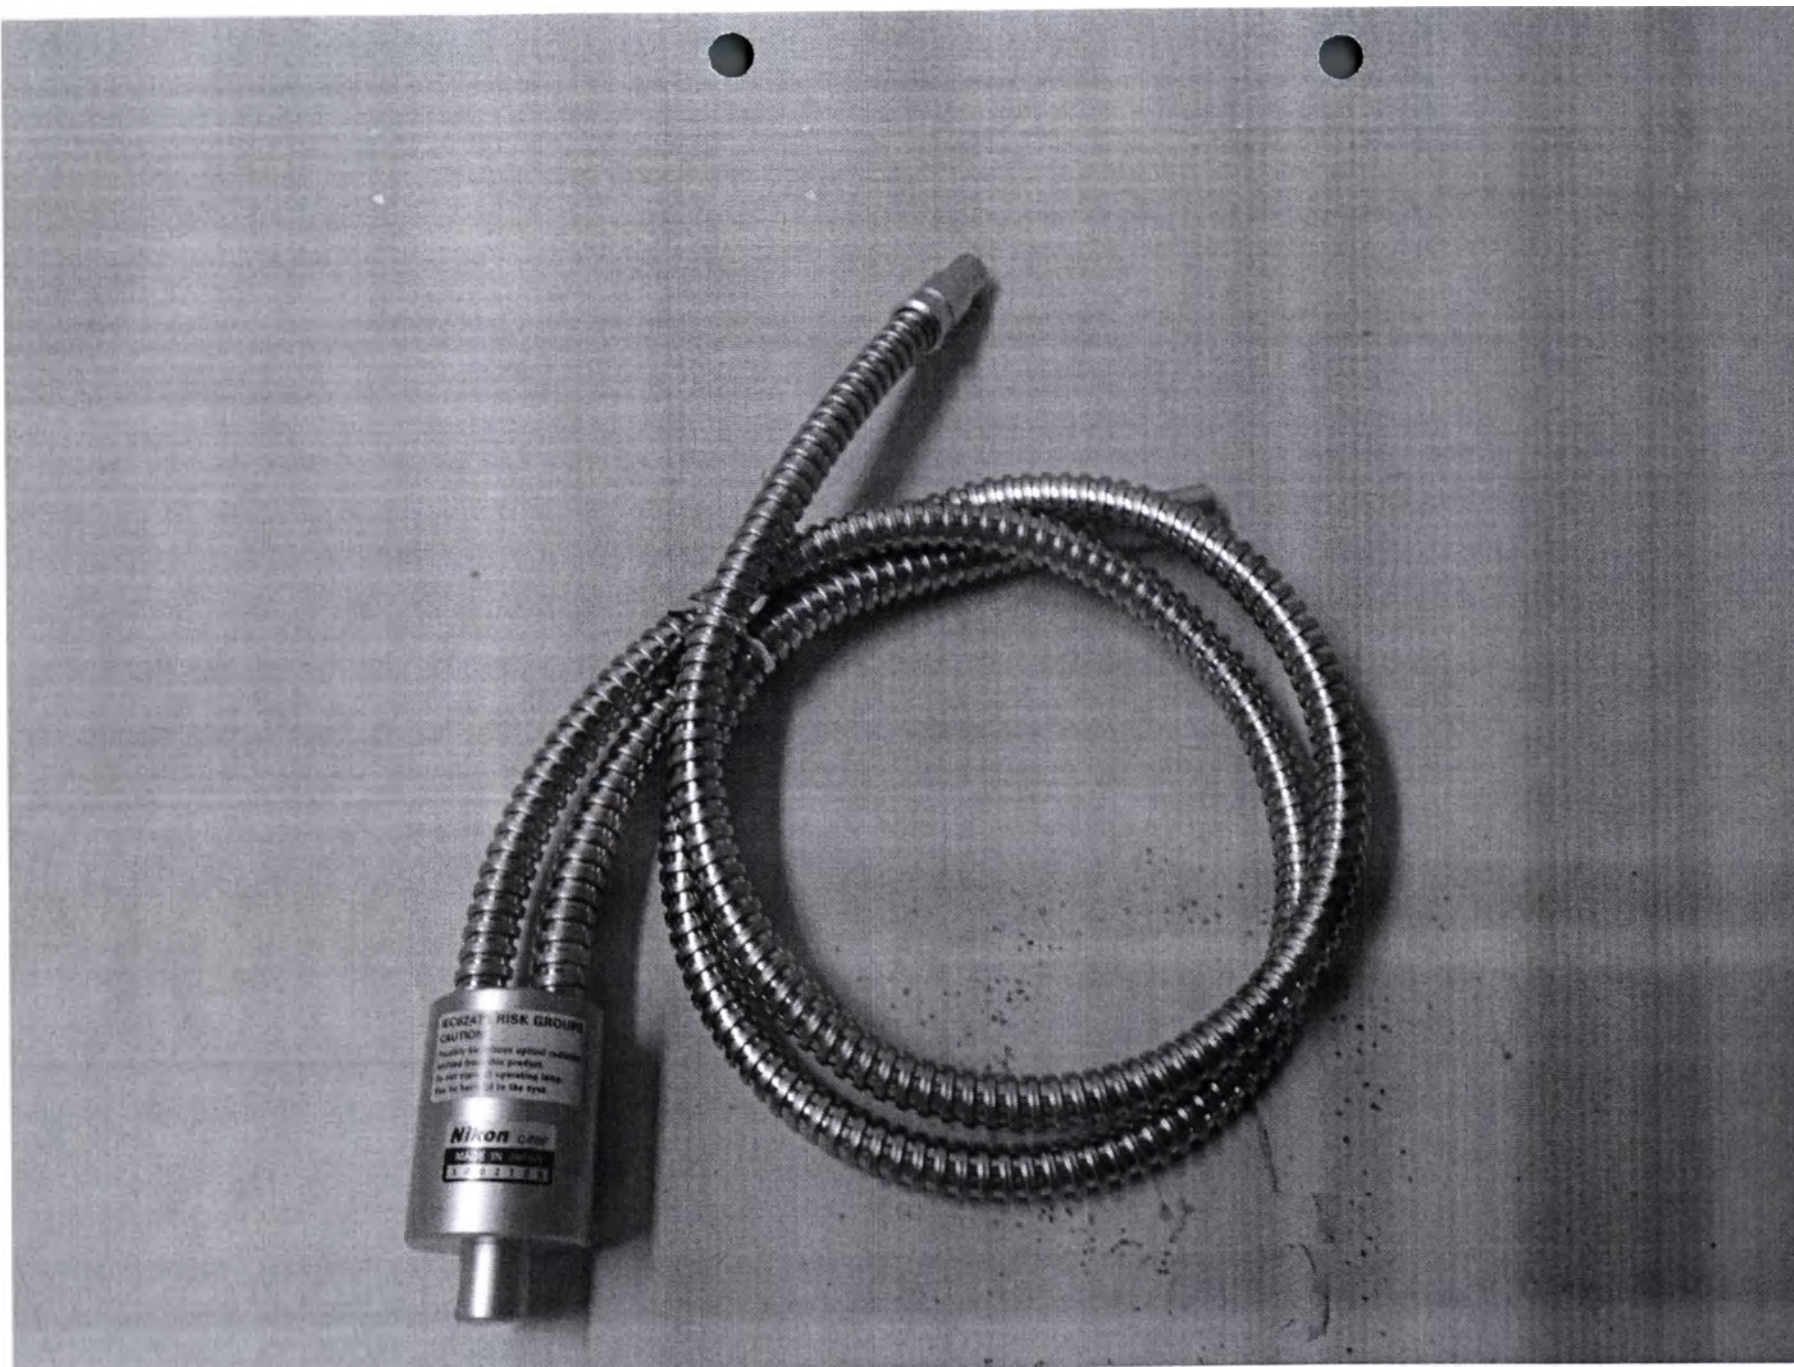


Рис.39 - Световод двухплечный C-FDF

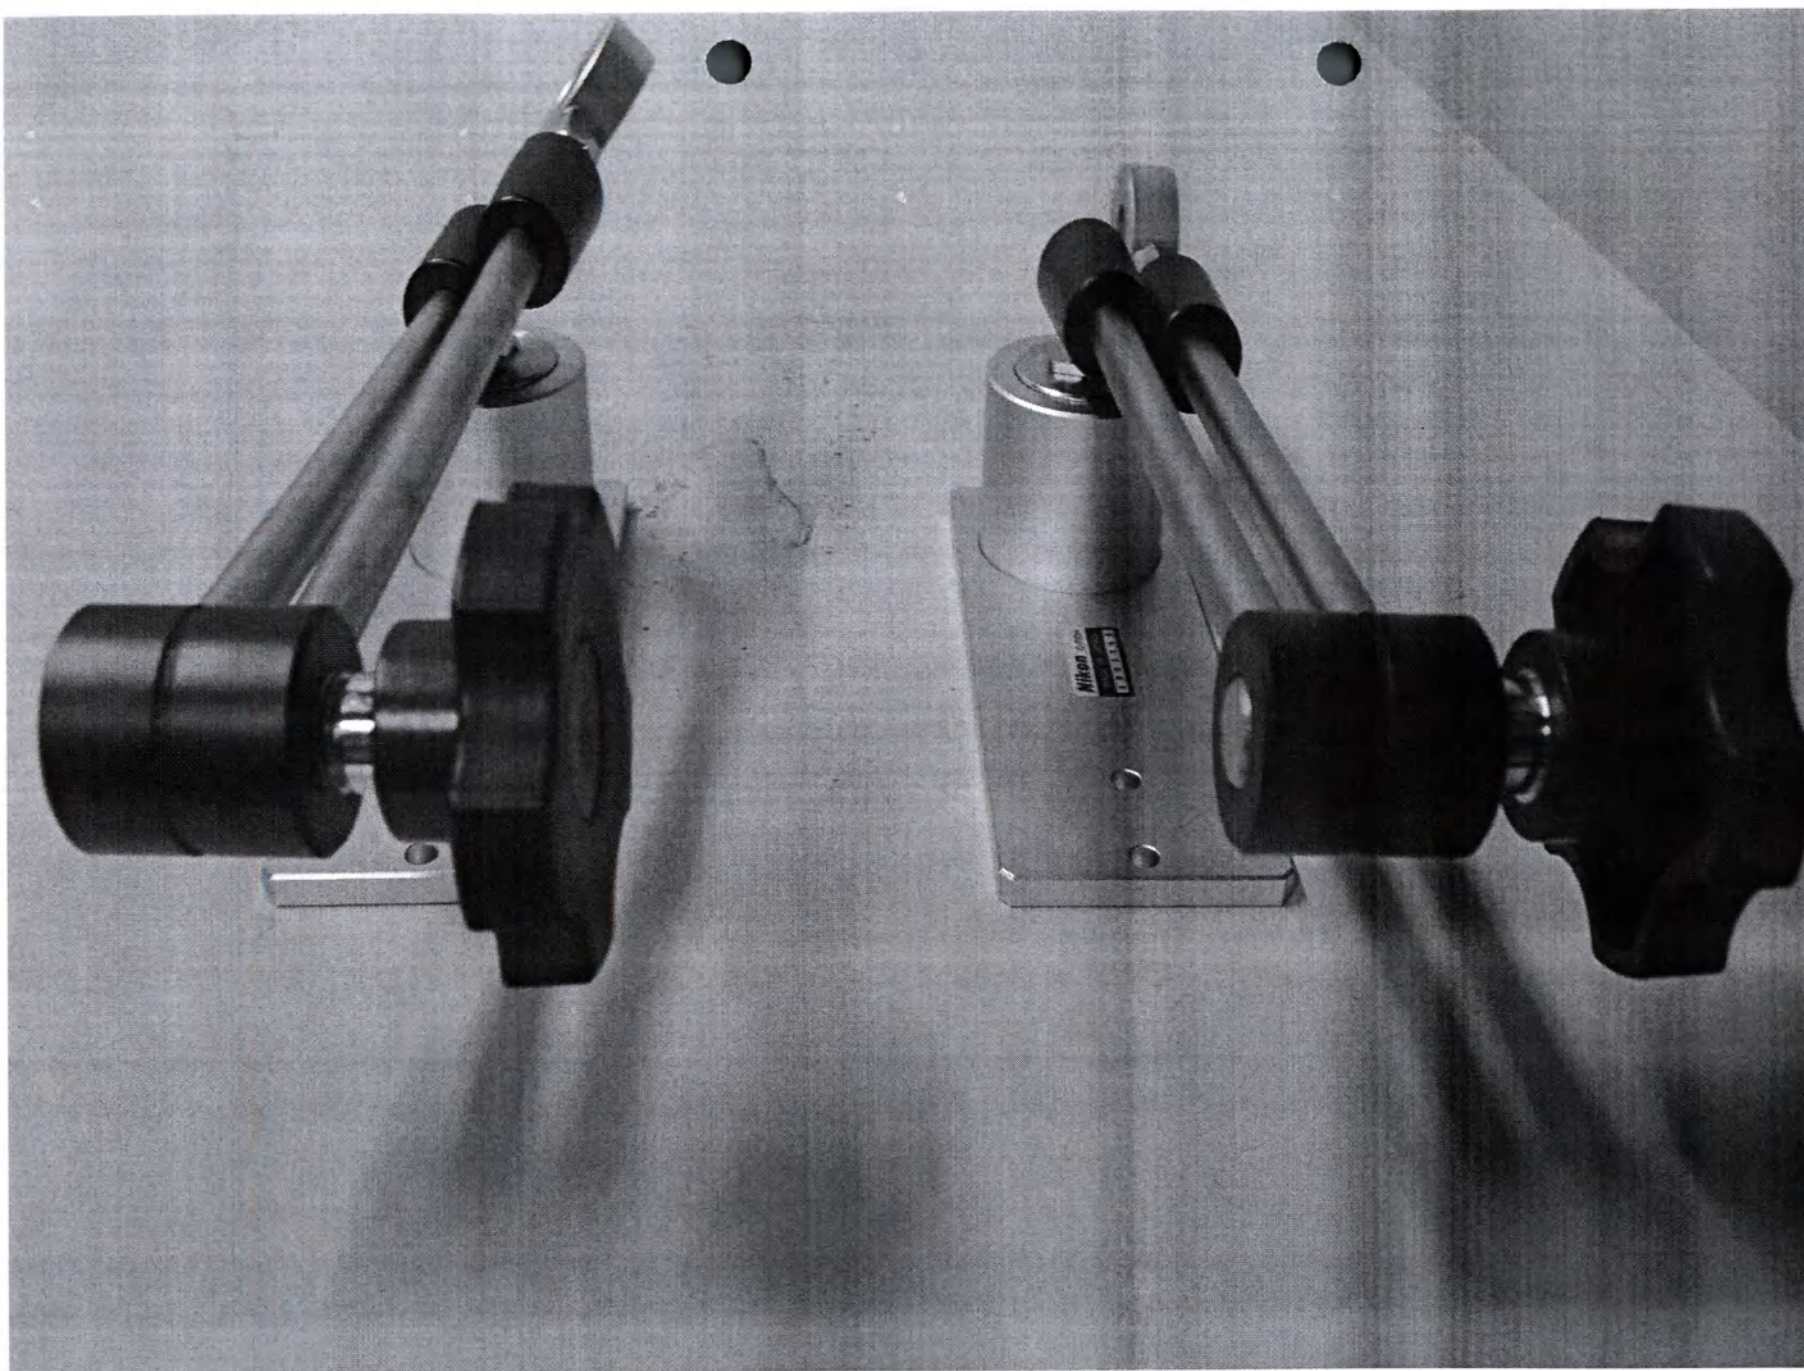


Рис.40 - Держатель световода двухплечного С-FIDH

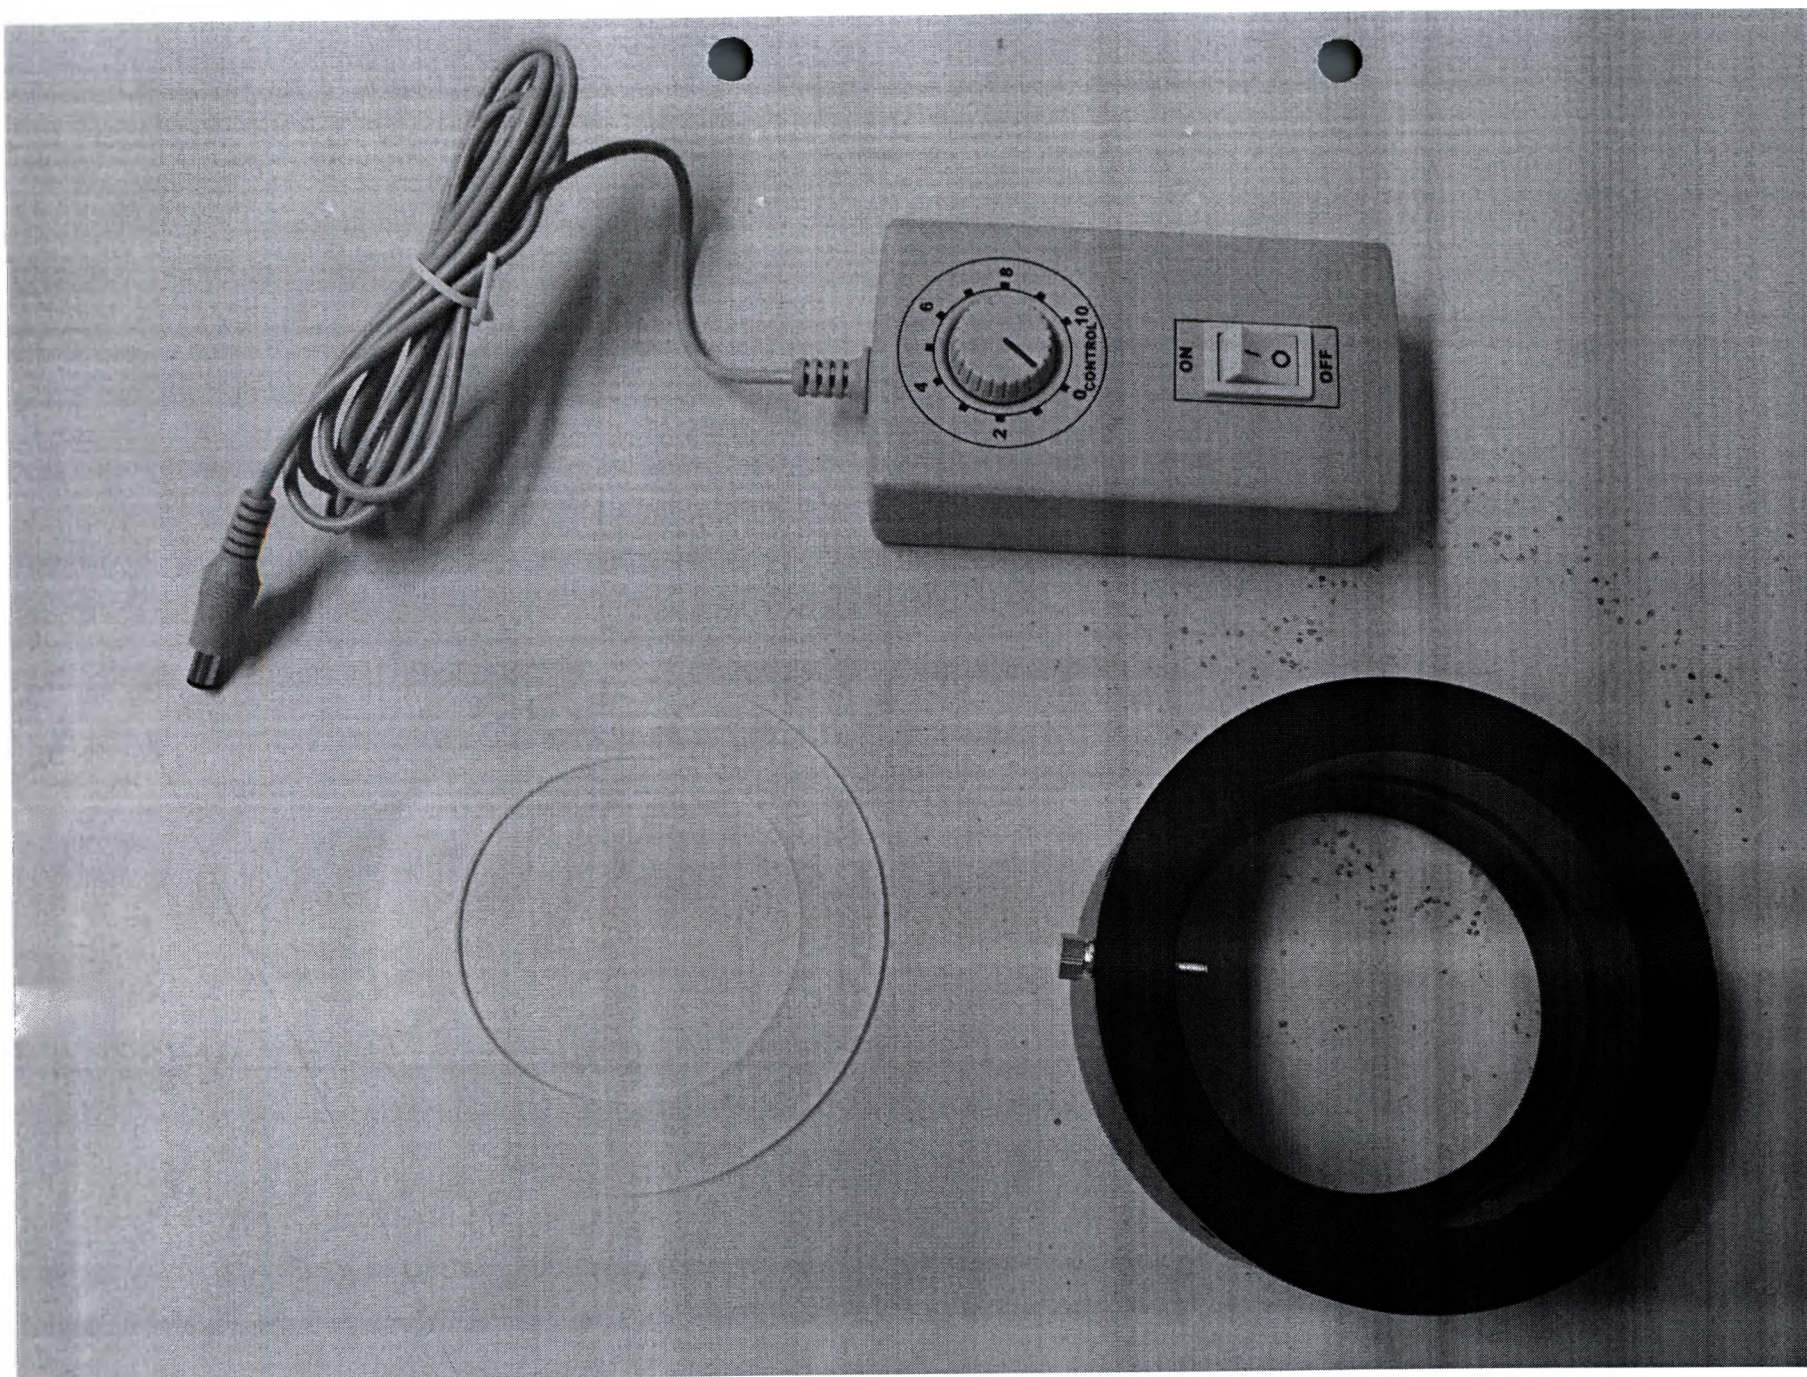


Рис.41 - Осветитель кольцевой светодиодный P2-FIRL LED

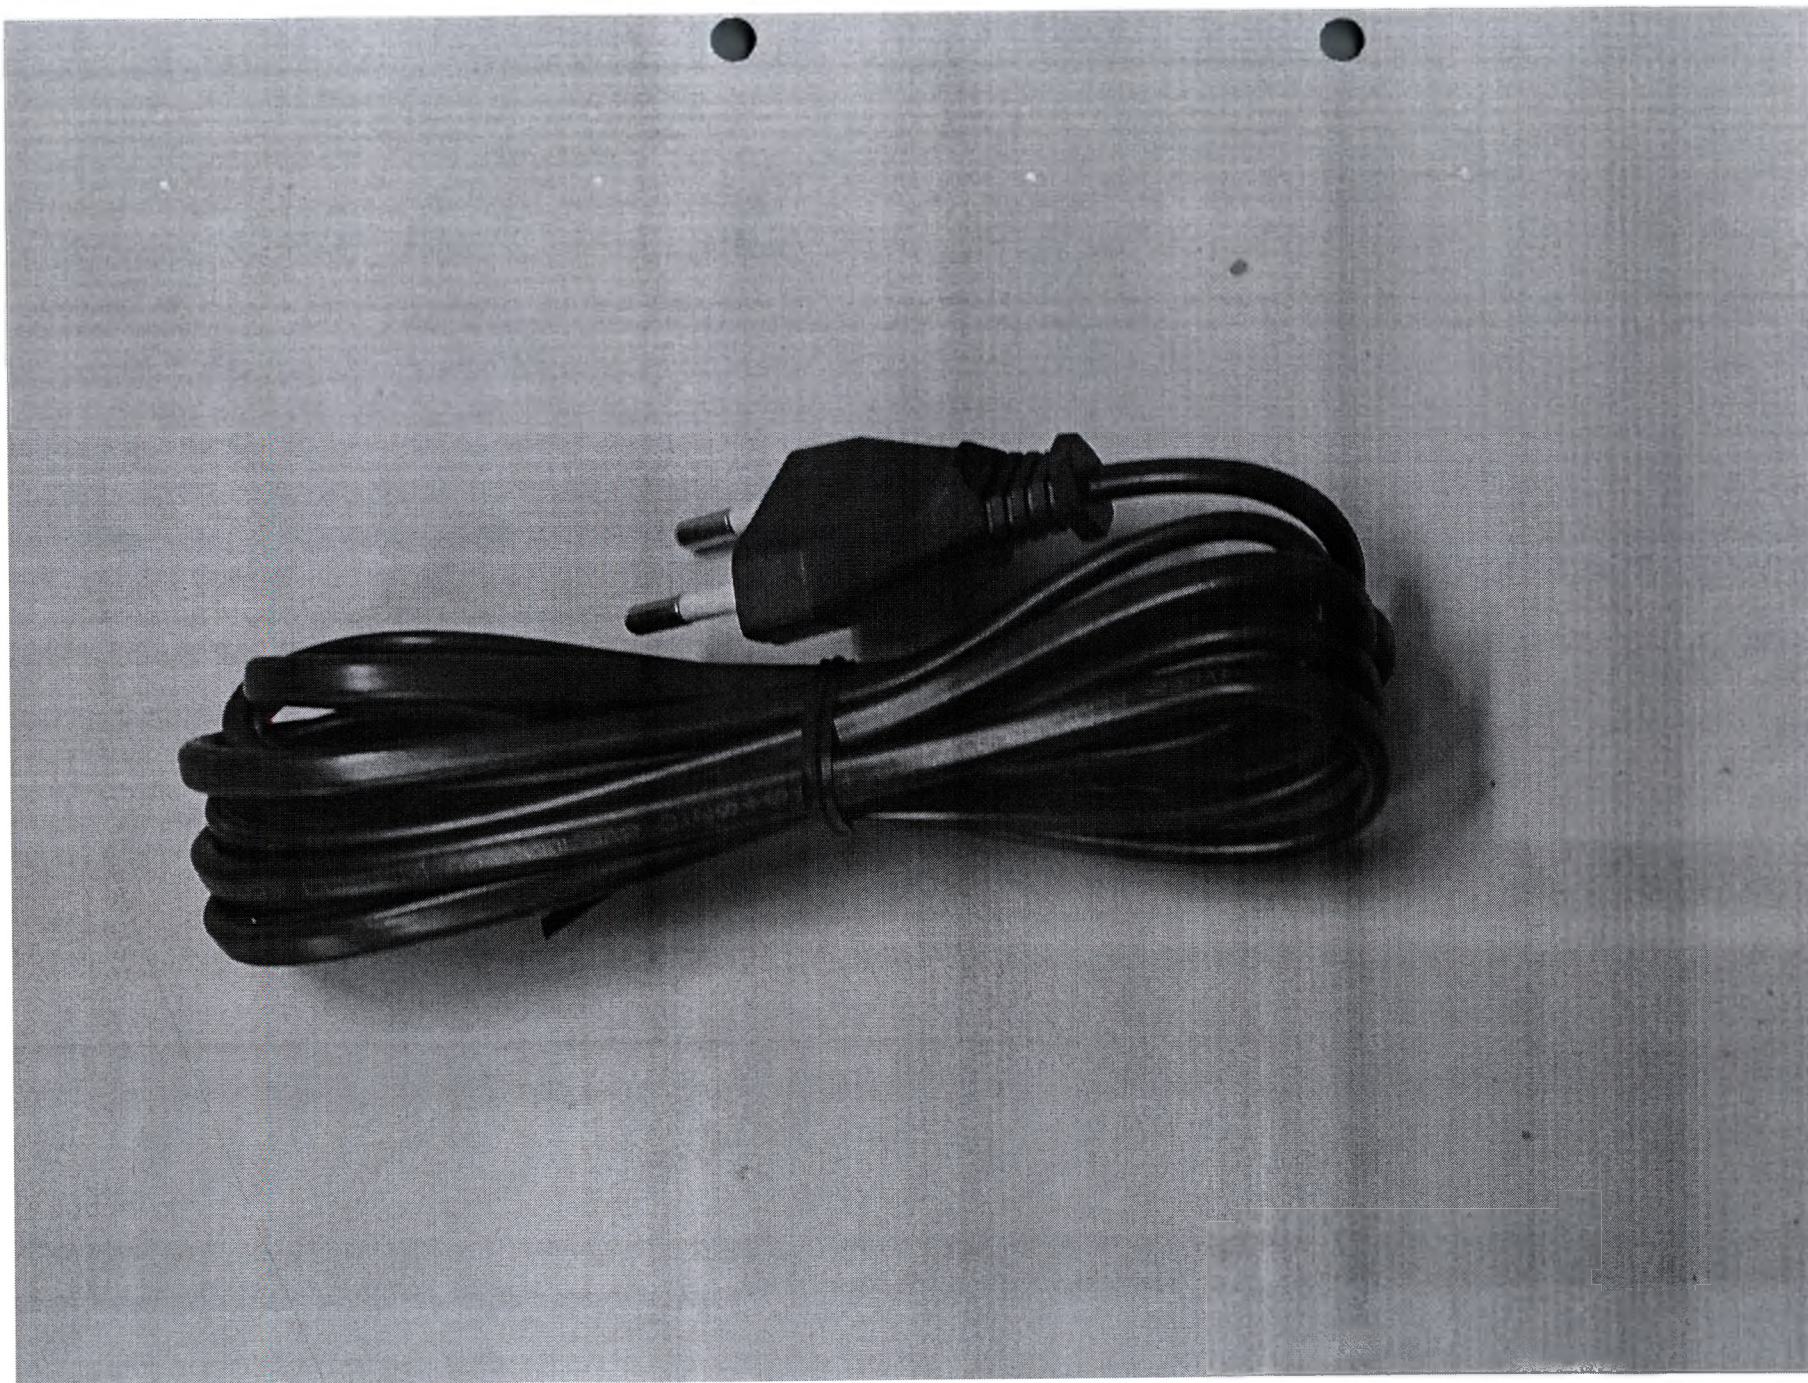


Рис.42 - Кабель AZLED-PCE

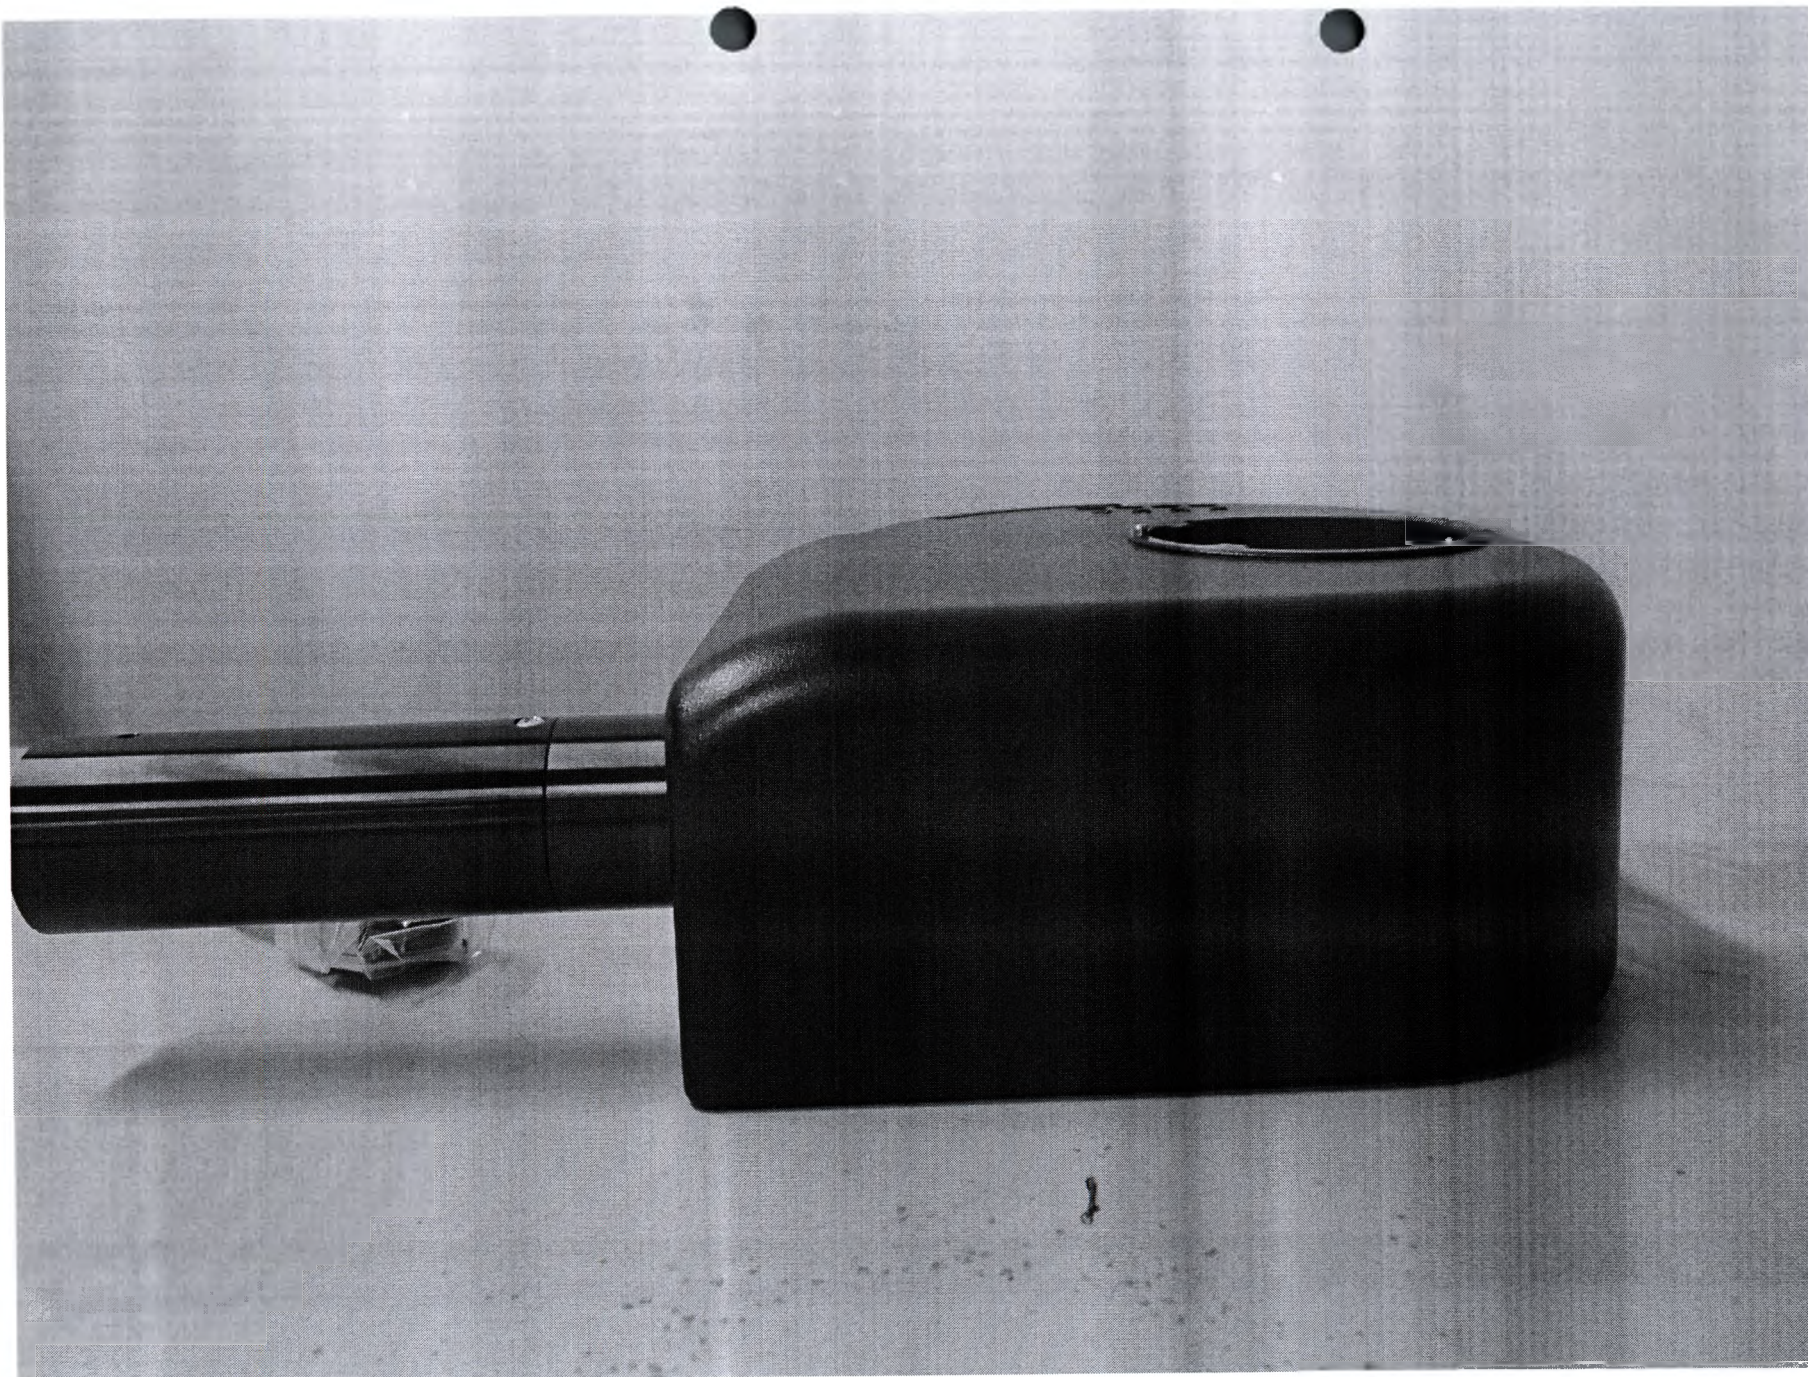


Рис.43 - Насадка эпифлуоресцентная моторизованная P2-EFLM.



Рис.44 - Насадка эпифлуоресцентная P2-EFLI

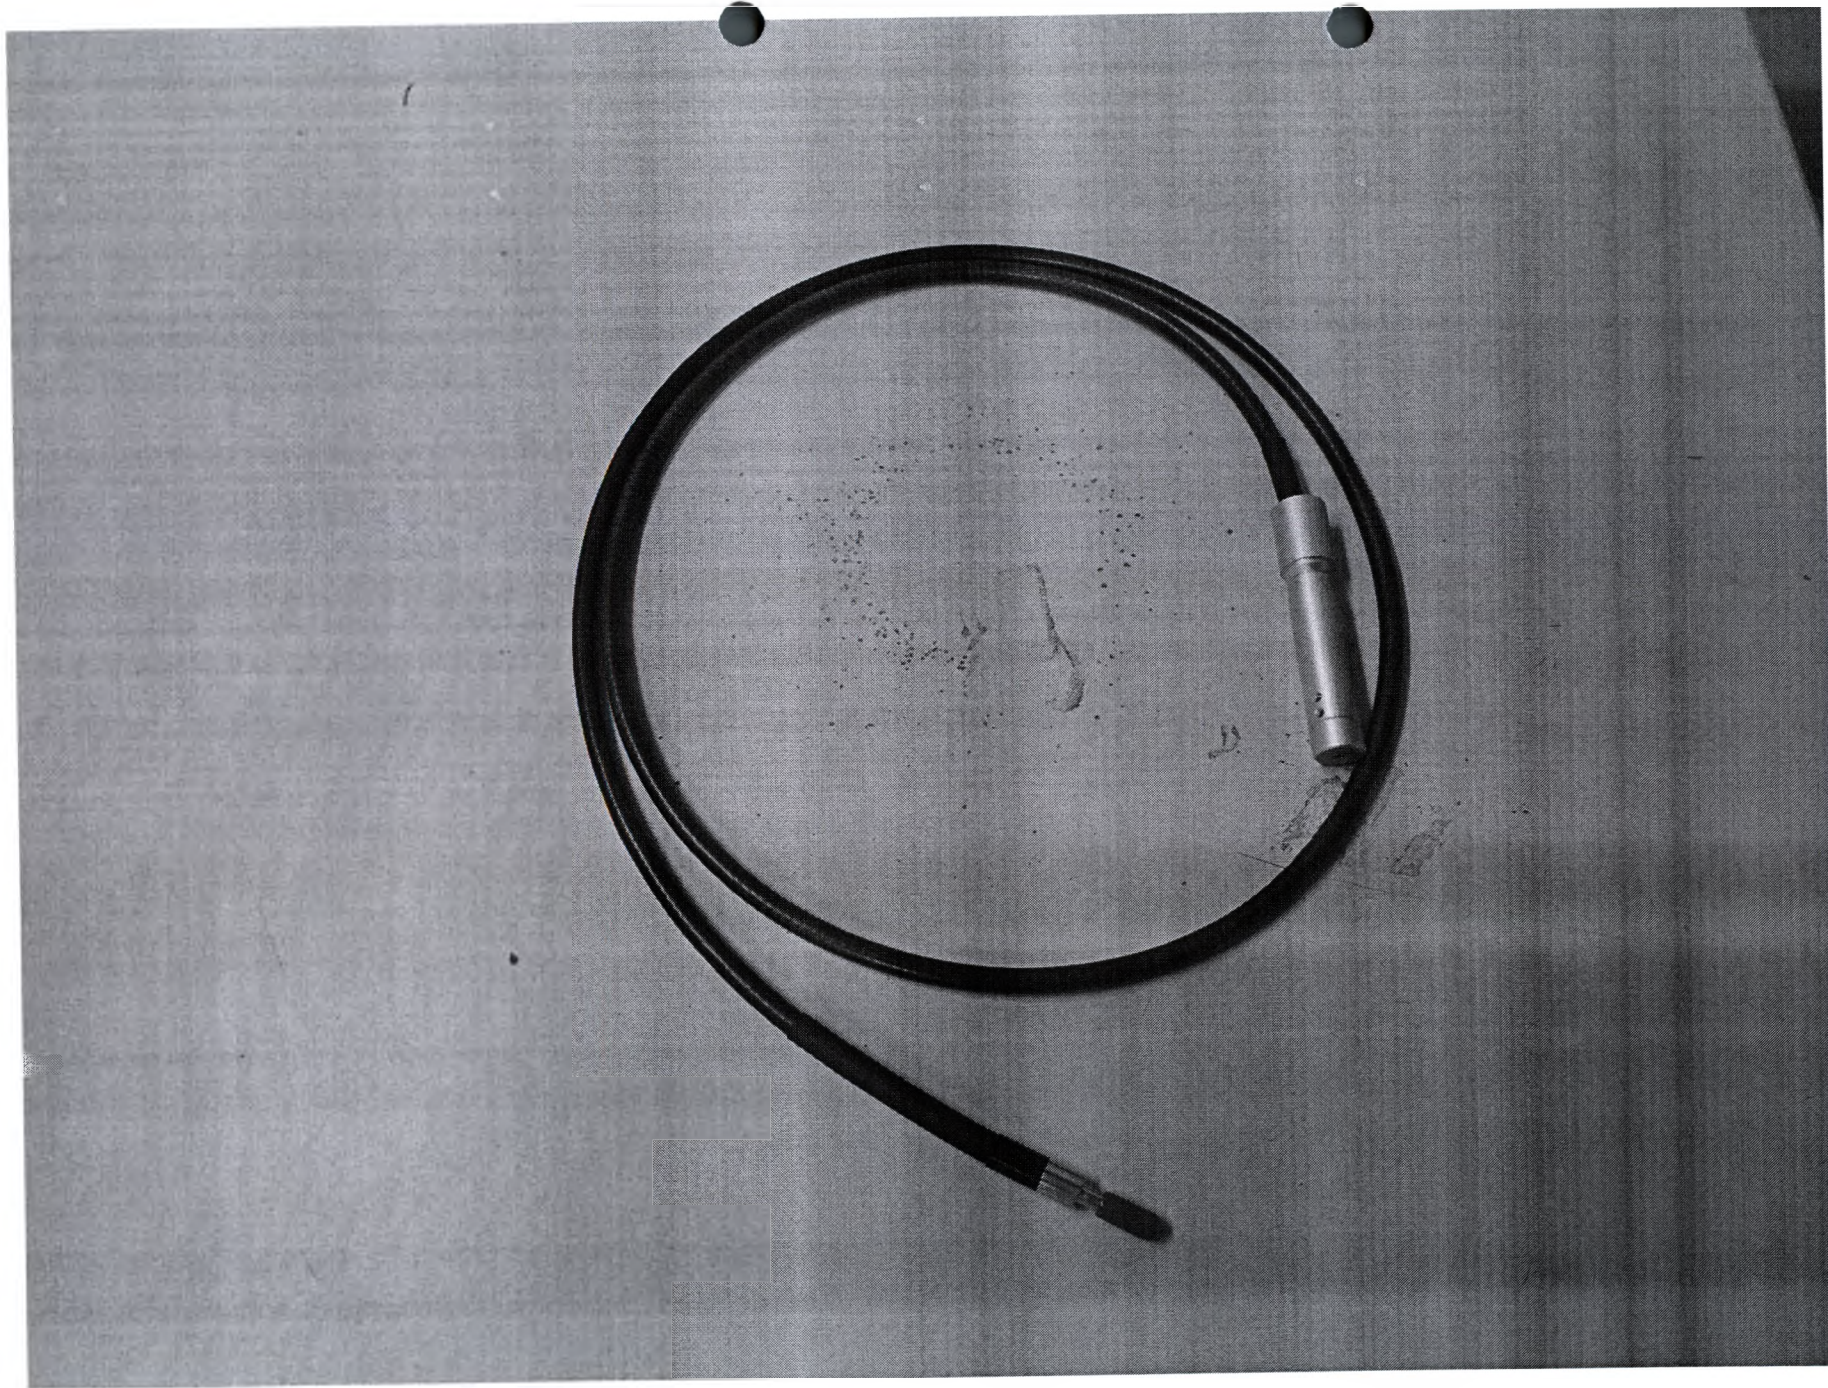


Рис.45 - Осветитель элифлуоресцентный оптоволоконный Intensilight C-HGFI.

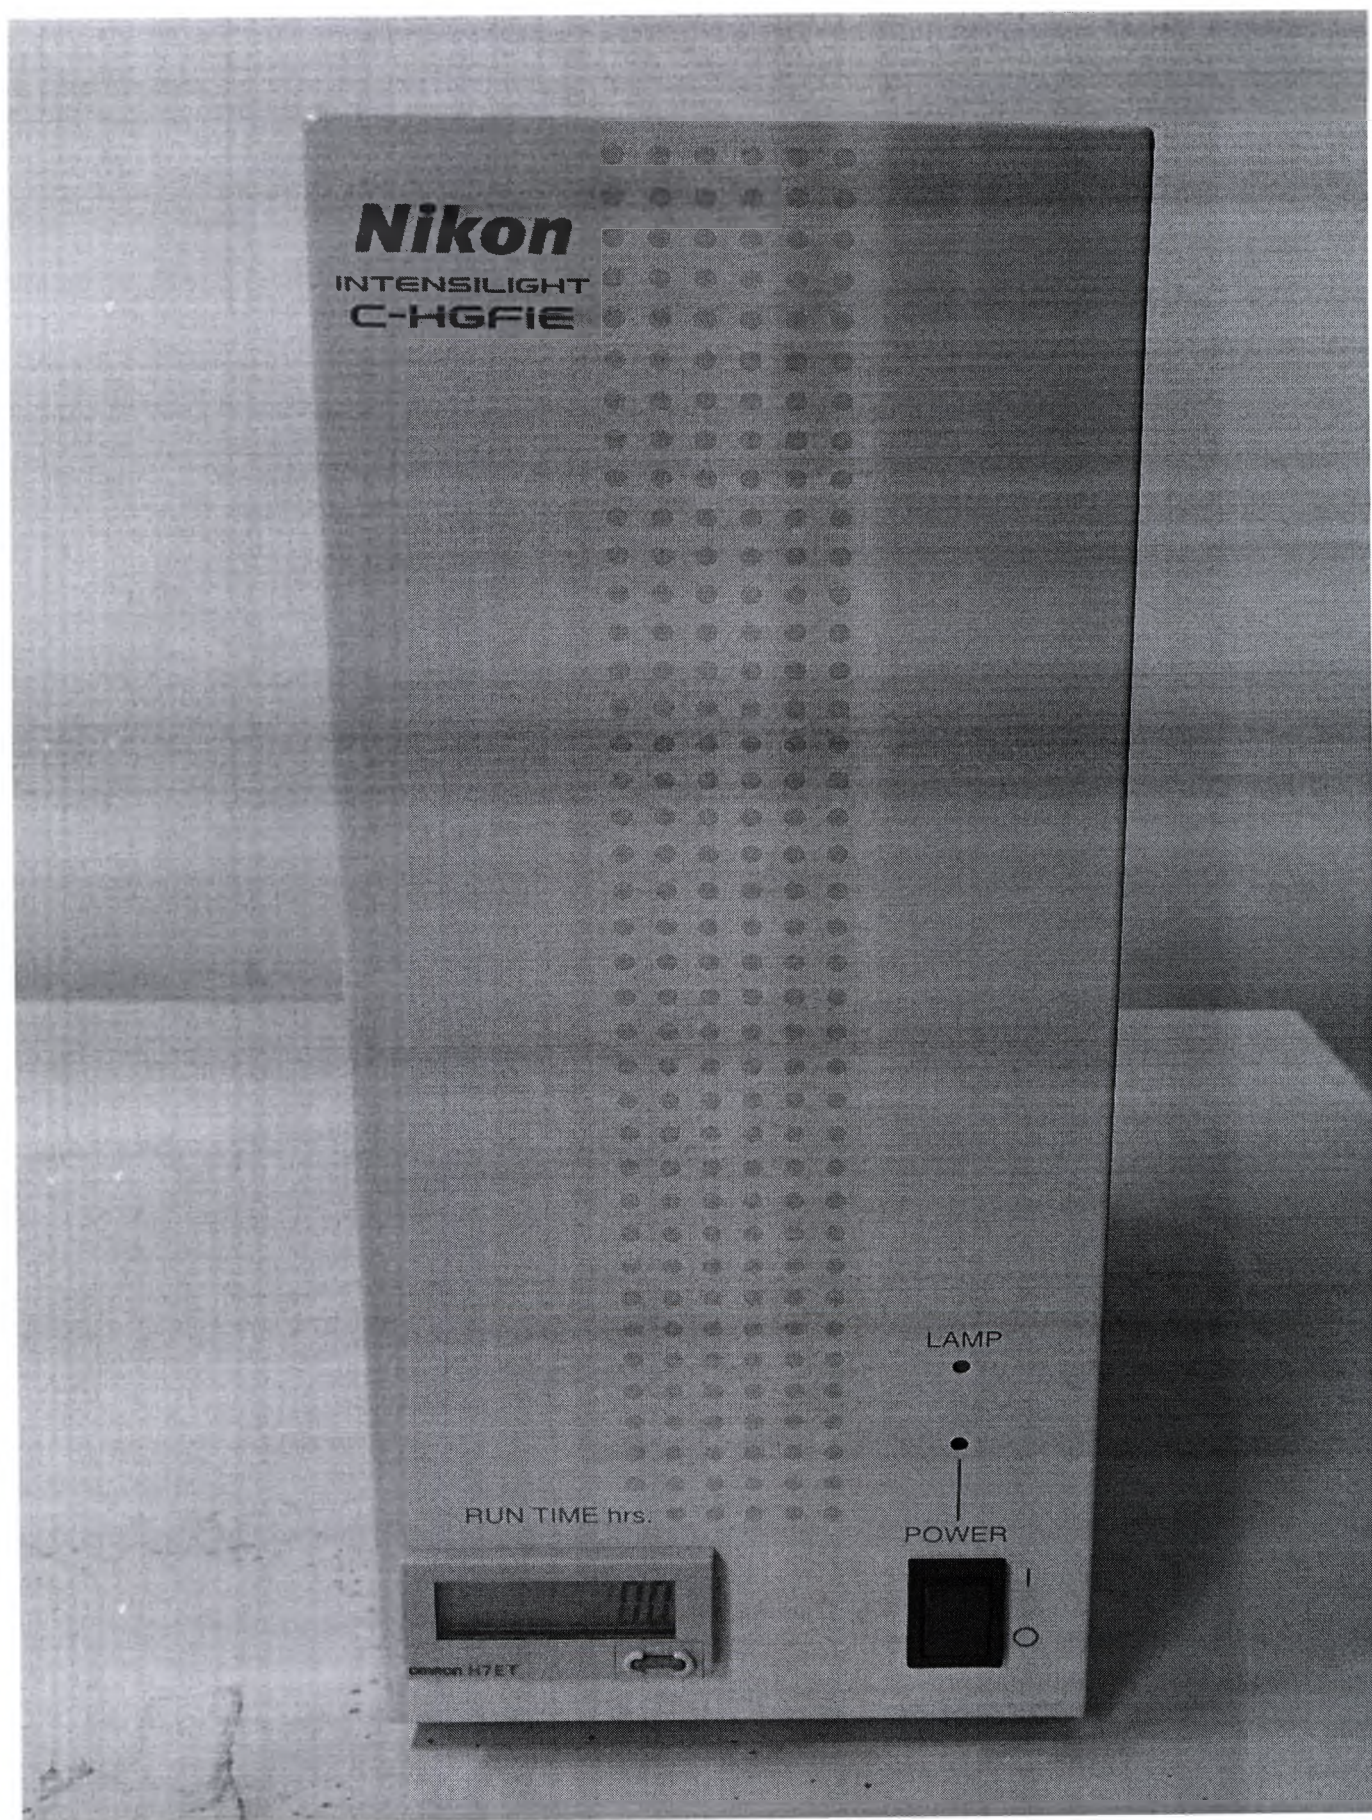


Рис.46 - Осветитель элифлуоресцентный оптоволоконный моторизованный Intensilight C-HGFIE.

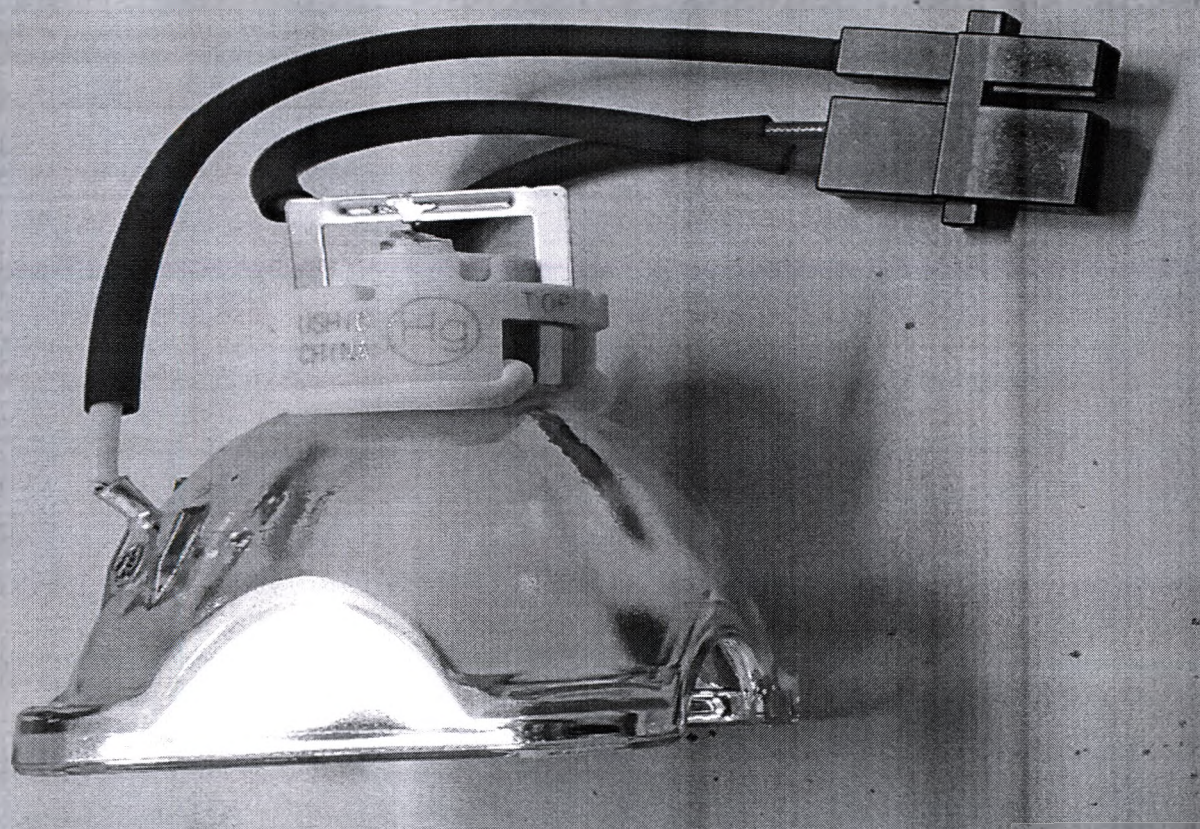


Рис.47 - Лампа ртутная C-LHGFI

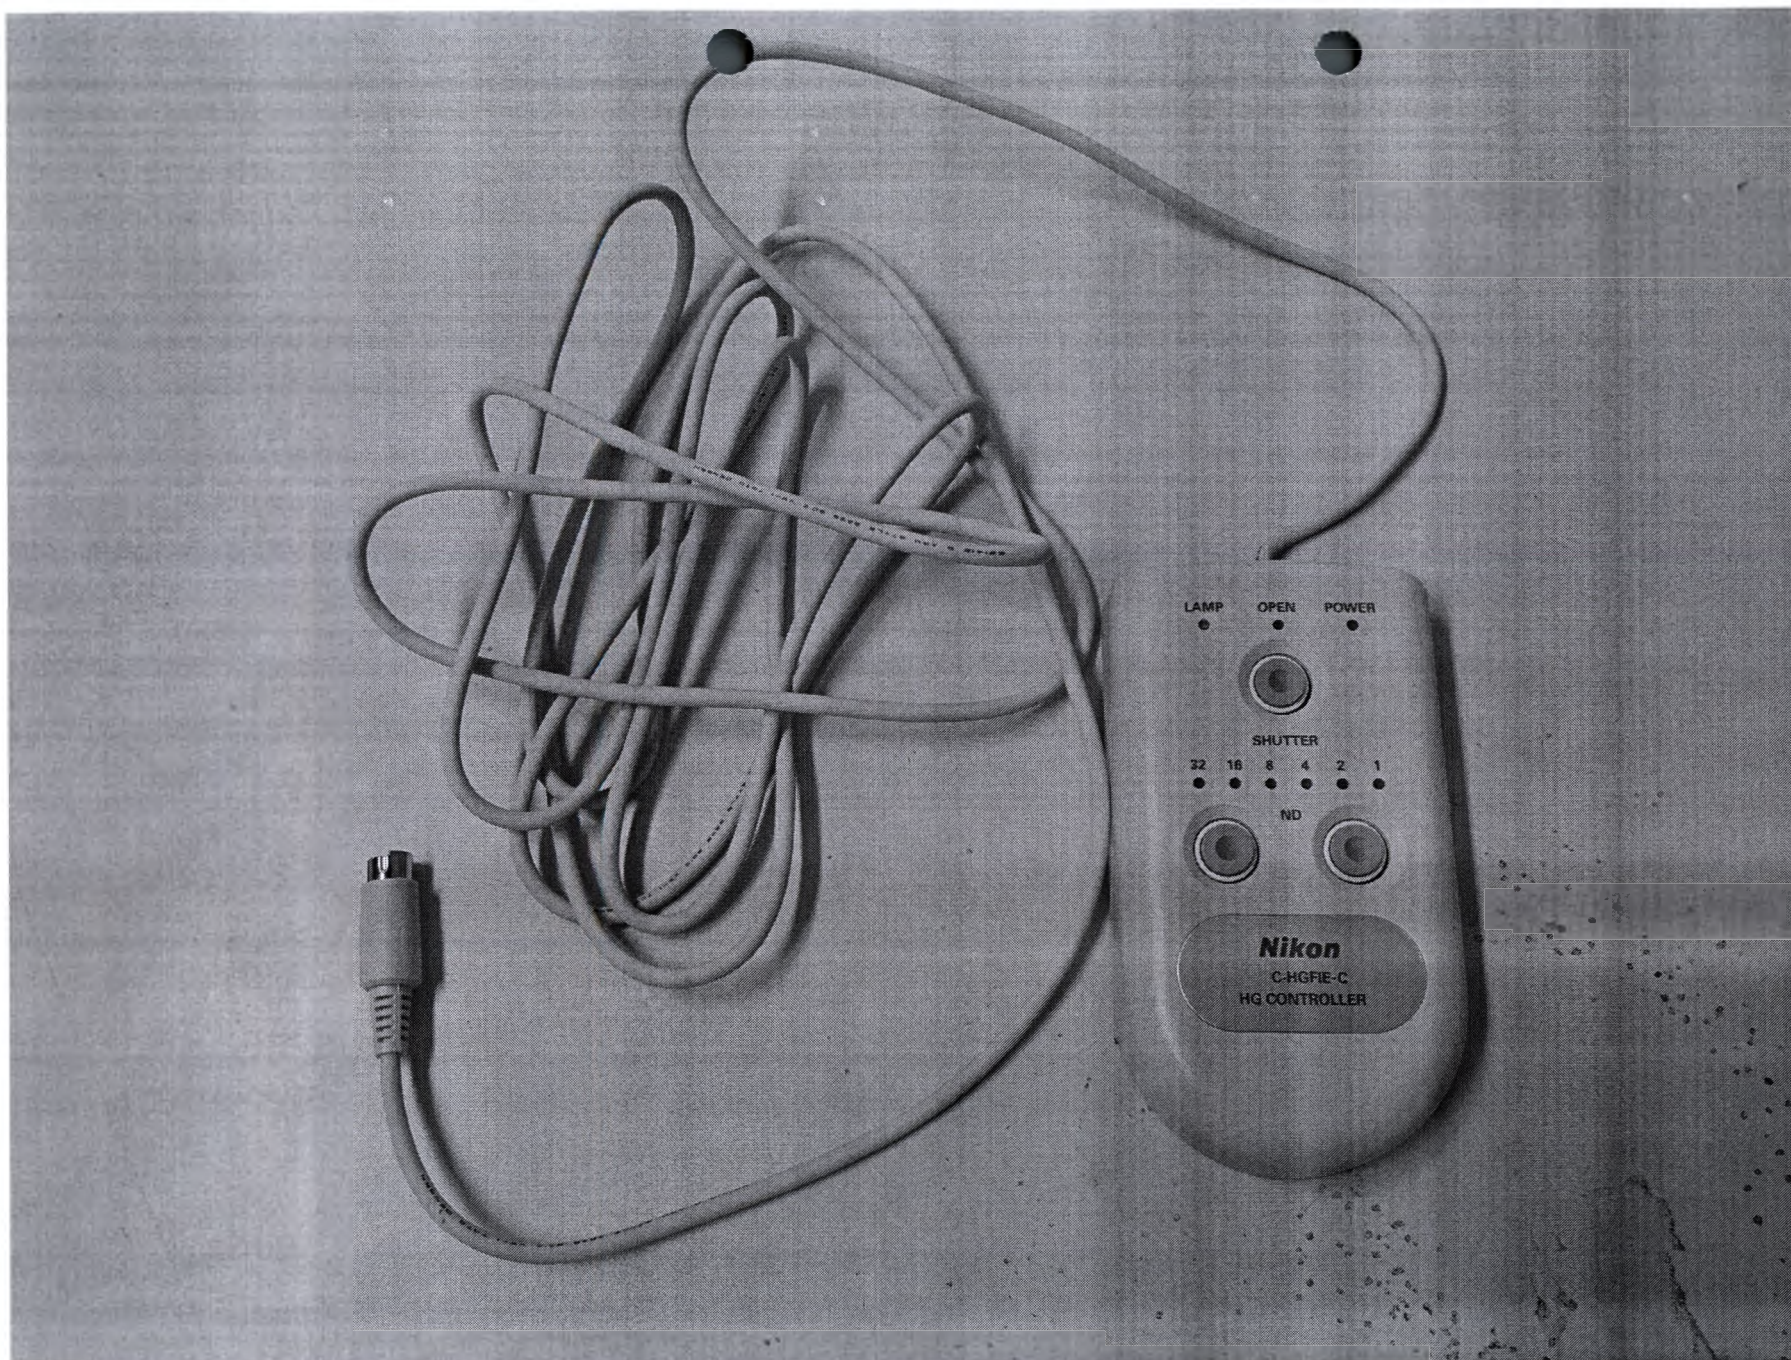


Рис.48 - Блок управления C-HGFIE-C

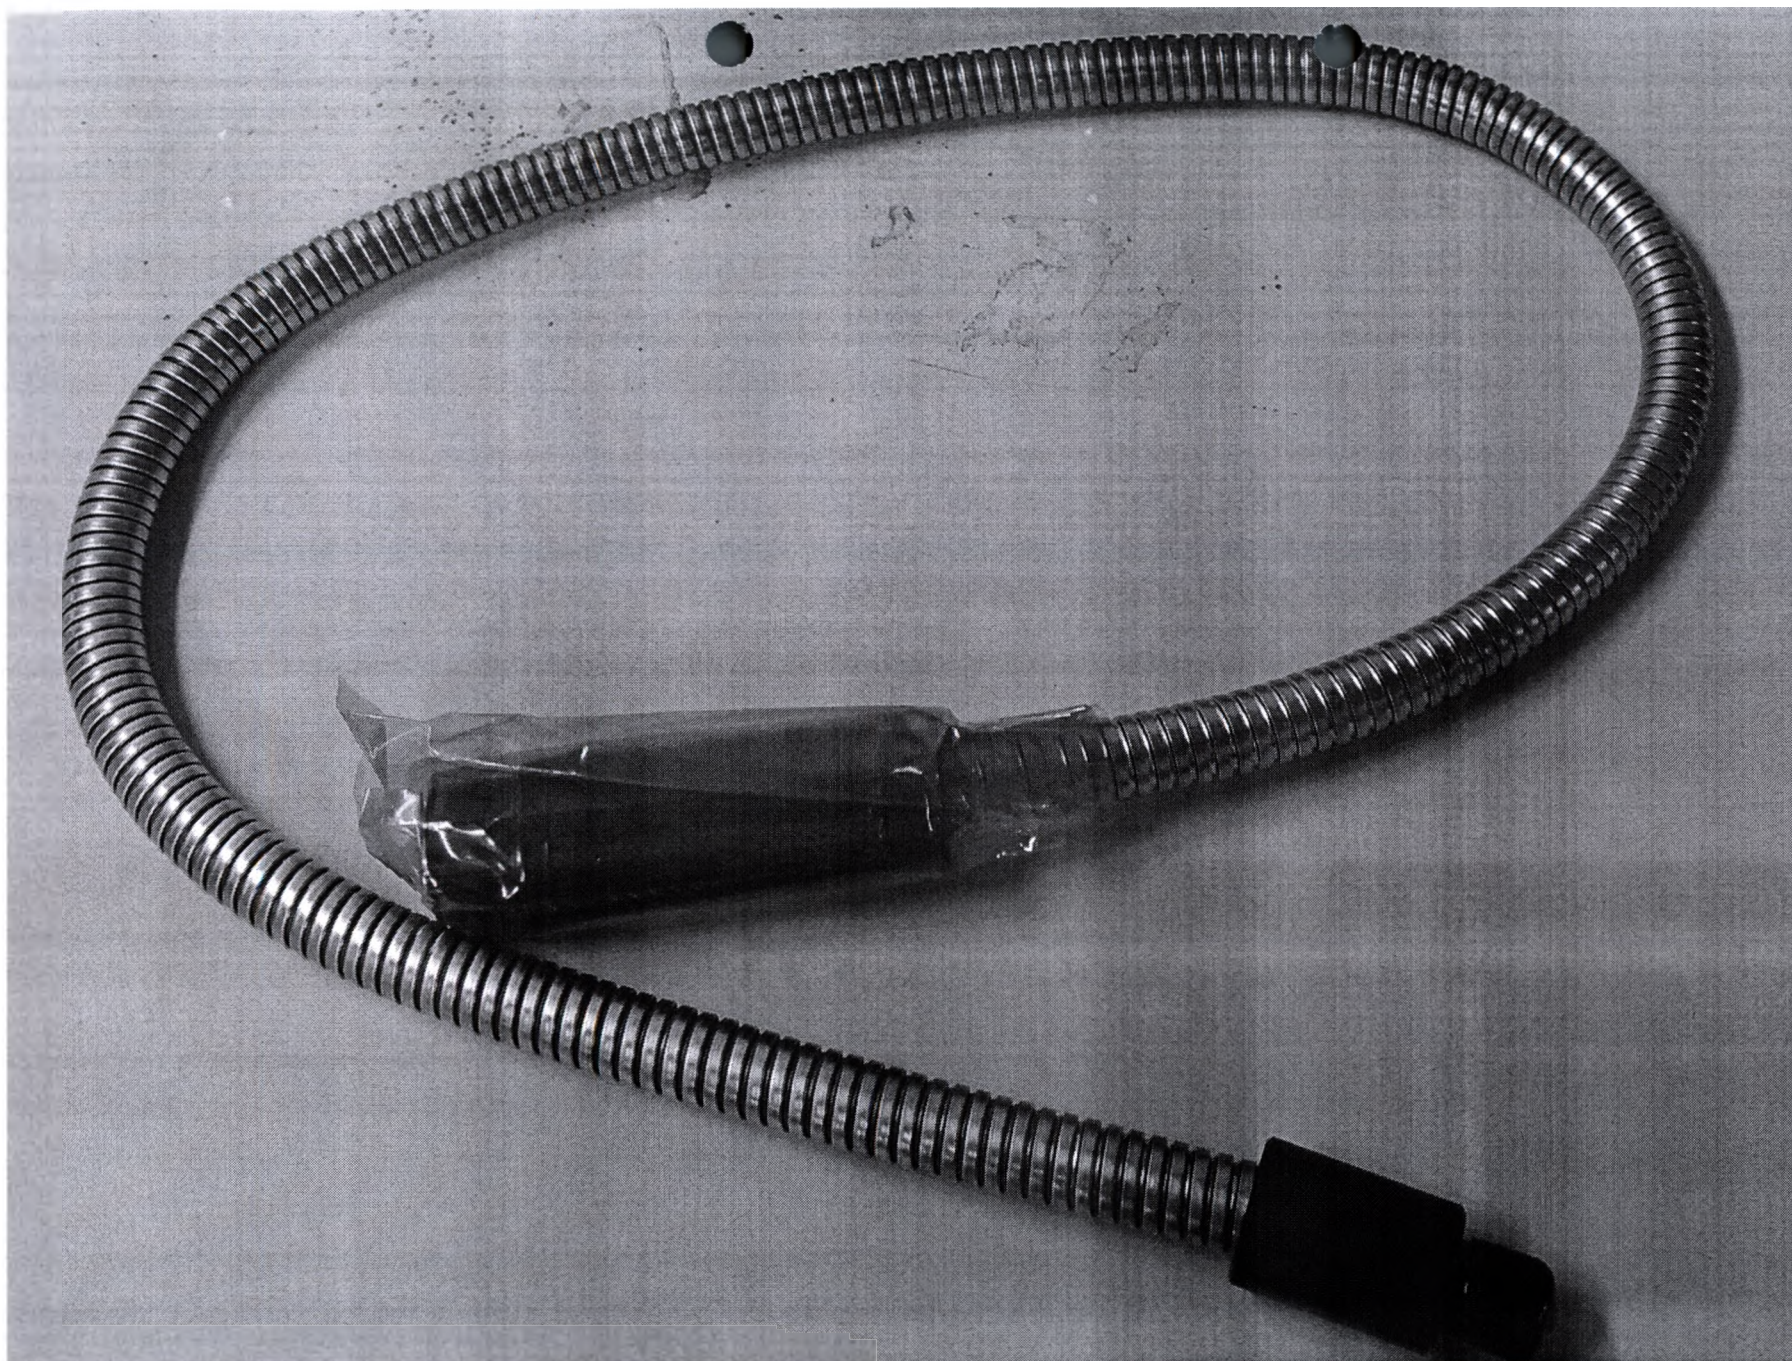


Рис.49 - Световод С-НГФИ15

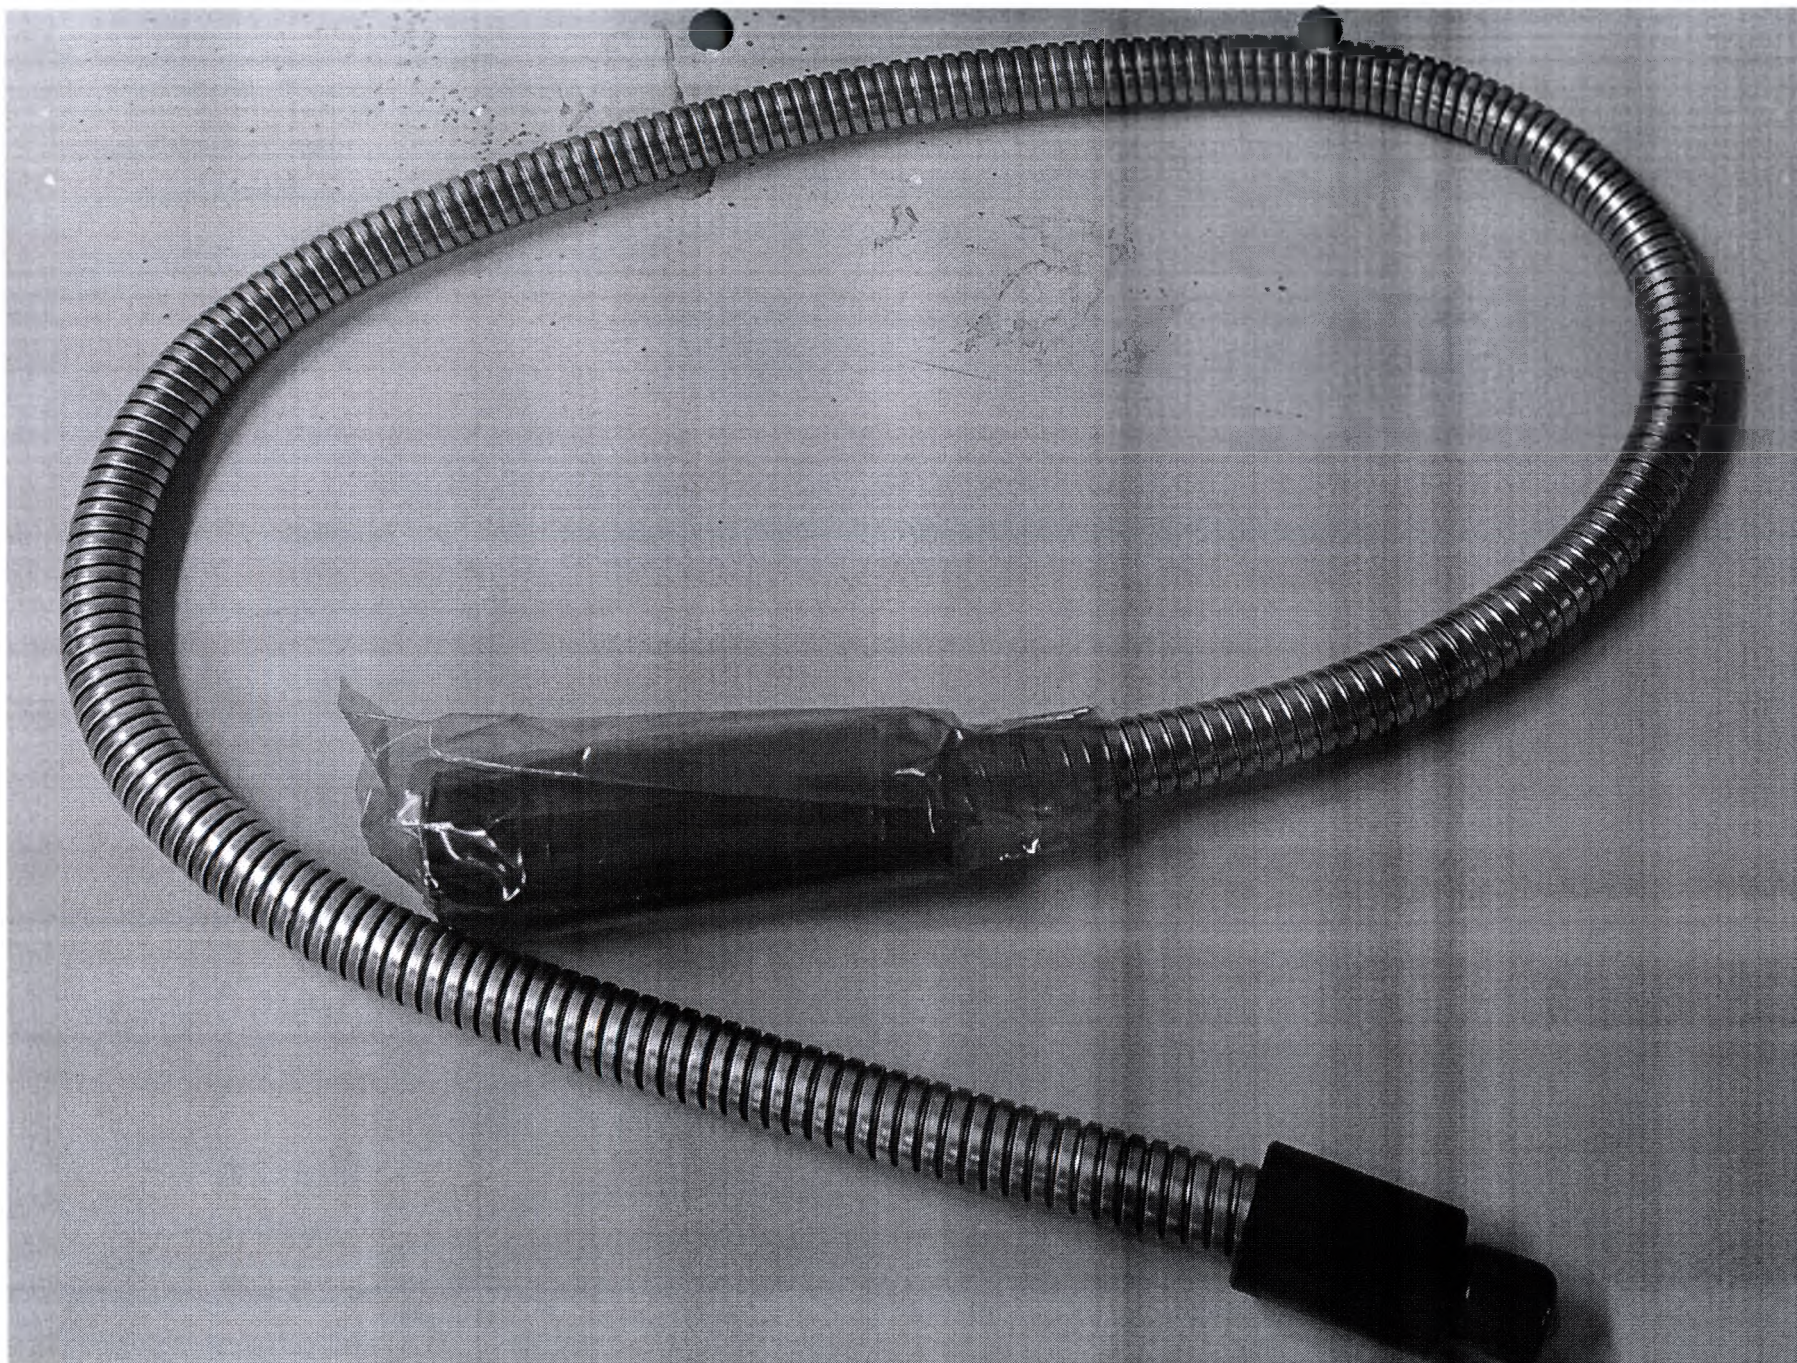


Рис.50 - Световод С-НГФИ30

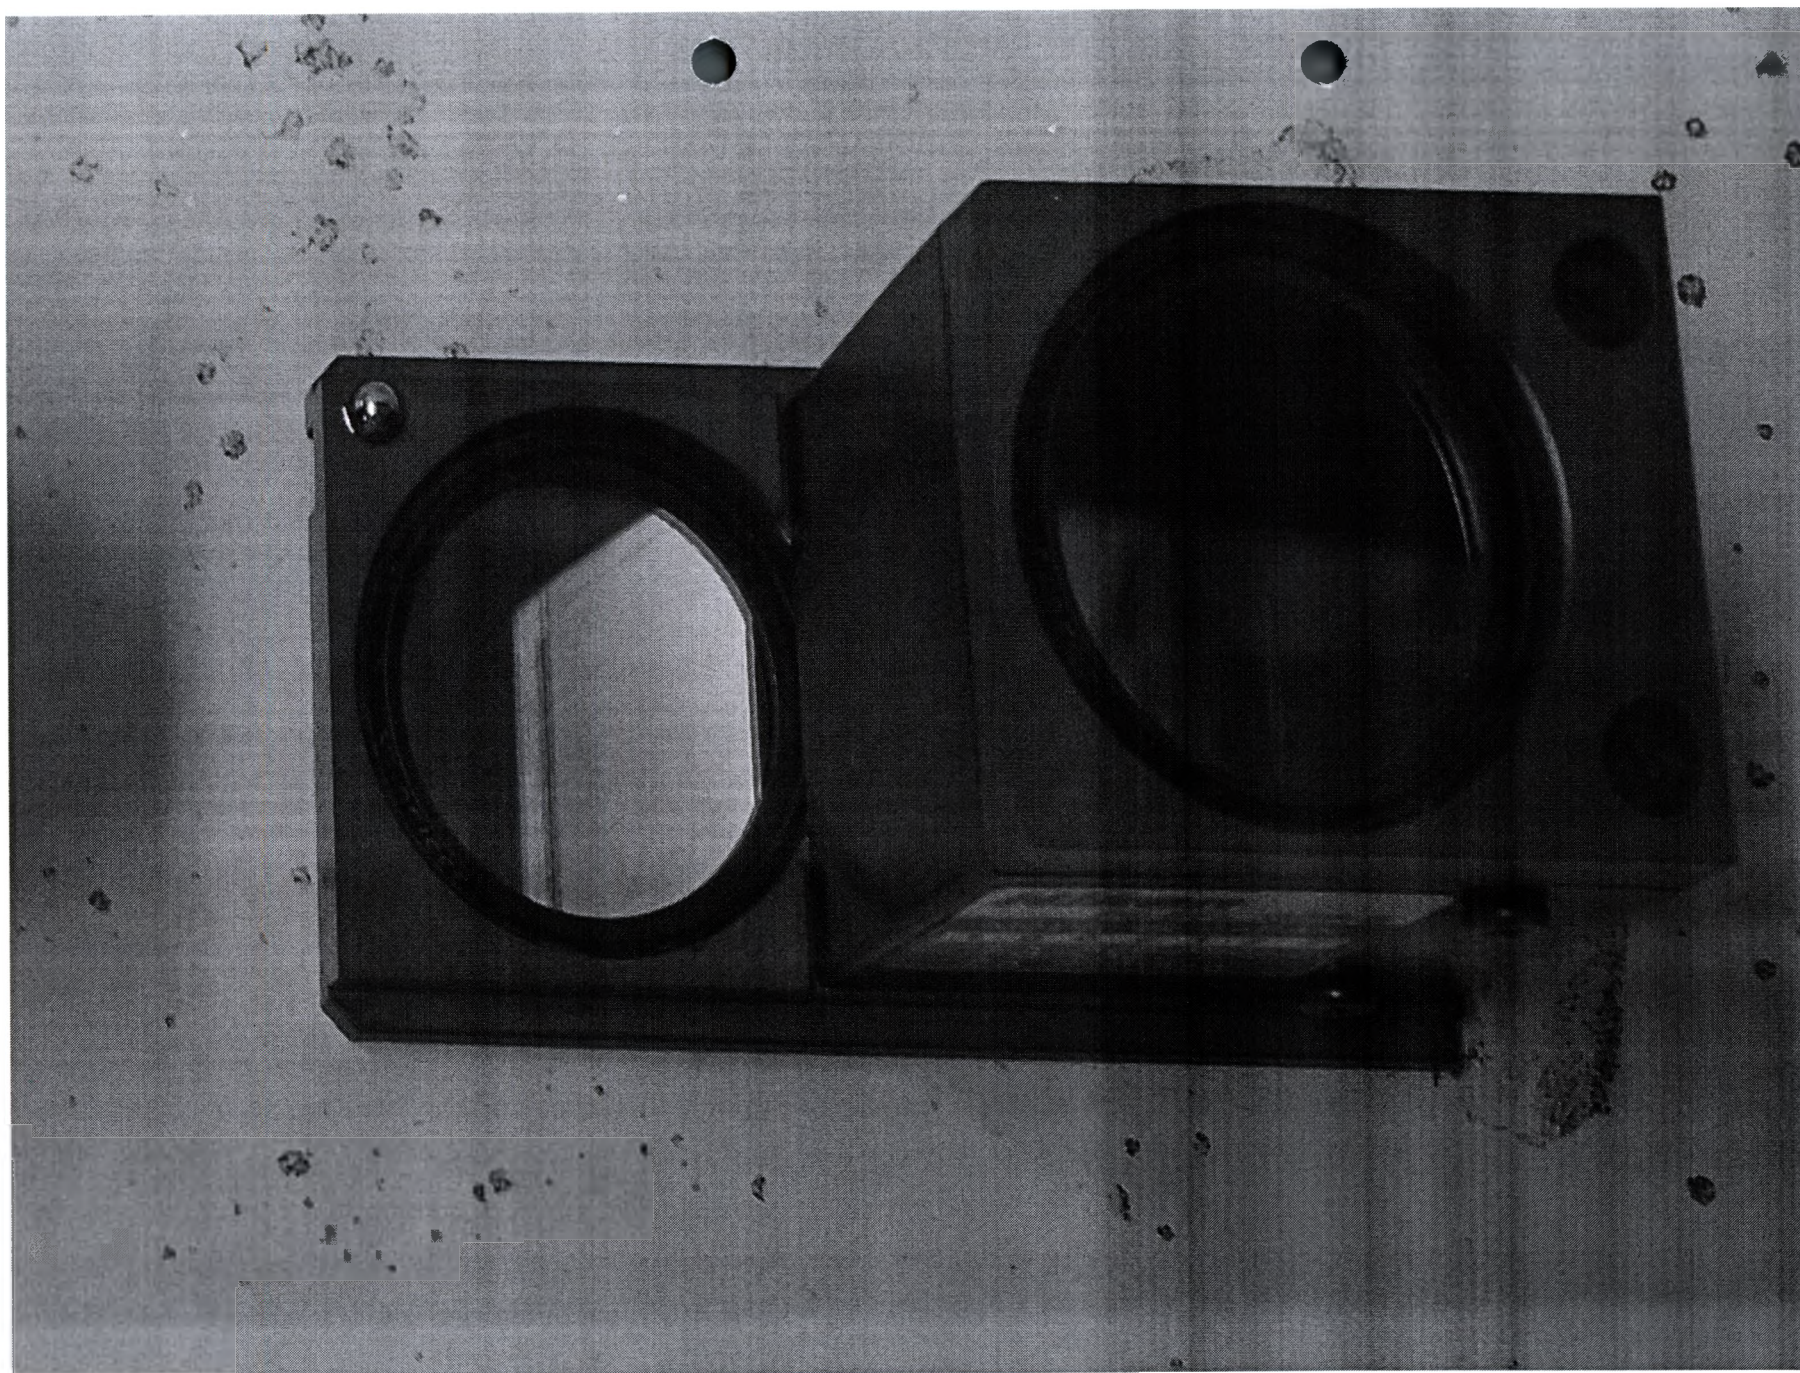


Рис.51 - Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров P2-EFL GFP-B

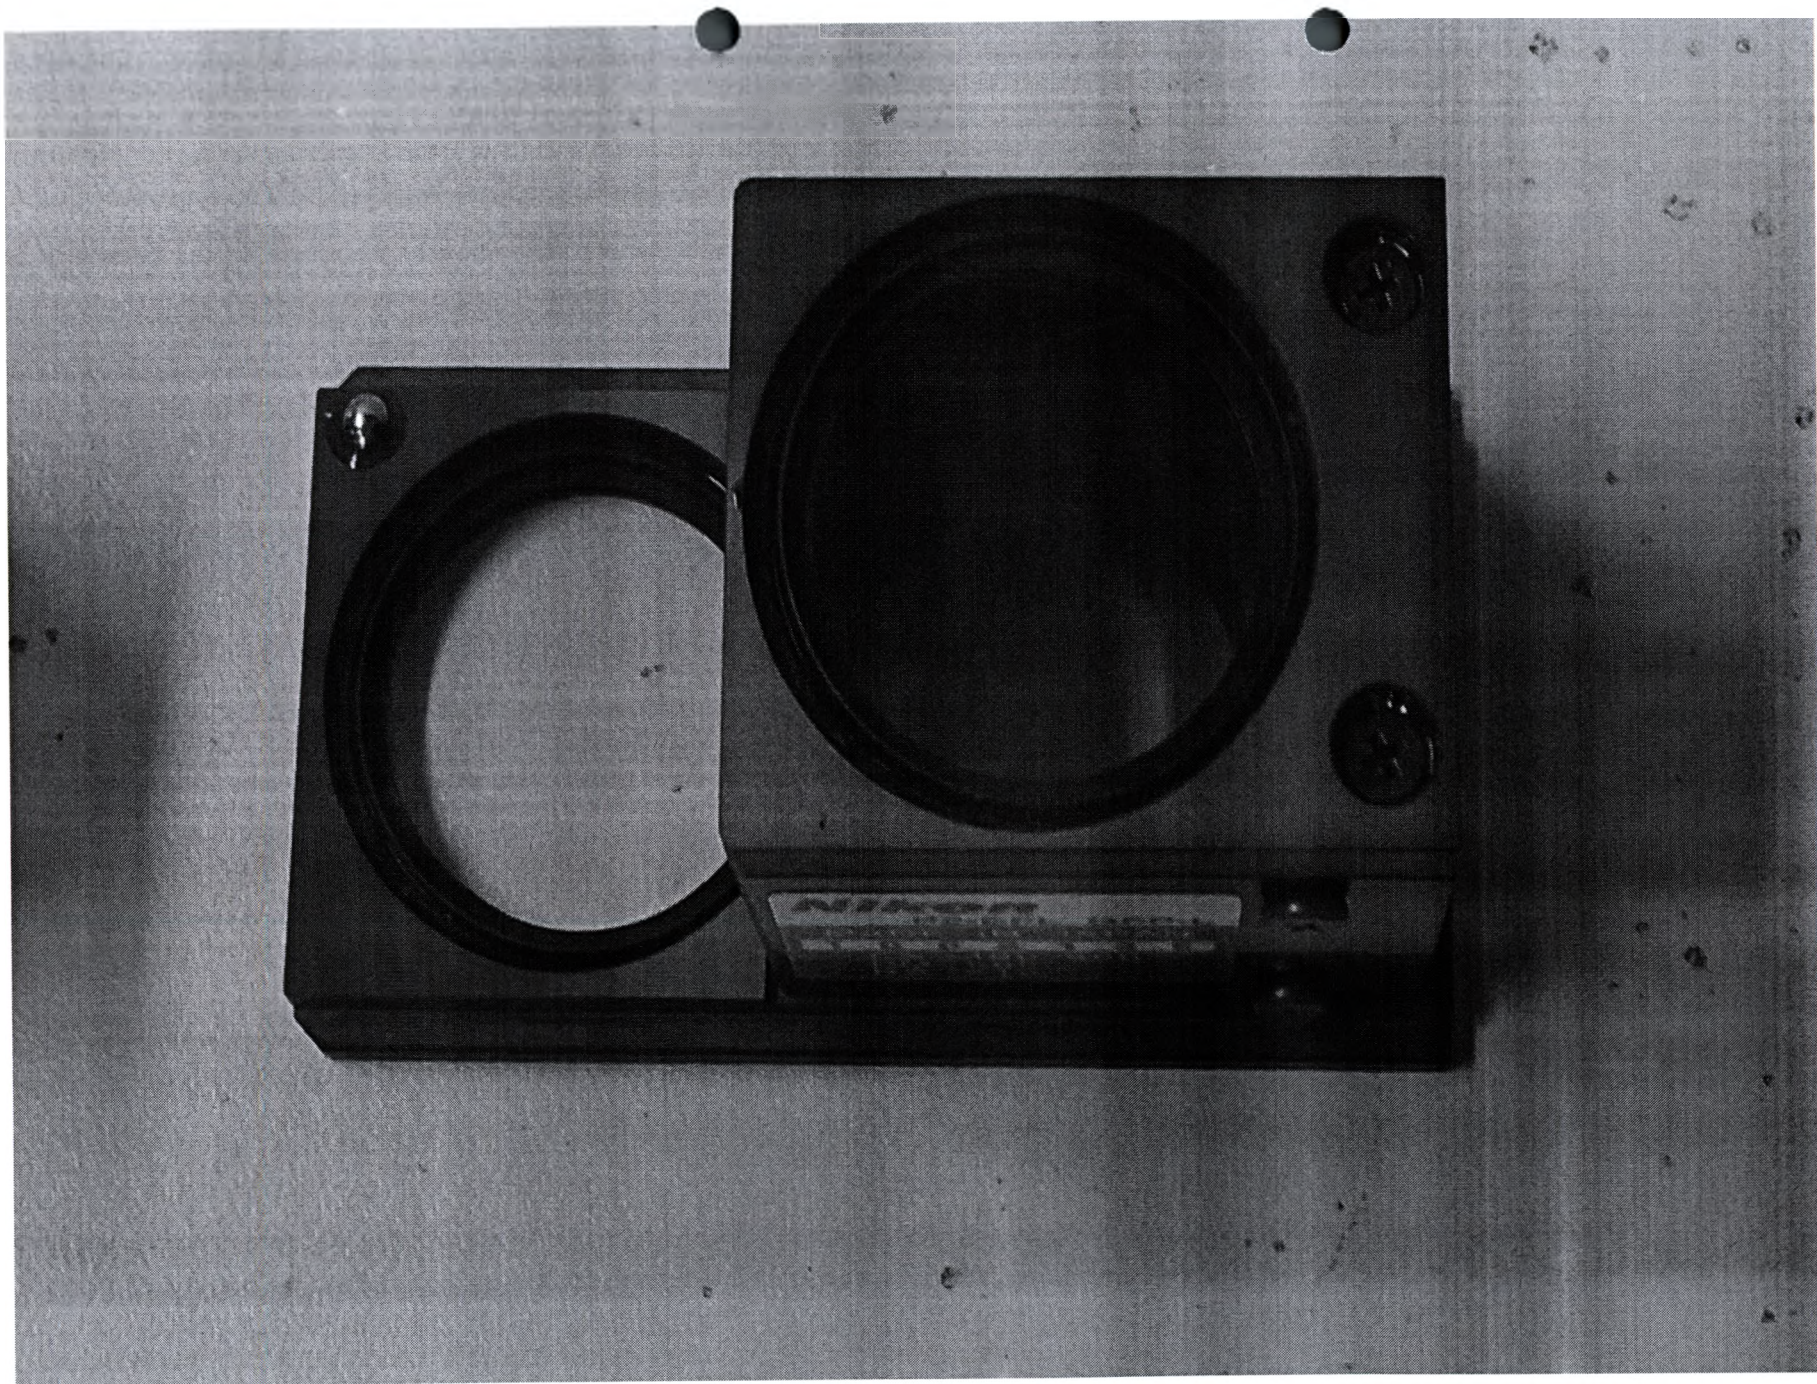


Рис.52 - Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров P2-EFL GFP-L

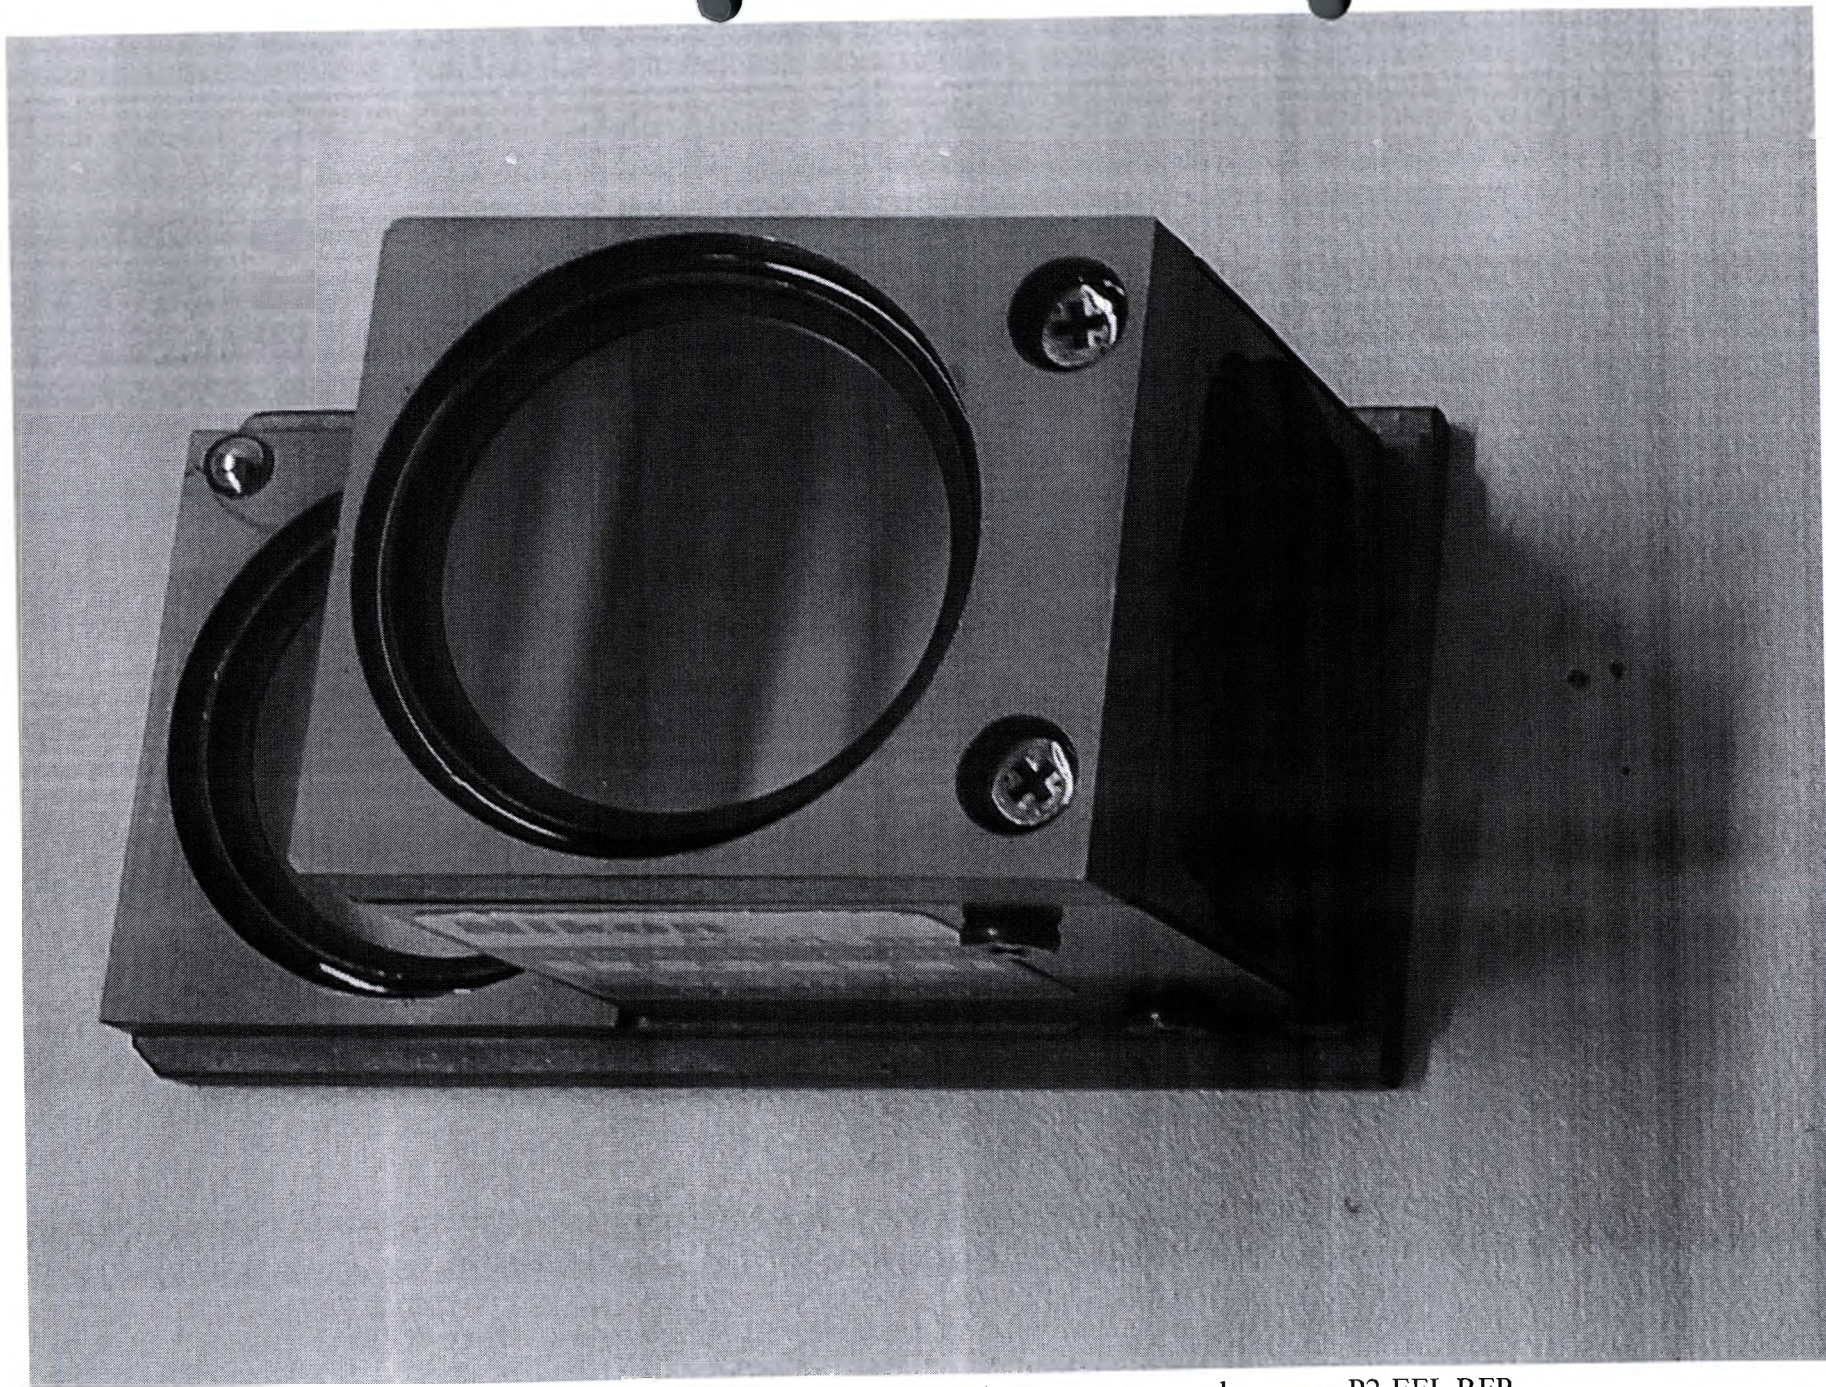


Рис.53 - Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров P2-EFL RFP

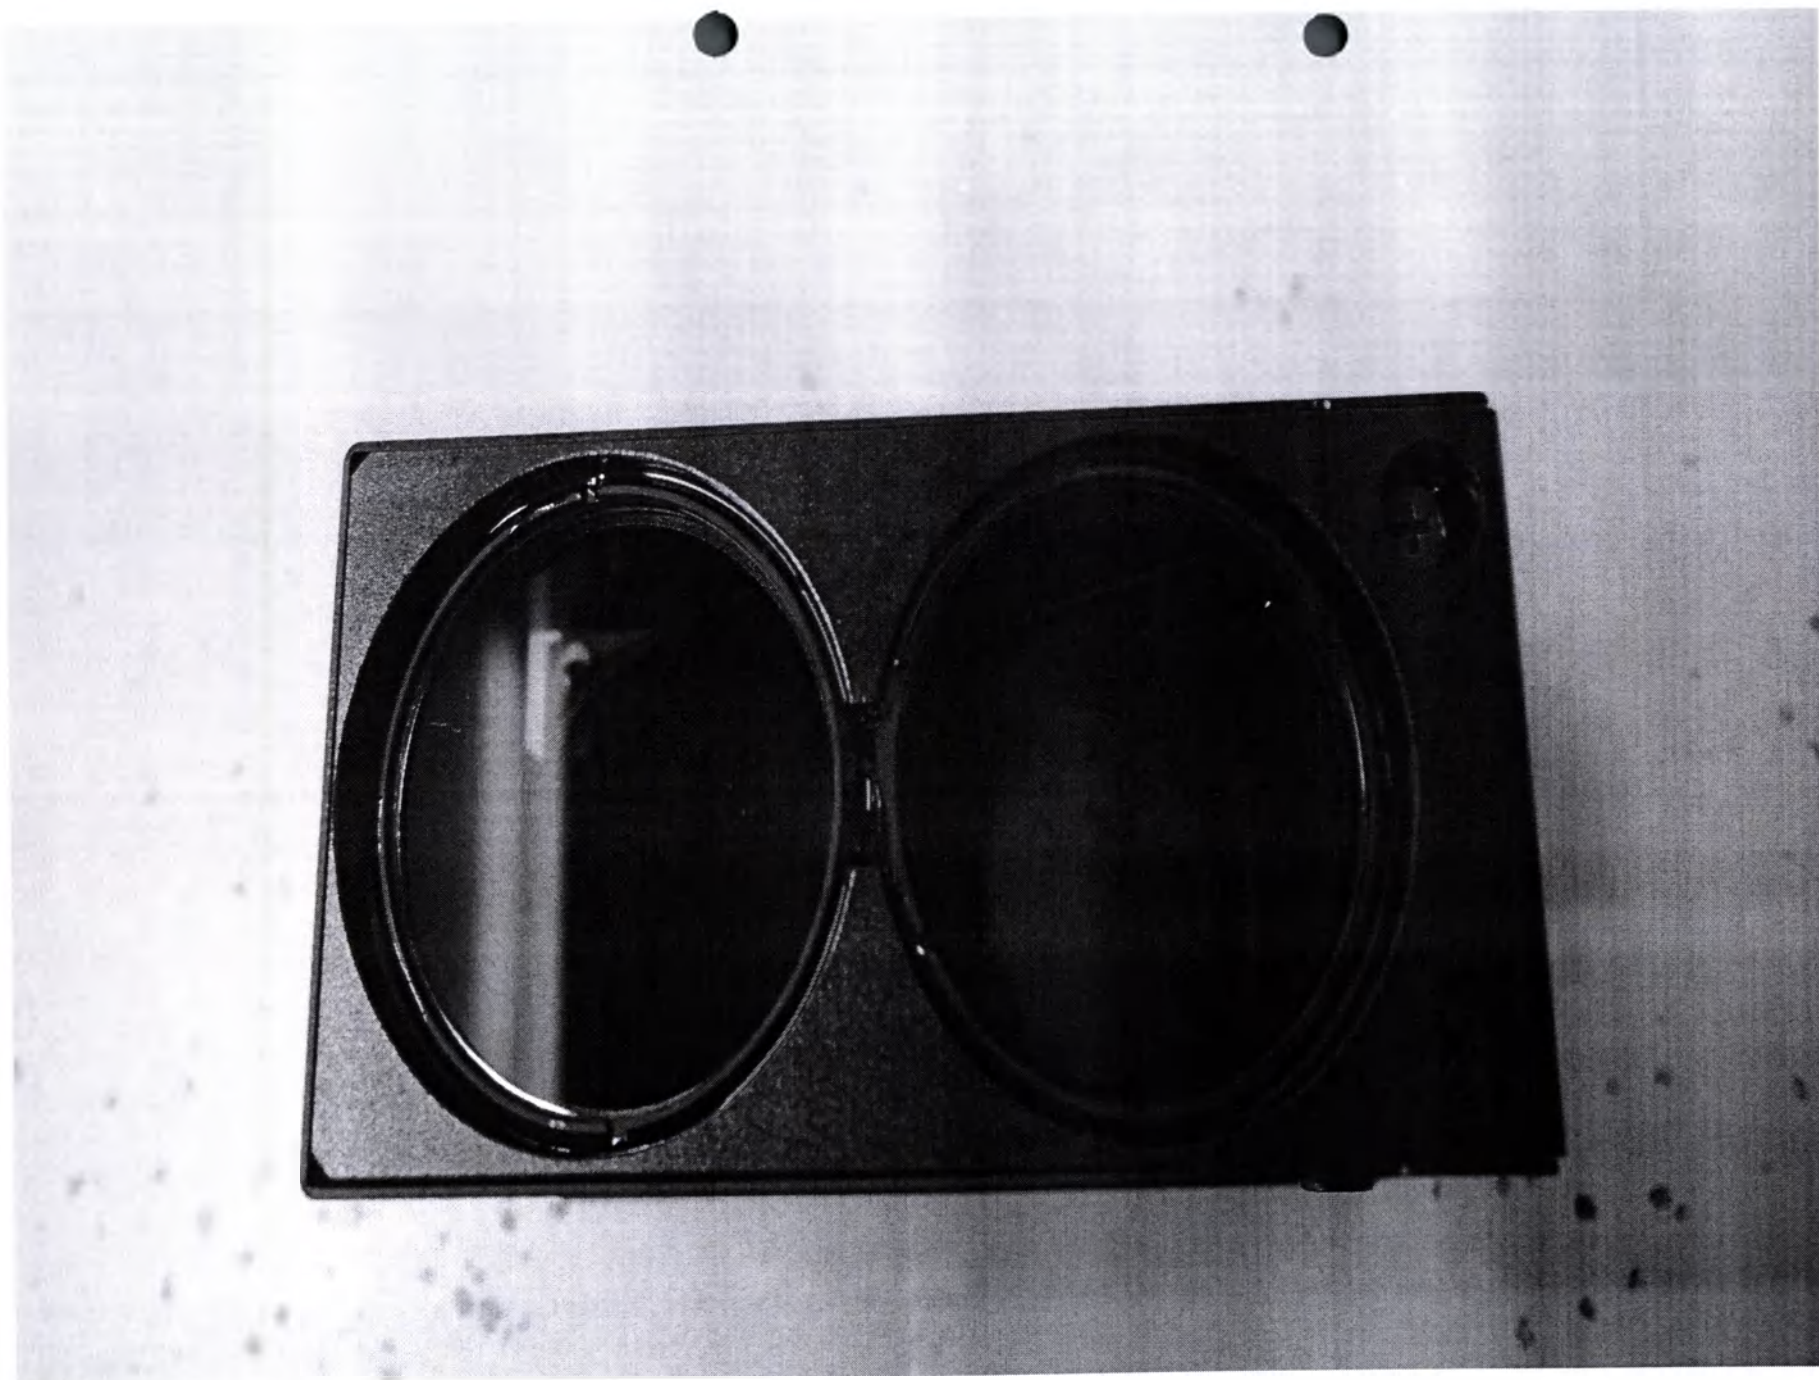


Рис.54 - Куб P2-EFLBF с полупрозрачным зеркалом для светлого поля

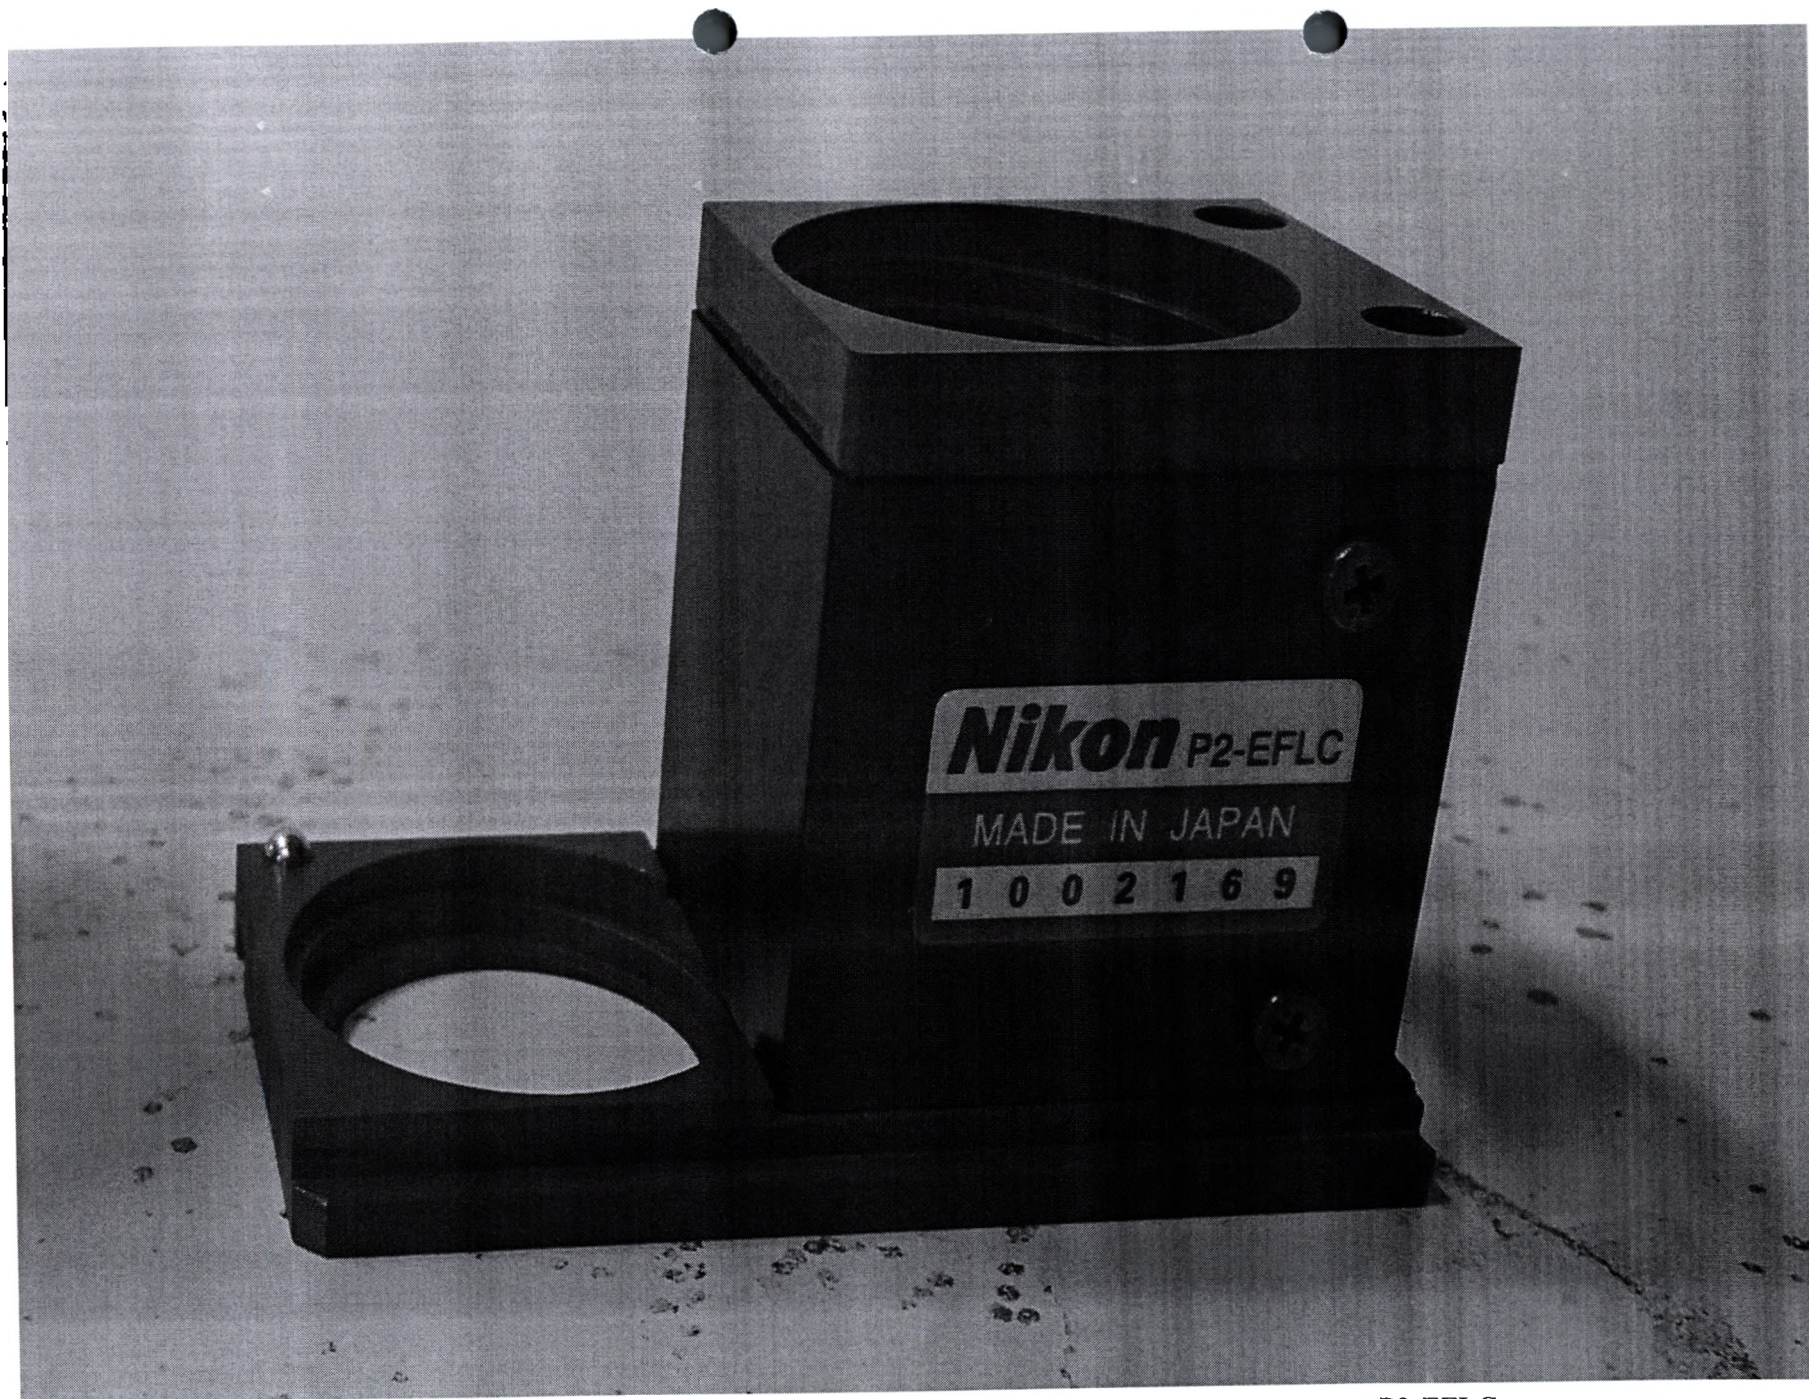


Рис.55 - Куб для крепления флуоресцентных фильтров P2-EFLC

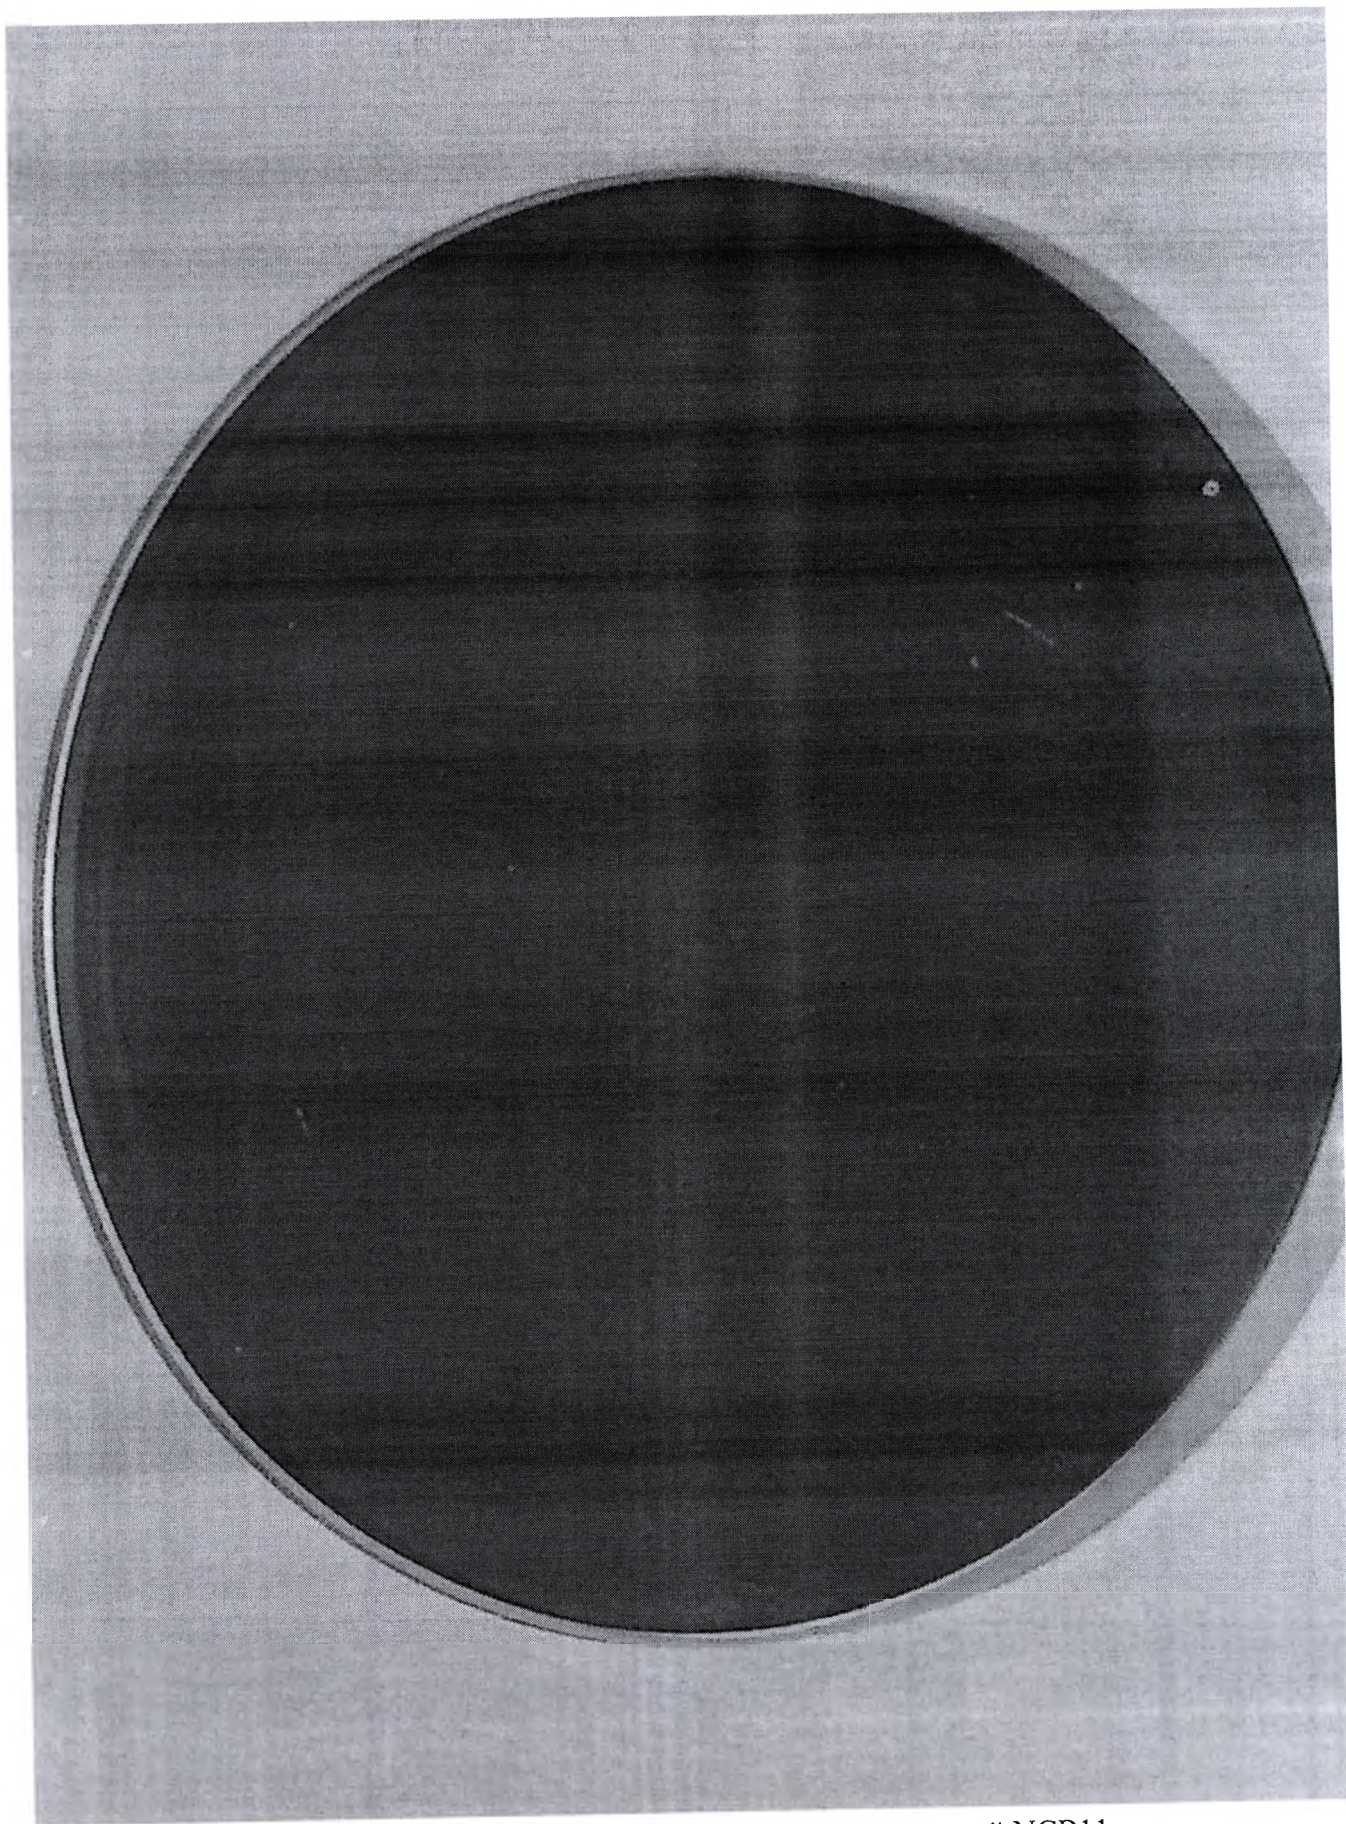


Рис.56 - Светофильтр цветокорректирующий компенсационный NCB11

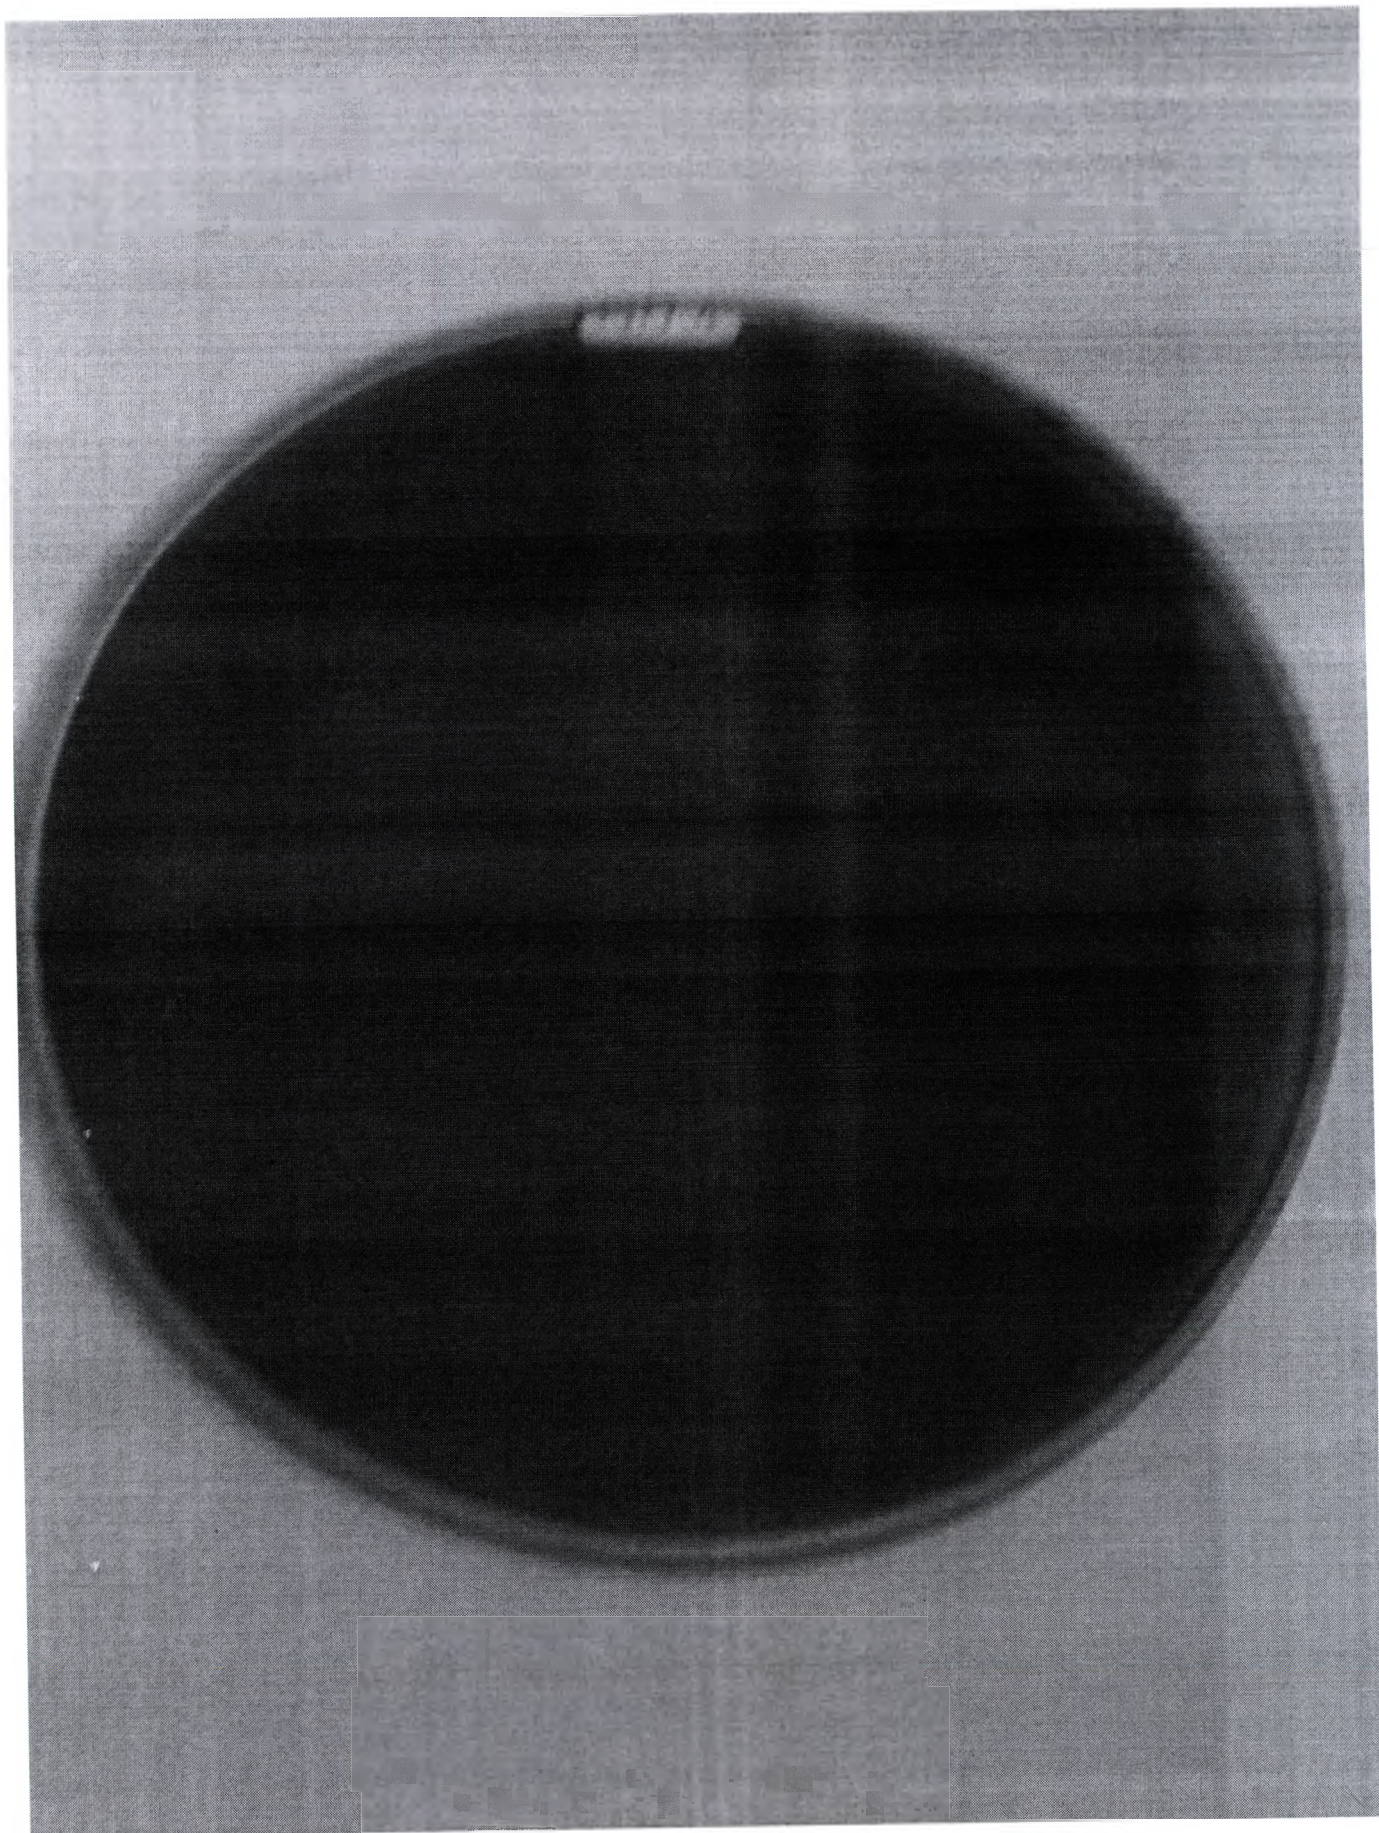


Рис.57 - Светофильтр нейтральный ND4

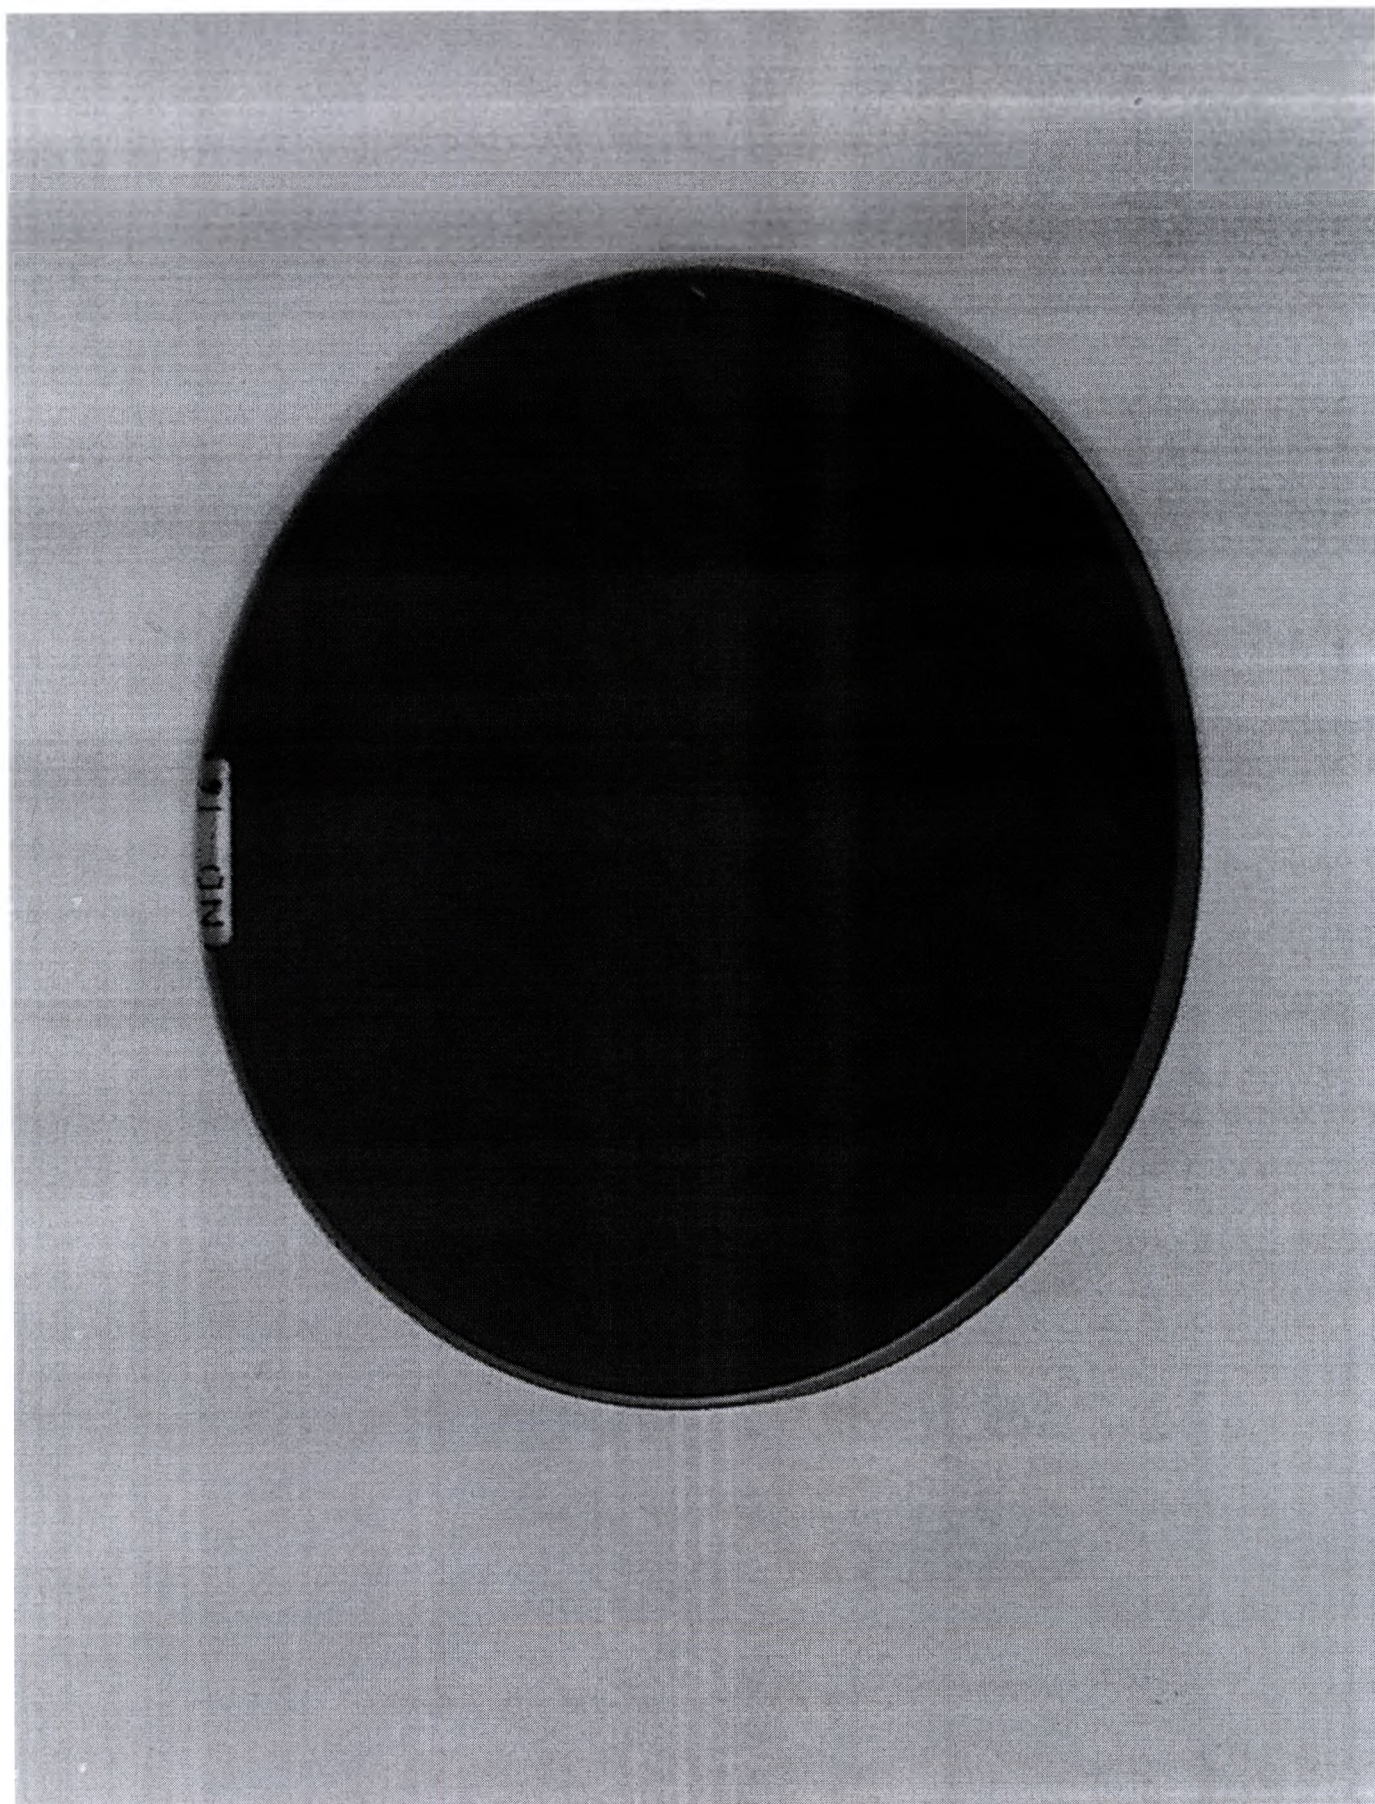


Рис.58 - Светофильтр нейтральный ND16



Рис.59 - Модуль темного поля светодиодный P-DF LED.

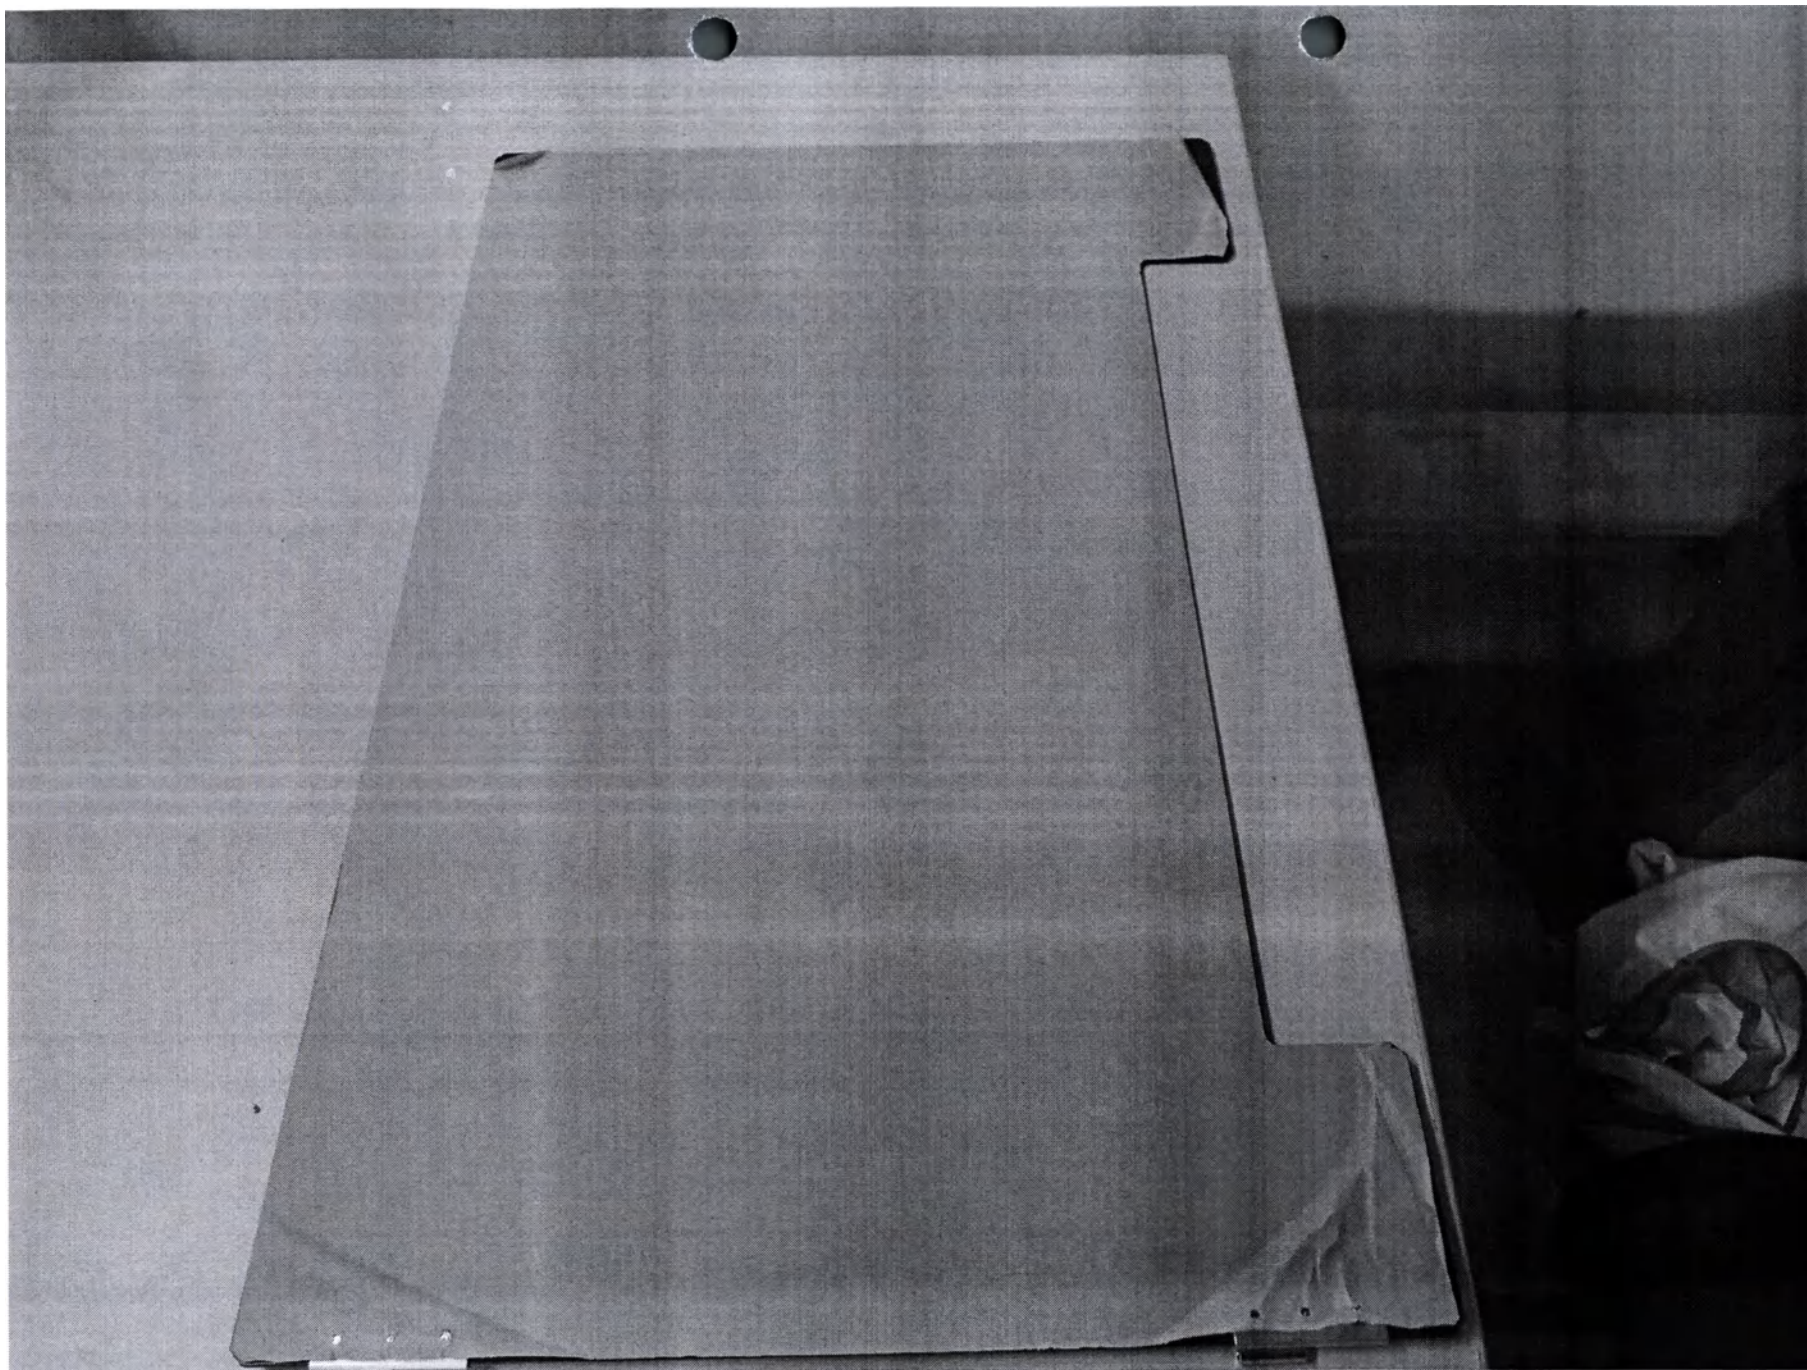


Рис.60 - Экран защитный P-DF

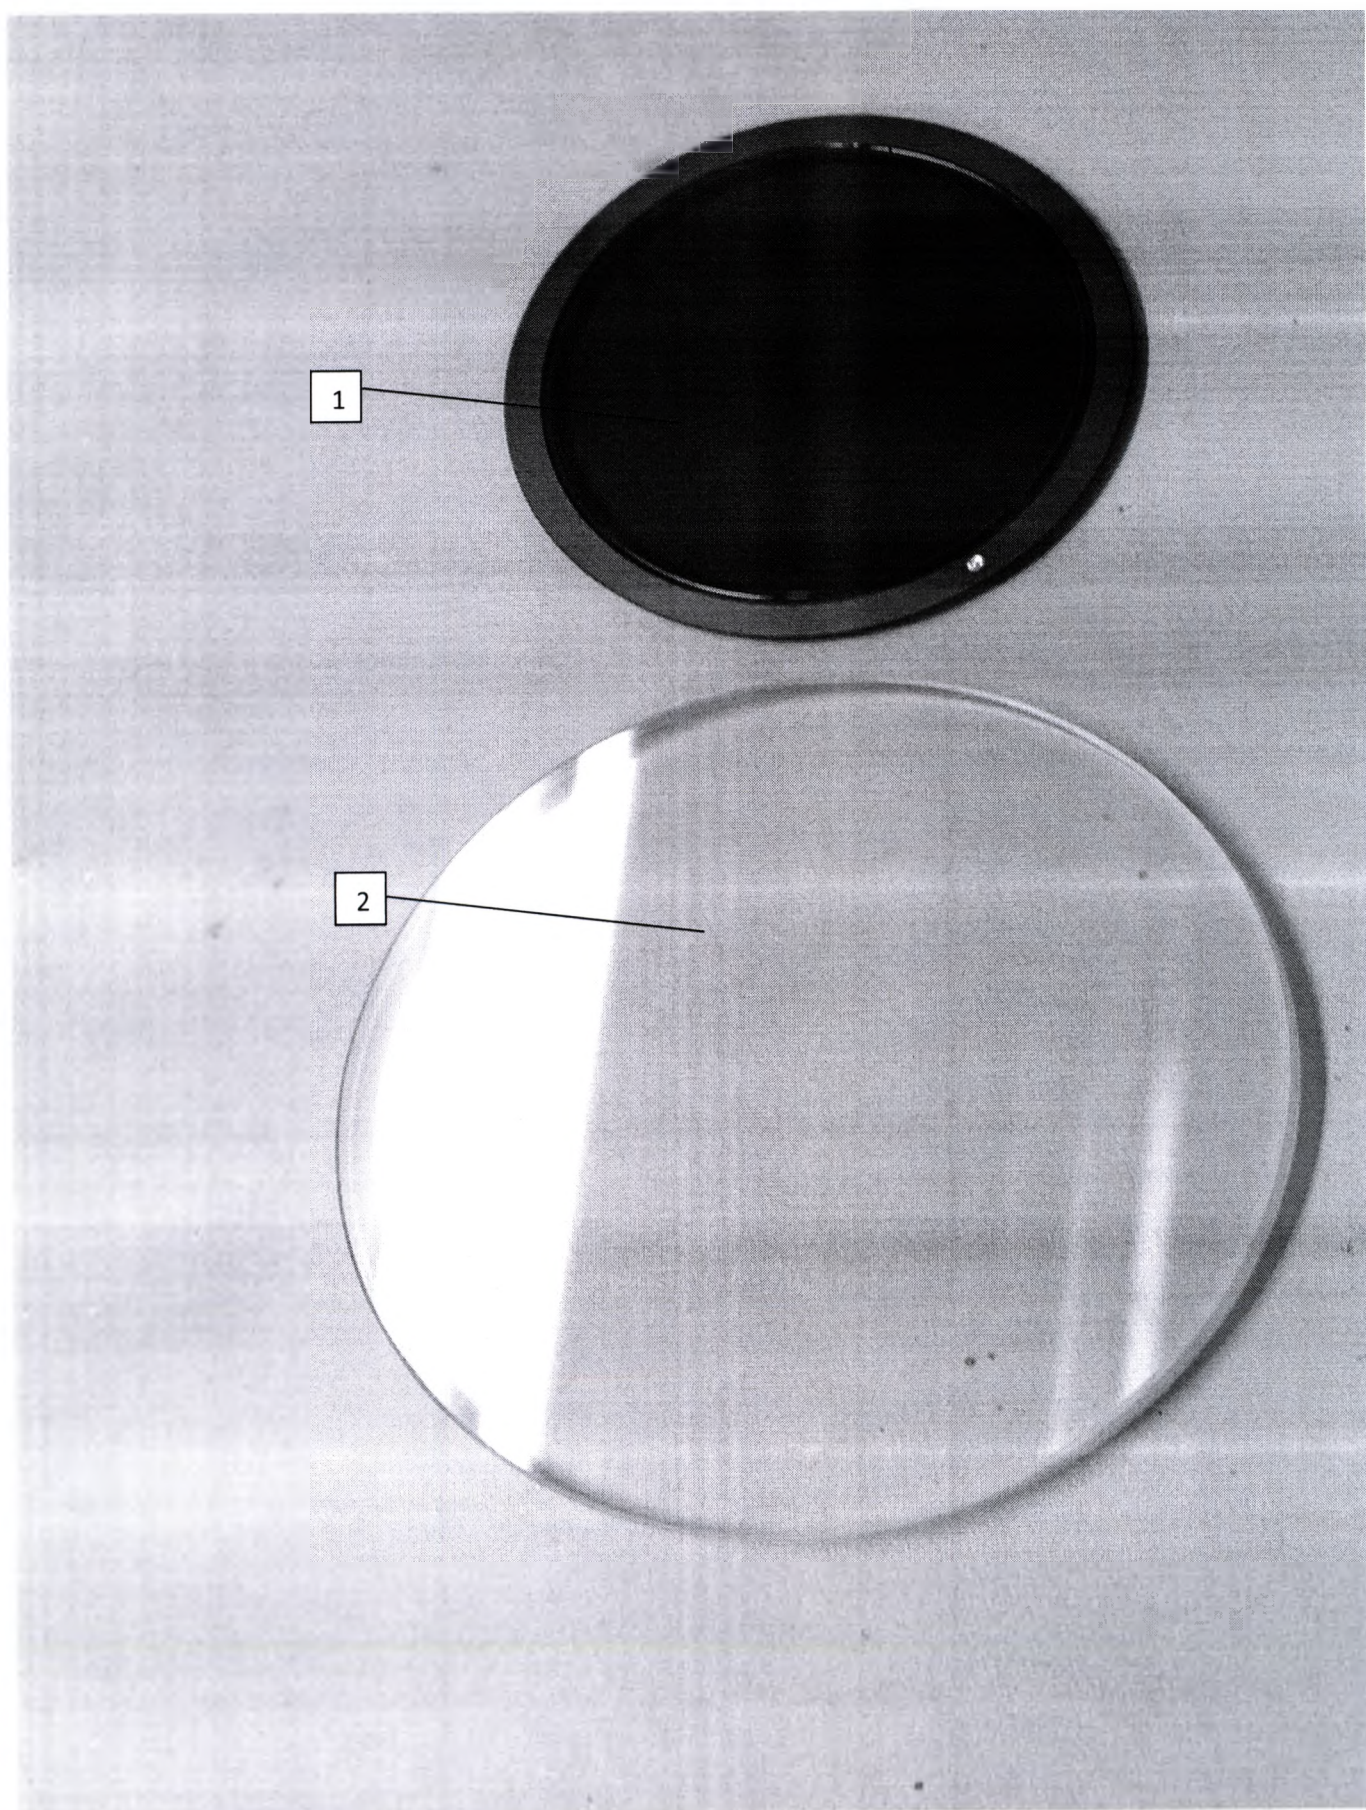


Рис.61 - Набор P2-POL для простой поляризации в составе:
1. поляризатор; 2.анализатор.

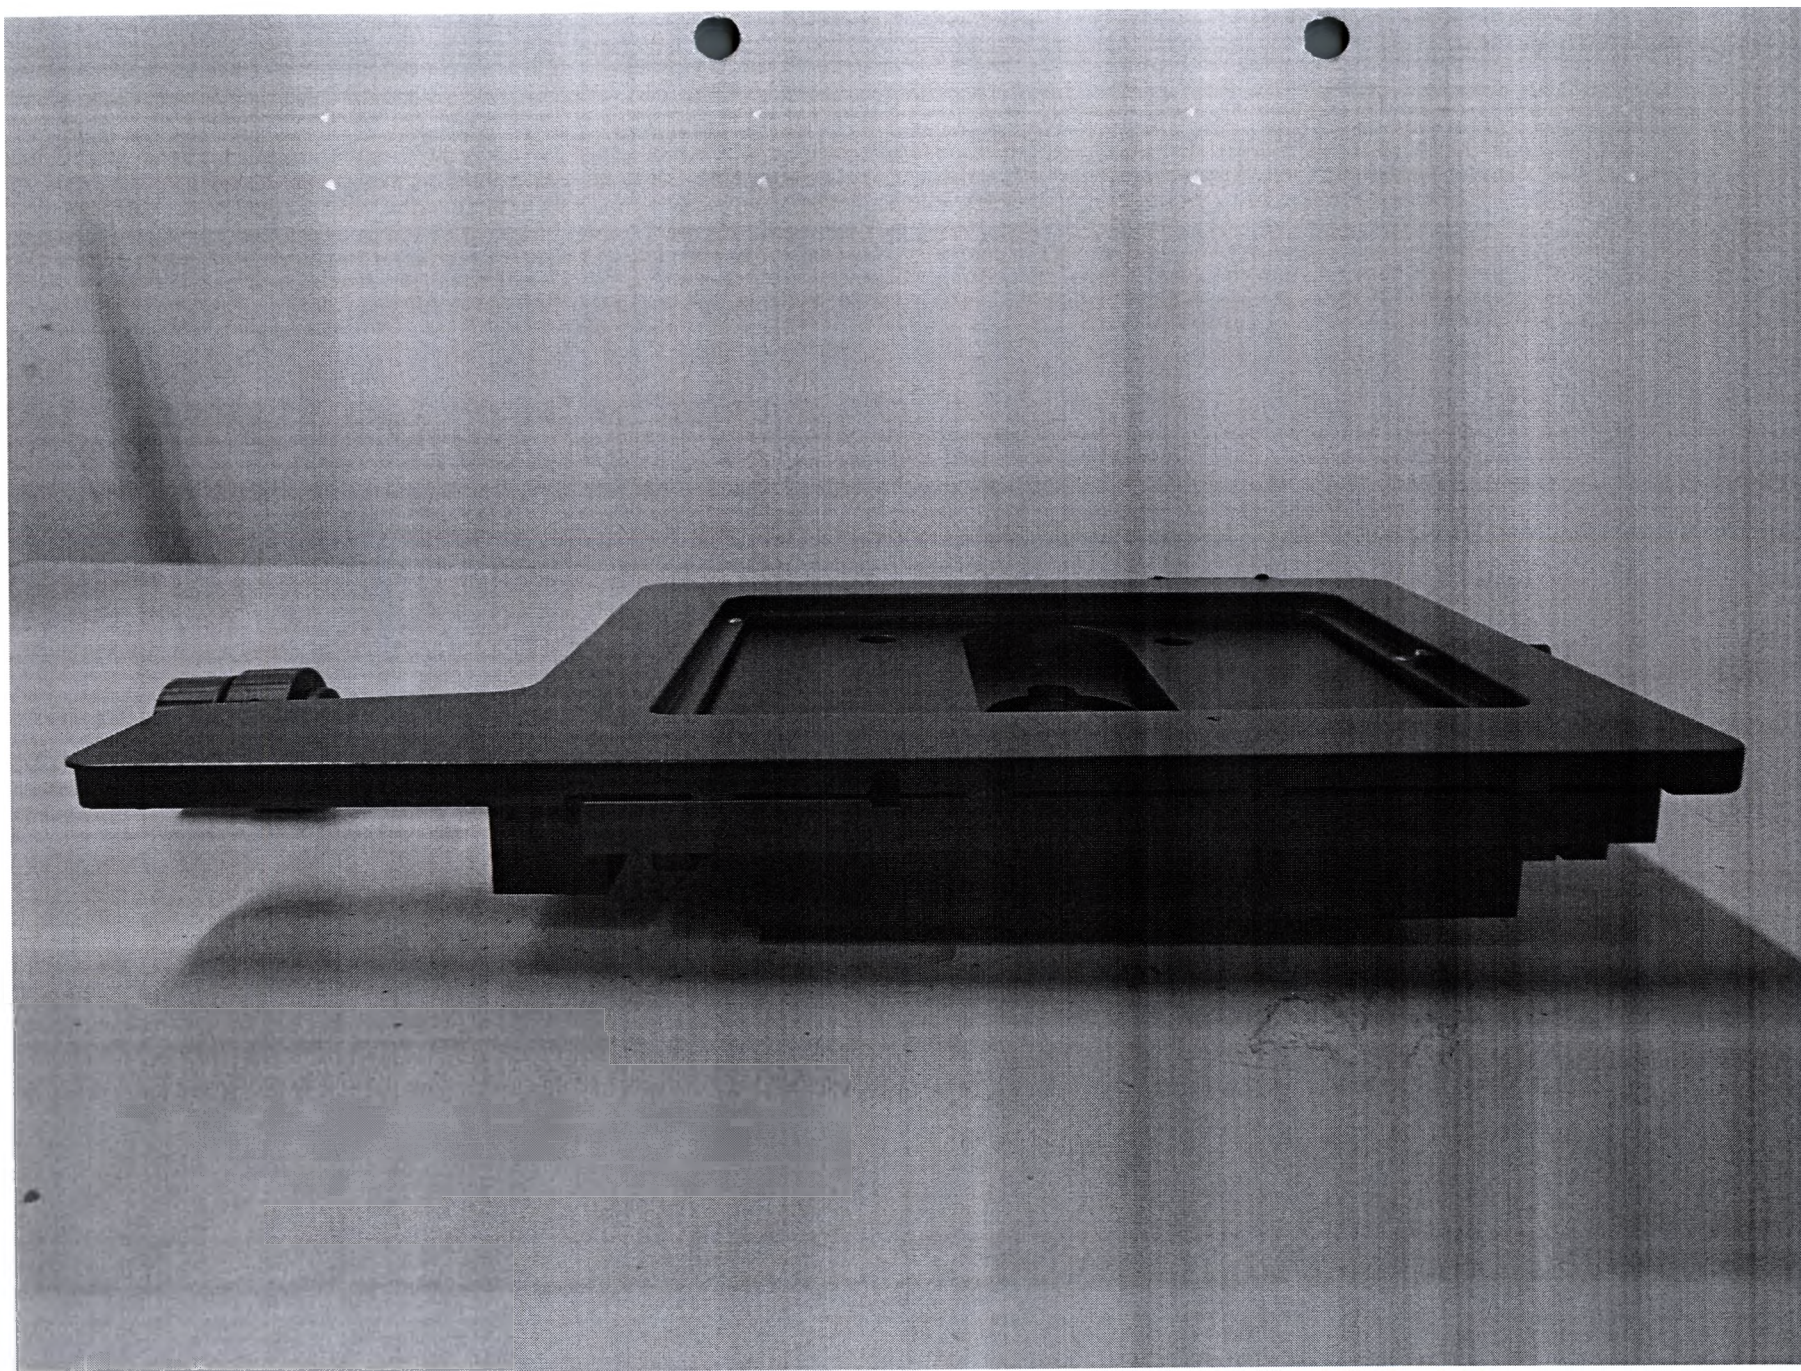


Рис.62 - Столик предметный P-SXY46

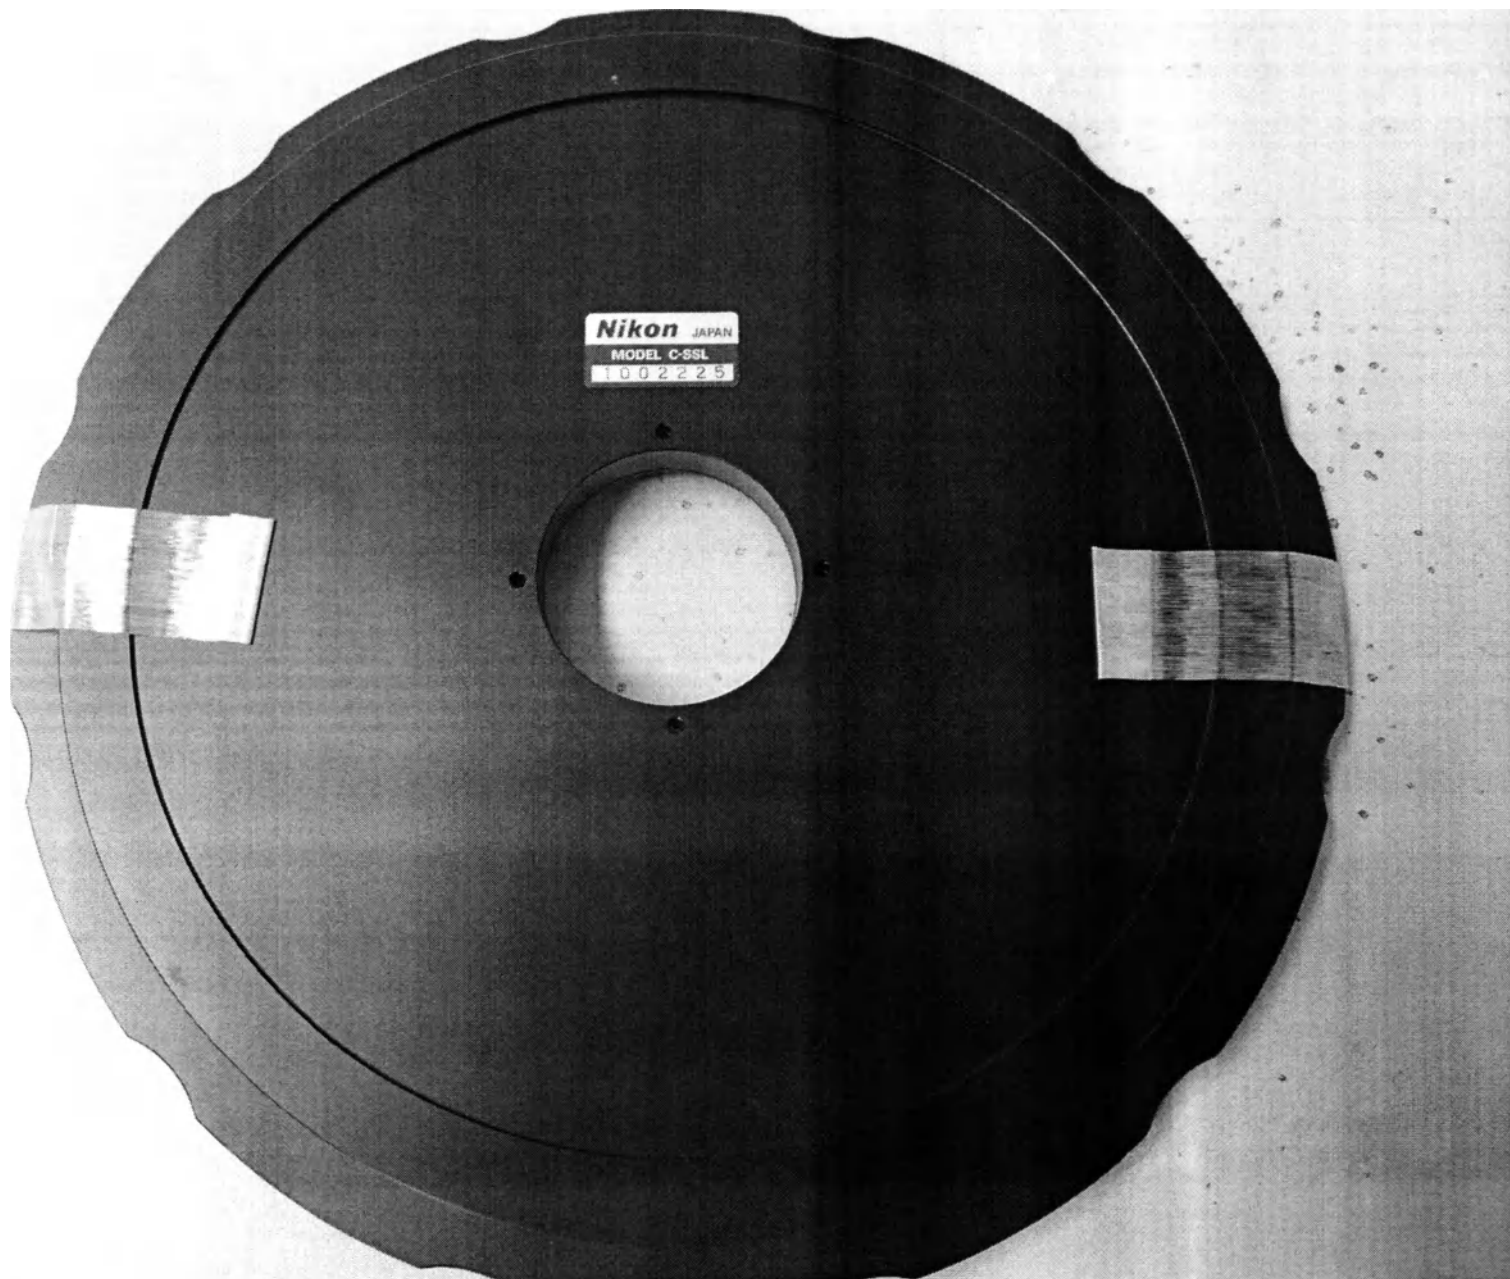


Рис.63 - Столик скользящий C-SSL DIA

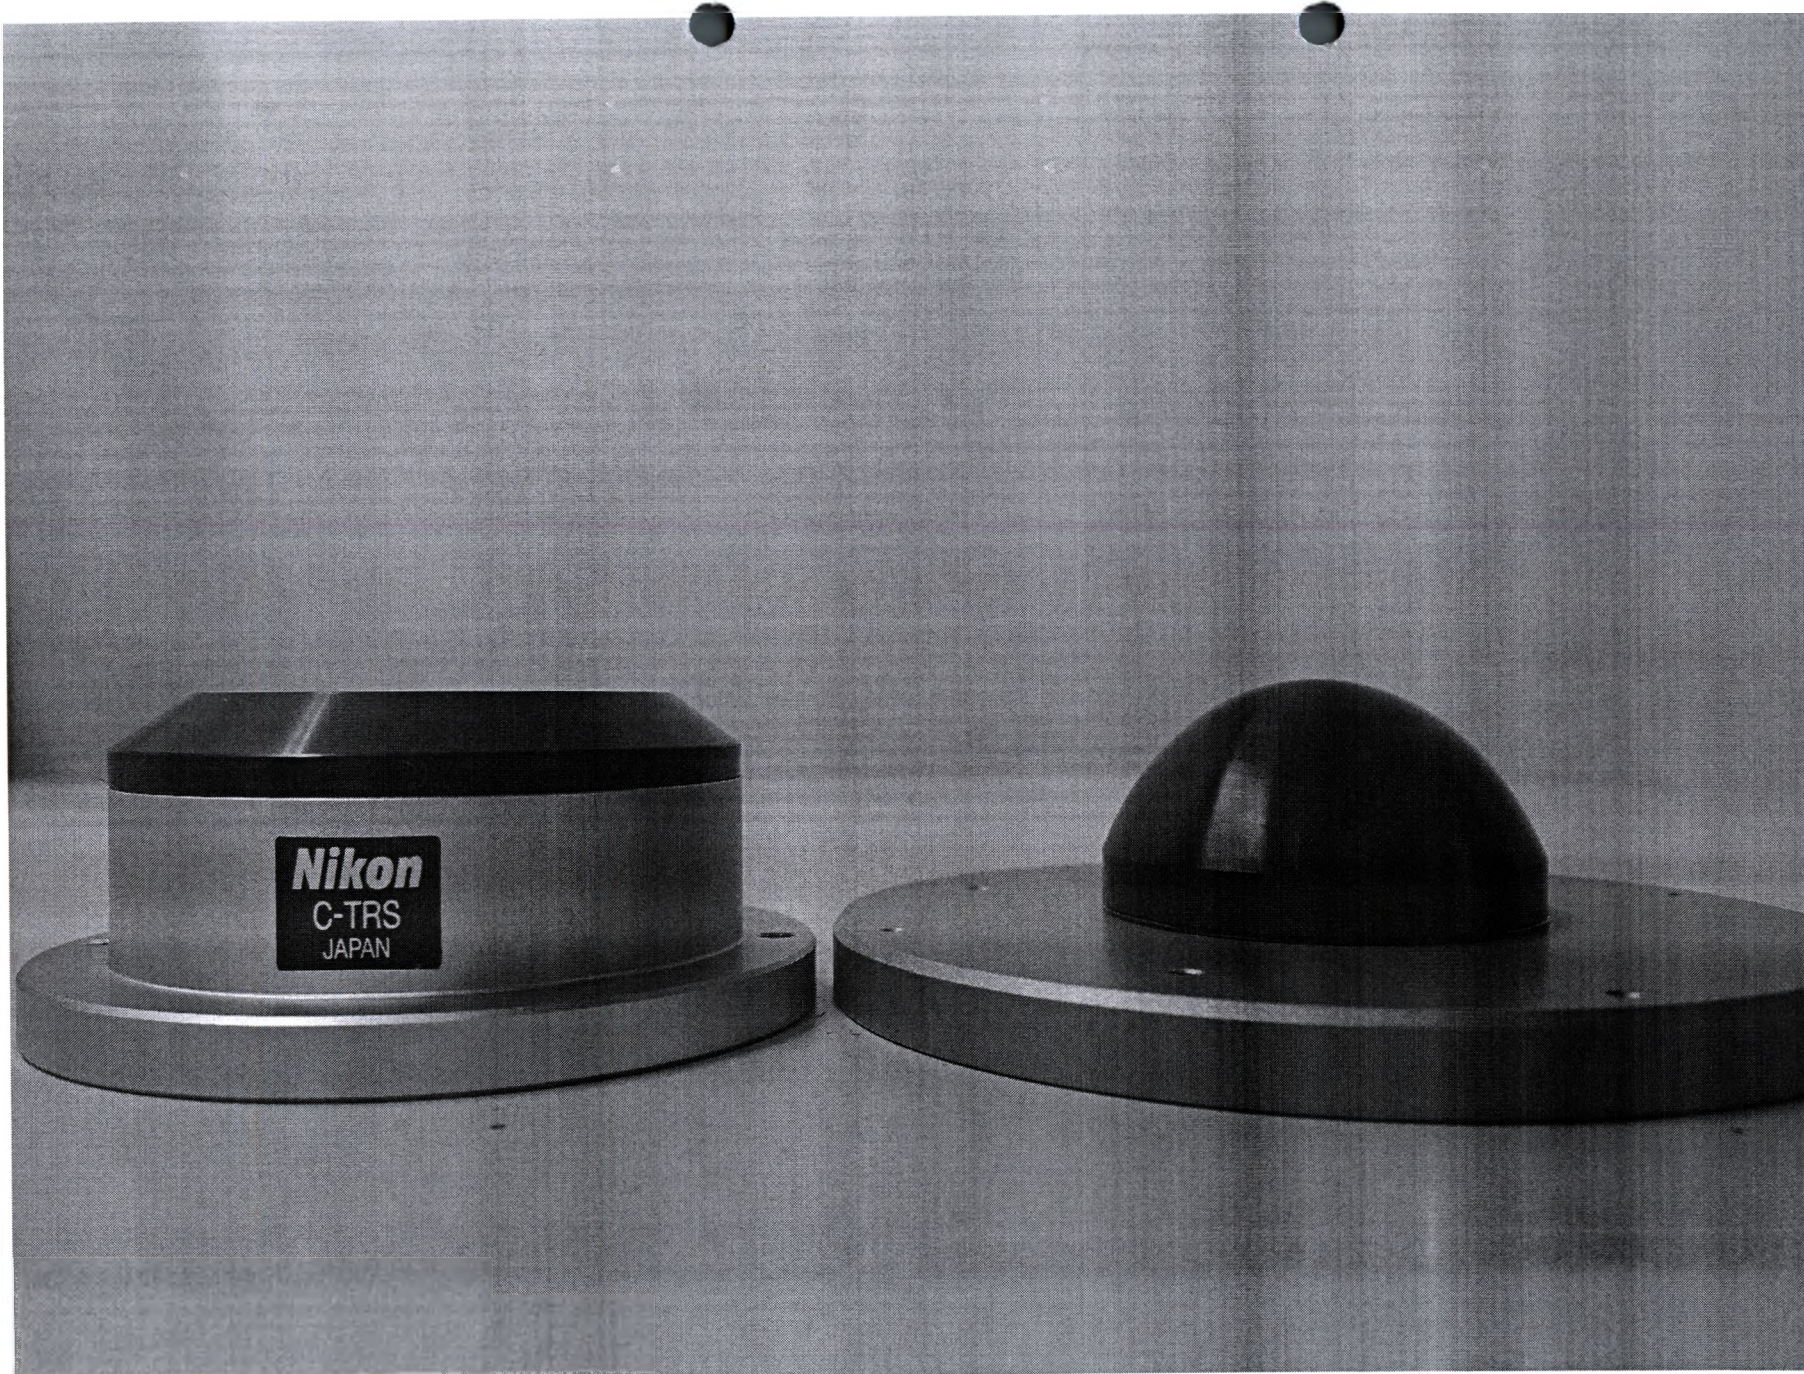


Рис.64 - Столик наклоняемый C-TRS

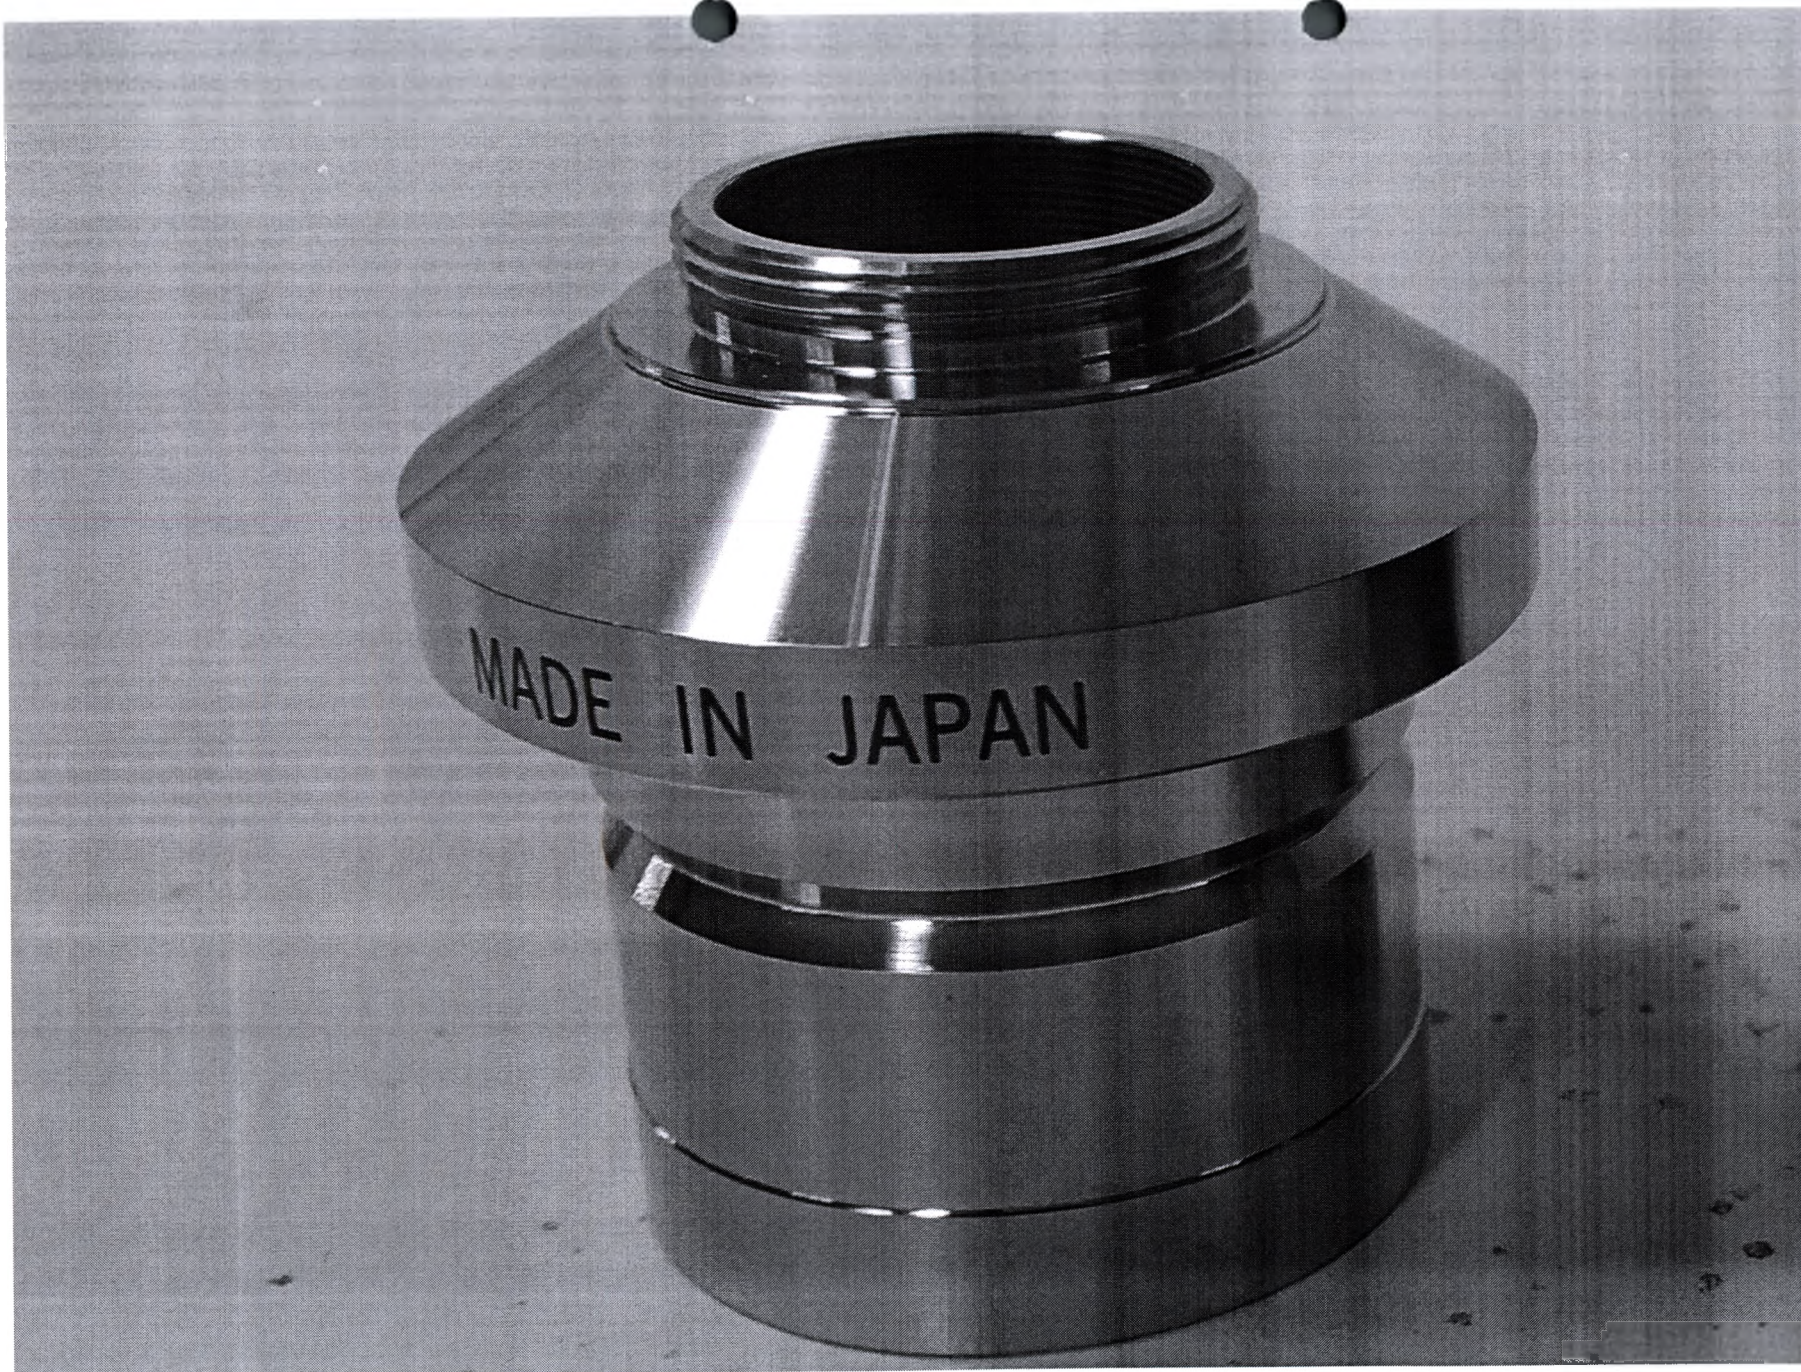


Рис.65 - C-mount TV адаптер А



Рис.66 - C-mount адаптер 0.55x

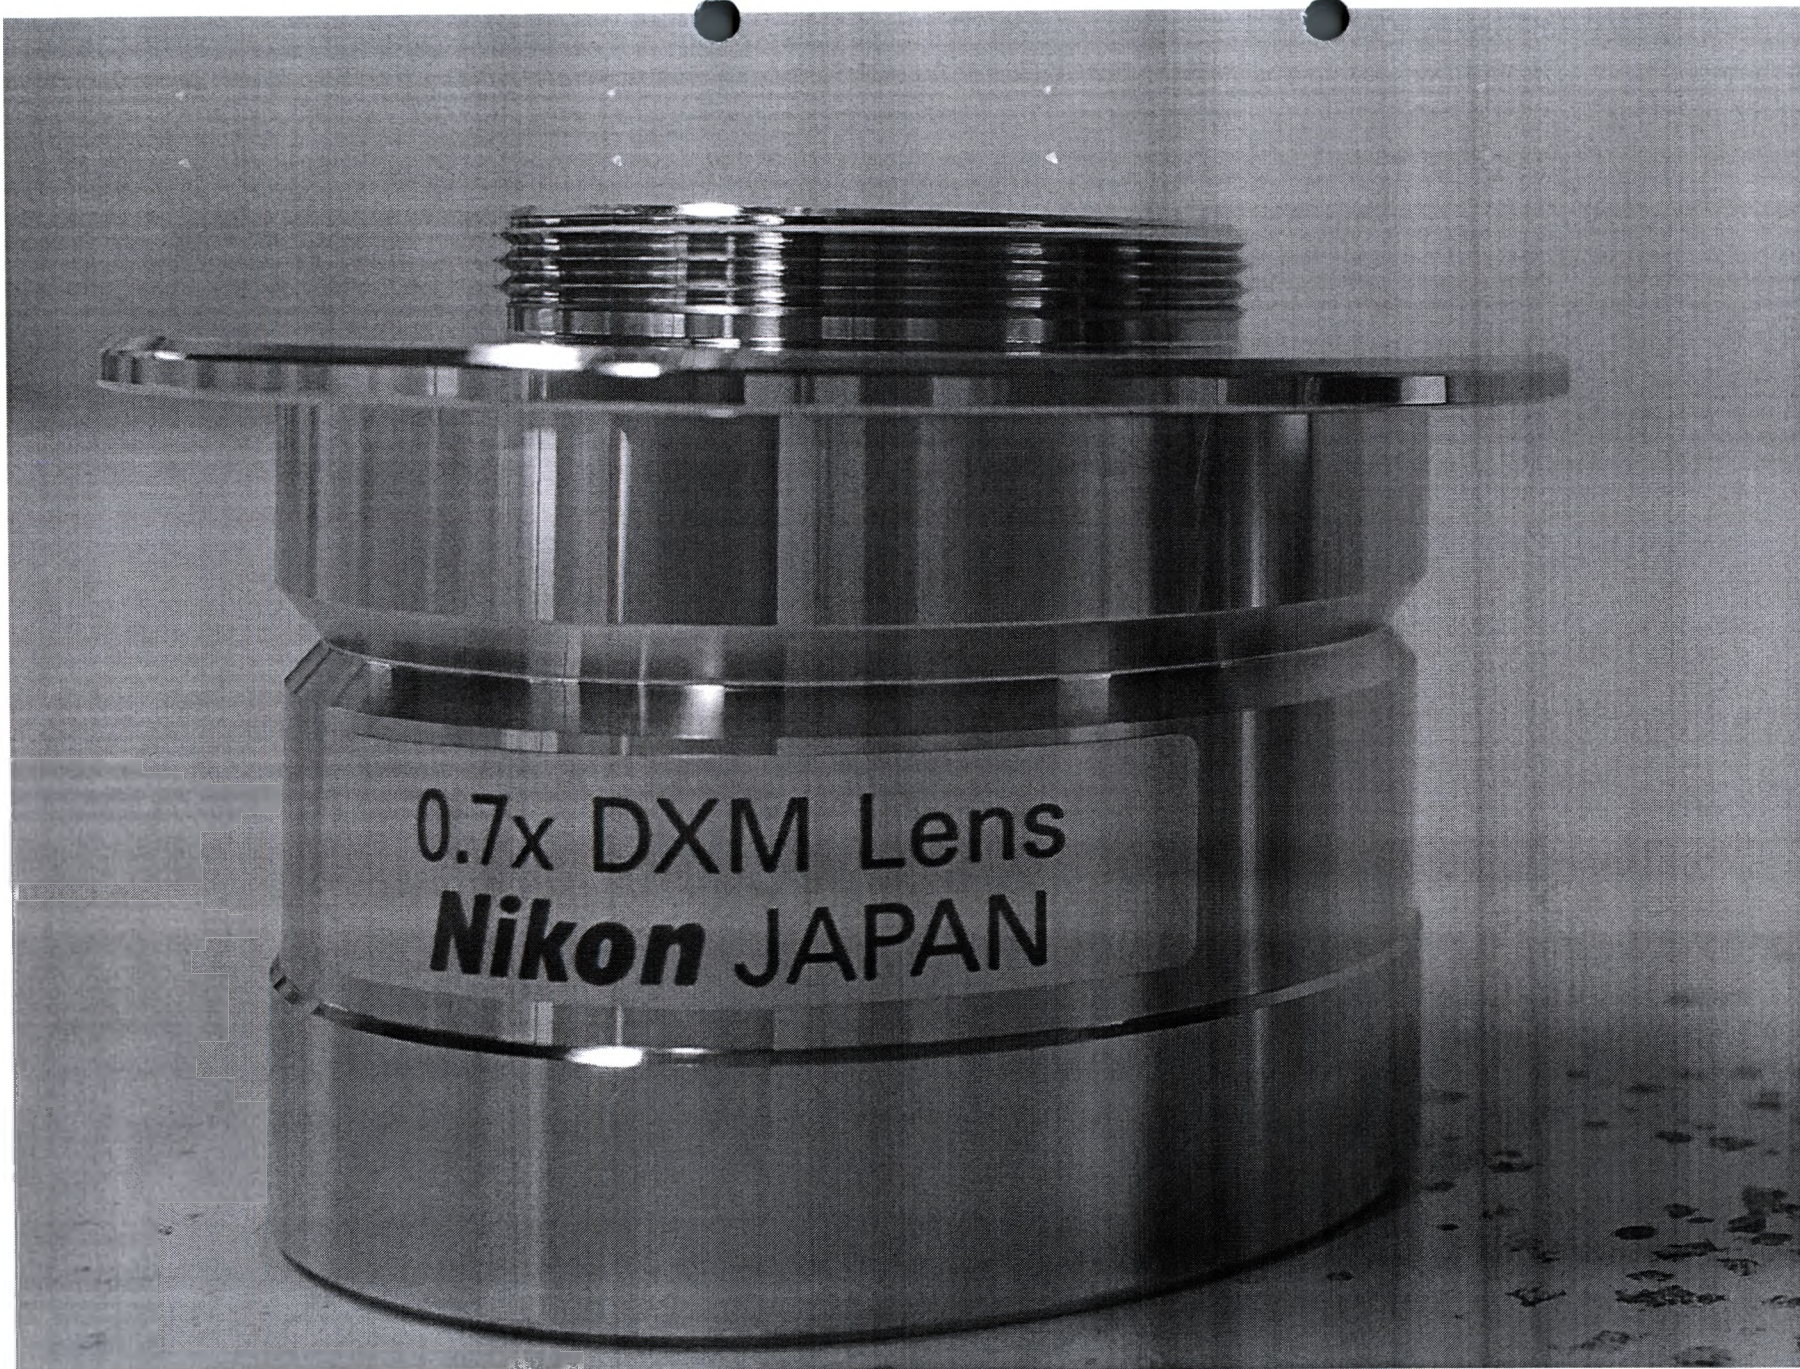


Рис.67 - C-mount адаптер 0.7x

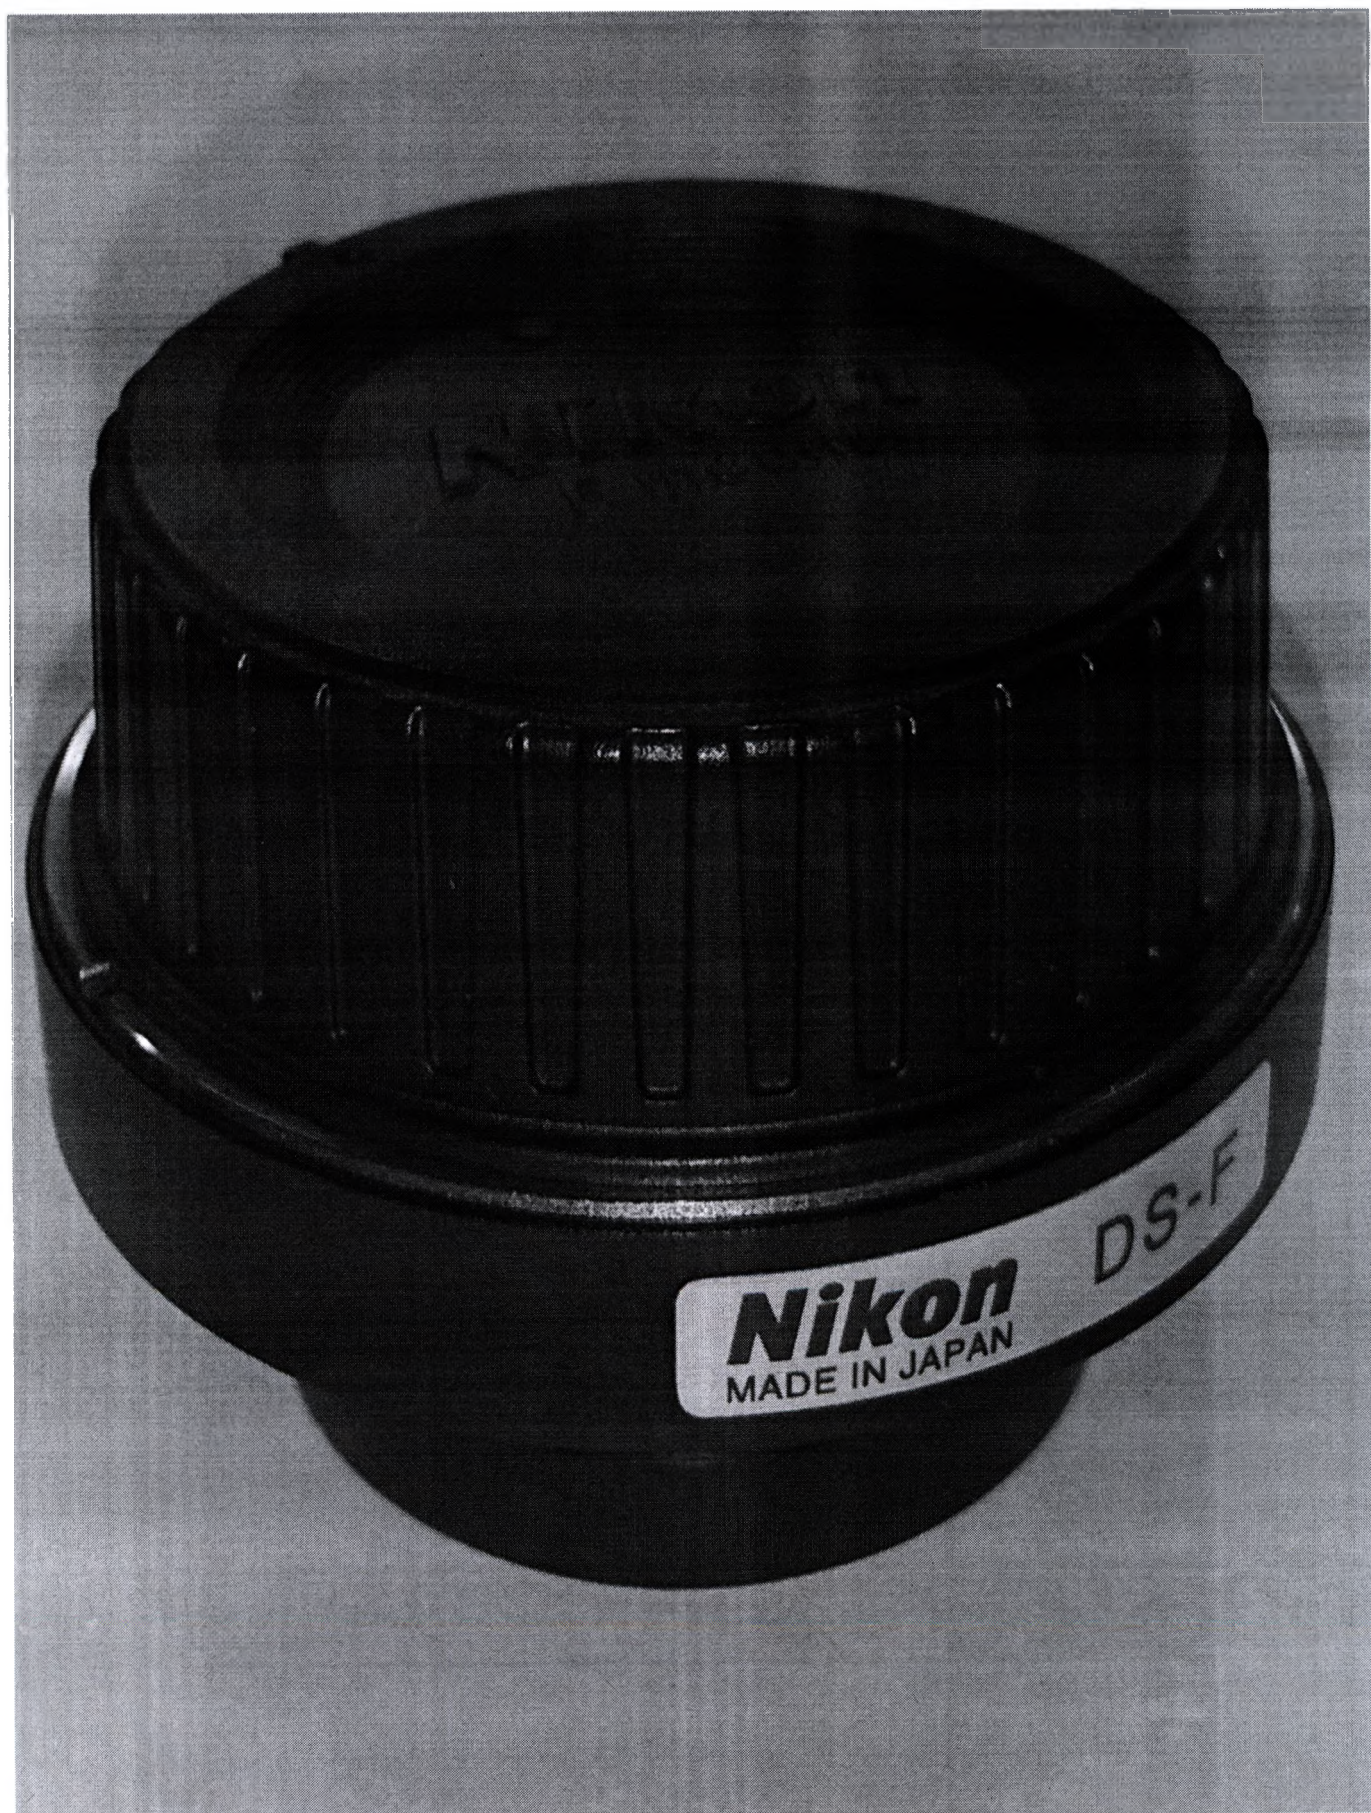


Рис.68 - DS-F F-mount адаптер



Рис.69 - DS-F2.5 F-mount адаптер 2.5x

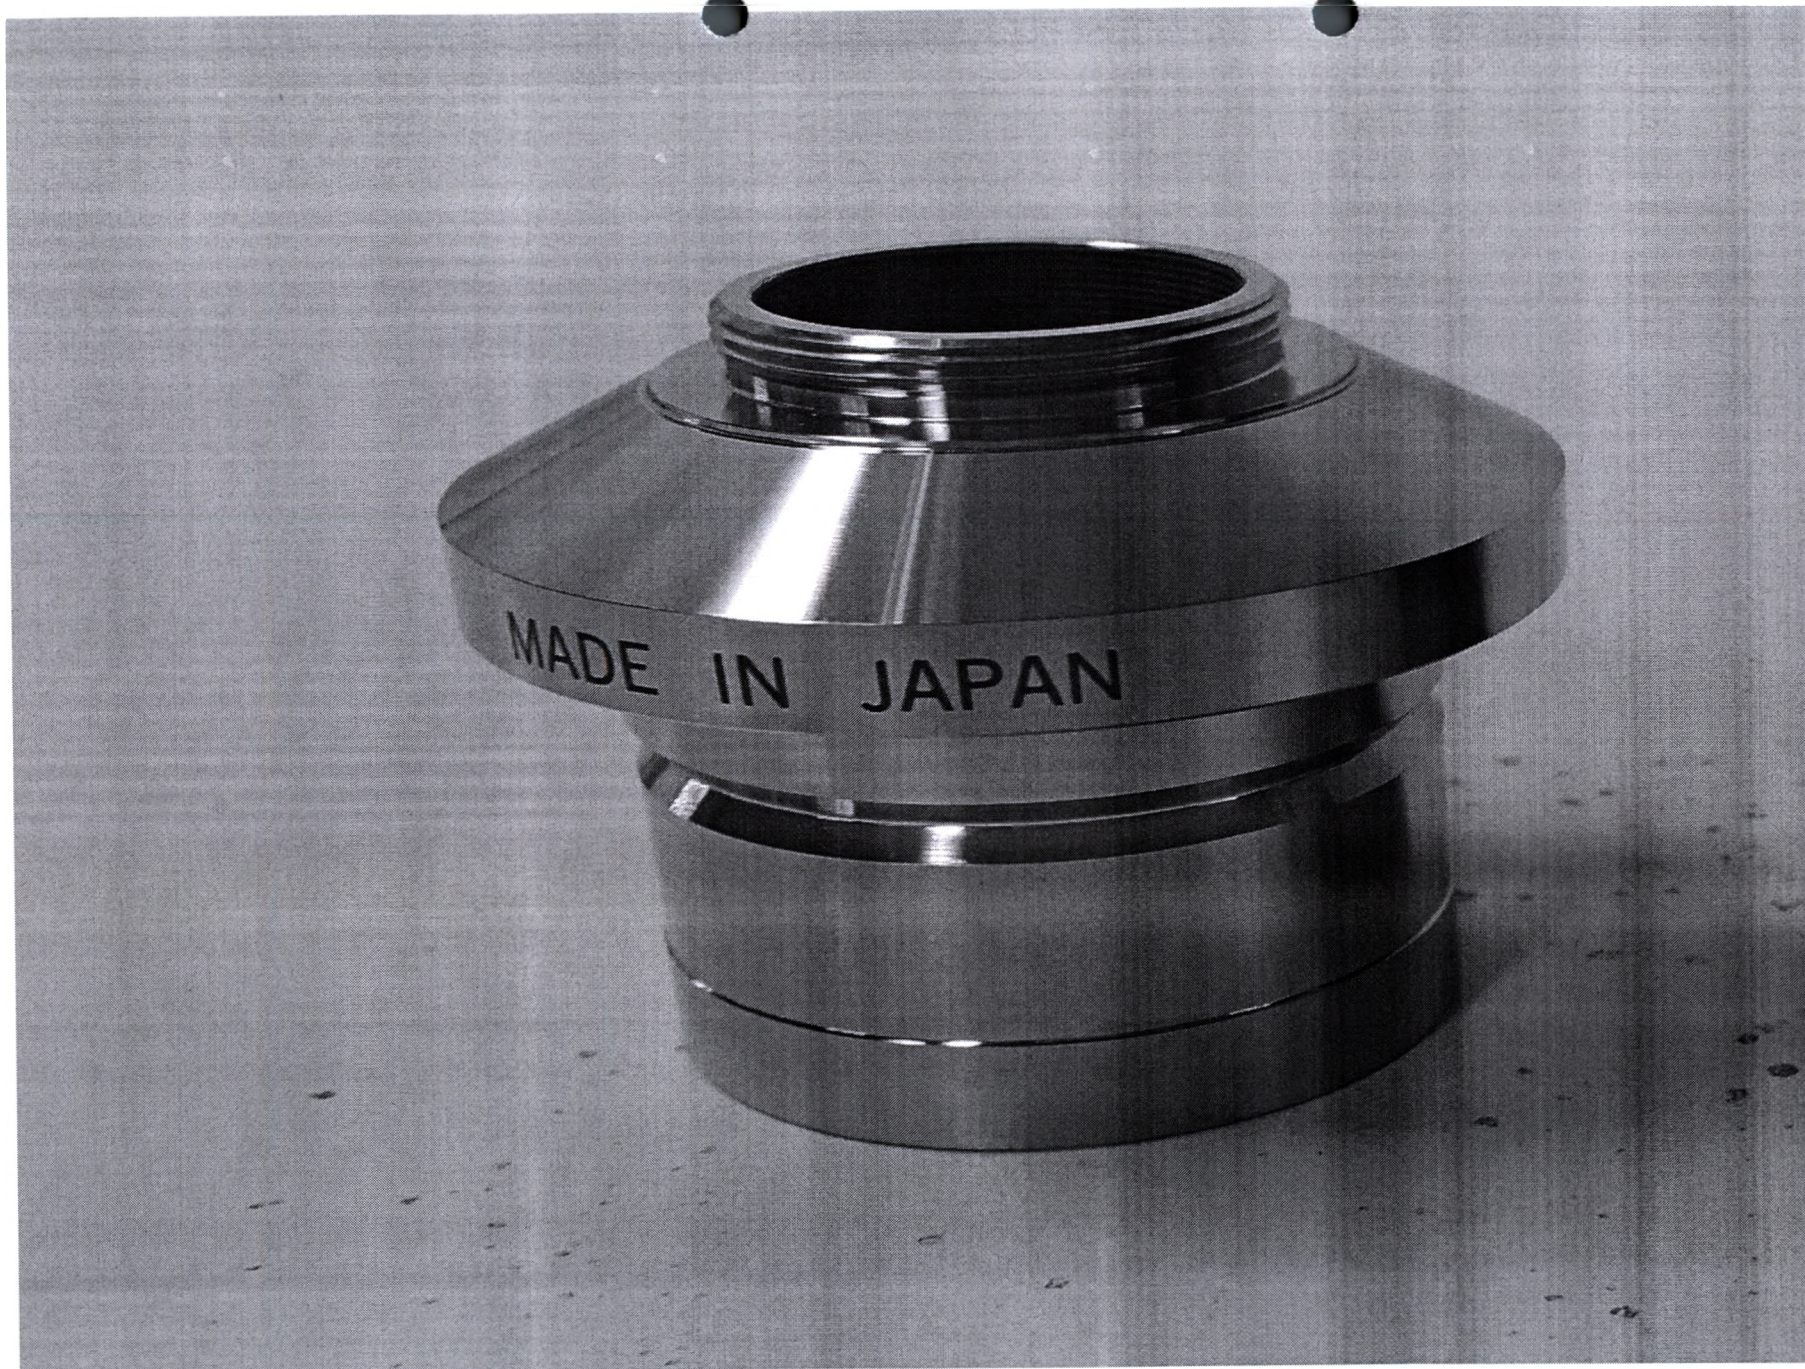


Рис.70 - Адаптер трубный LV-TV



Рис.71 - Камера цифровая специализированная DS-Qi2



Рис.72 - Камера цифровая специализированная DS-Ri2



Рис.73 - Камера цифровая специализированная DS-Fi1c

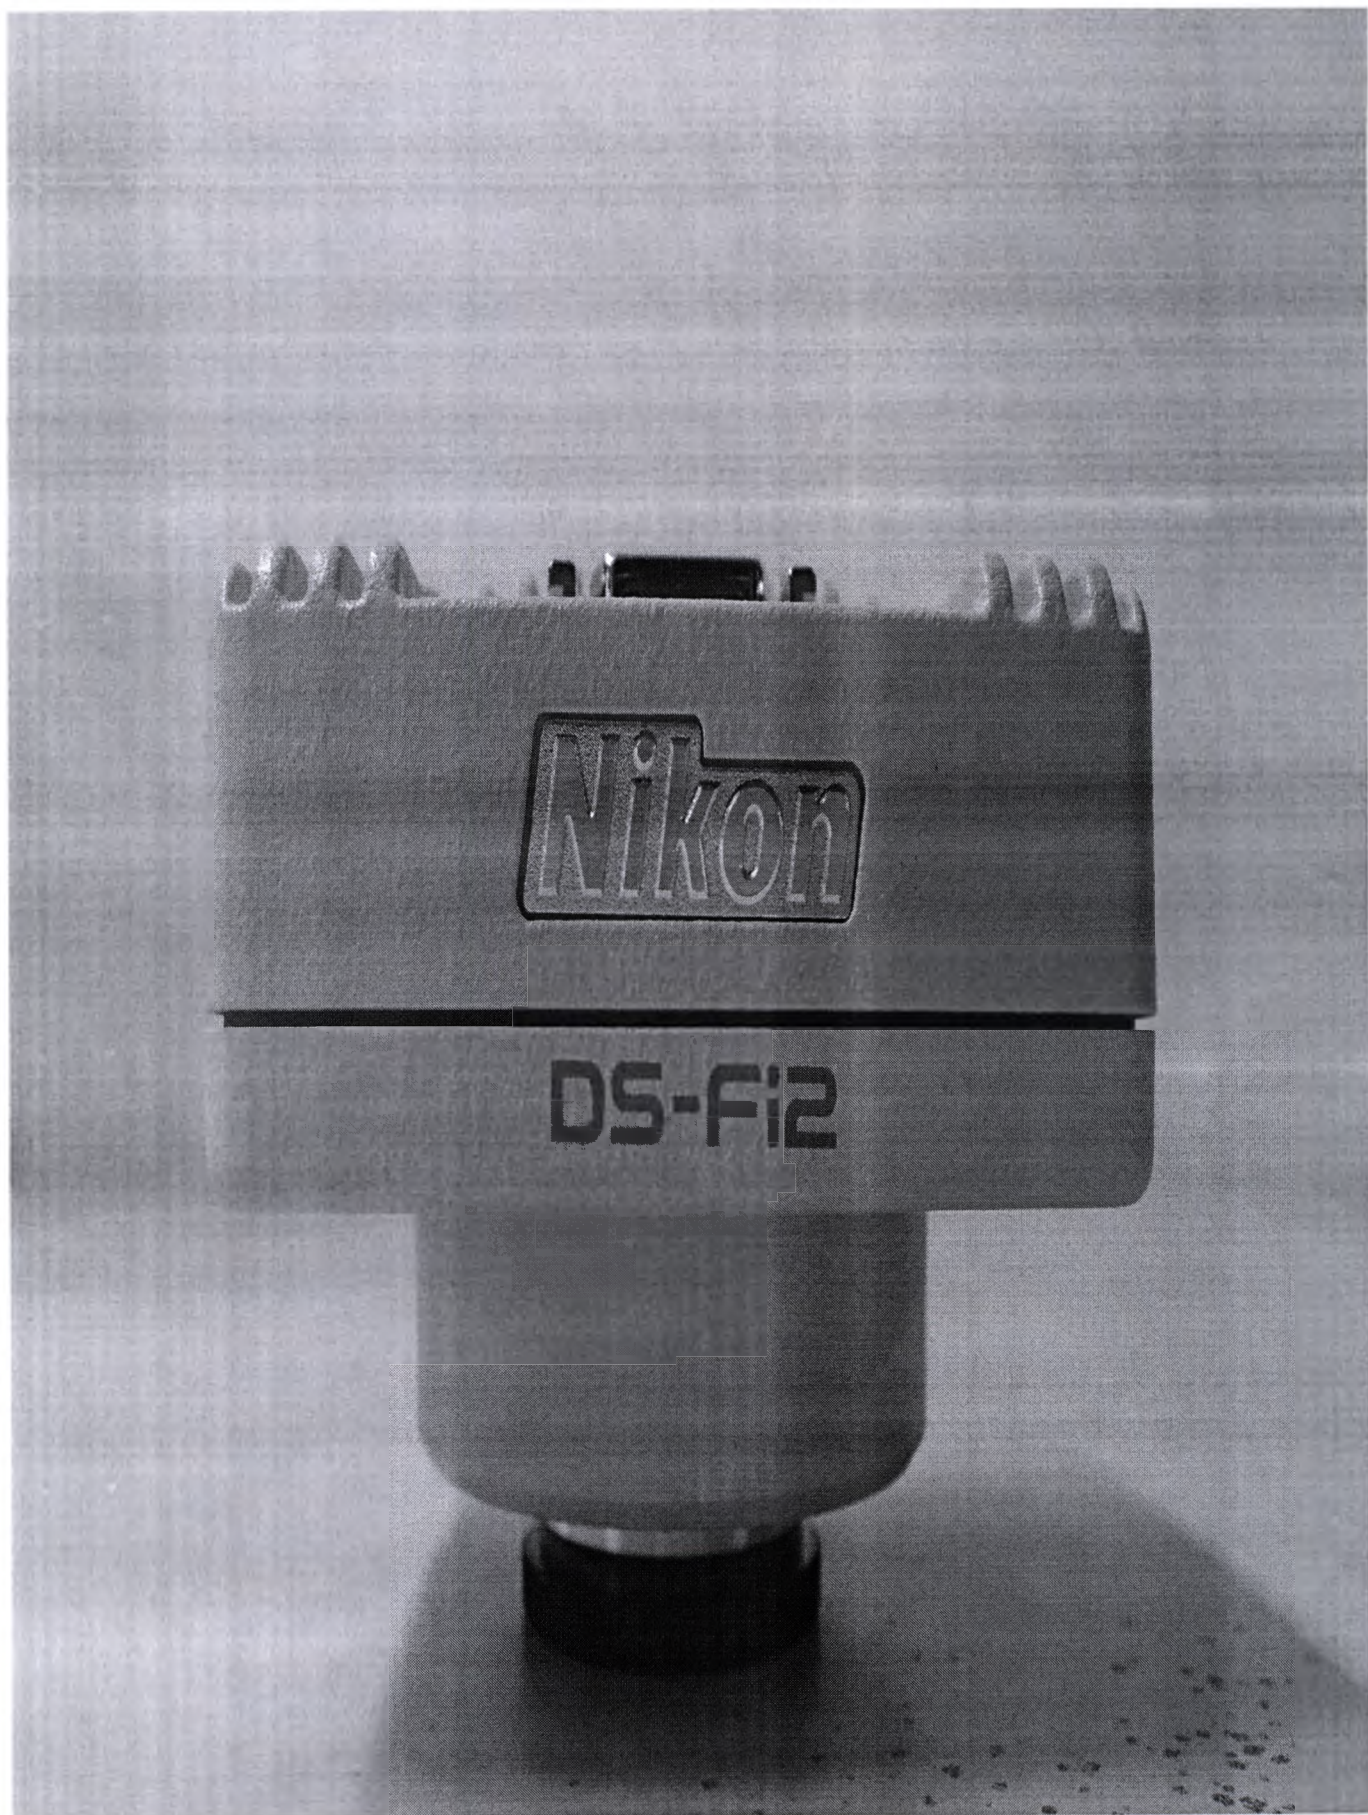


Рис.74 - Камера цифровая специализированная DS-Fi2



Рис.75 - Камера цифровая специализированная DS-Vi1

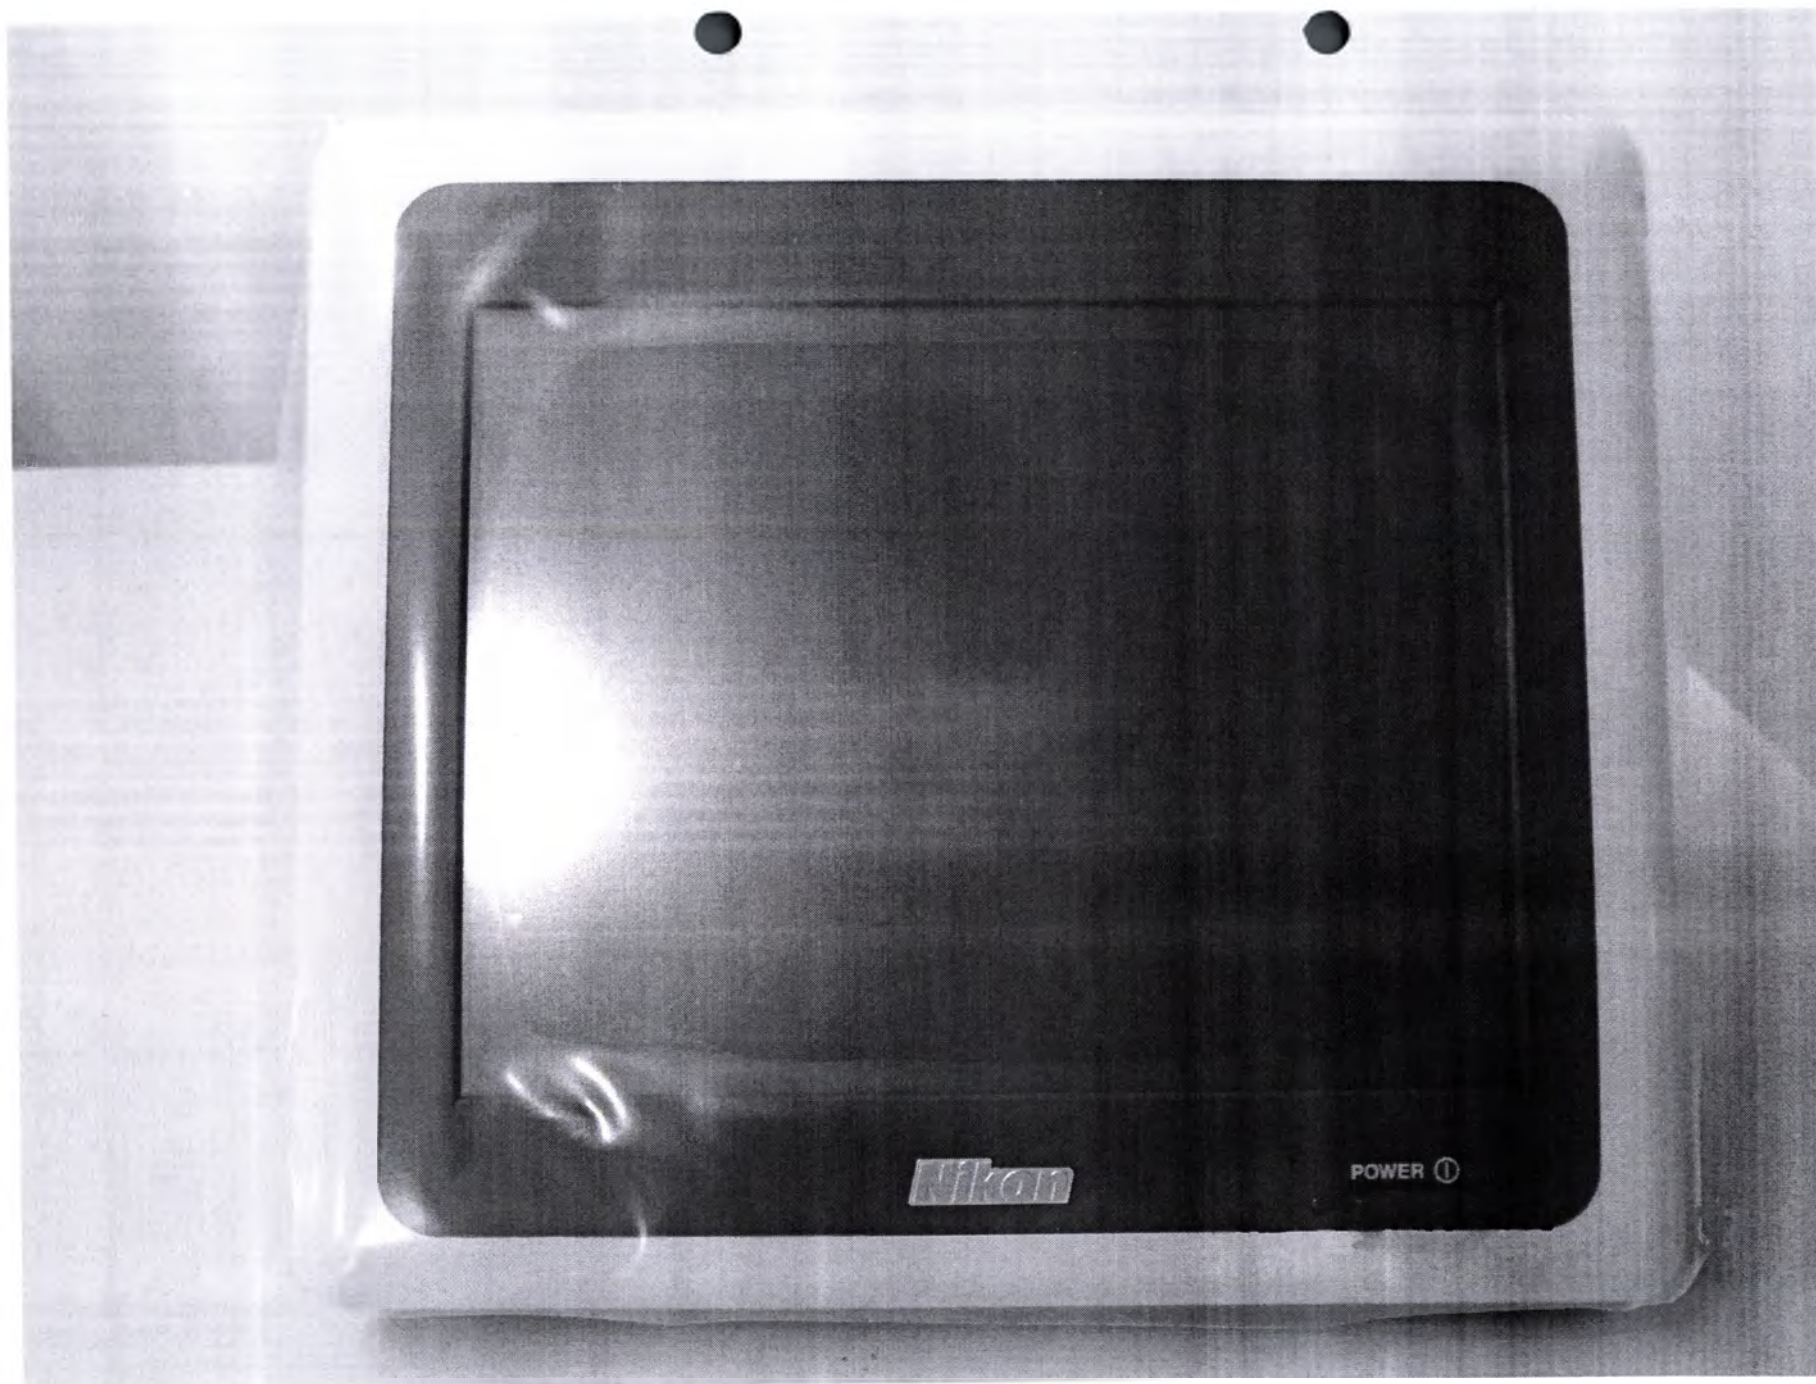


Рис.76 - Блок управления DS-L3 камерой цифровой специализированной

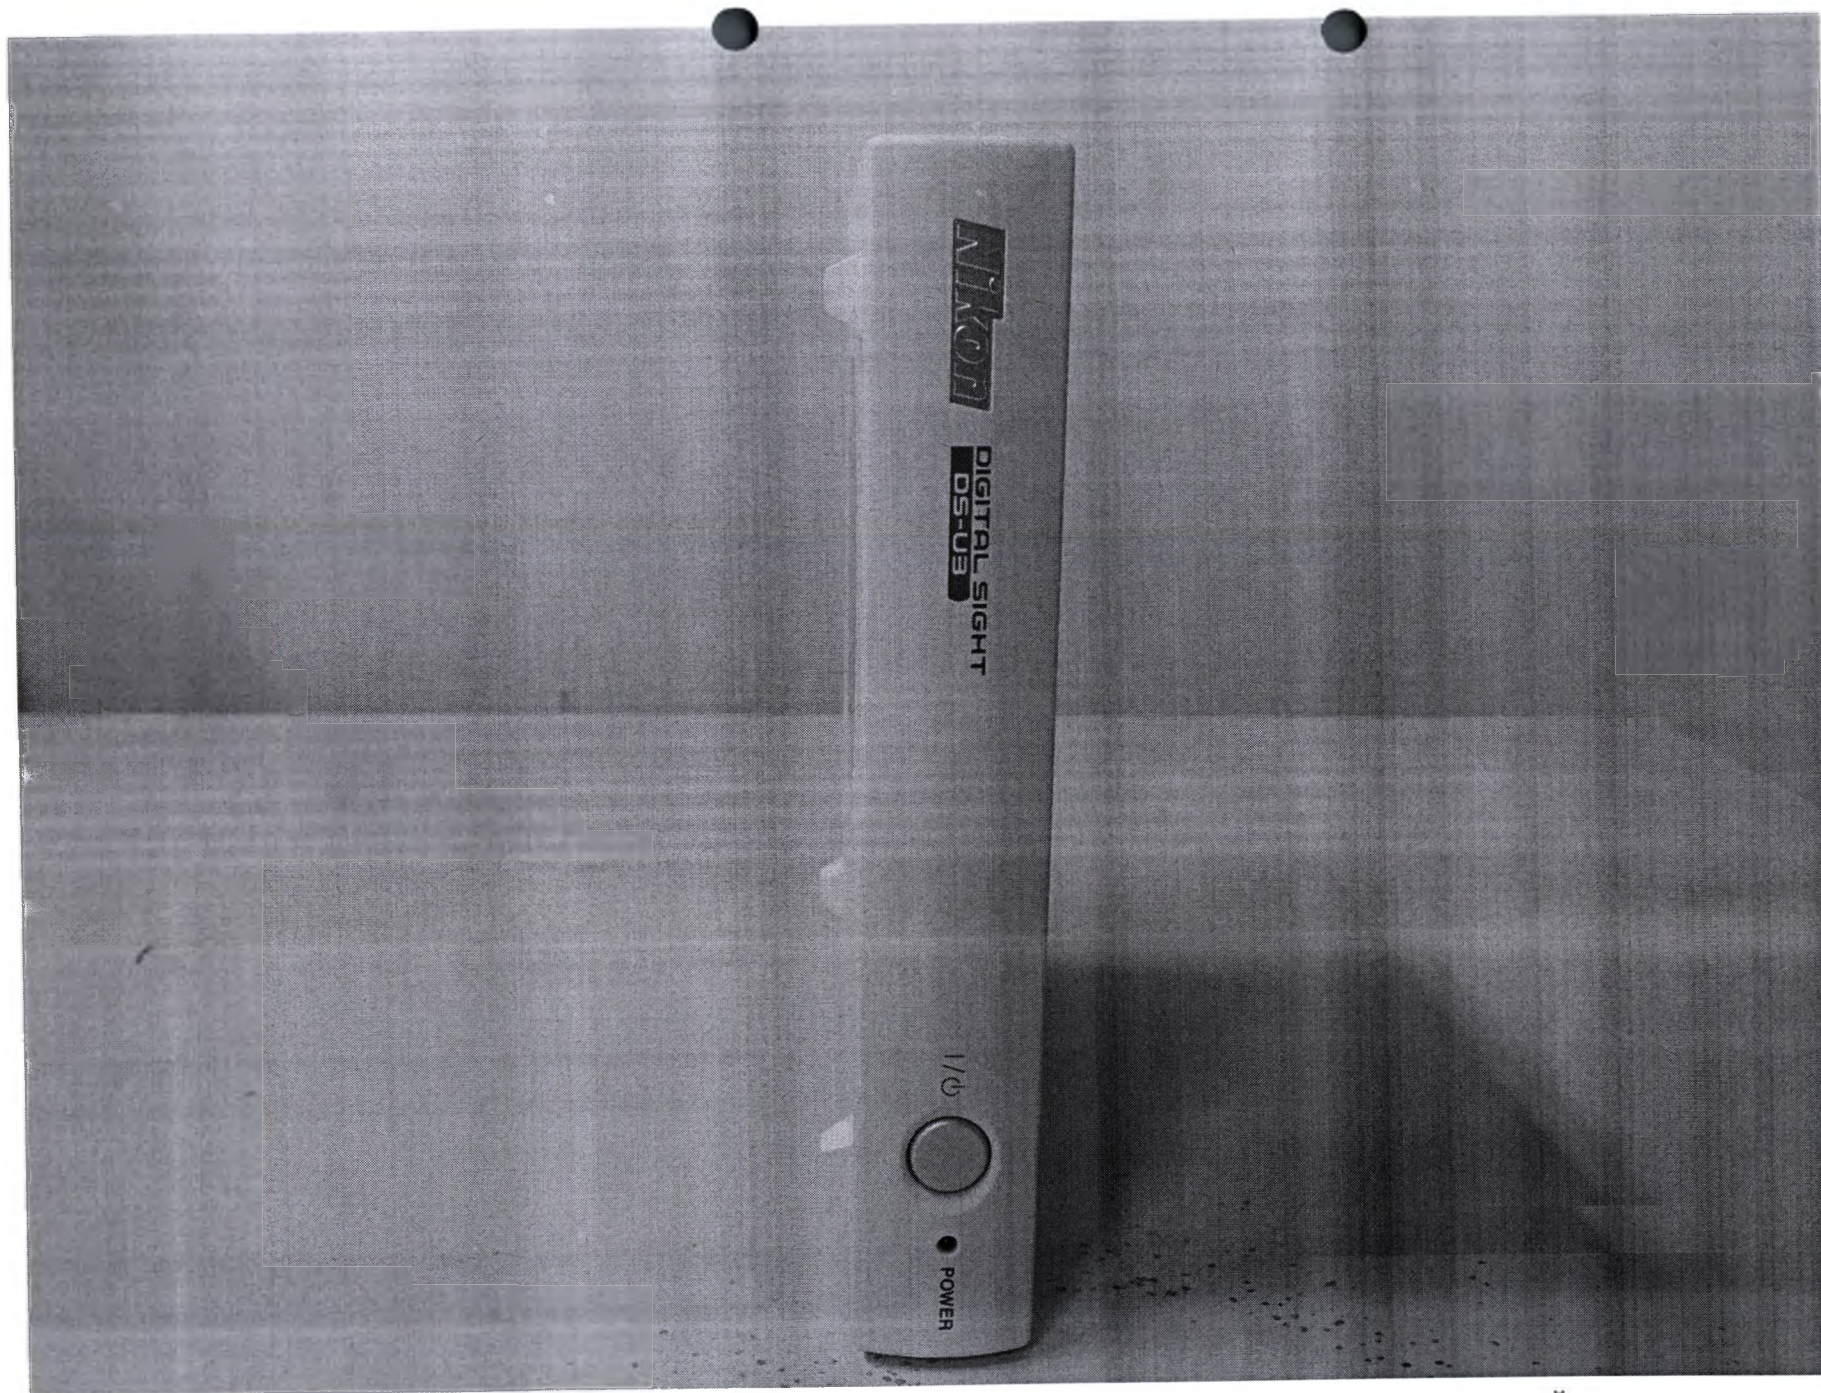


Рис.77 - Блок управления DS-U3 камерой цифровой специализированной

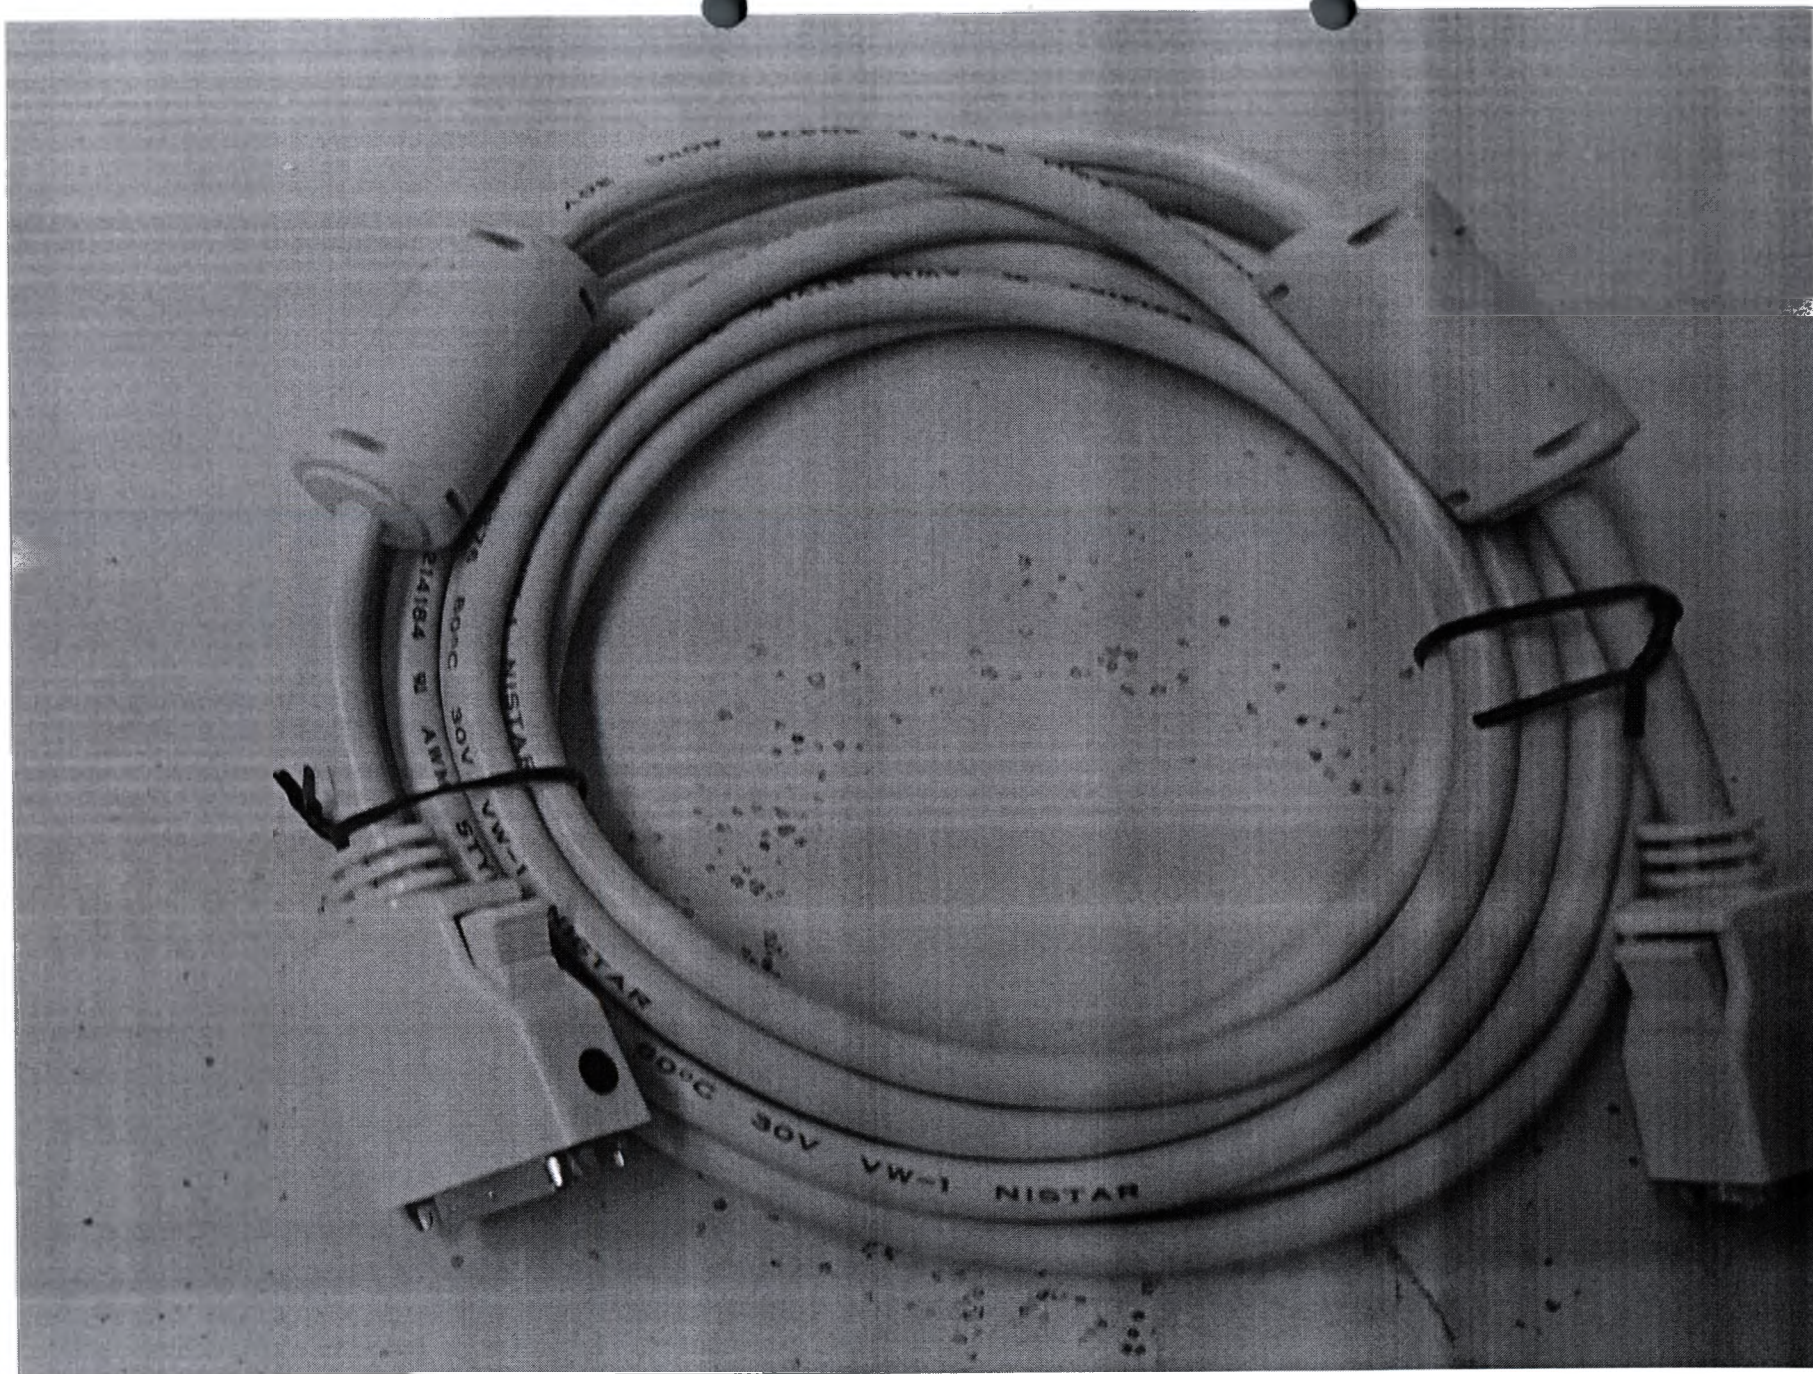


Рис.78 - Кабель интерфейсный для камеры серии DS

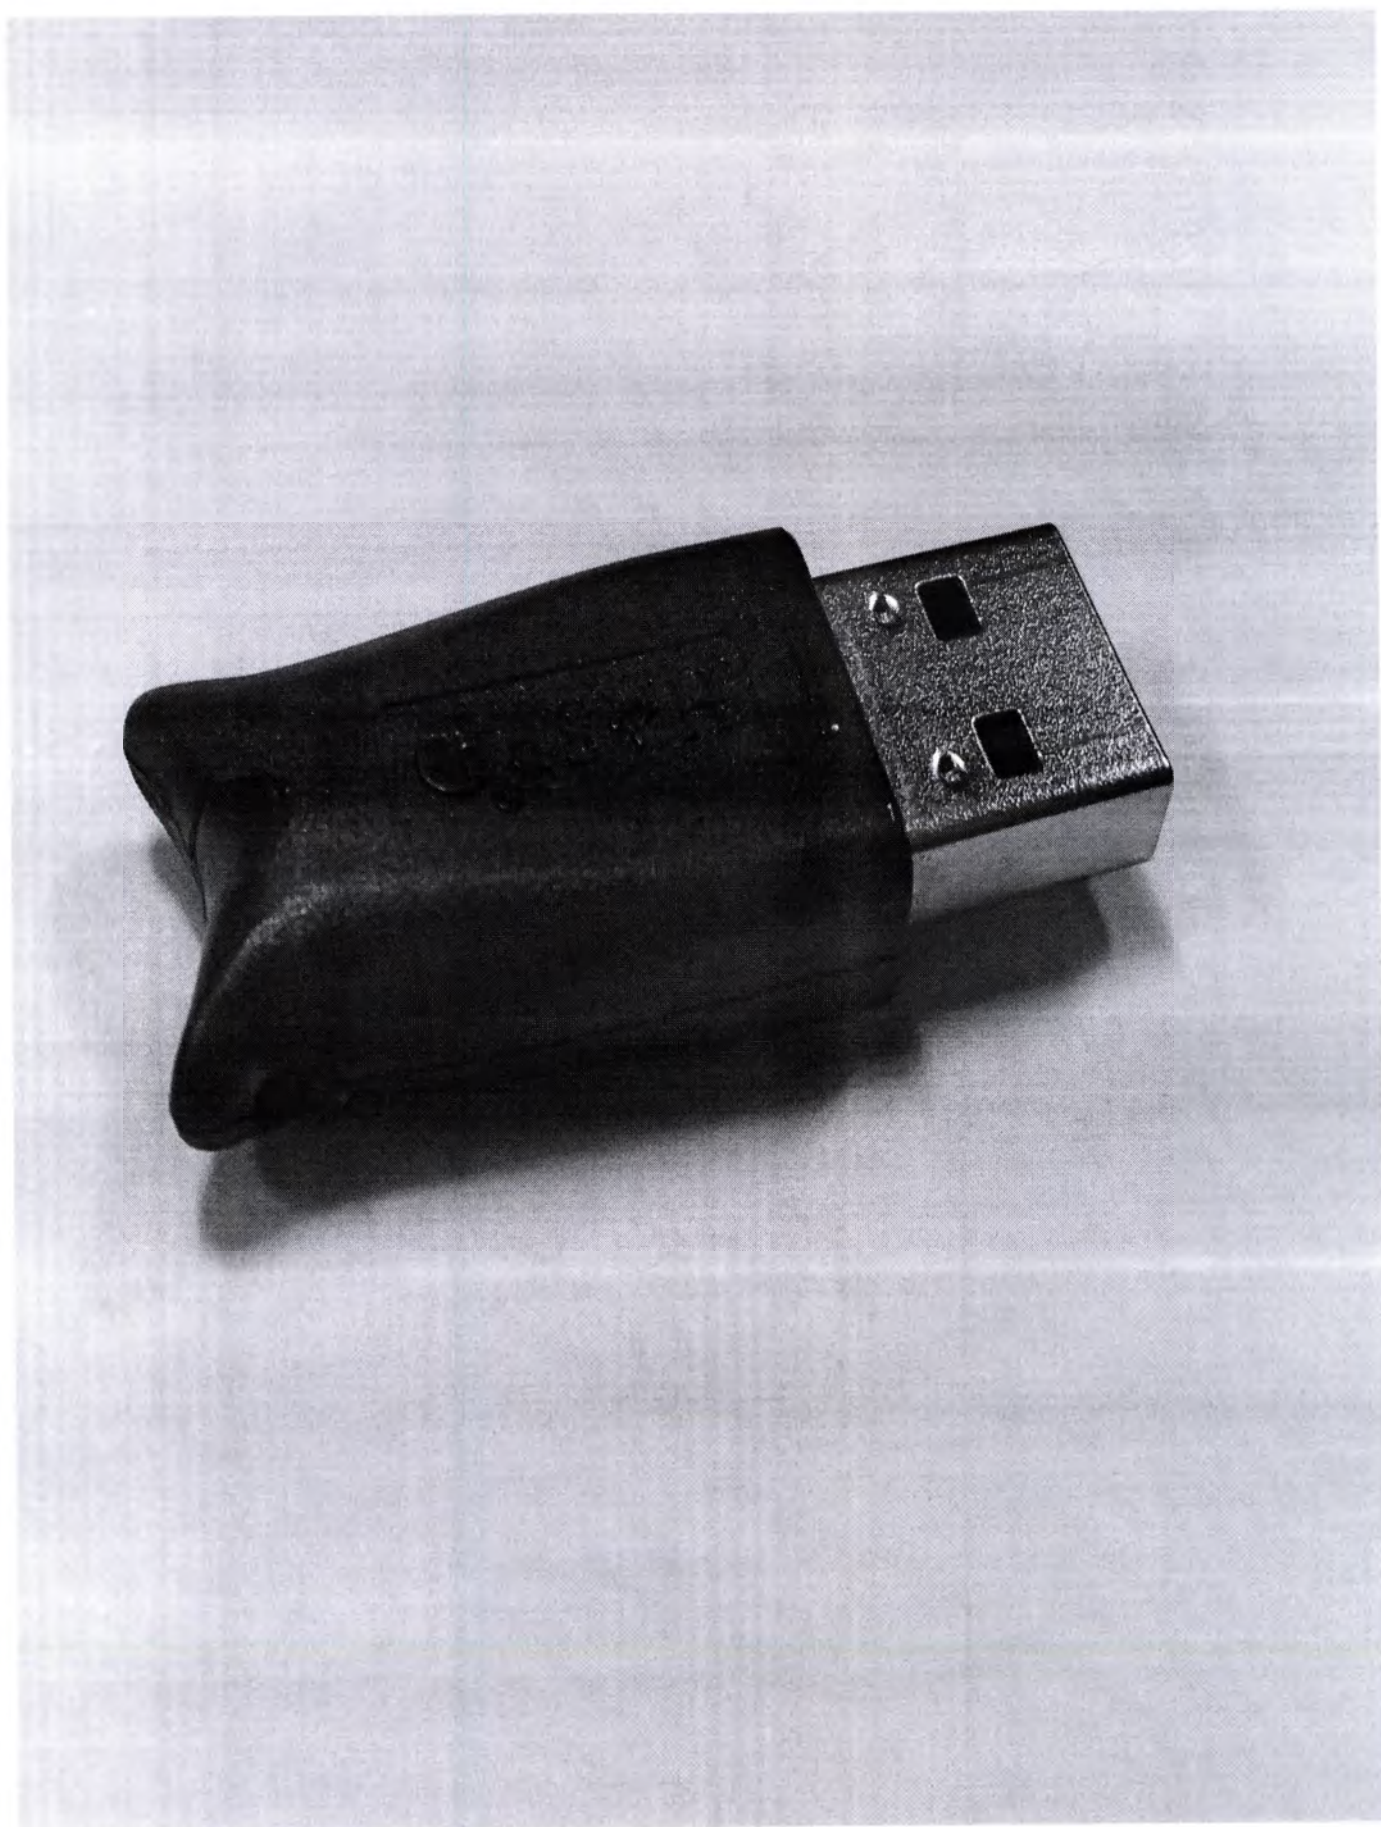


Рис.79 – Ключ электронный

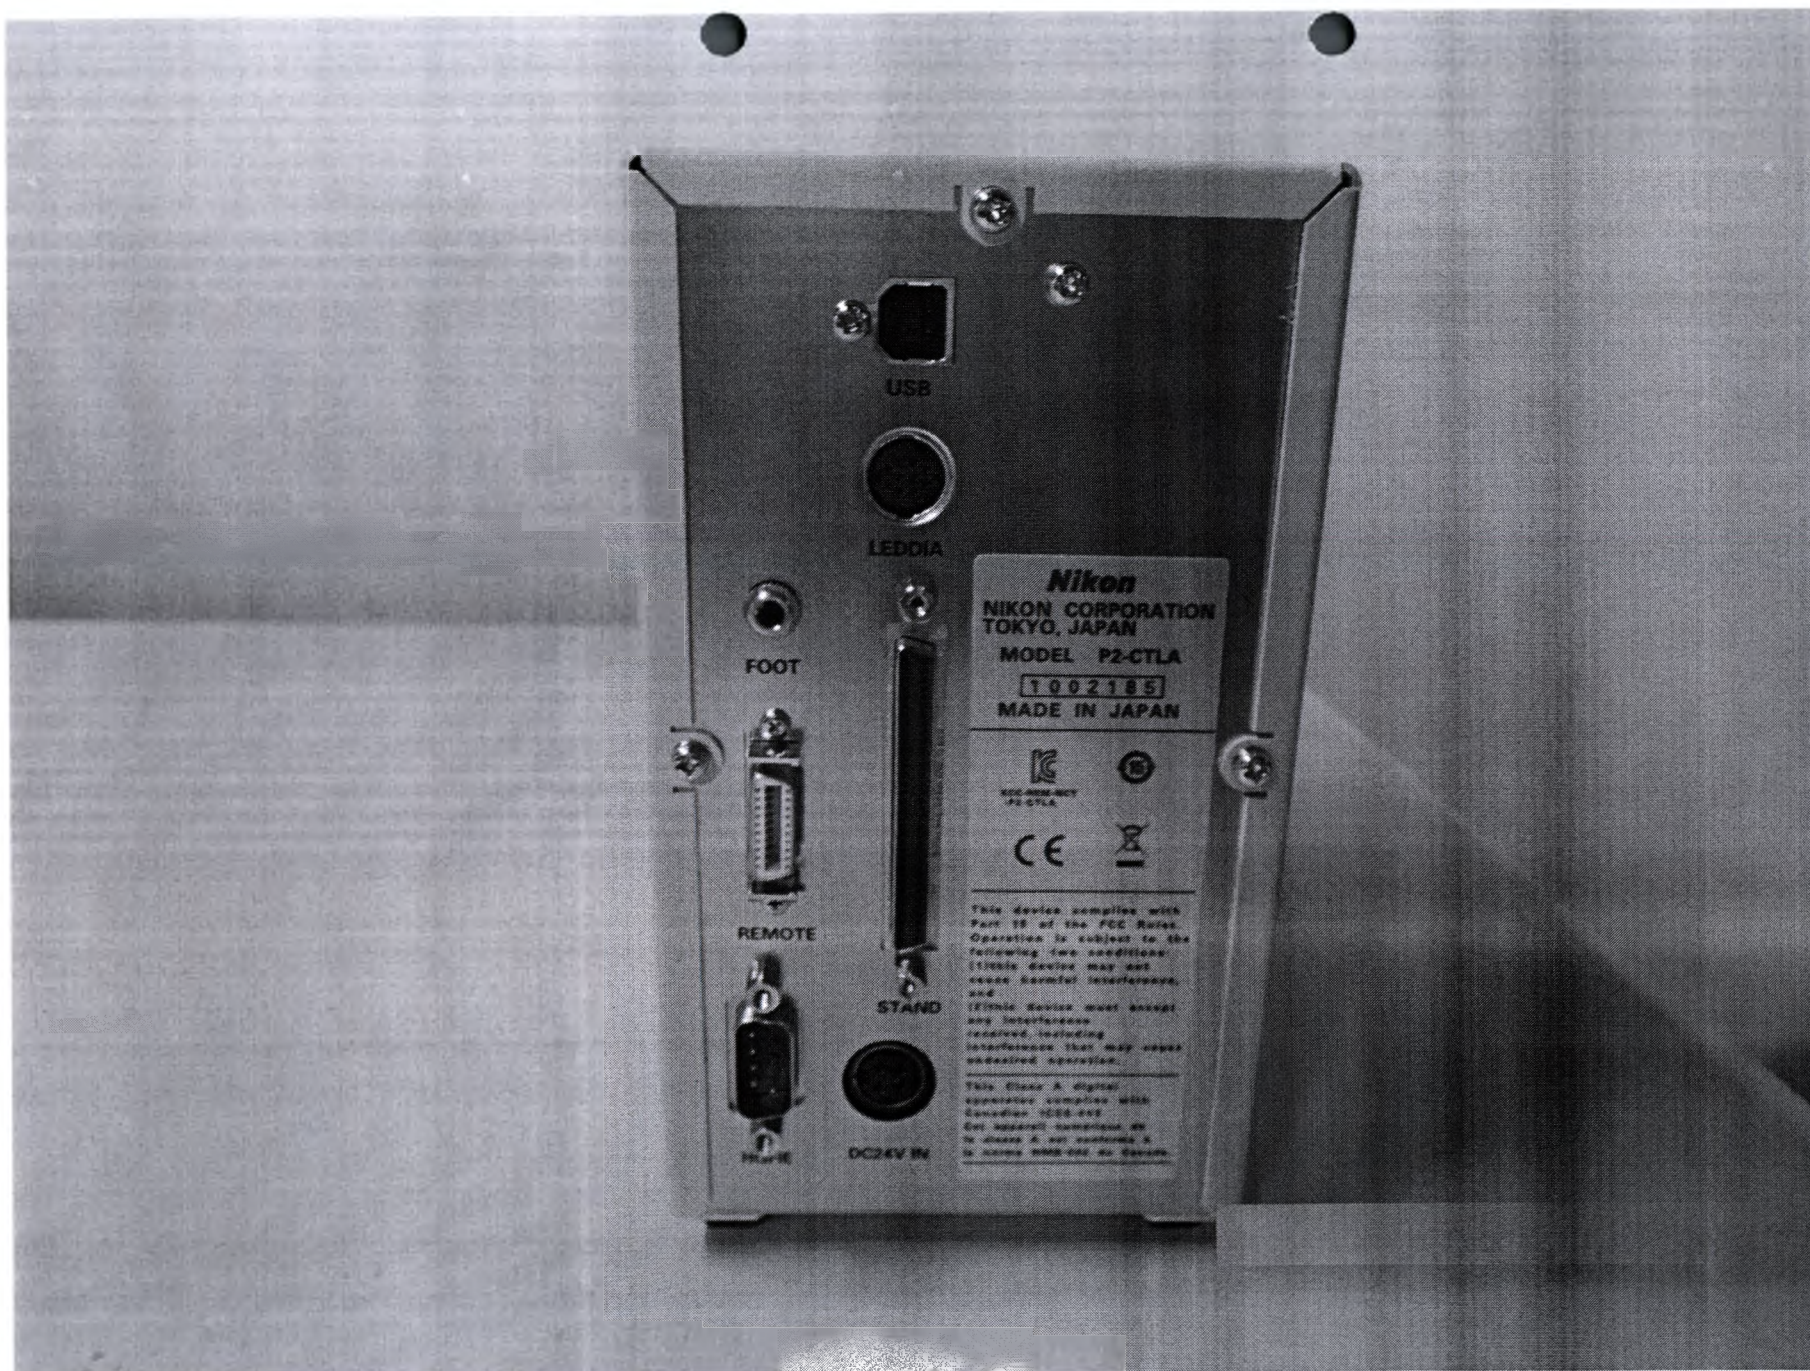


Рис.80 - Блок управления P2-CTLA

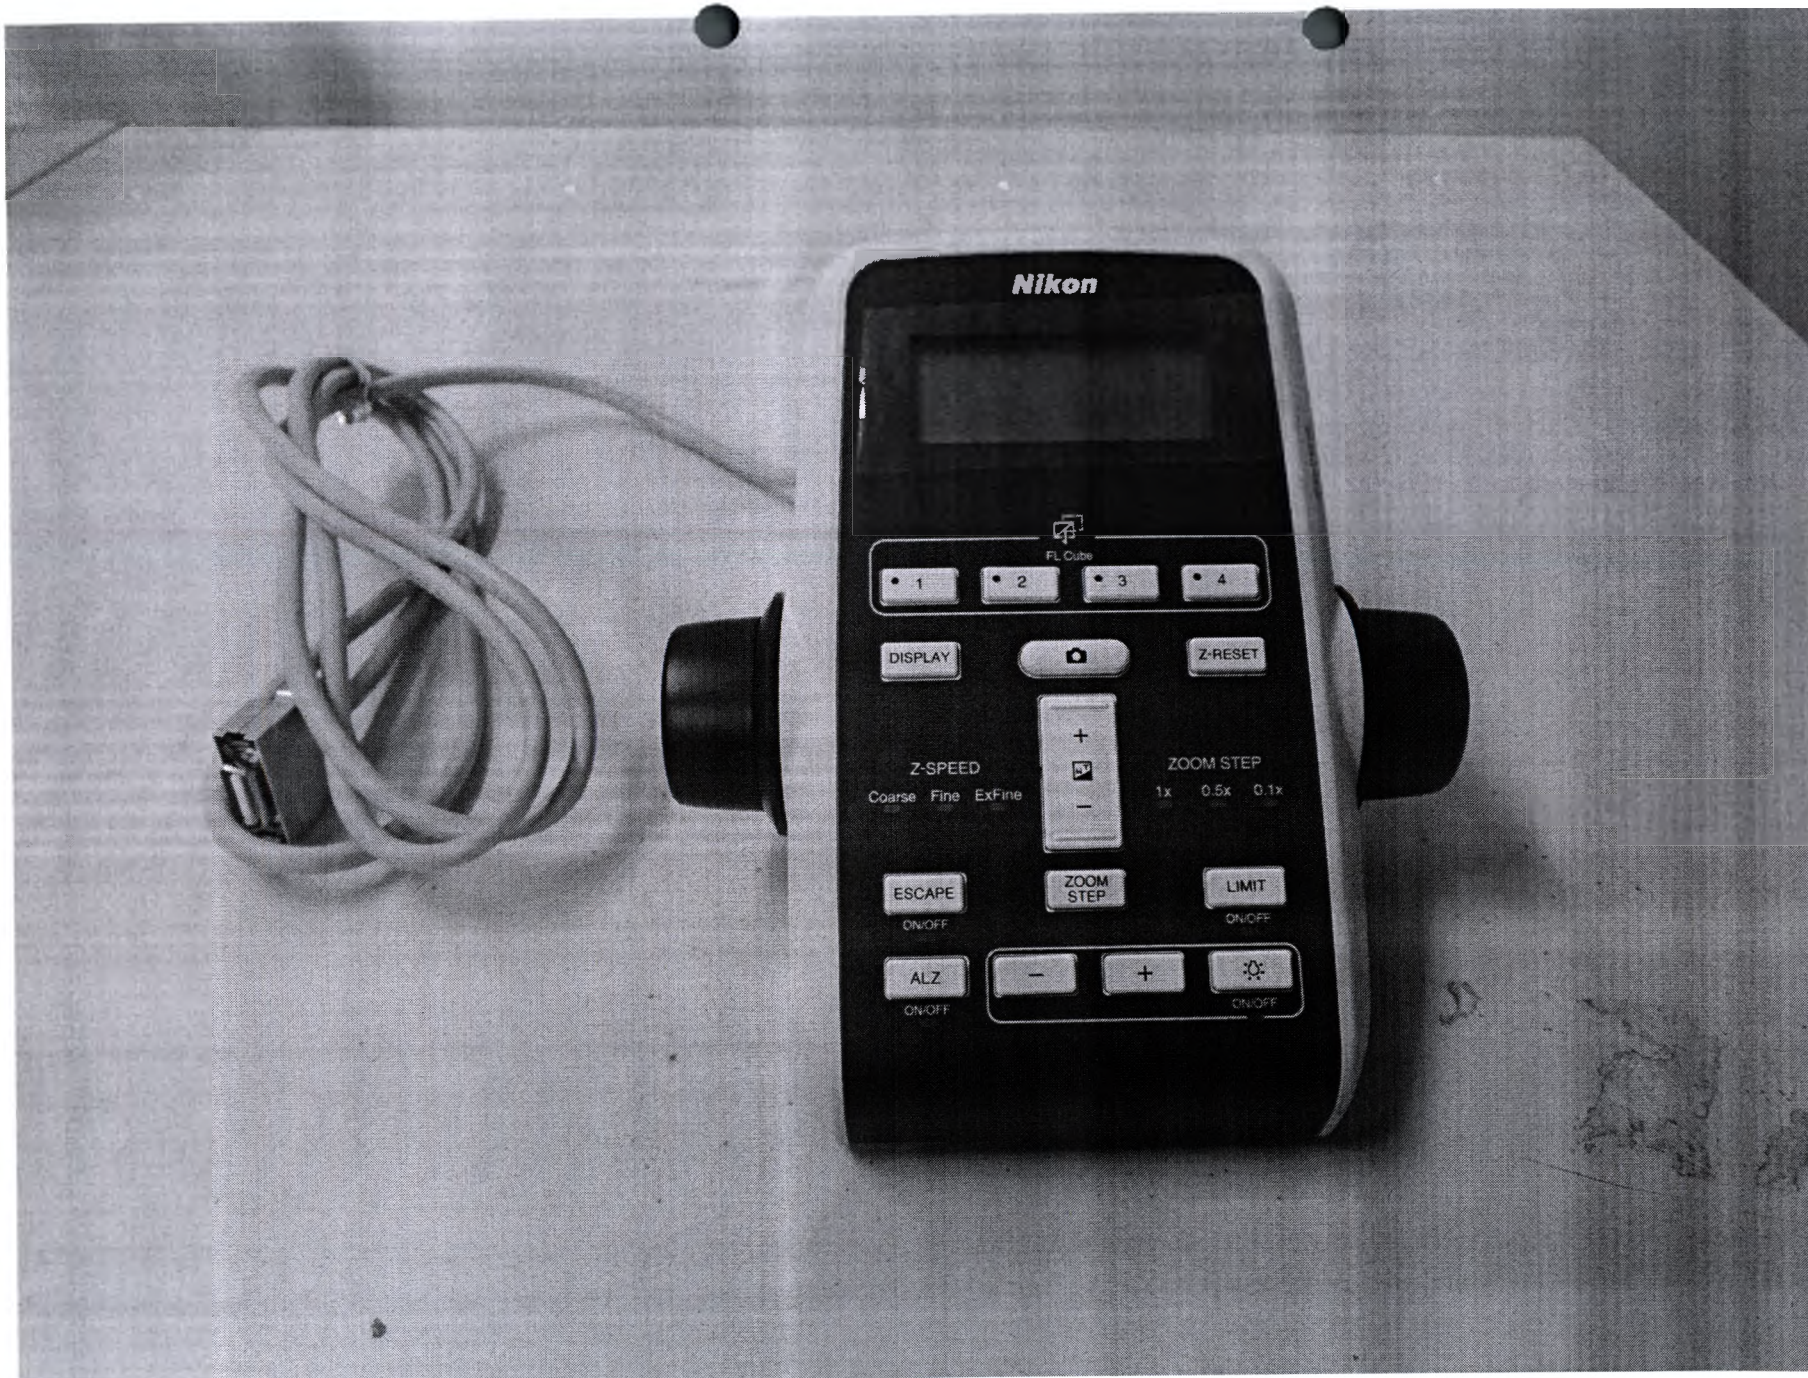


Рис.81 - Пульт дистанционного управления P2-RC

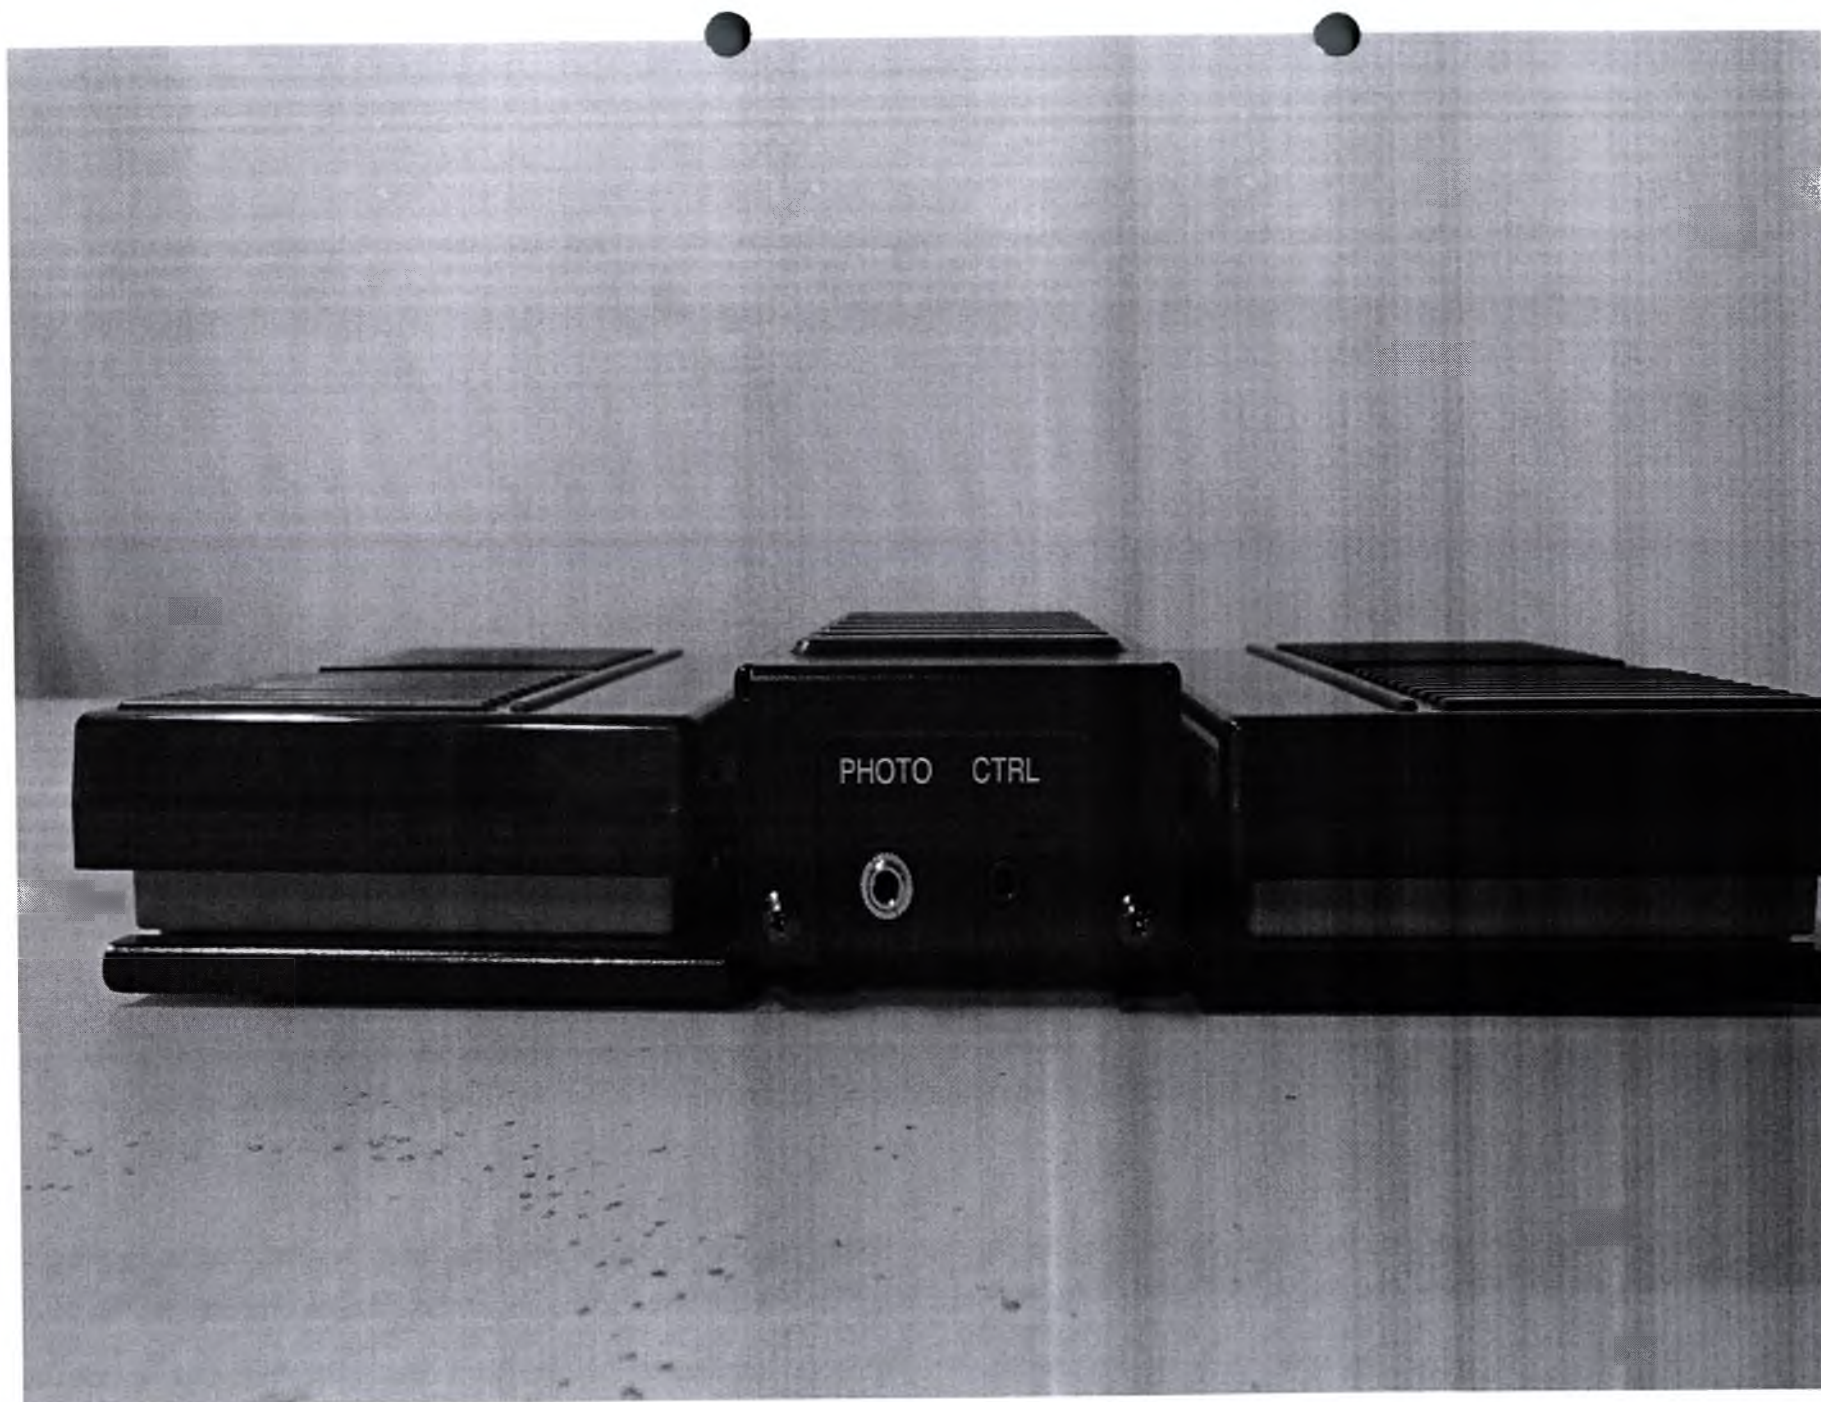


Рис.82 - Переключатель ножной AZ-FSW



Рис.83 - Педаль захвата изображений AZ-HRC

M608 E 13.5.NF.1
M608N01

Nikon

Стереомикроскопы

SMZ25/SMZ18

Руководство по эксплуатации

Рис.84 - Руководство по эксплуатации.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
68/1000000000 лист (ов)
Генеральный директор
ООО «МедТехКомплект»
А.Г.Трофименко