

Сумка с ремнем для переноски

Монитор

Зарядное устройство

Вспомогательное устройство

Программное обеспечение BIAS BIS

Зарядное устройство

Электроды одноразовые

Кабель с красным и черным наконечником длиной 1,2 м

Сумка с ремнем для переноски

Монитор

Кабель с красным и черным
наконечником длиной 1,2м

Вспомогательное устройство
Бодистат

Электроды одноразовые

Сумка с ремнем для переноски



Электроды одноразовые

Монитор

Зарядное устройство

Программное обеспечение
BIAS Platinum

Вспомогательное
устройство

Кабель с красным и черным наконечником длиной 1,2 м



Bodystat 1500 Сумка
THE TRUTH ABOUT YOUR BODY COMPOSITION

REPORT

NAME _____ DATE _____
VENUE _____ HEIGHT _____


RESULTS
READINGS TAKEN

FAT %		RECOMMENDED RANGE
FAT WEIGHT %		
LEAN %		
LEAN WEIGHT %		
TOTAL BODY WEIGHT %		
WATER %		
TOTAL BODY FAT %		
EST. METABOLIC RATE AT REST		
EST. AVERAGE ENERGY REQ.		


CONSULTANT'S COMMENTS _____

TARGET FAT WEIGHT TO LOSE/GAIN _____
FAT WEIGHT NOT TOTAL WEIGHT DETERMINED

Монитор

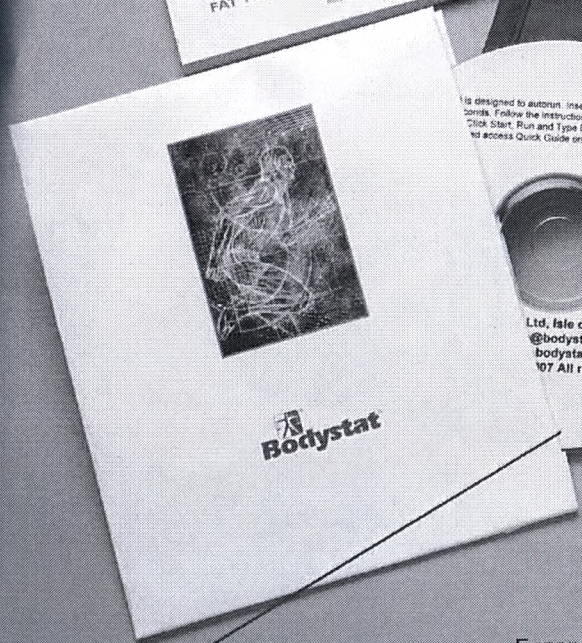


Руководство пользователя

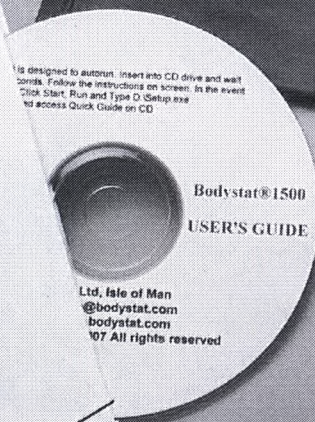

Батарейки Duracell/Procell AA 1.5B



Вспомогательное устройство Бодистат

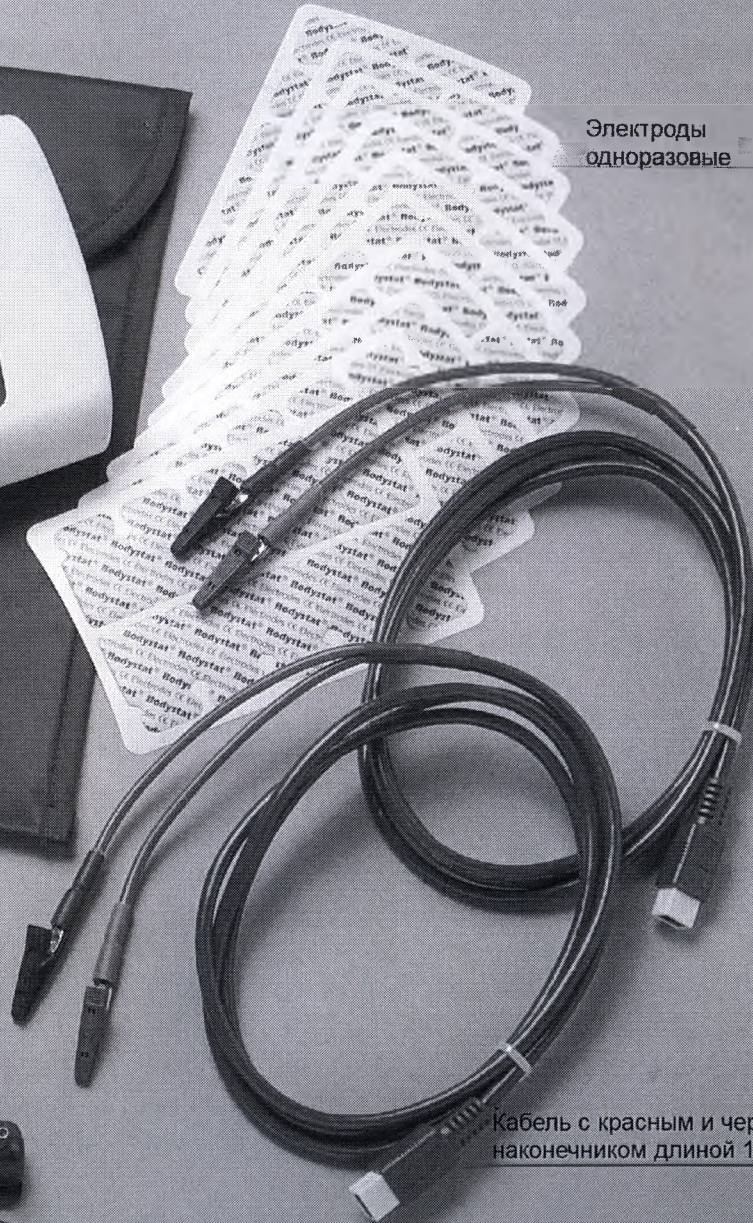

Электроды одноразовые


Кабель с красным и черным наконечником длиной 1,2 м

Сумка с ремнем для переноски

Руководство пользователя монитором

Монитор

Програмное обеспечение BIAS Body Manager Pro


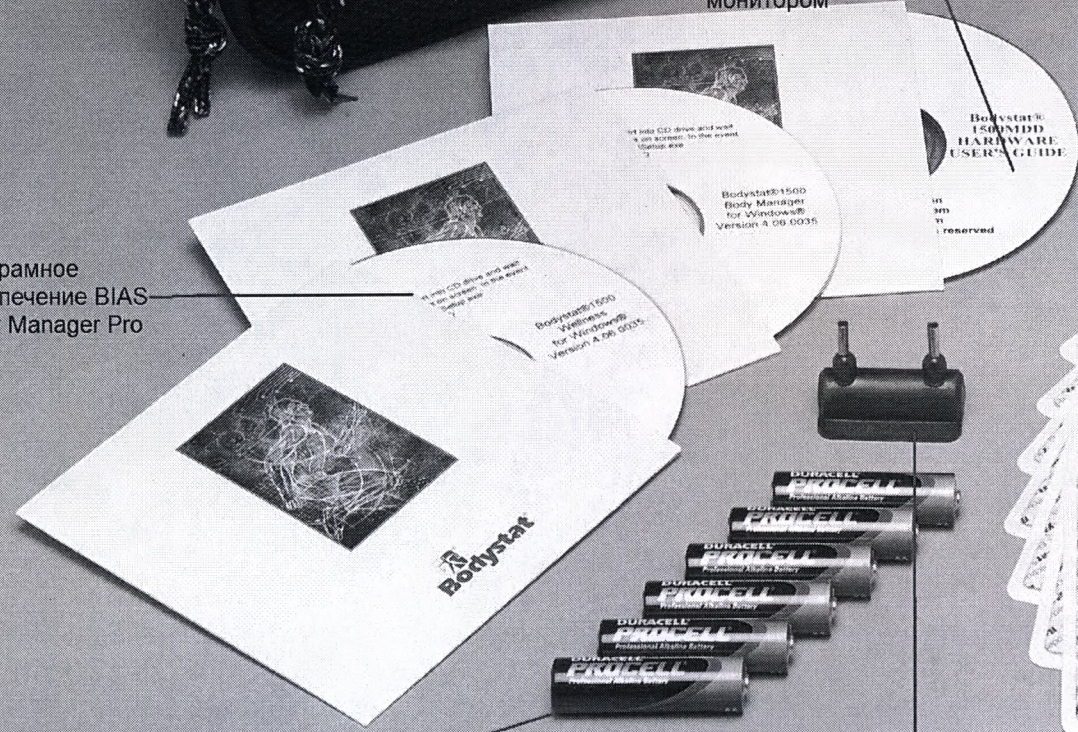


Батарейки Duracell/Procell AA 1,5

Вспомогательное устройство Бодистат

Электроды одноразовые

Кабель с красным и черным наконечниками длиной 1,2 м

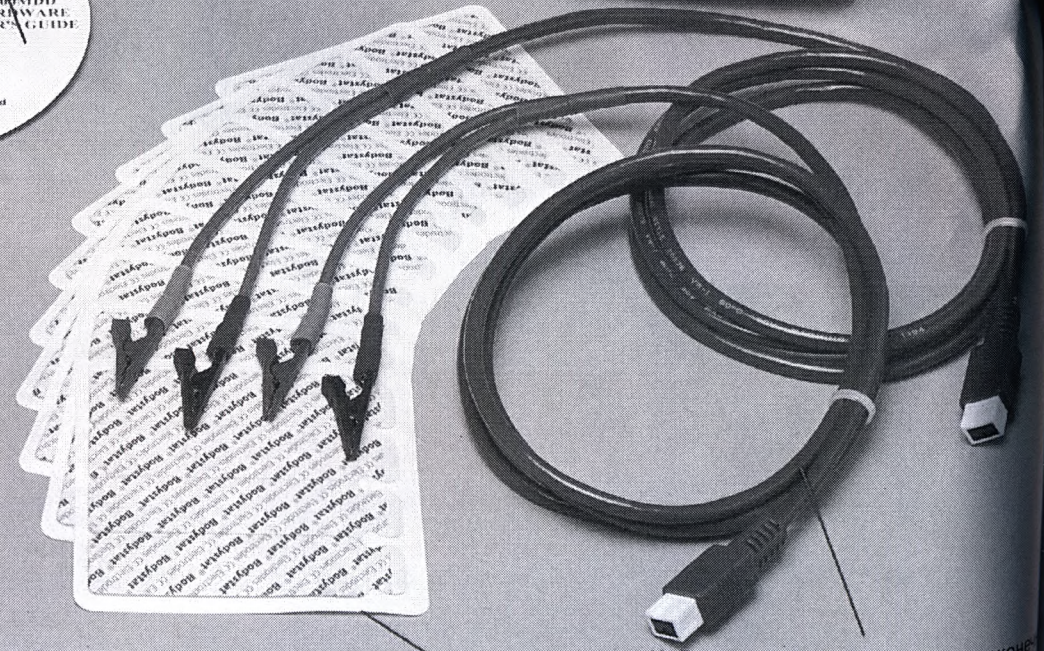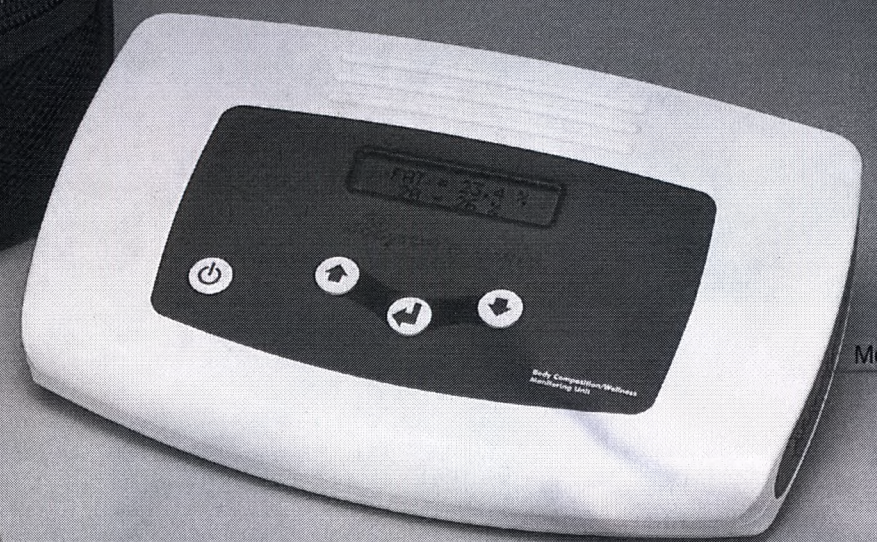

Сшито и заверено печатью 5
(ксер) лист об

Генеральный директор
ООО «Б.Браун Авитум Руссланд»
С. Тйаги

