



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Медента»
Терехов В.В.

« 05 » октября 2021г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАКЕТА МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Аппарат стоматологический Dentaport ZX (DP-ZX) Module Apexlocator
RSM-EX для определения длины корневых каналов с принадлежностями.**

Производства J. MORITA MFG. CORP.,
адрес: 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8533, Япония.


1) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (общий вид)



2) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид спереди)

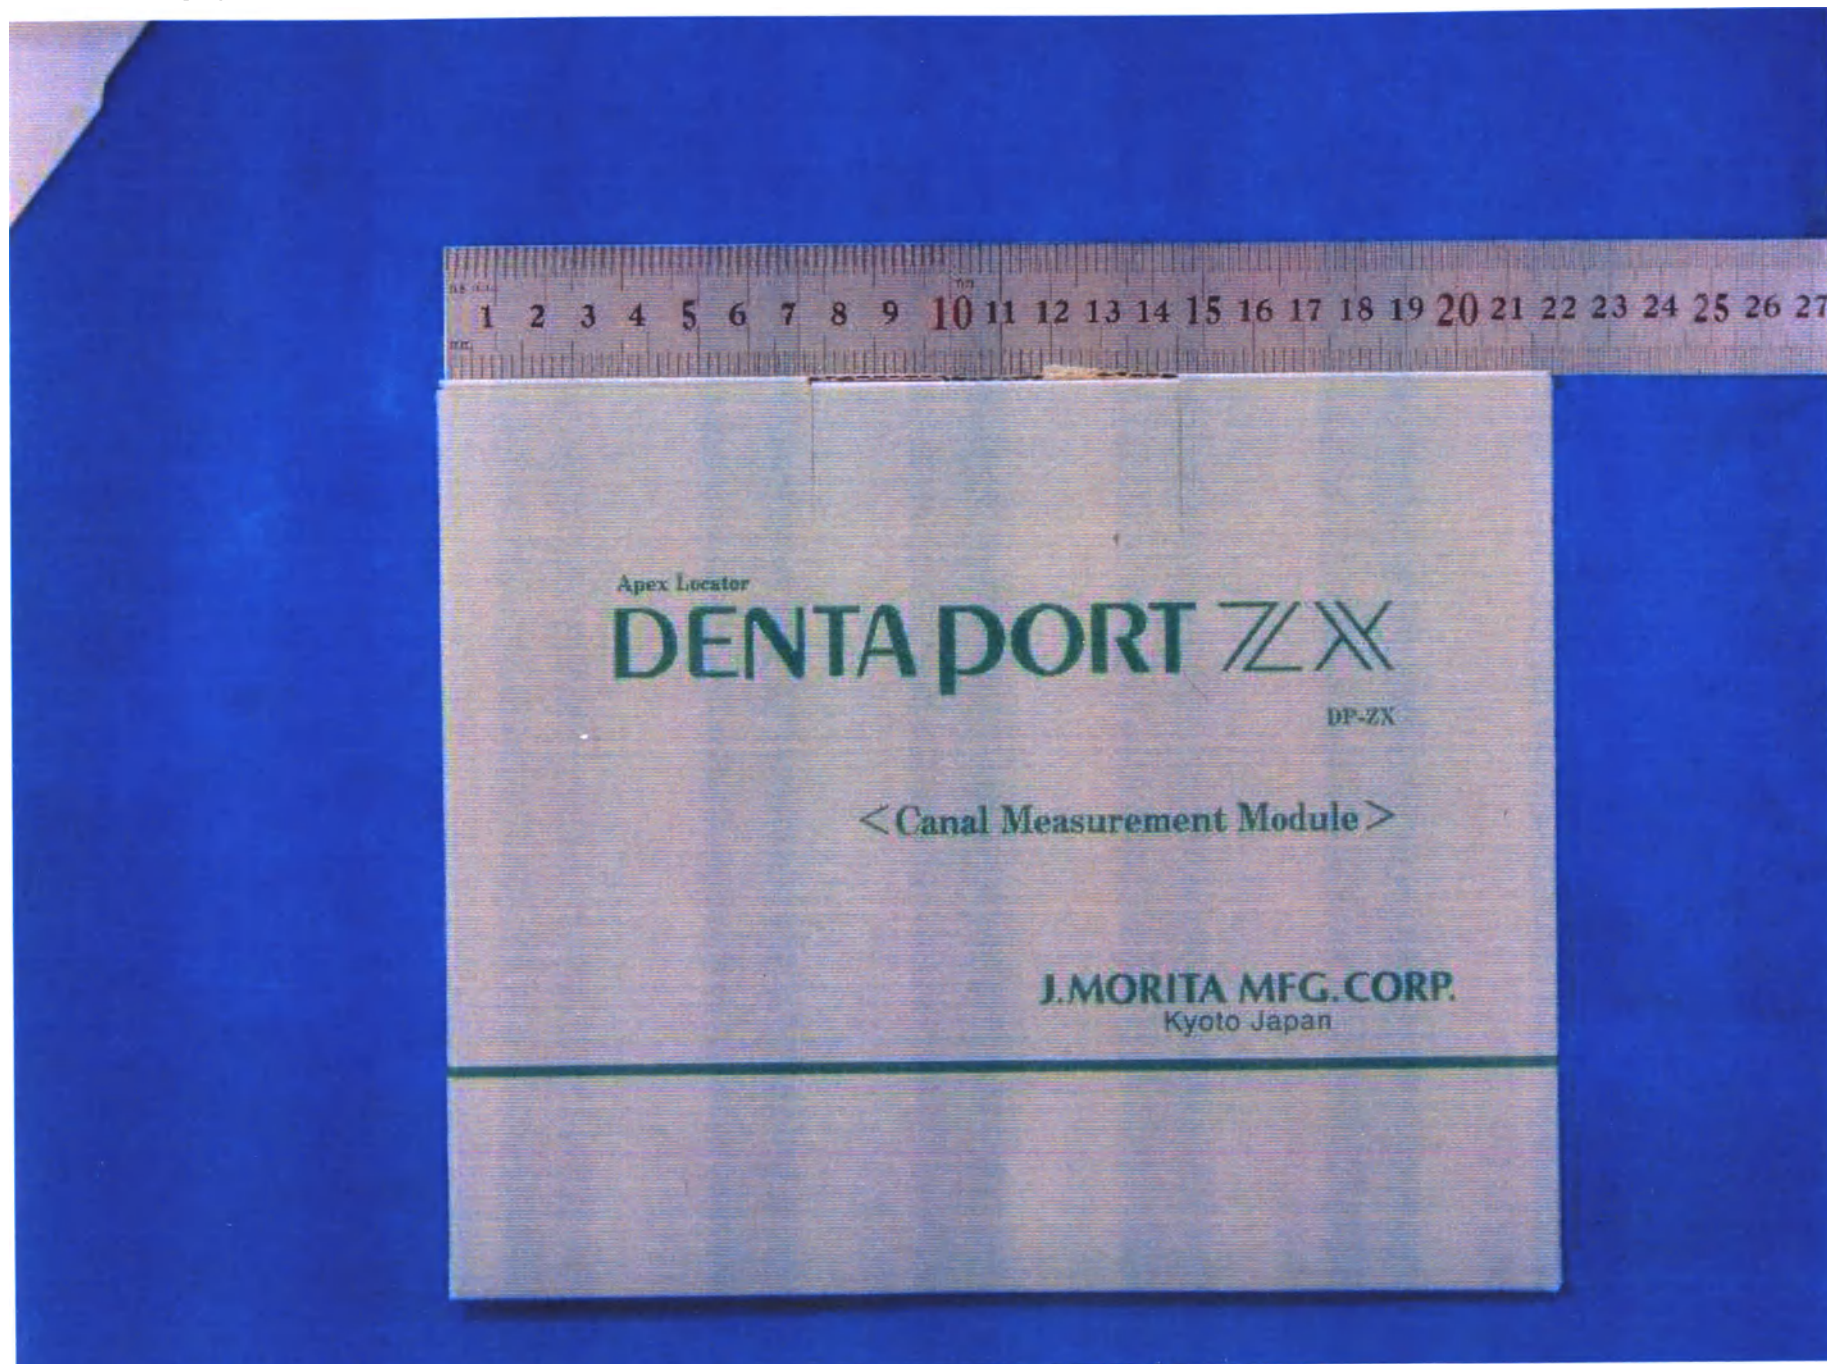

3) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид сзади)

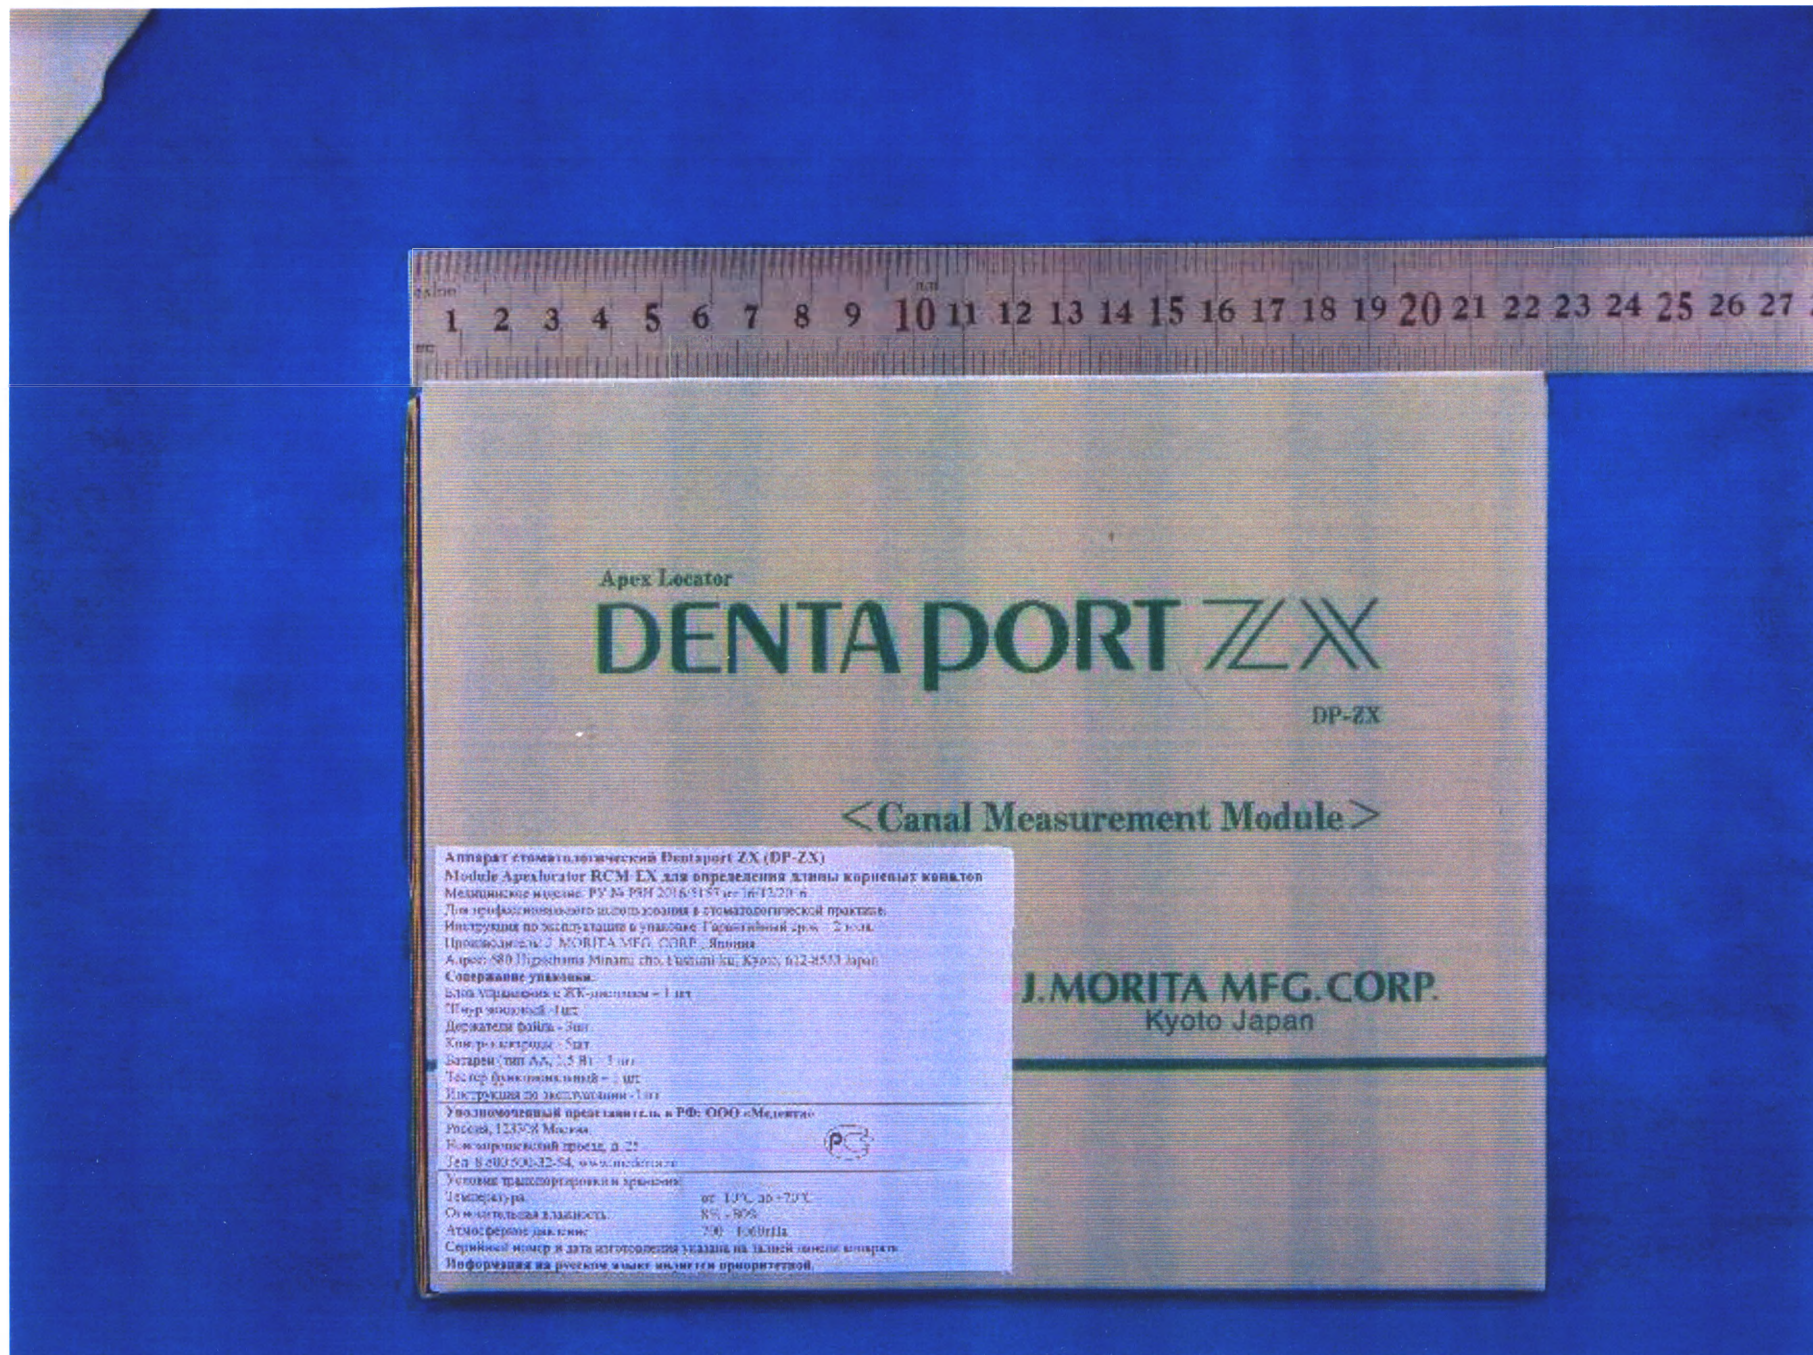

Аппарат стоматологический Dentaport ZX (DP-ZX)

Module Apexlocator RCM-EX для определения длины корневых каналов

Медицинское изделие. РУ № РЗН 2016/5157 от 16/12/2016

Для профессионального использования в стоматологической практике.

Инструкция по эксплуатации в упаковке. Гарантийный срок – 2 года.

Производитель: J. MORITA MFG. CORP., Япония

Адрес: 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8533 Japan

Содержание упаковки:

Блок управления с ЖК-дисплеем – 1 шт.

Шнур зондовый -1шт.

Держатели файла - 3шт.

Контр-электроды - 5шт

Батареи (тип AA, 1,5 В) – 3 шт.

Тестер функциональный -- 1 шт

Инструкция по эксплуатации -1шт.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медента»

Россия, 123308 Москва,

Новохорошевский проезд, д. 25

Тел. 8 800 500-32-54, www.medenta.ru



Условия транспортировки и хранения:

Температура: от -10°C до +70°C

Относительная влажность: 8% - 80%

Атмосферное давление: 700 - 1060гПа


Серийный номер и дата изготовления указана на задней панели аппарата.

Информация на русском языке является приоритетной.


5) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид справа)




6) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид слева)

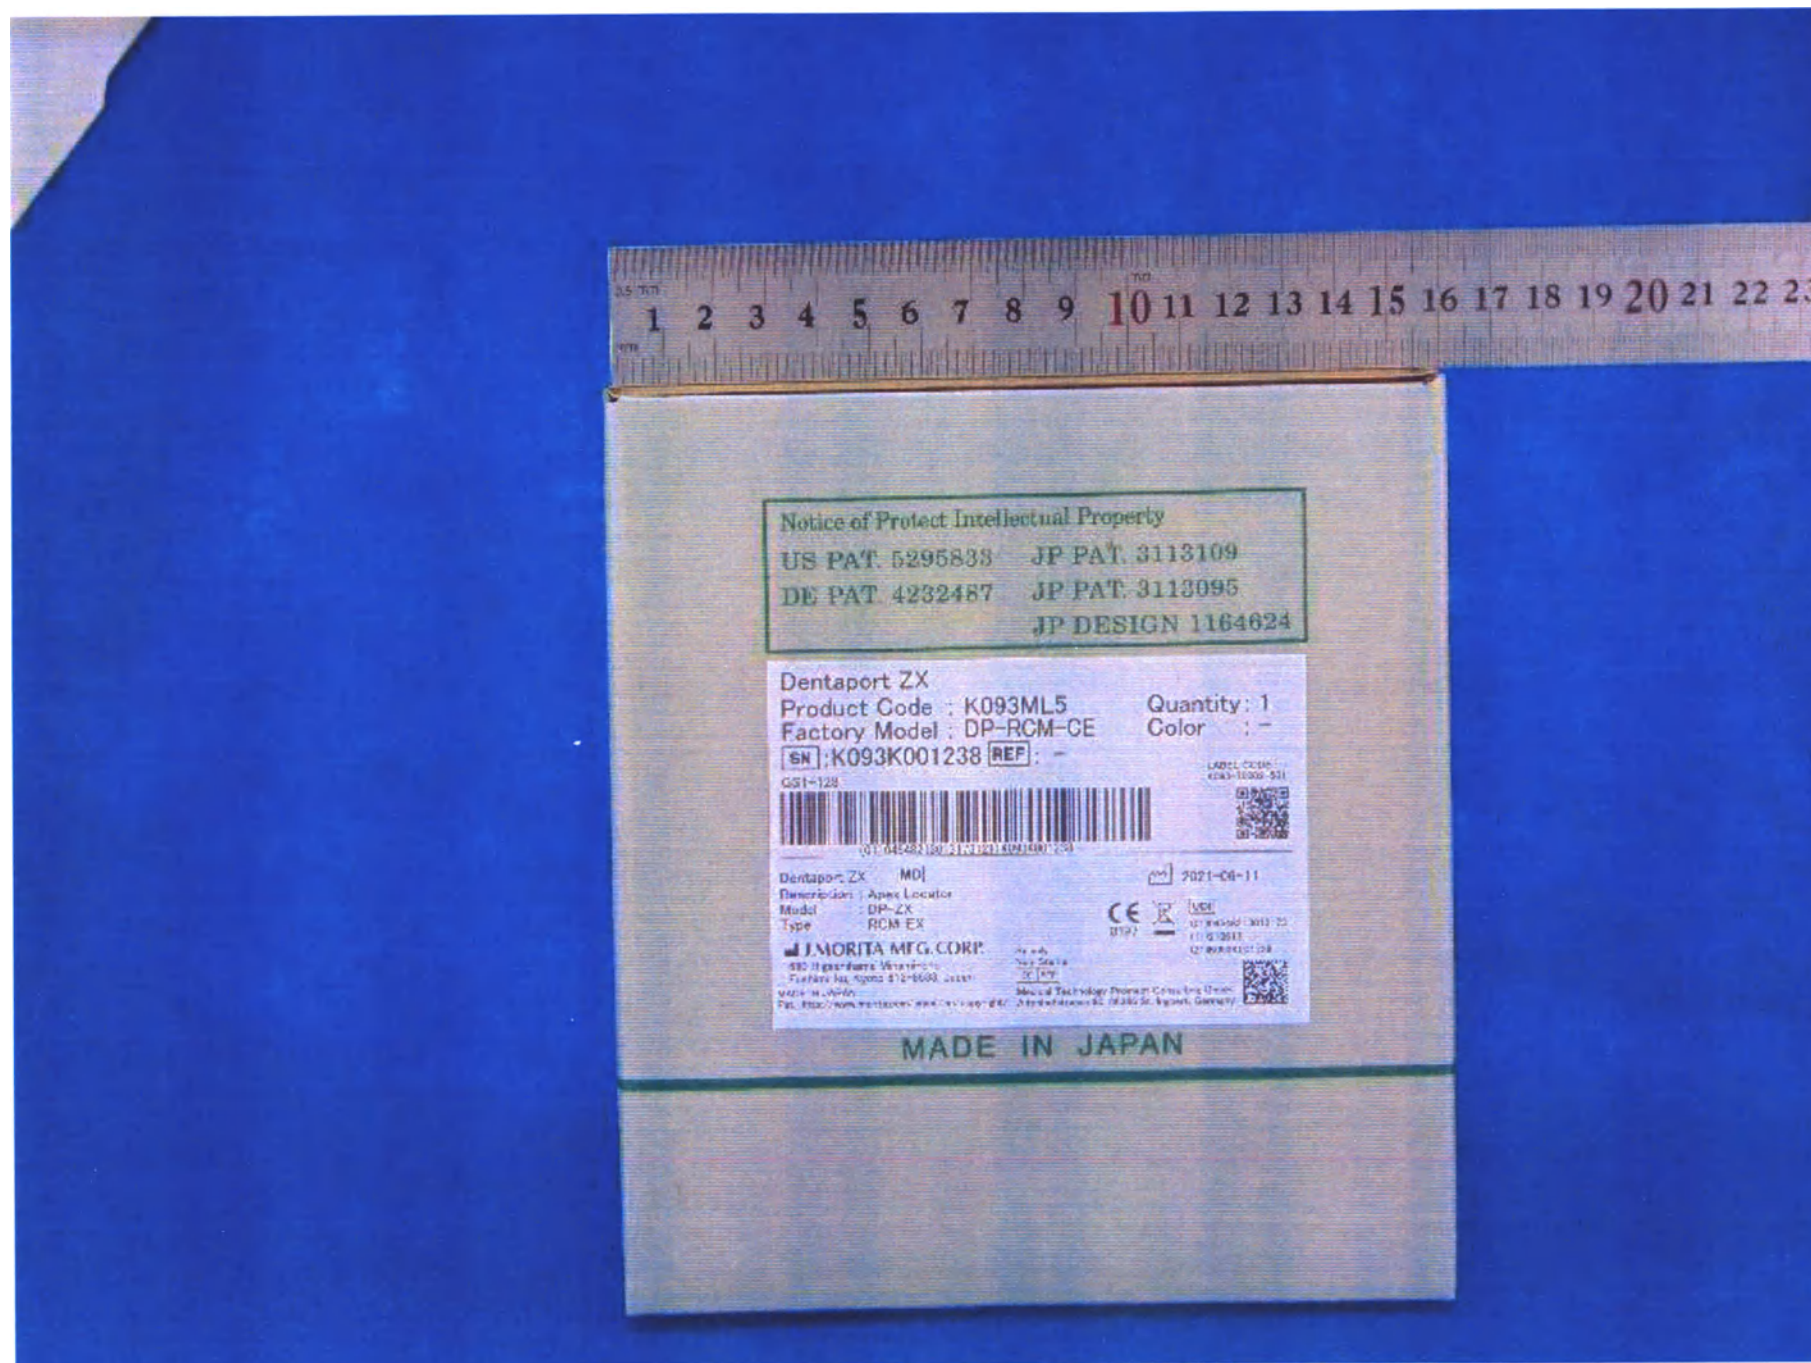

7) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид сверху)

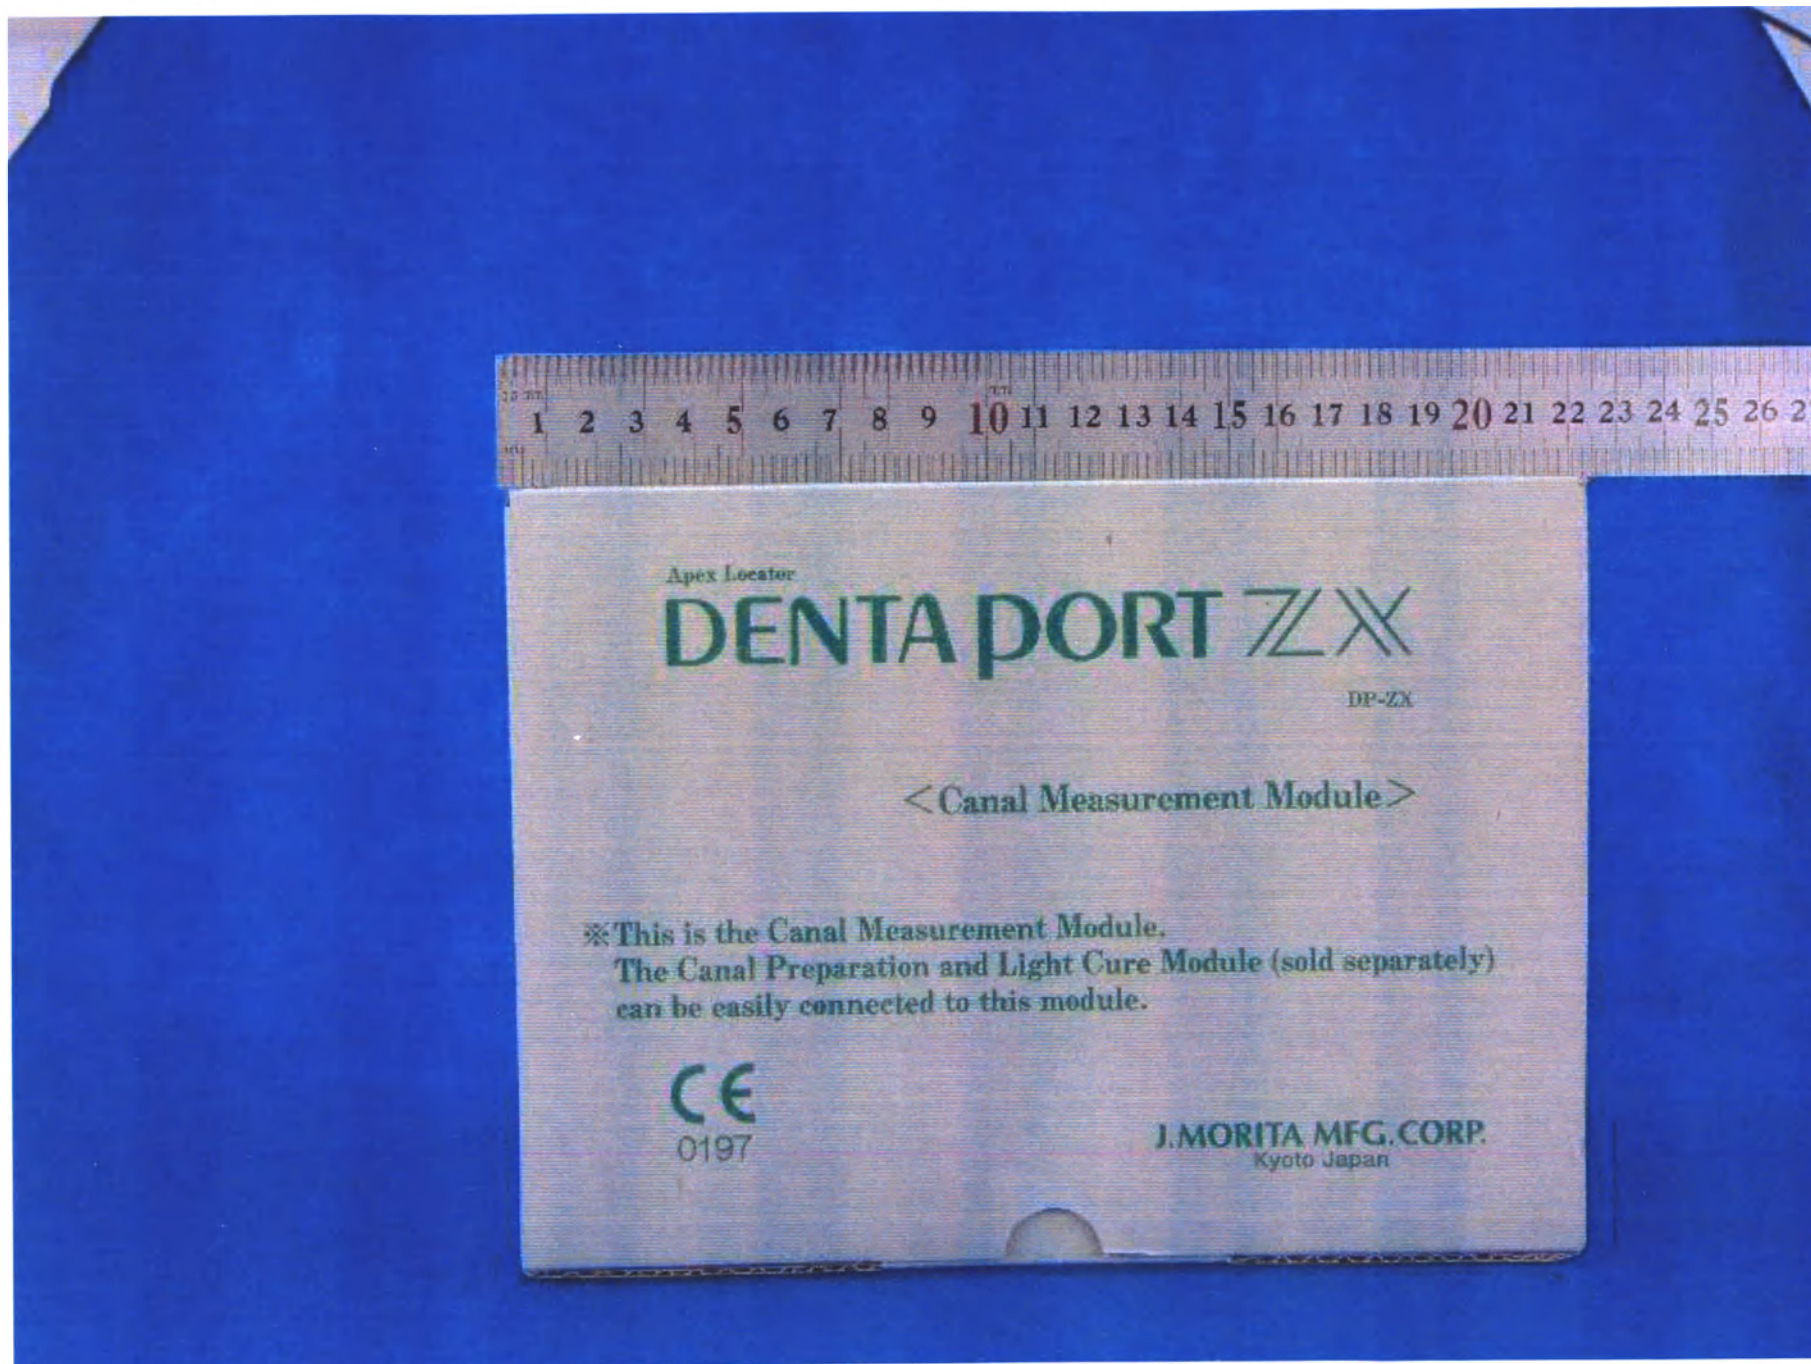


8) Фотография макета маркировки и упаковки медицинского изделия (содержимое упаковки).

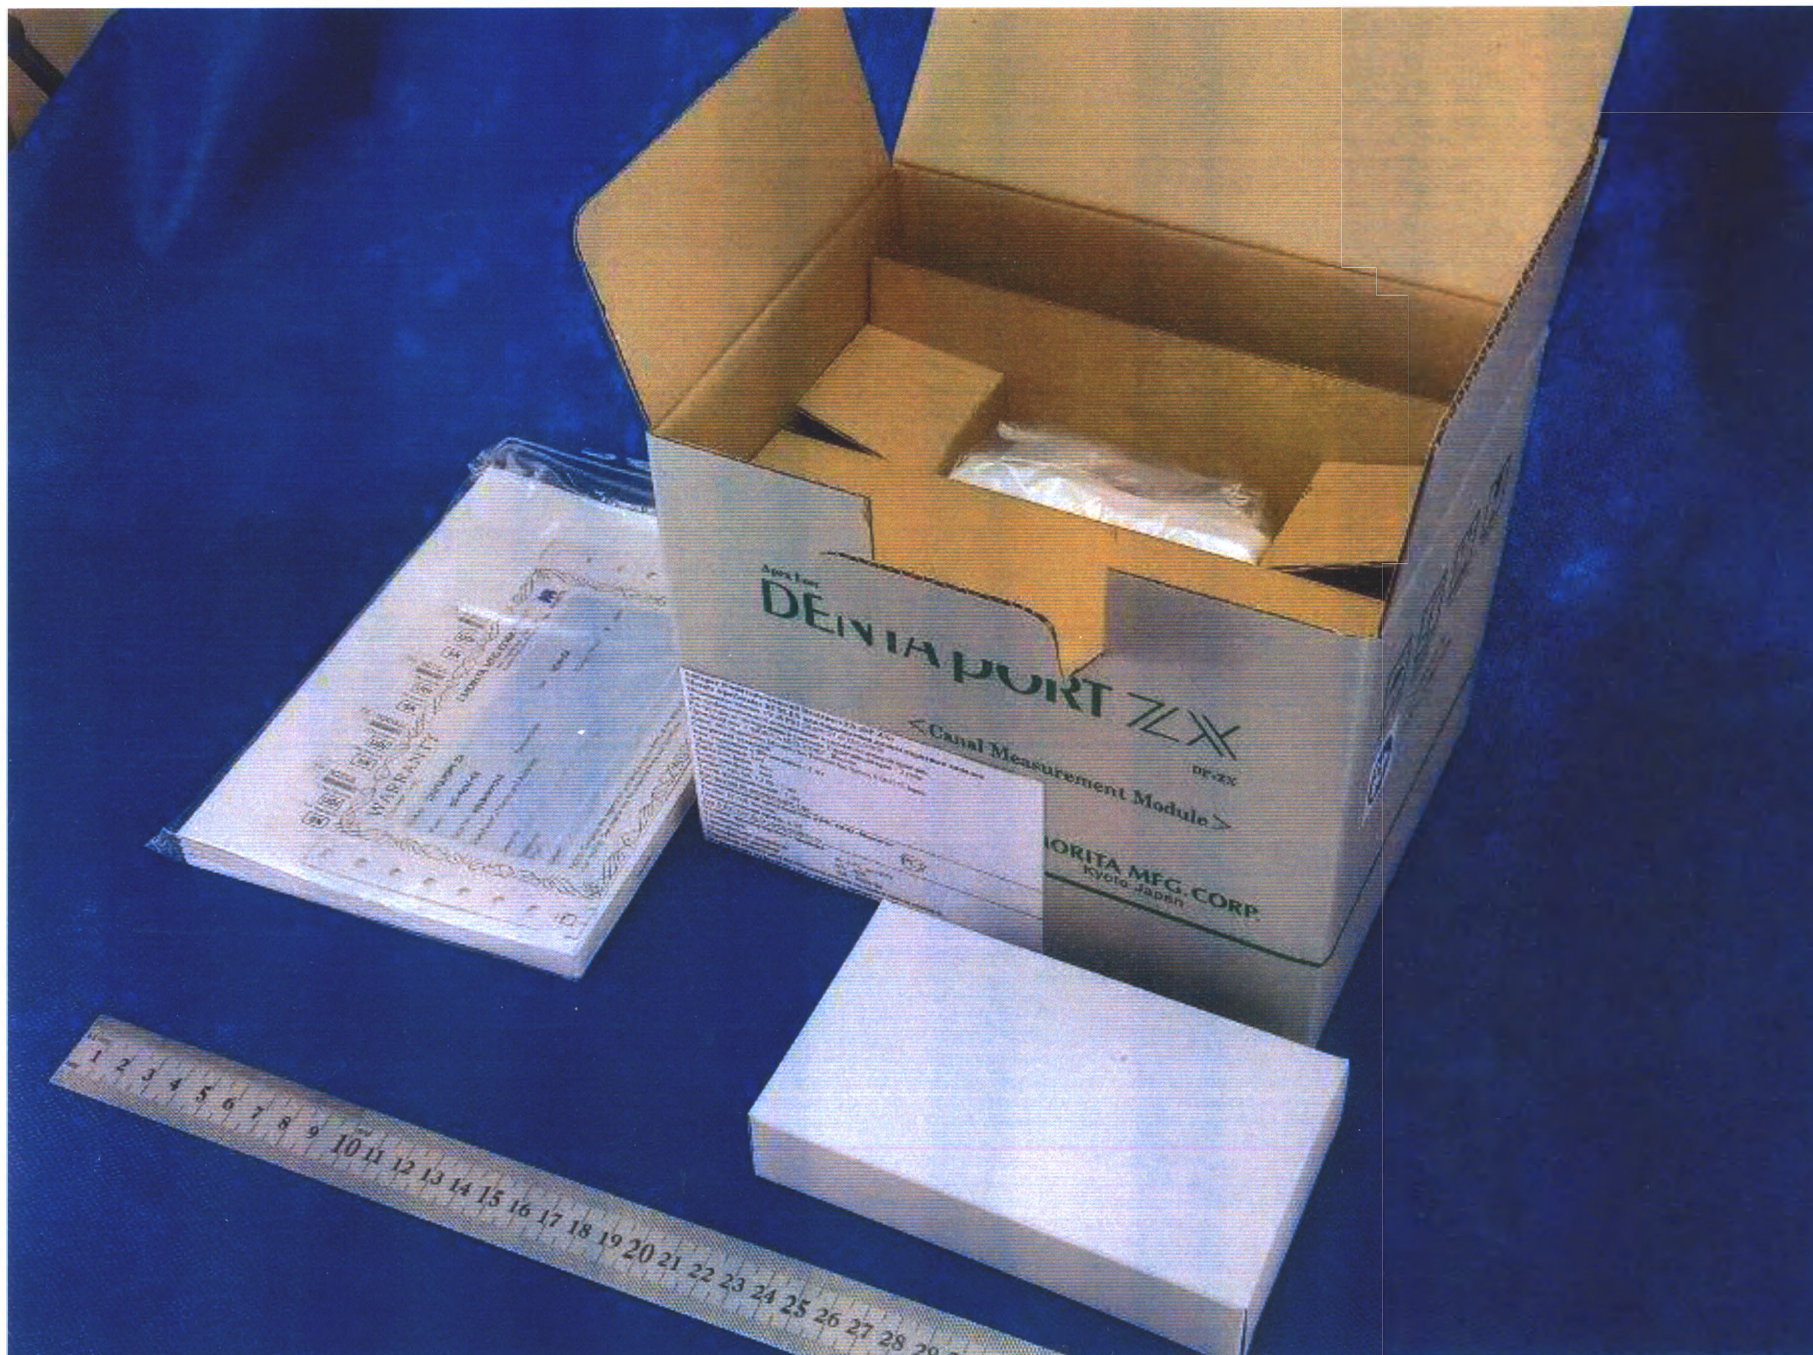

9) Фотография блока управления с ЖК-дисплеем (общий вид).



10) Фотография шильдика на блоке управления с ЖК-дисплеем.

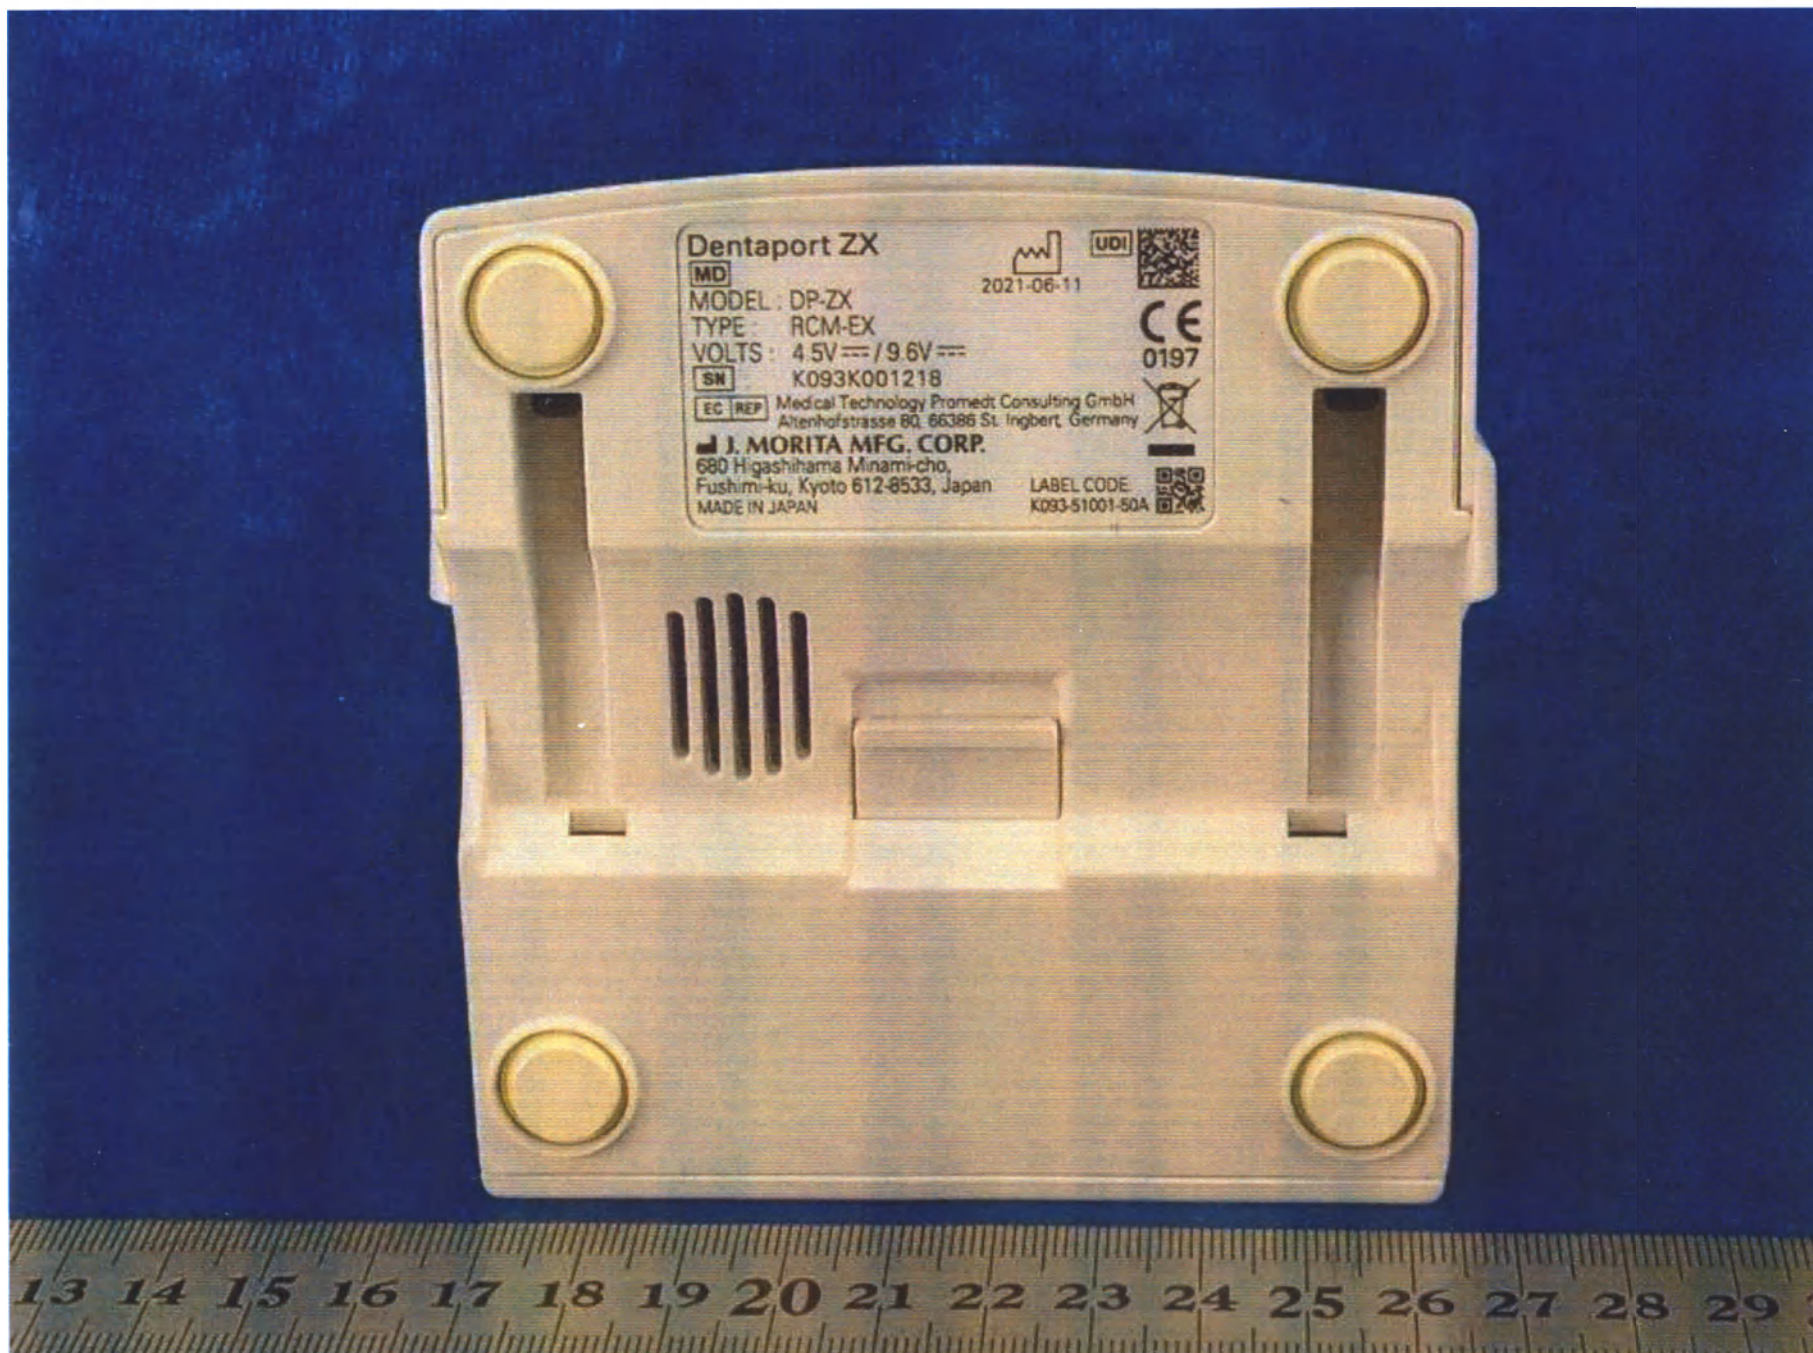

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
11/одинадцать листов
Ген. Директор ООО «Медента»

В. В. Терехов

