

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Медента»
Терехов В.В.


«05» октября 2021г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МАКЕТА МАРКИРОВКИ И УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Аппарат стоматологический Dentaport ZX (DP-ZX) Module TR-EX Ver. DP-TR3
для лечения корневых каналов с принадлежностями.**

Производства J. MORITA MFG. CORP.,
адрес: 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8533, Япония.


1) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (общий вид).

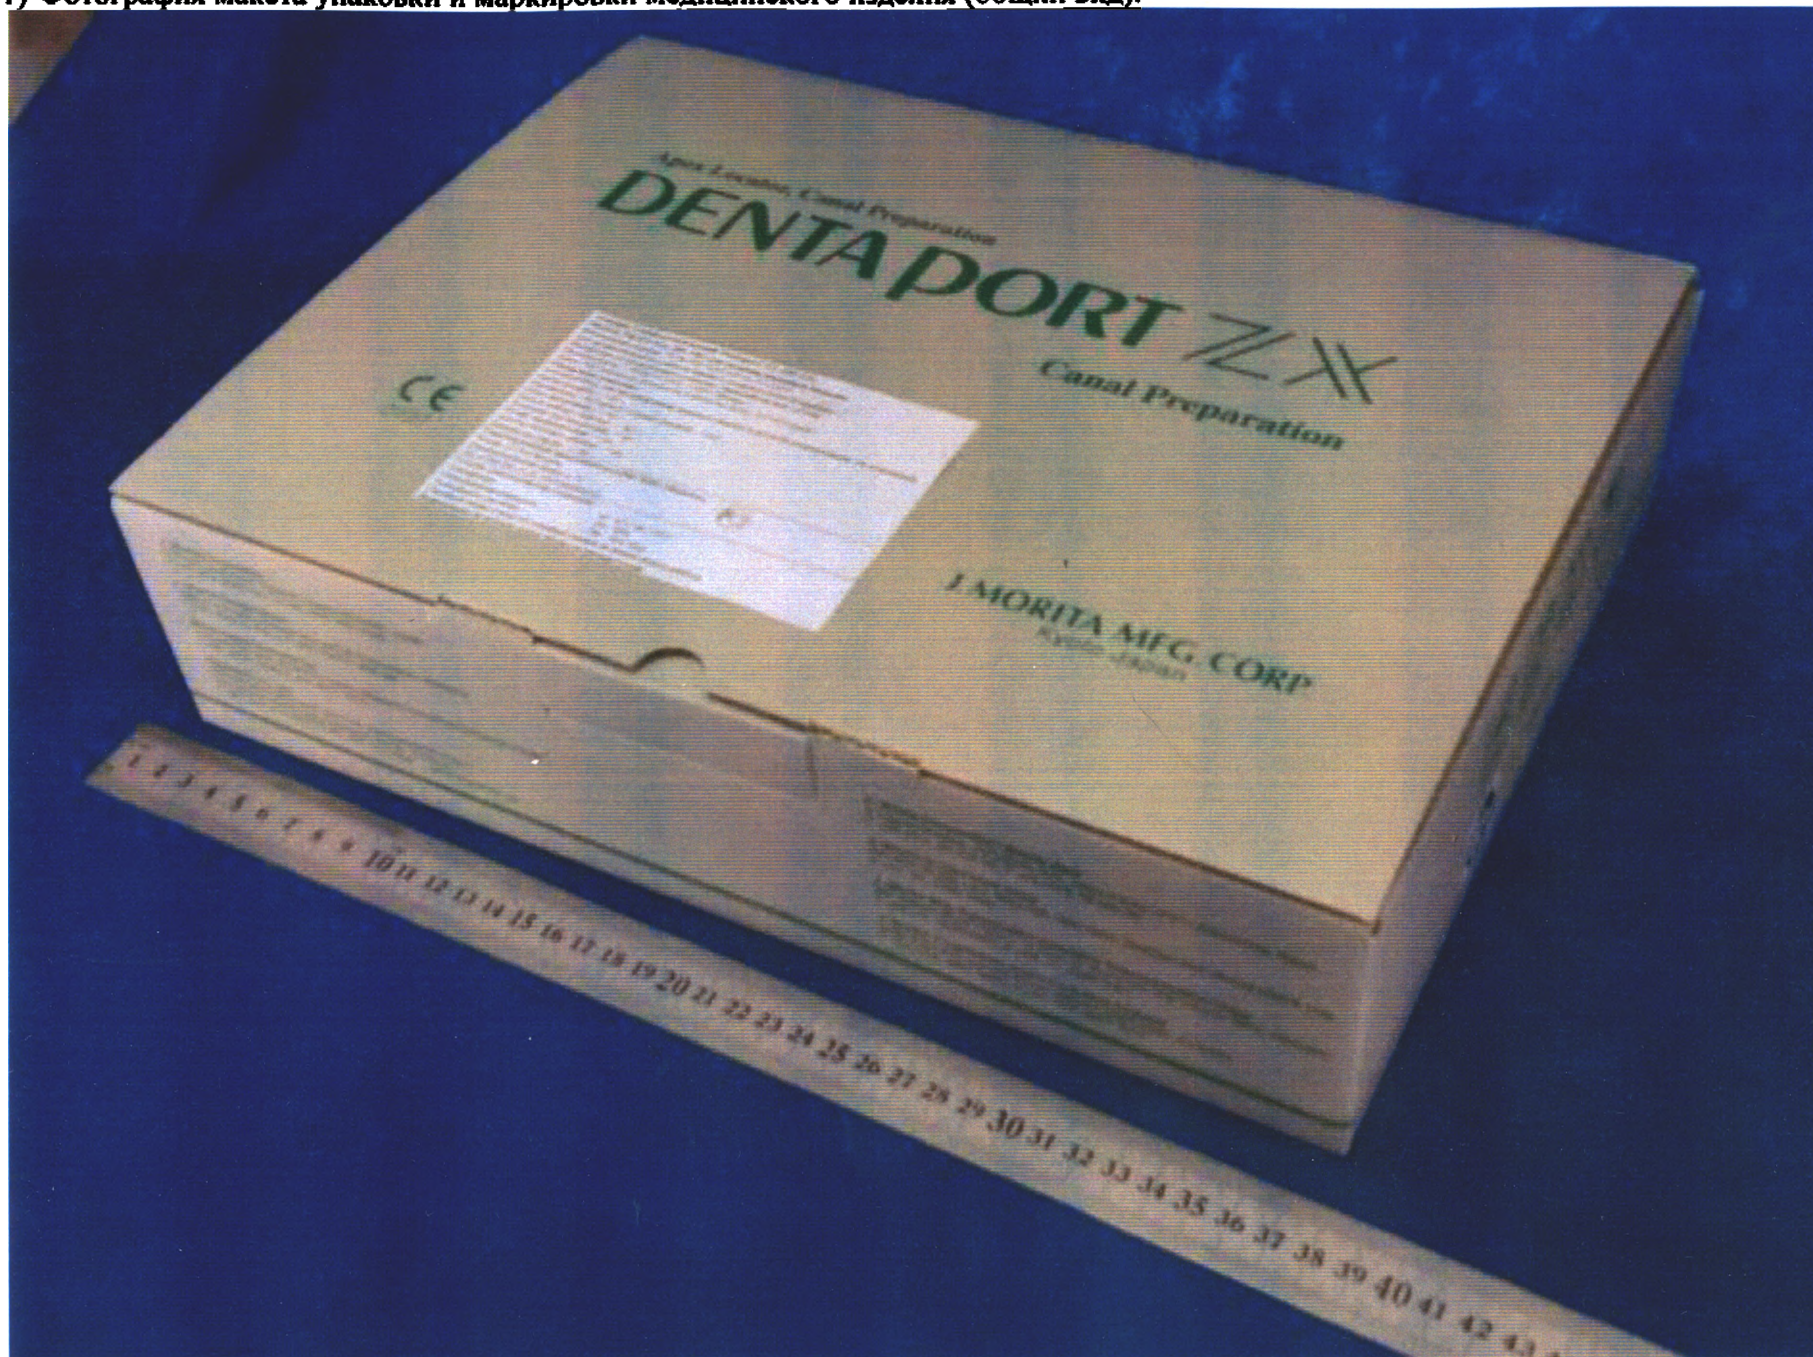

2) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид спереди).

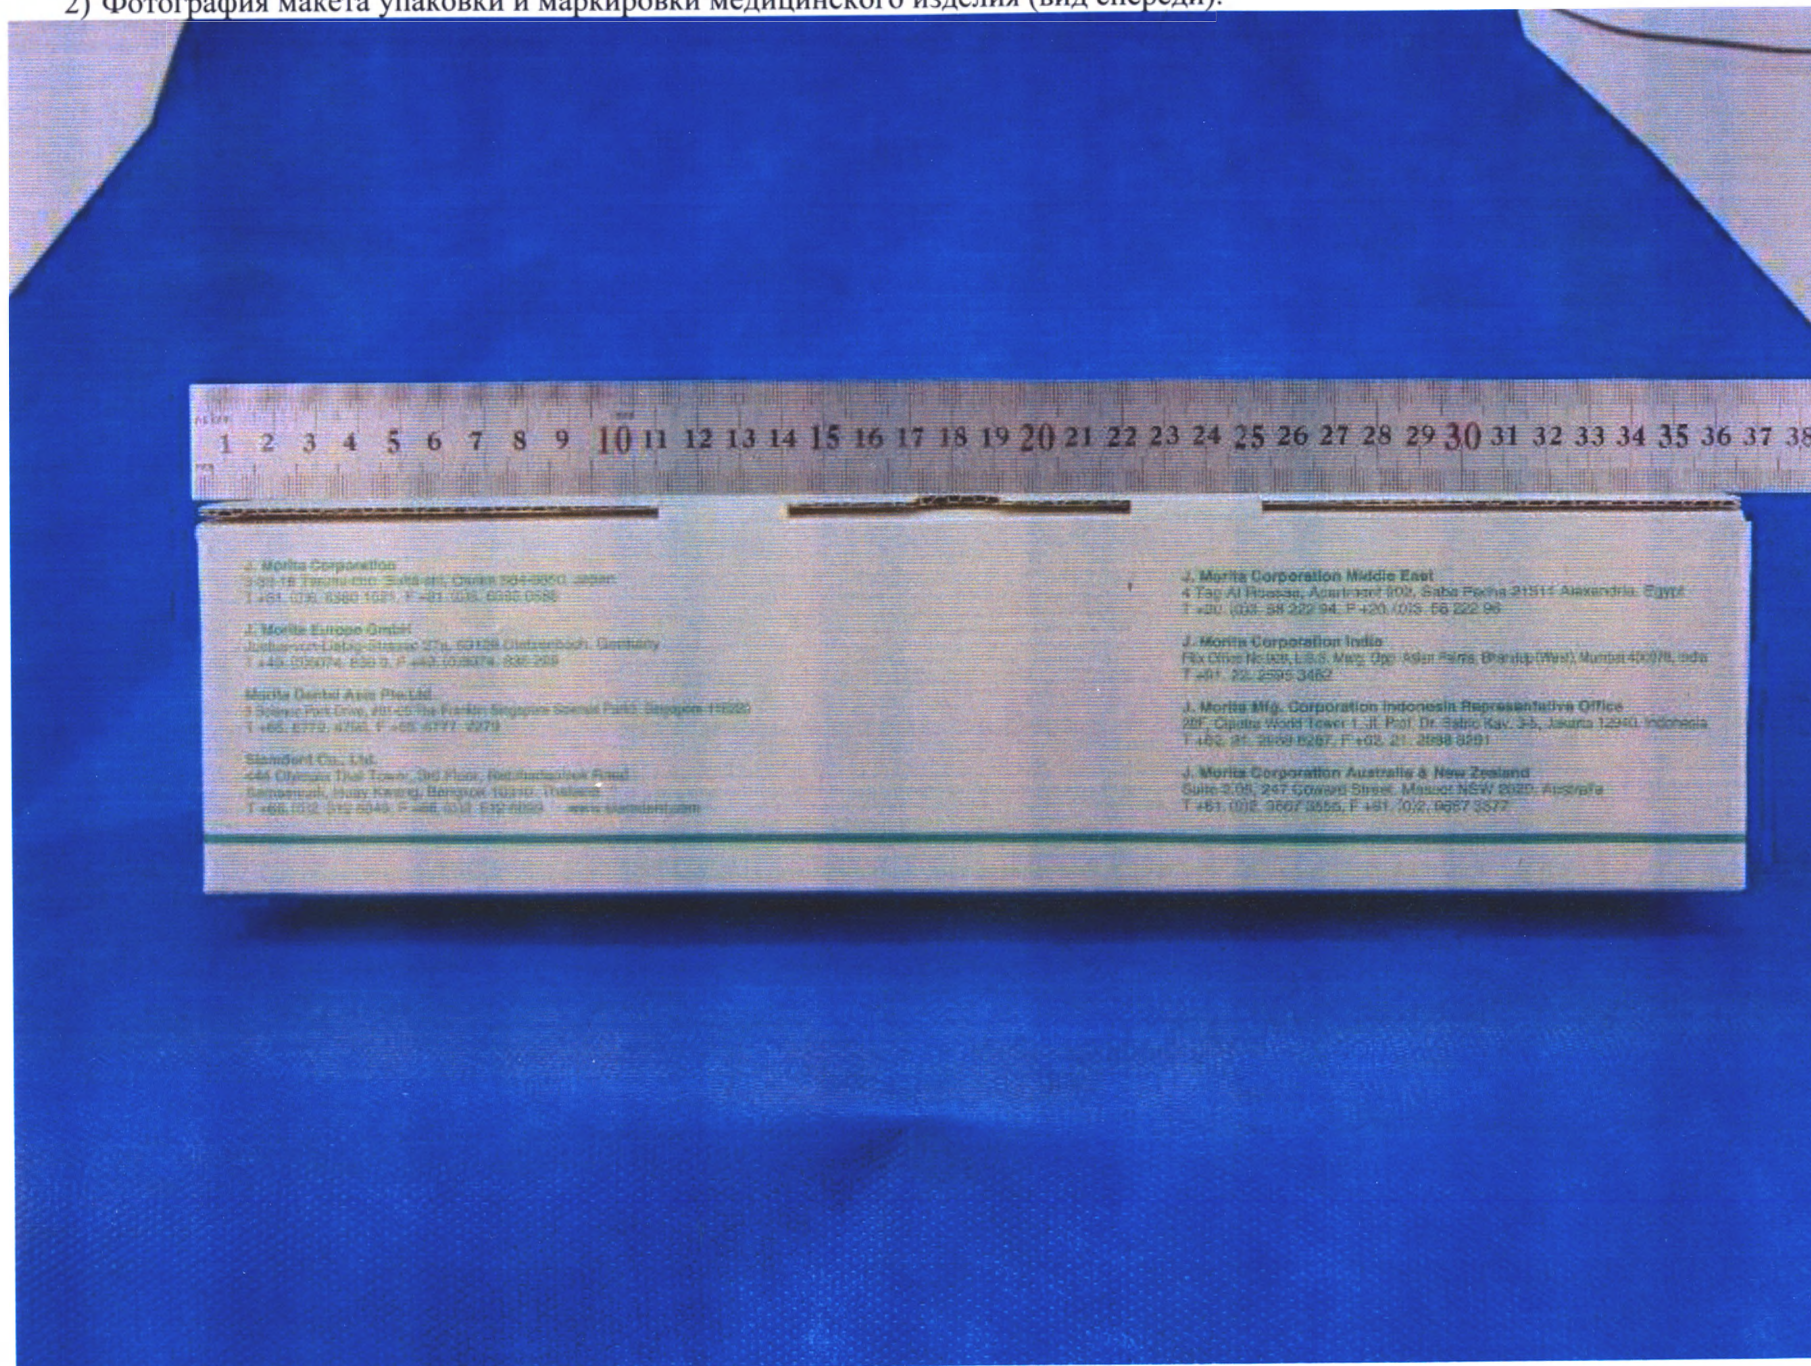


3) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид сзади).

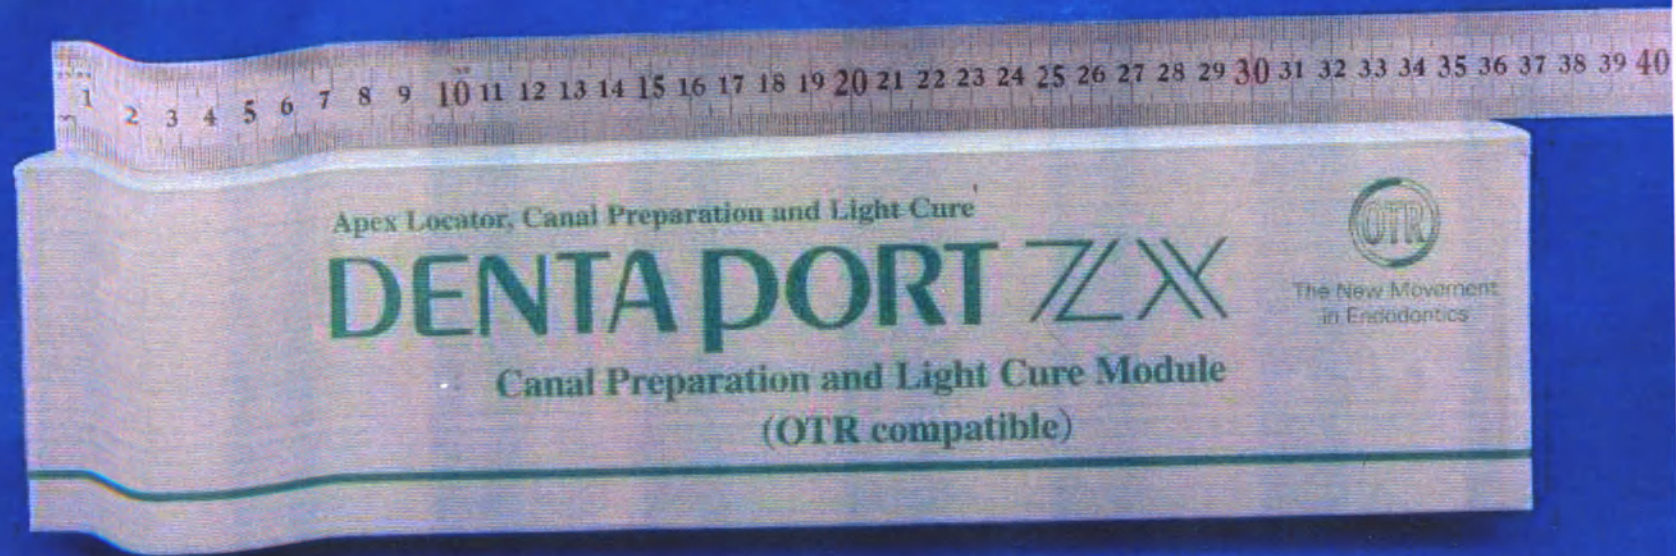


4) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид справа).




4) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид справа).

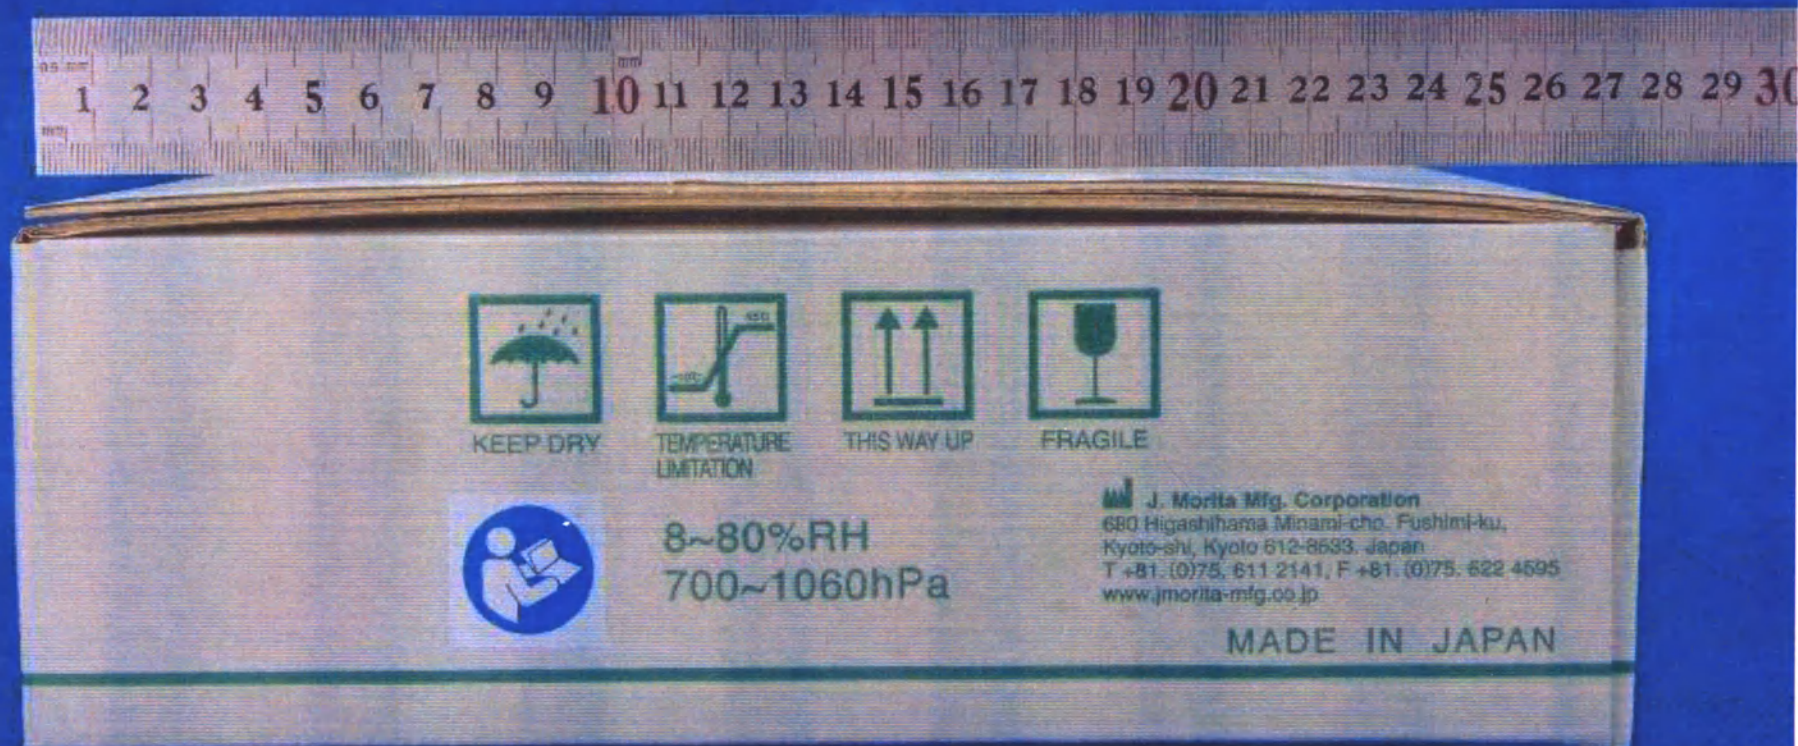

5) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид слева).

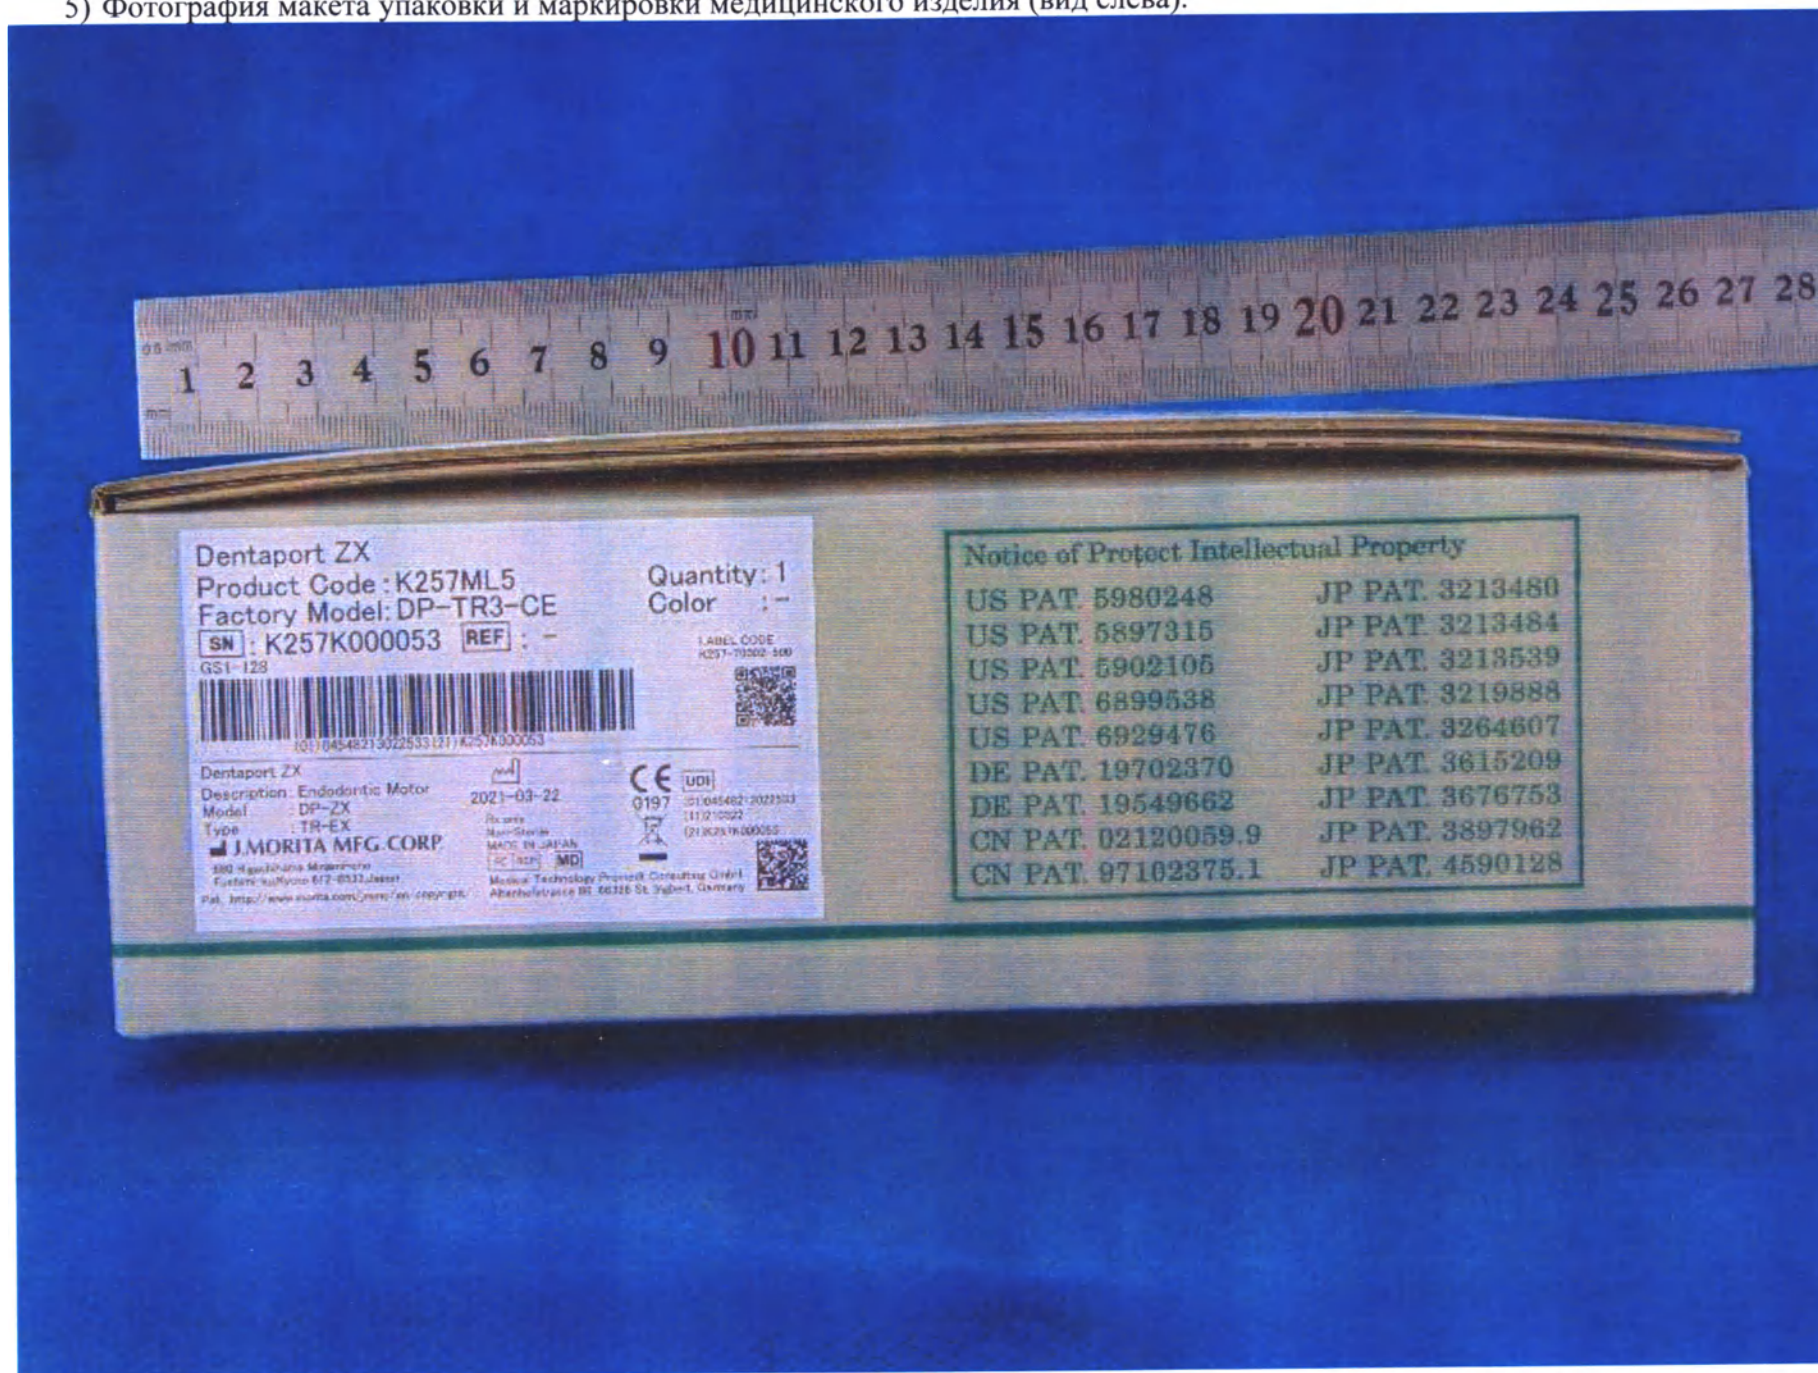

6) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид сверху).

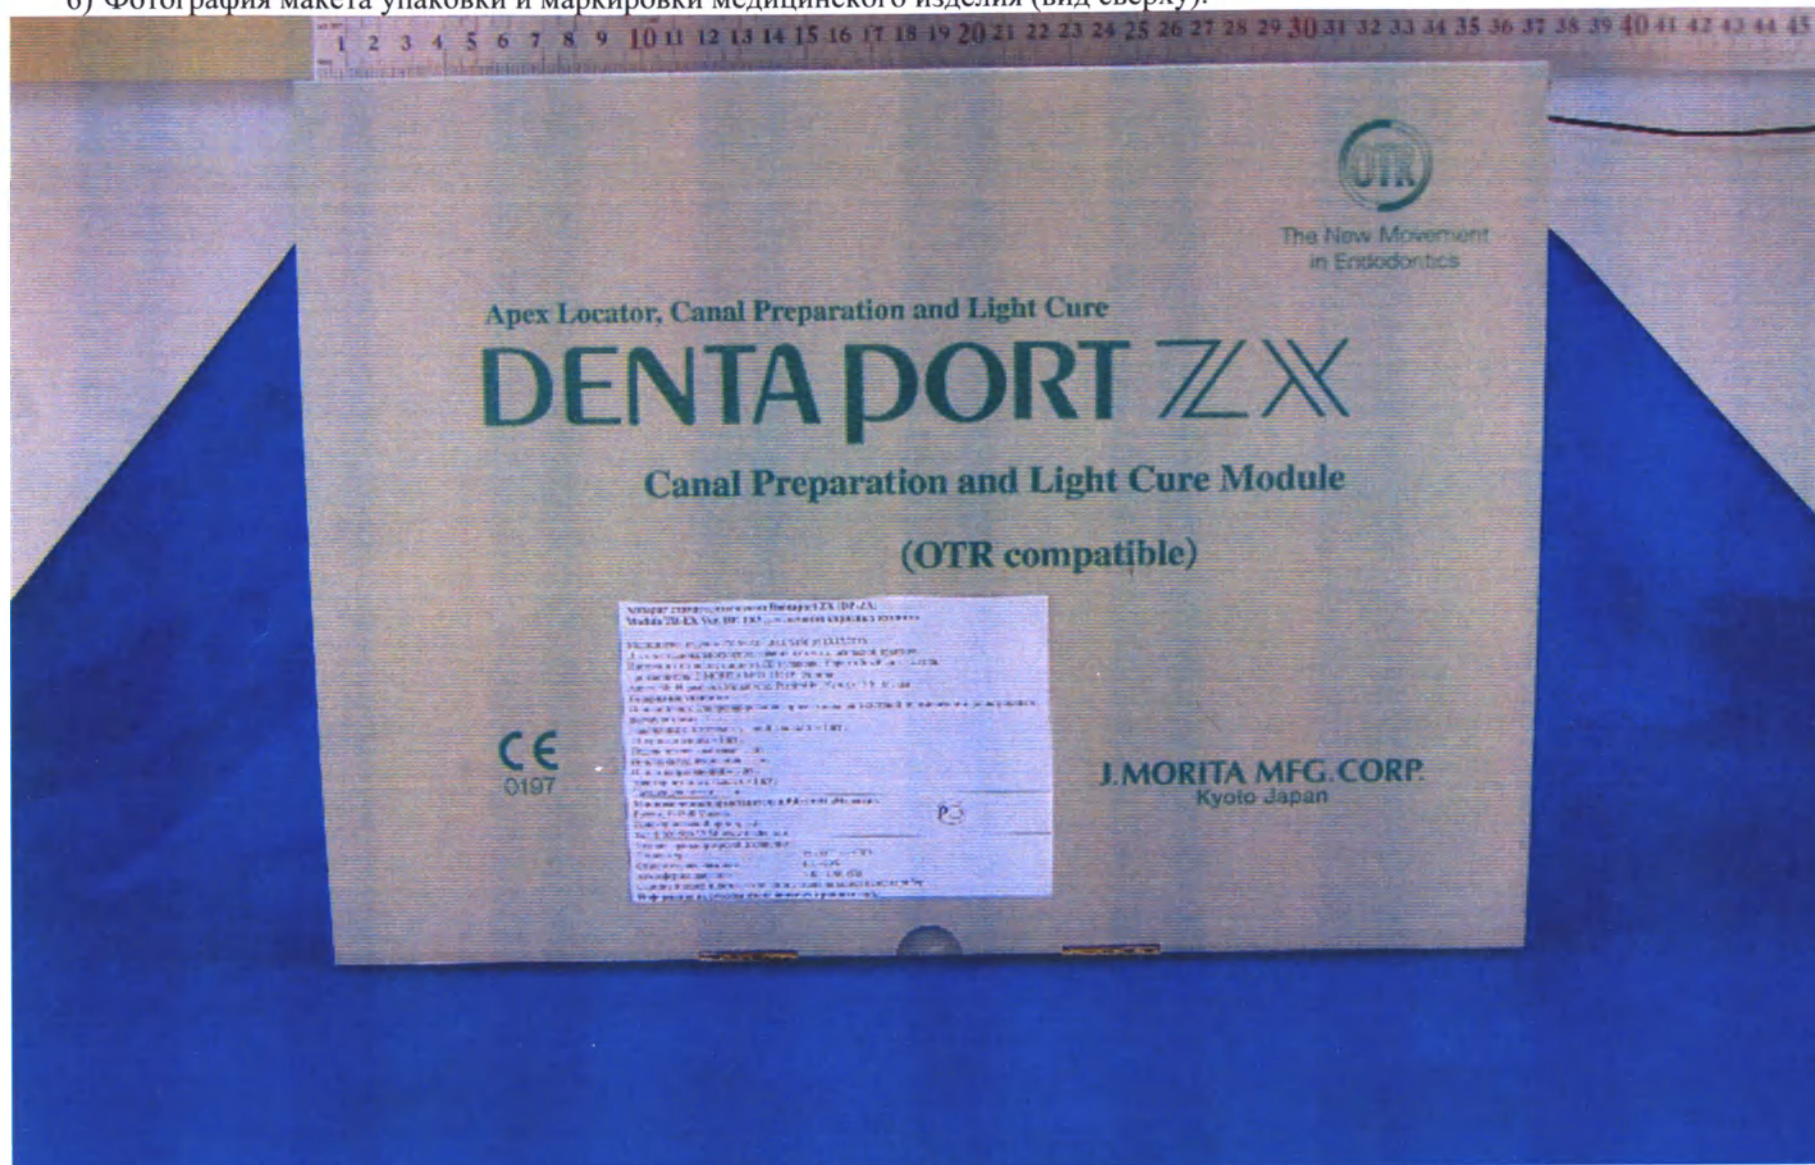

Аппарат стоматологический Dentaport ZX (DP-ZX)
Module TR-EX Ver. DP-TR3 для лечения корневых каналов.

Медицинское изделие. РУ № РЗН 2016/5156 от 19/12/2016.

Для профессионального использования в стоматологической практике.

Инструкция по эксплуатации на CD в упаковке. Гарантийный срок – 2 года.

Производитель: J. MORITA MFG. CORP., Япония

Адрес: 680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8533 Japan

Содержание упаковки:

Основной блок для препарирования корневых каналов и световой полимеризации (со встроенным аккумулятором) – 1 шт.;

Наконечник с мотором и угловой головкой – 1 шт.;

Шнур наконечника – 1 шт.;

Педаль ножная с кабелем – 1 шт.;

Подставка под наконечник – 1 шт.;

Штифт направляющий – 1 шт.;

Адаптер питания с кабелем – 1 шт.;

Насадка для смазки – 1 шт.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медента»,
Россия, 123308 Москва,
Новохорошевский проезд, д. 25
Тел. 8 800 500-32-54, www.medenta.ru



Условия транспортировки и хранения:

Температура: от -10°C до +70°C

Относительная влажность: 8% - 80%

Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа

Серийный номер и дата изготовления указана на задней панели прибора.

Информация на русском языке является приоритетной.

Аппарат стоматологический Dentaport ZX (DP-ZX)
Module TR-EX Ver. DP-TR3 для лечения корневых каналов.

Медицинское изделие. РУ № РЗН 2016/5156 от 19/12/2016.

Для профессионального использования в стоматологической практике.

Инструкция по эксплуатации на CD в упаковке. Гарантийный срок – 2 года.

Производитель: J. MORITA MFG. CORP., Япония

Адрес: 680 Higasihami Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8533 Japan

Содержание упаковки:

Основной блок для препарирования корневых каналов и световой полимеризации (со встроенным аккумулятором) – 1 шт.;

Наконечник с мотором и угловой головкой – 1 шт.;

Шнур наконечника – 1 шт.;

Педаль ножная с кабелем – 1 шт.;

Подставка под наконечник – 1 шт.;

Штифт направляющий – 1 шт.;

Адаптер питания с кабелем – 1 шт.;

Насадка для смазки – 1 шт.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Медента»,

Россия, 123308 Москва,

Новохорошевский проезд, д. 25

Тел. 8 800 500-32-54, www.medenta.ru



Условия транспортировки и хранения:

Температура: от -10°C до +70°C


Относительная влажность: 8% - 80%

Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа

Серийный номер и дата изготовления указана на задней панели прибора.


Информация на русском языке является приоритетной.

8) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (вид снизу).

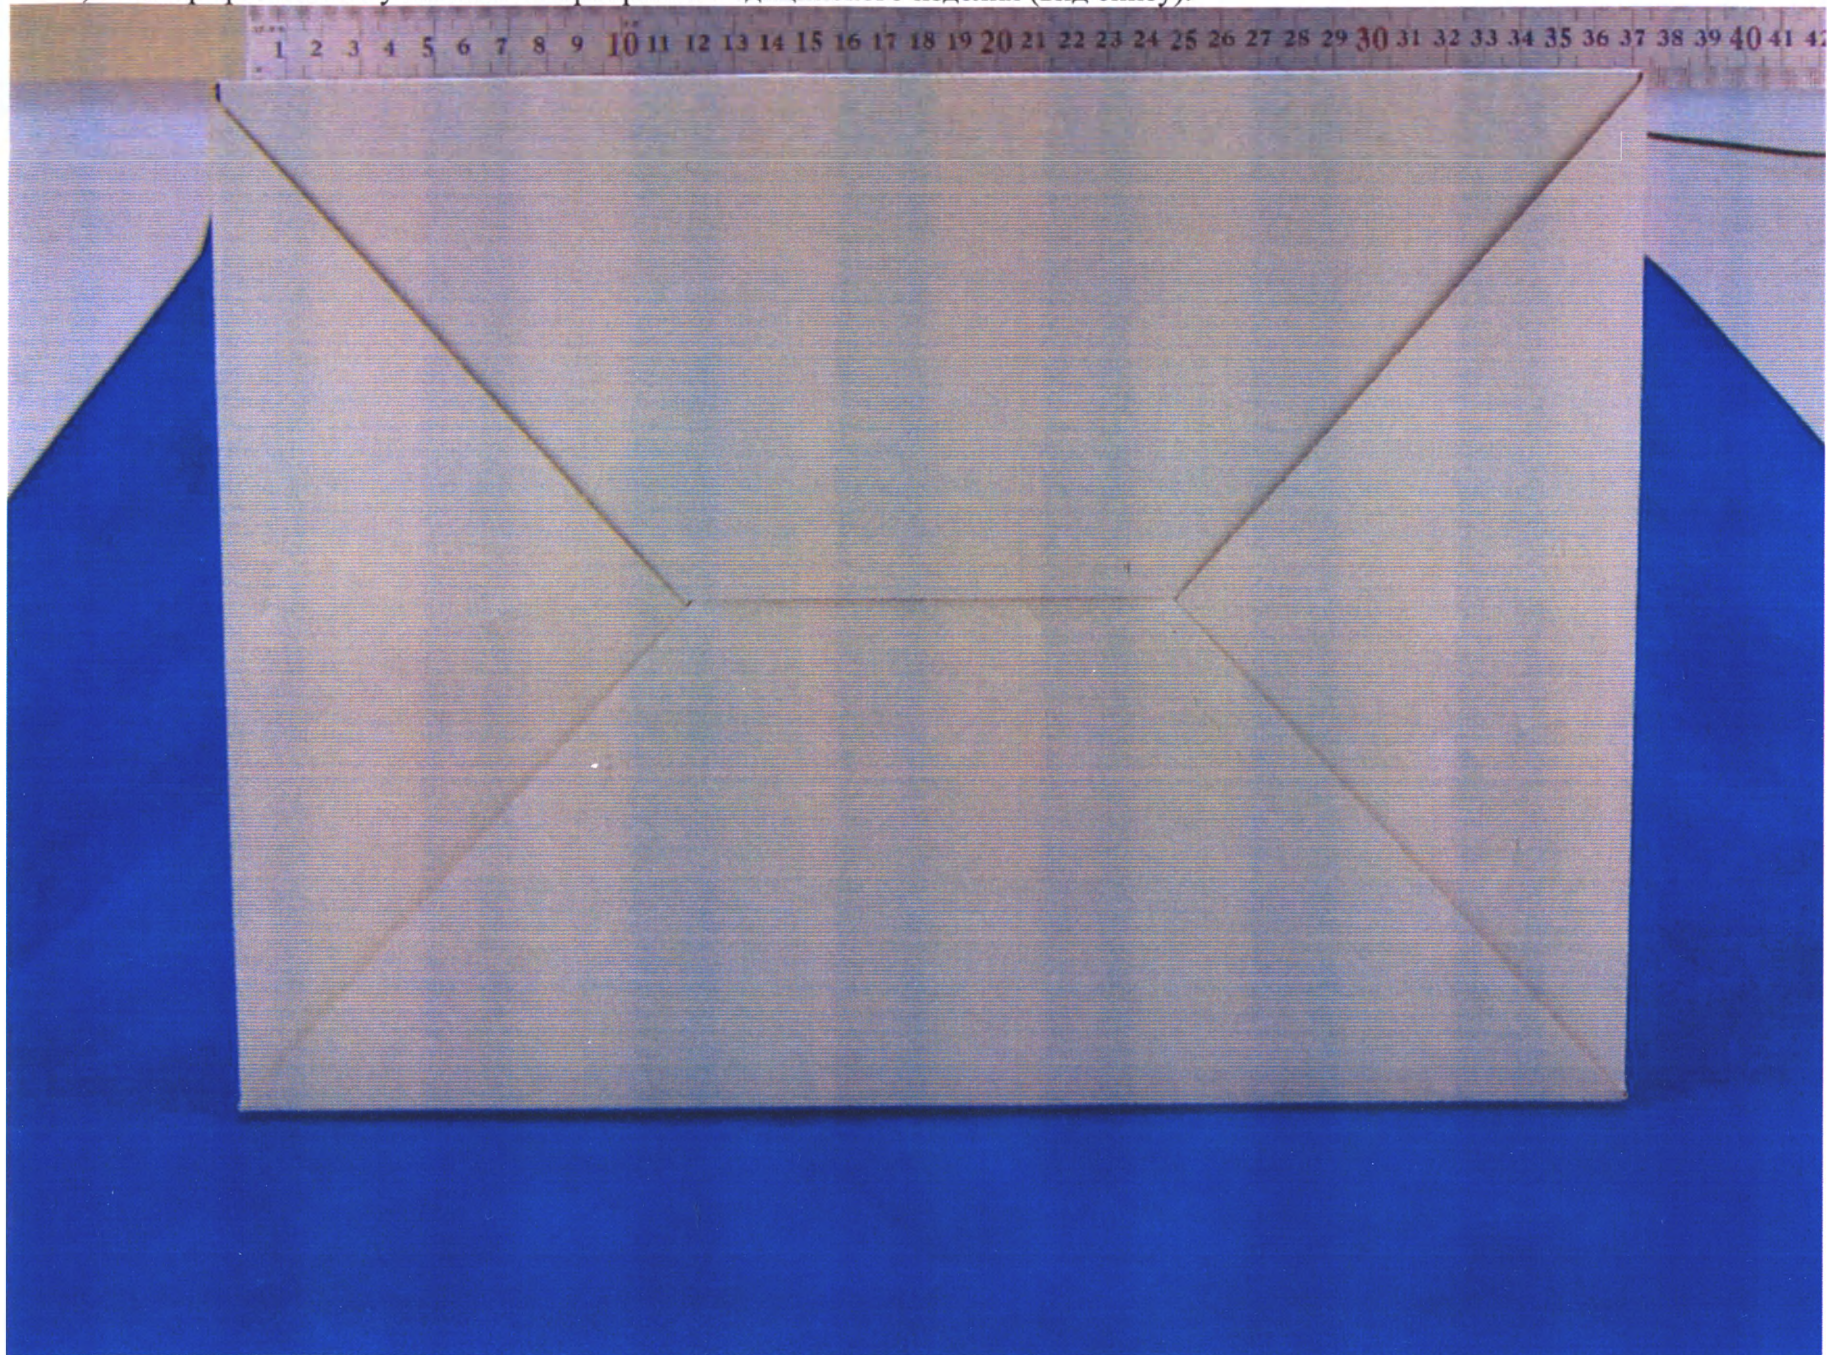

9) Фотография макета упаковки и маркировки медицинского изделия (содержимое упаковки).



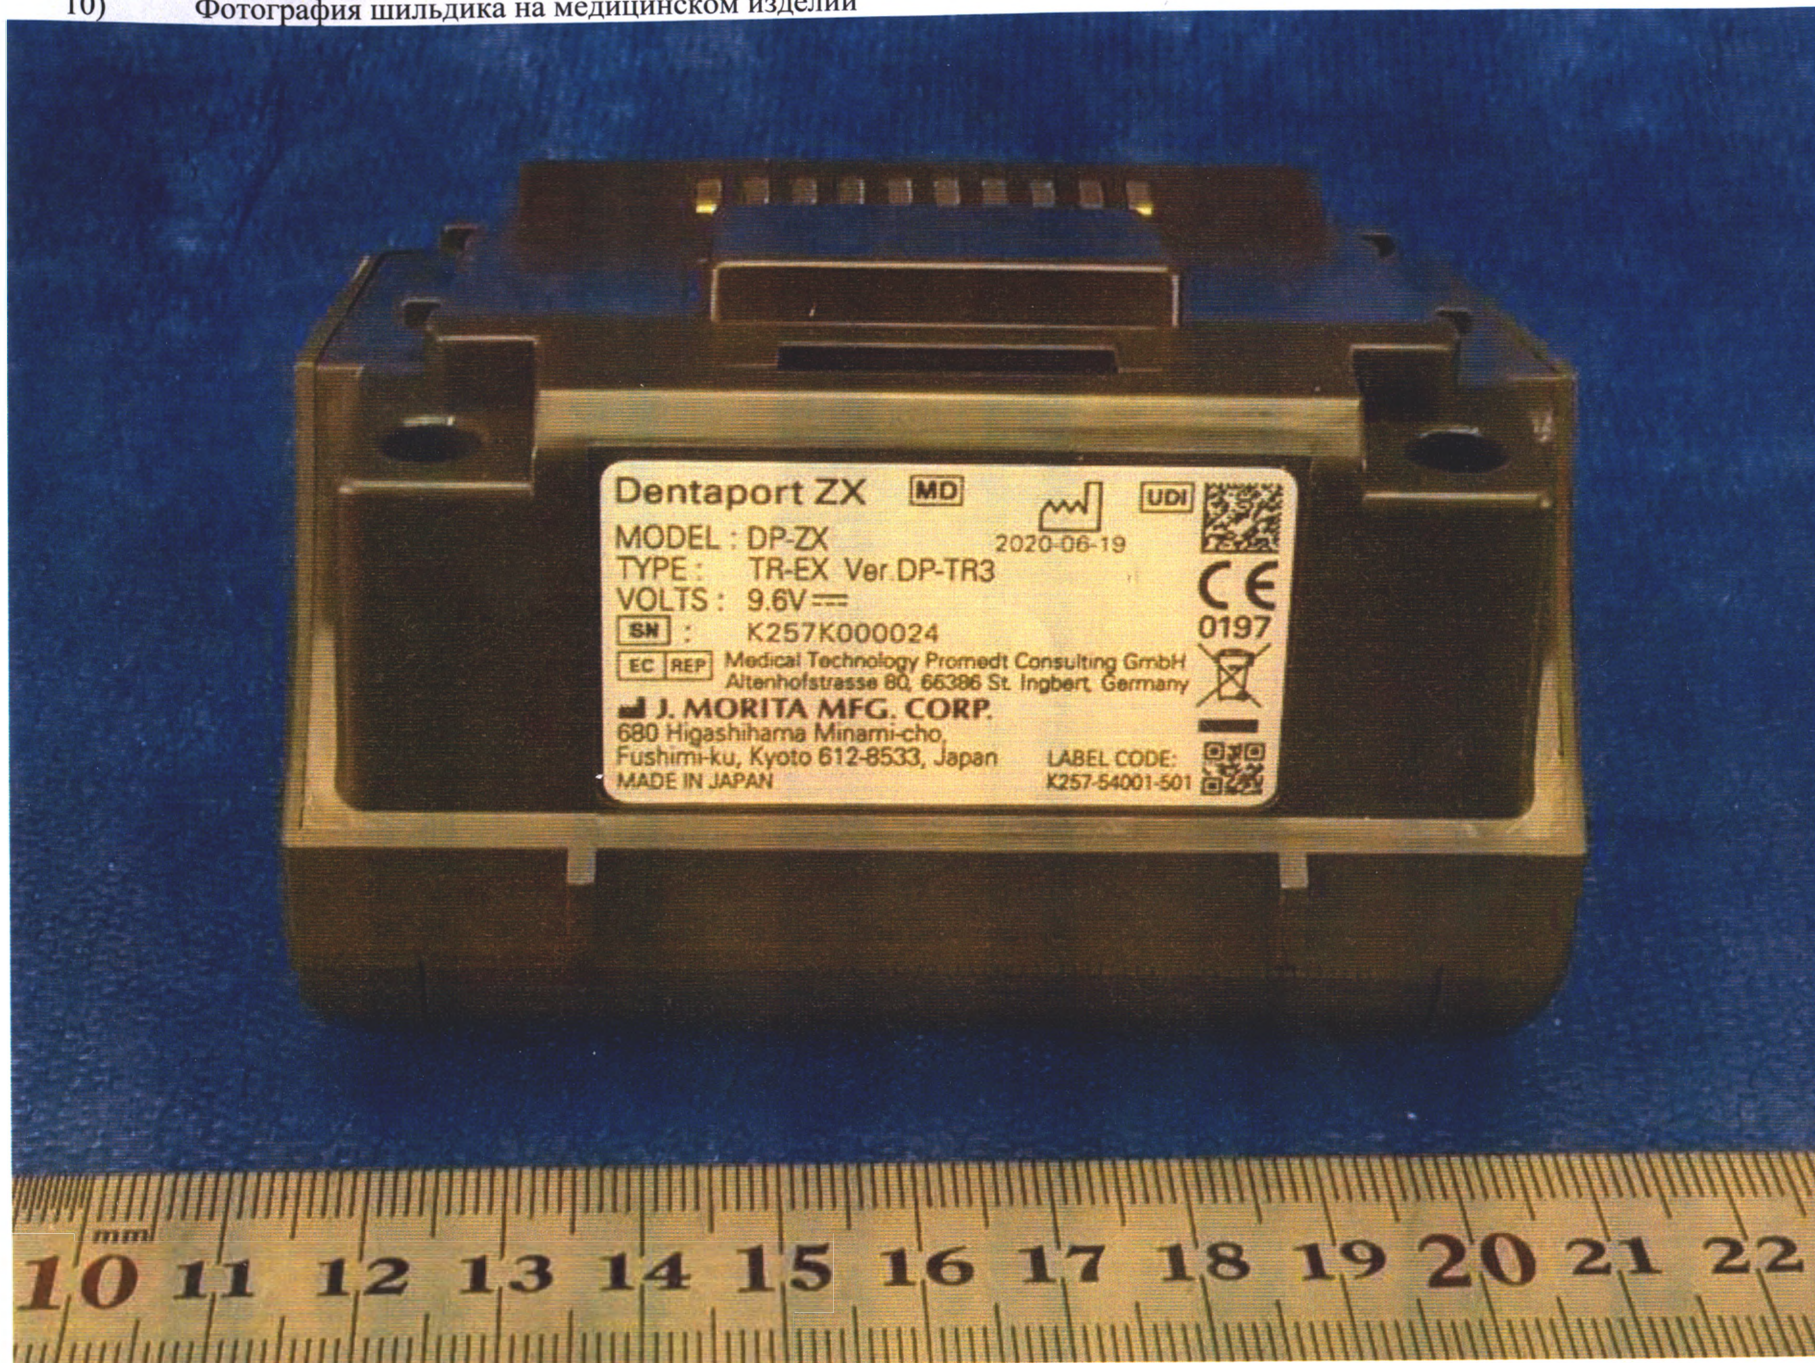

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
11 (одиннадцать) листов
Ген. Директор ООО «Медента»

В. В. Терехов

