

Фотографические изображения медицинского изделия
Аппарат рентгенографический палатный
«Гаммарент-Моби»

Аппарат рентгенографический палатный «ГАММАРЕНТ-МОБИ»:
«ГАММАРЕНТ-МОБИ»



ГАММАМЕД



**МП НПФ Гаммамед-П
ГАММАРЕНТ-МОБИ**


ТУ 9442-009-42879986-2012

Серийный номер: 049

Дата выпуска: декабрь 2015

Напряжение питания: 220 В одна фаза 50 Гц

РФ 141009 МО г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5

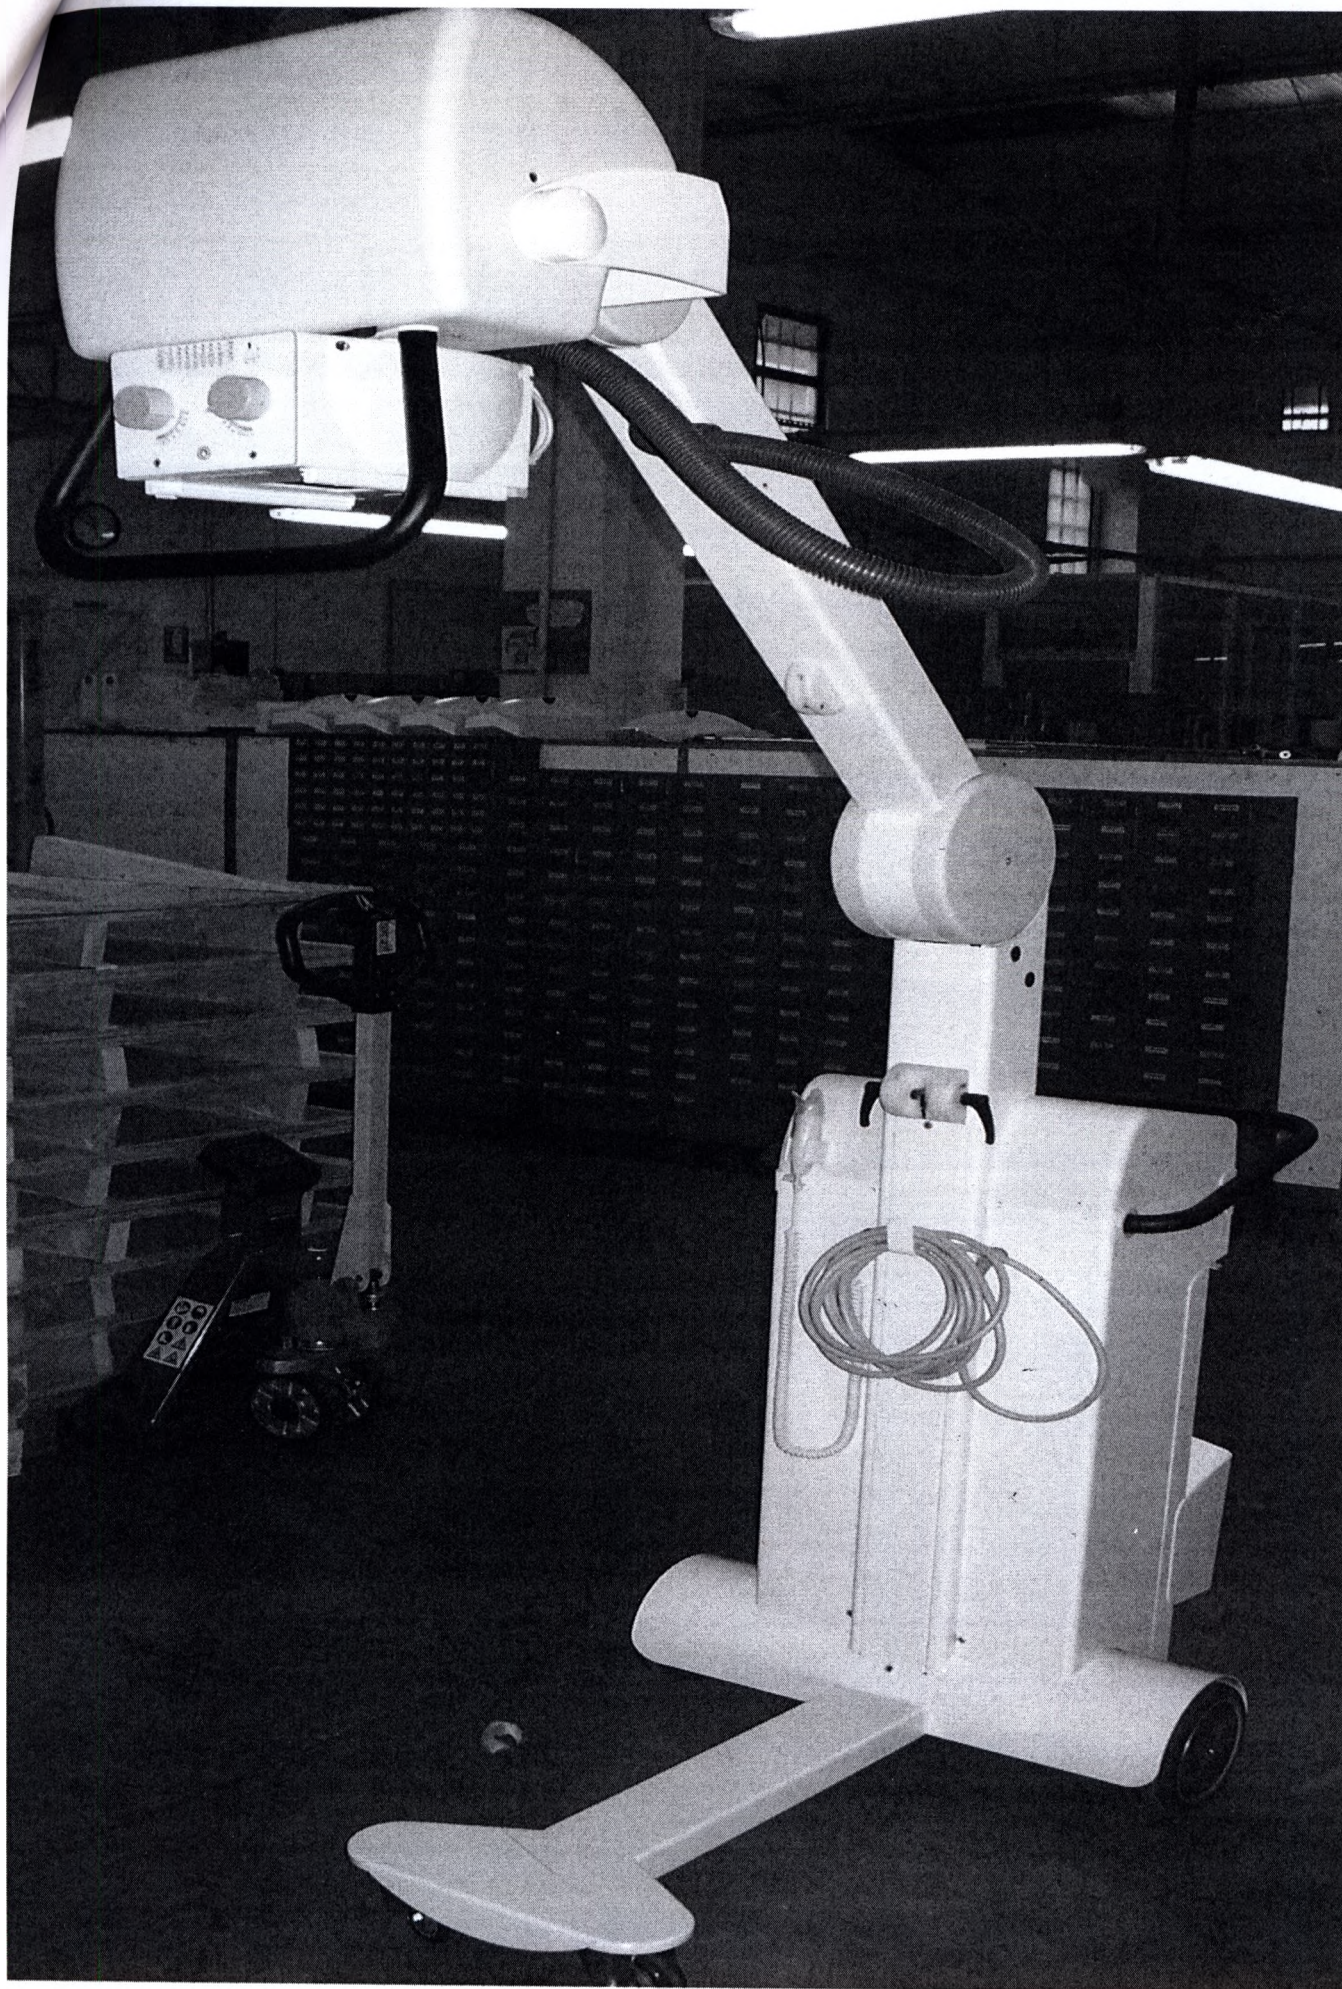

ГАММАМЕД




МП НПФ Гаммамед-П
ГАММАРЕНТ-МОБИ/01
ТУ 9442-009-42879986-2012

Серийный номер: 0054
Дата выпуска: февраль 2016

Напряжение питания: 220 В одна фаза 50 Гц

РФ 141009 МО г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5





ГАММАМЕД



МП НПФ Гаммамед-П
ГАММАРЕНТ-МОБИ/02
ТУ 9442-009-42879986-2012


Серийный номер: 0055
Дата выпуска: февраль 2016

Напряжение питания: 220 В одна фаза 50 Гц


РФ 141009 МО г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5

Модуль передвижной рентгеновский /установка передвижная рентгенодиагностическая на колесах:


- платформа передвижная, производства фирмы BMI Srl, Италия или фирмы SMAM Srl, Италия;

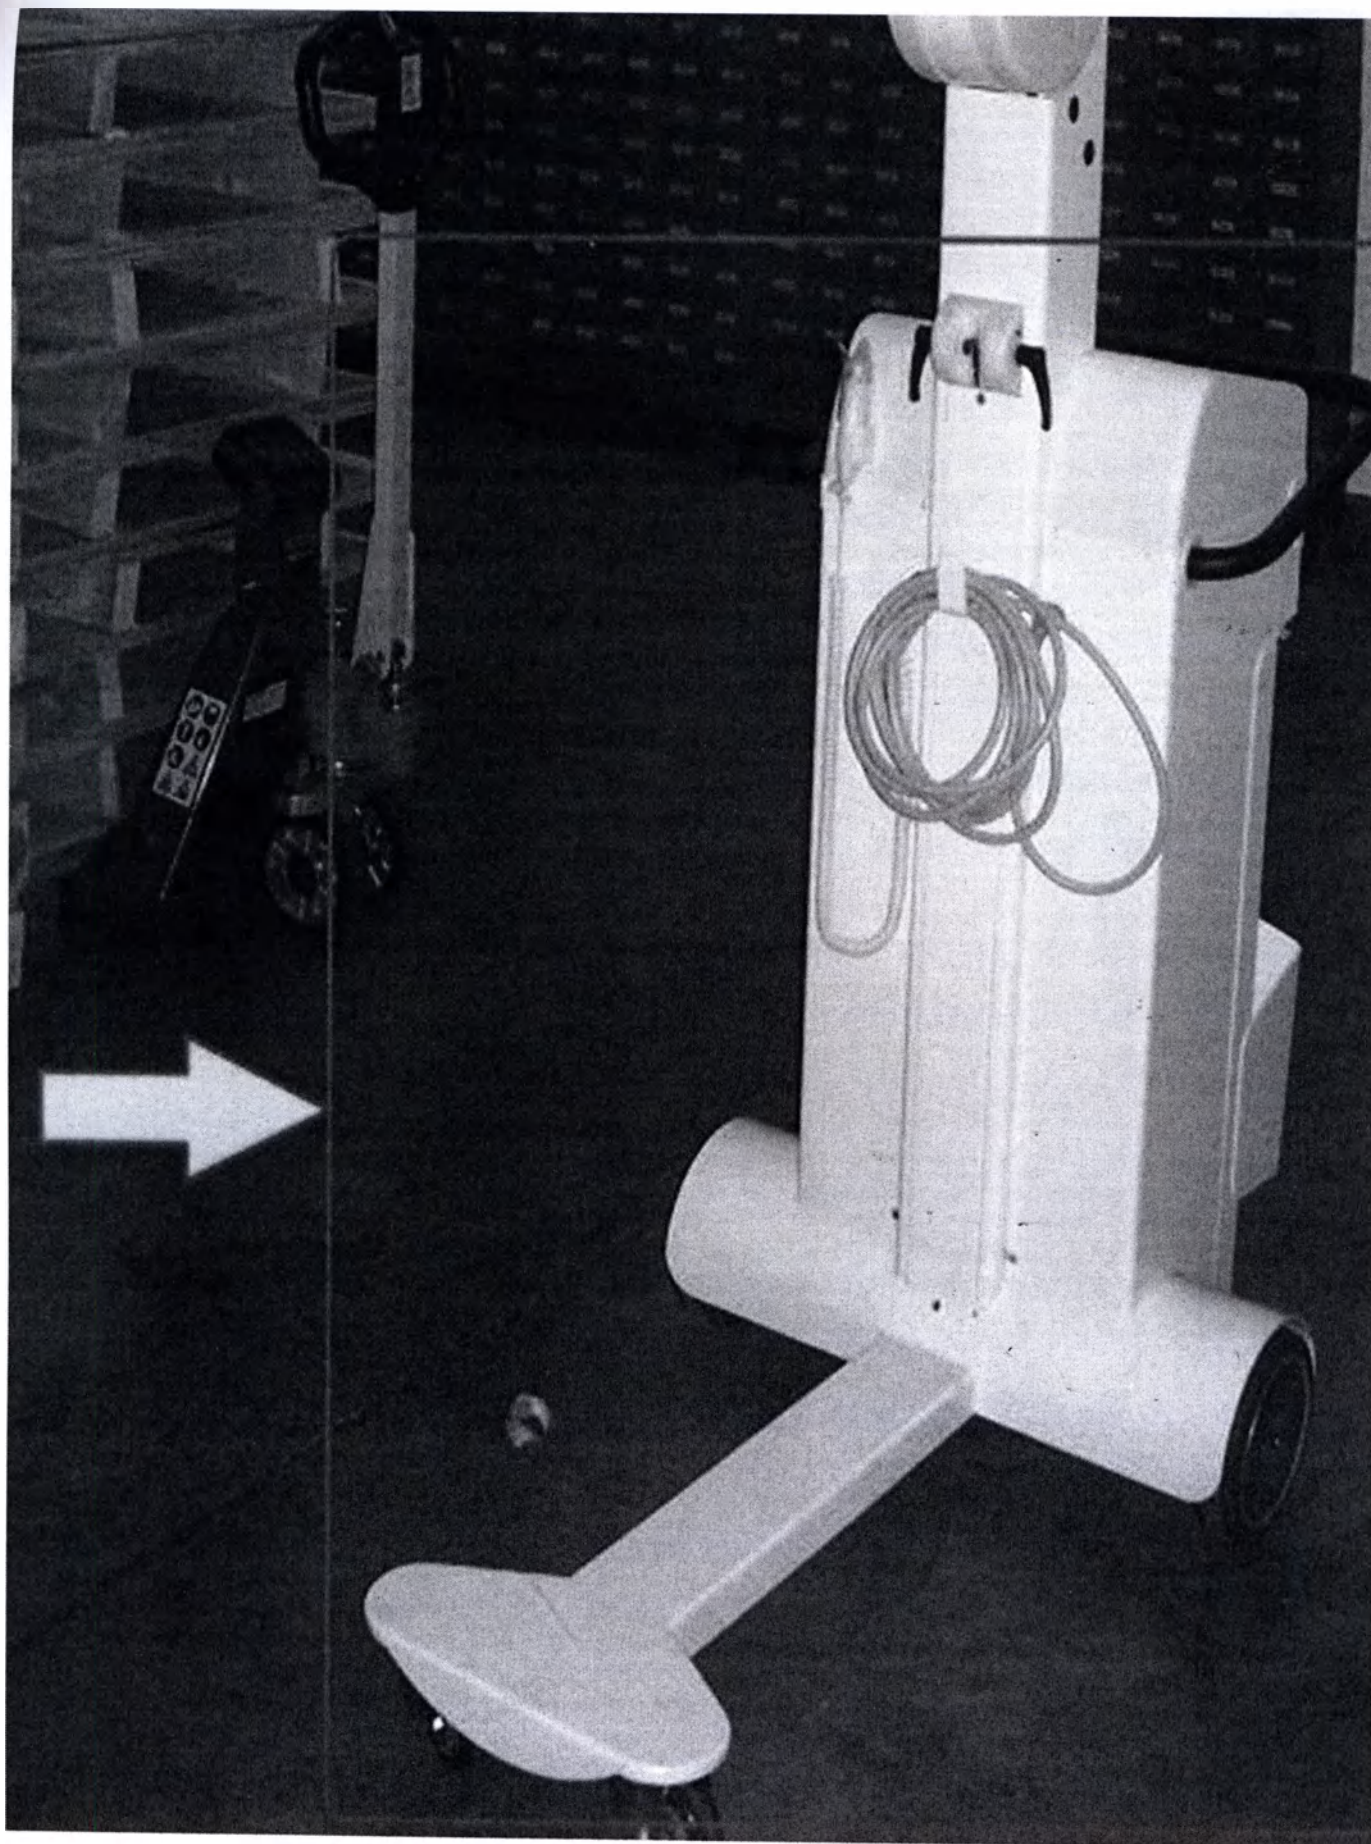


штатив поворотный, производства фирмы BMI Srl, Италия или фирмы SMAM Srl, Италия;

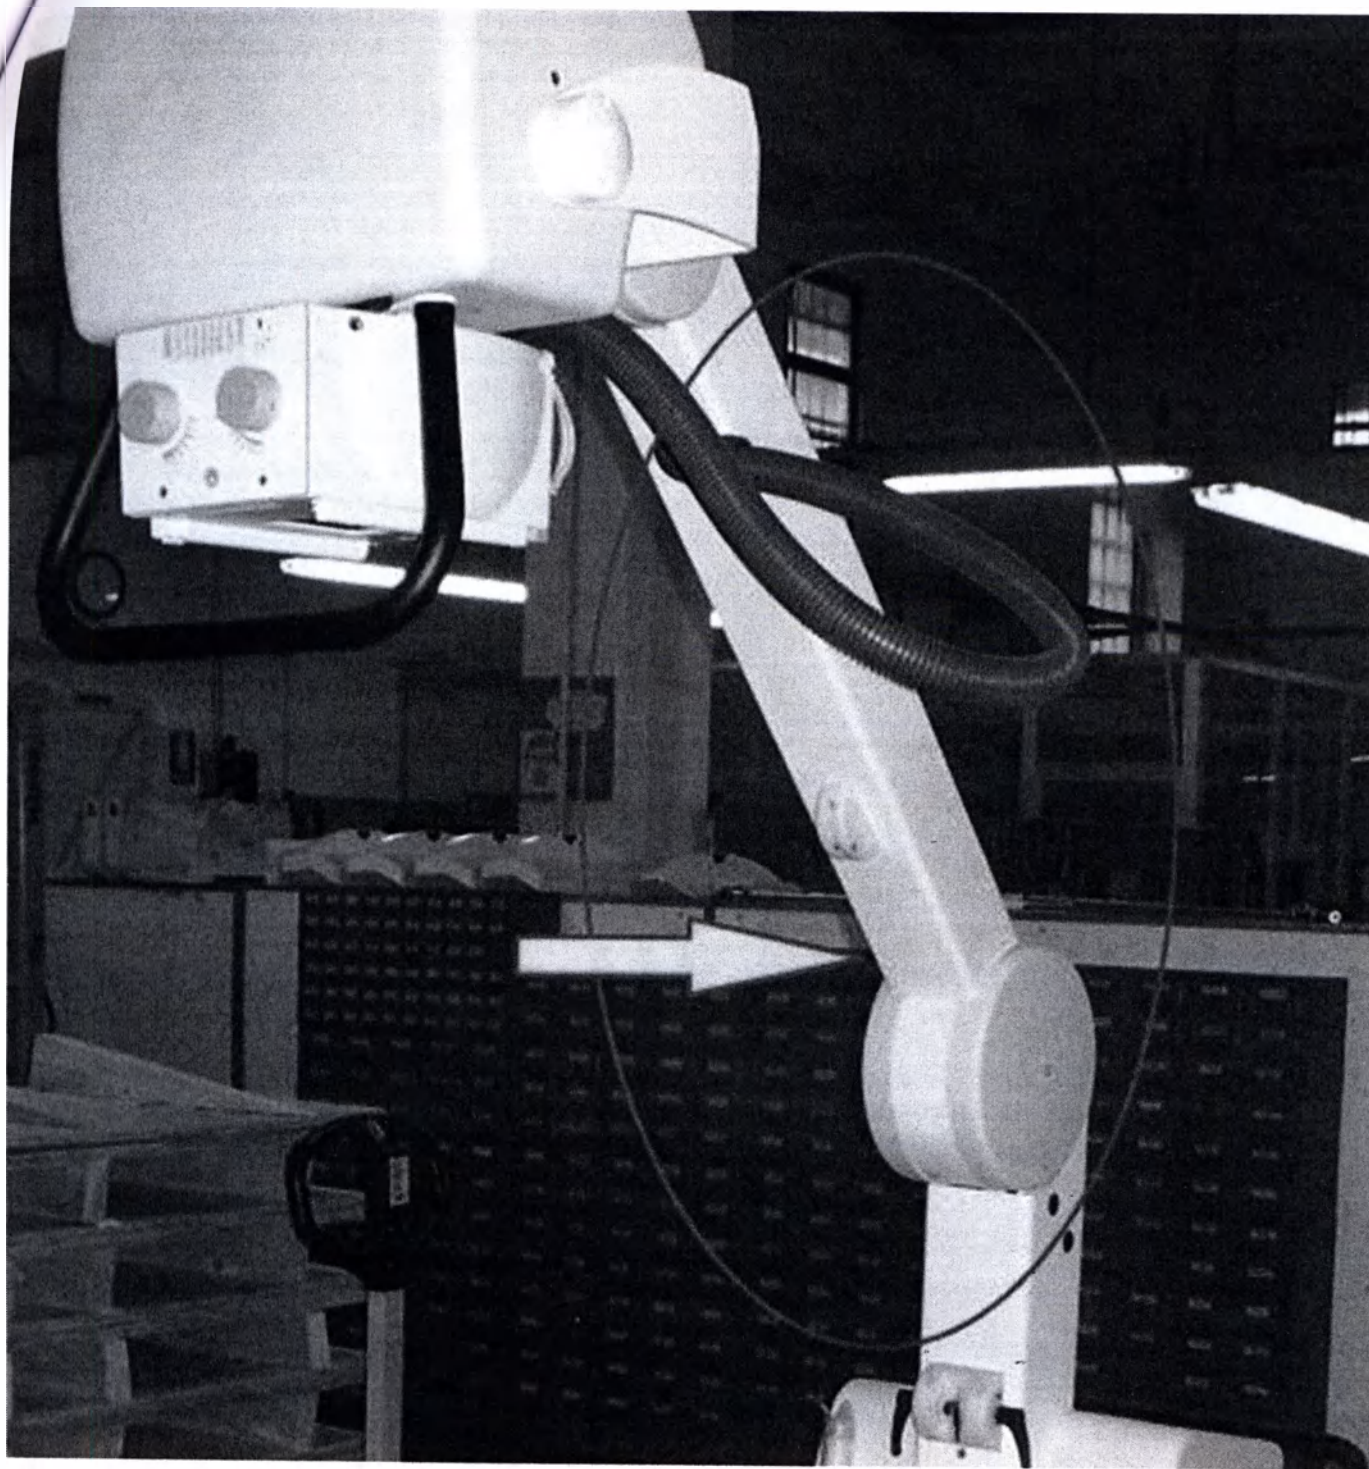


моноблок рентгеновский / моноблок в сборе, производства фирмы BMI Srl, Италия или
фирмы SMAM Srl, Италия;

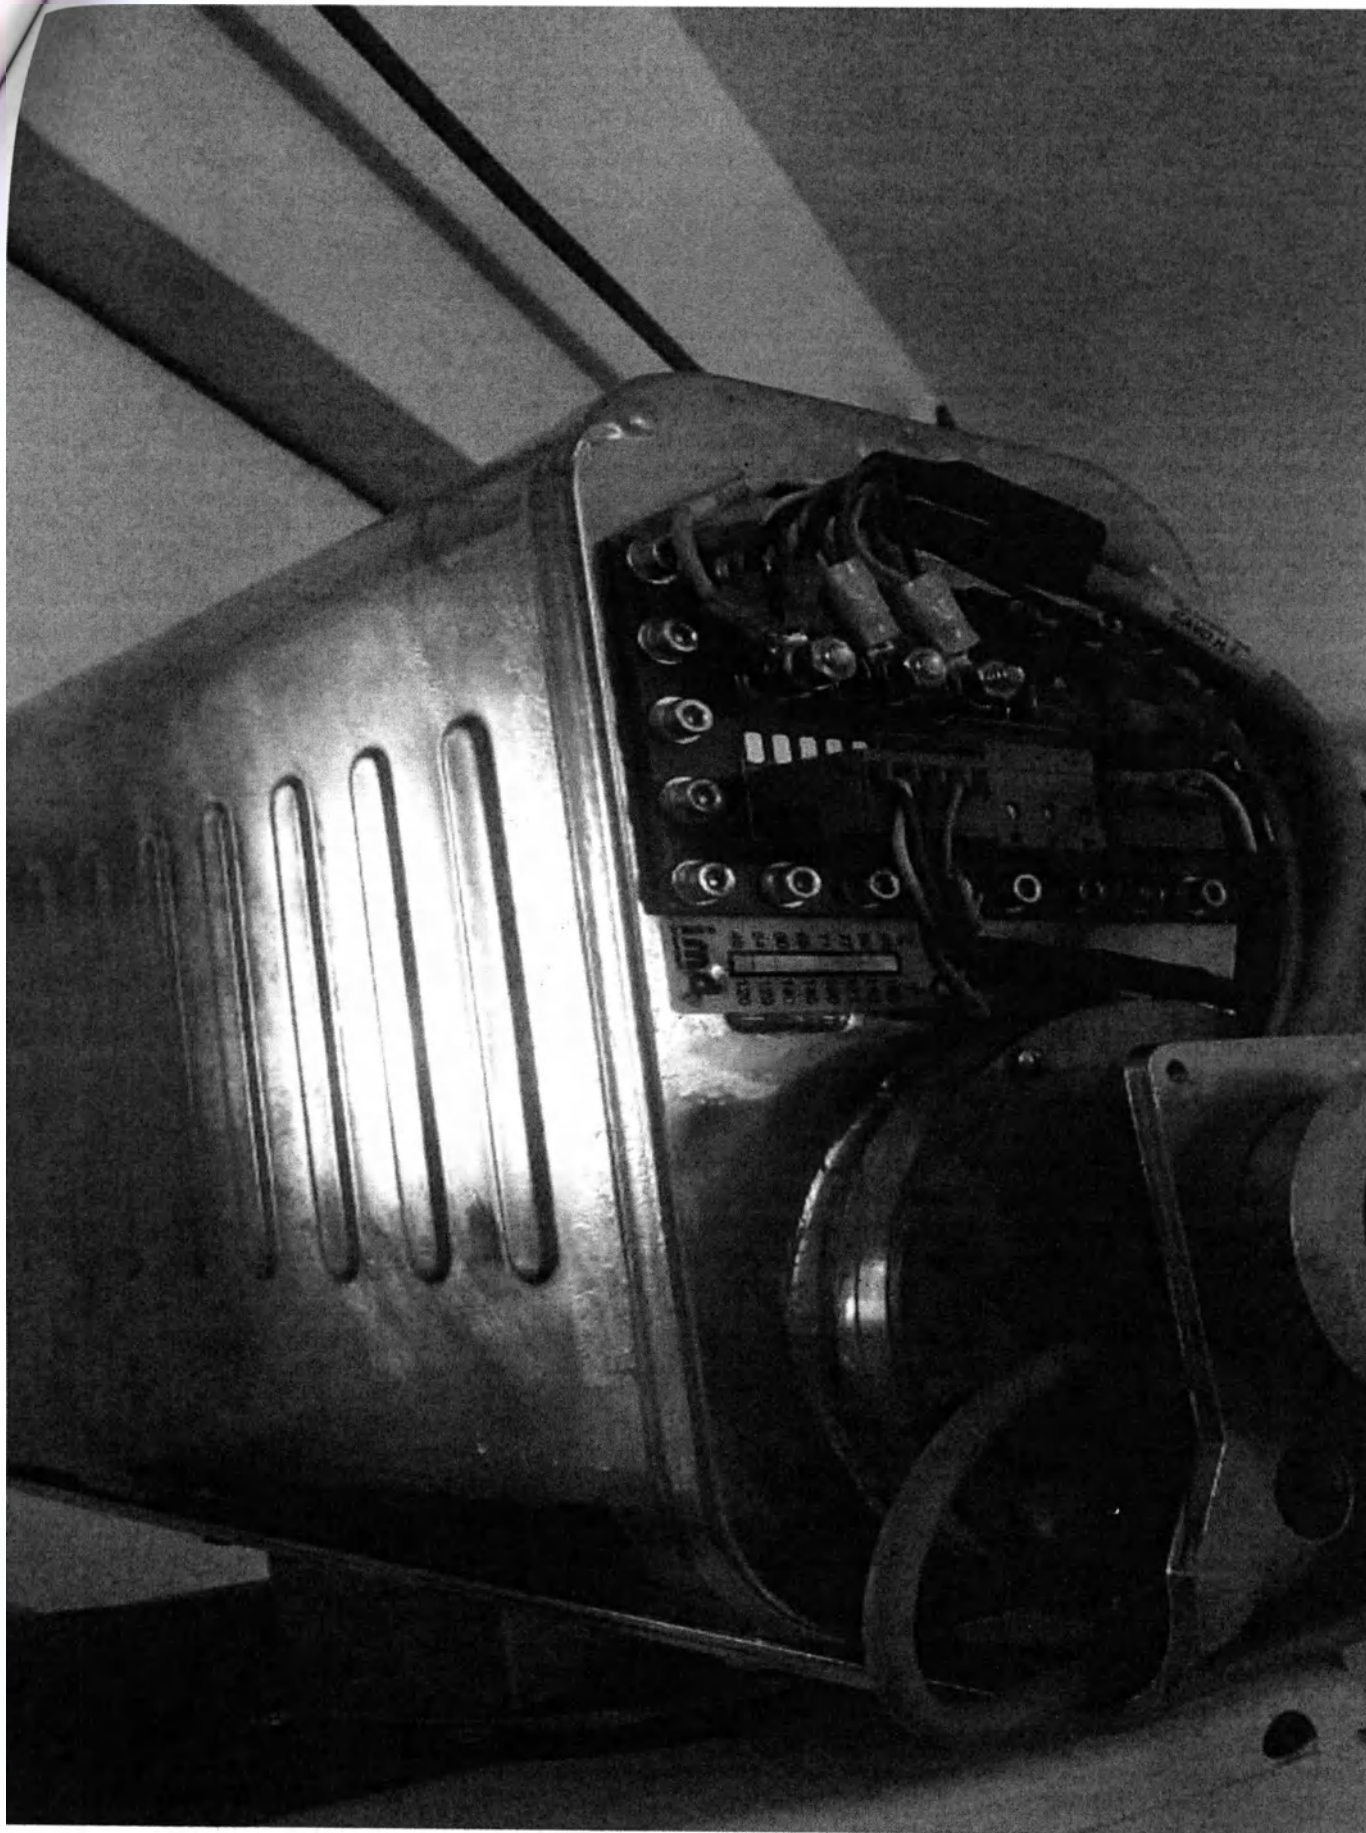


излучатель рентгеновский, производства фирмы IAE Spa, Италия или фирмы C.E.I. Srl, Италия;

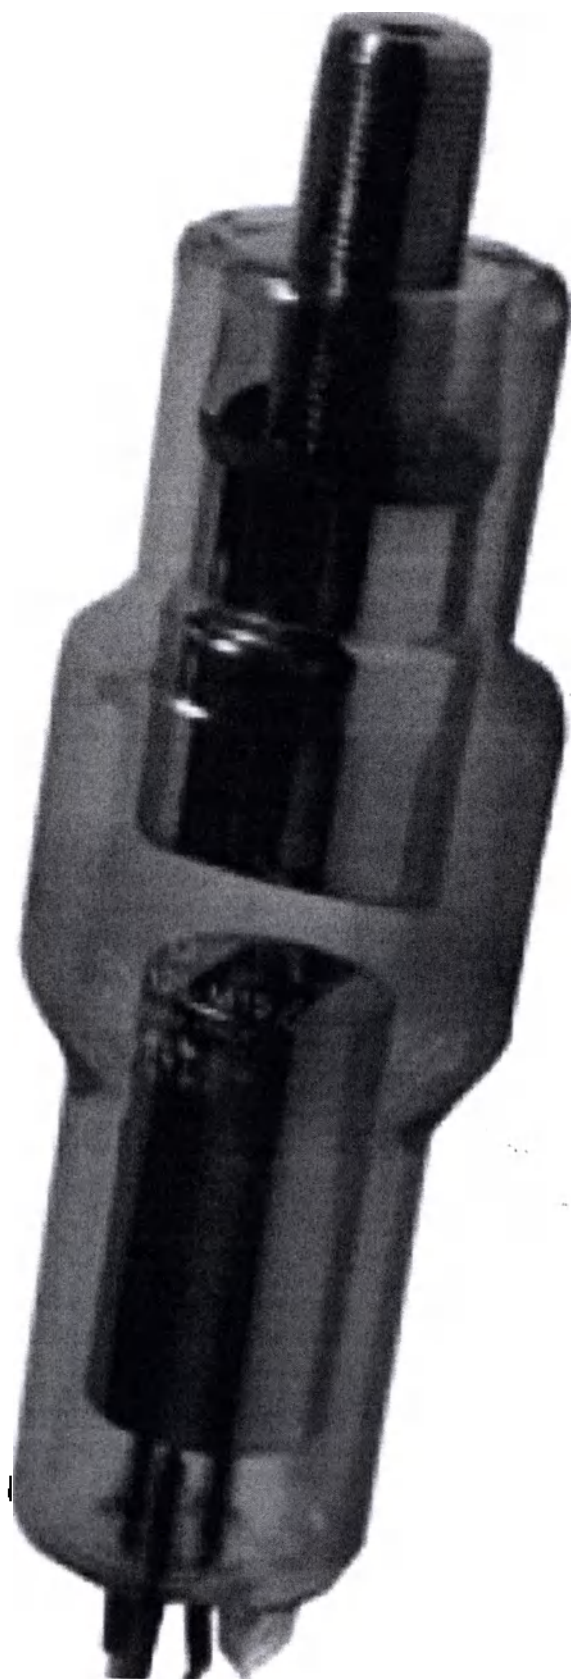


коллиматор (диафрагма) производства фирмы BMI, Италия или серий Ralko R, P, T производства фирмы Ralco Srl., Италия;

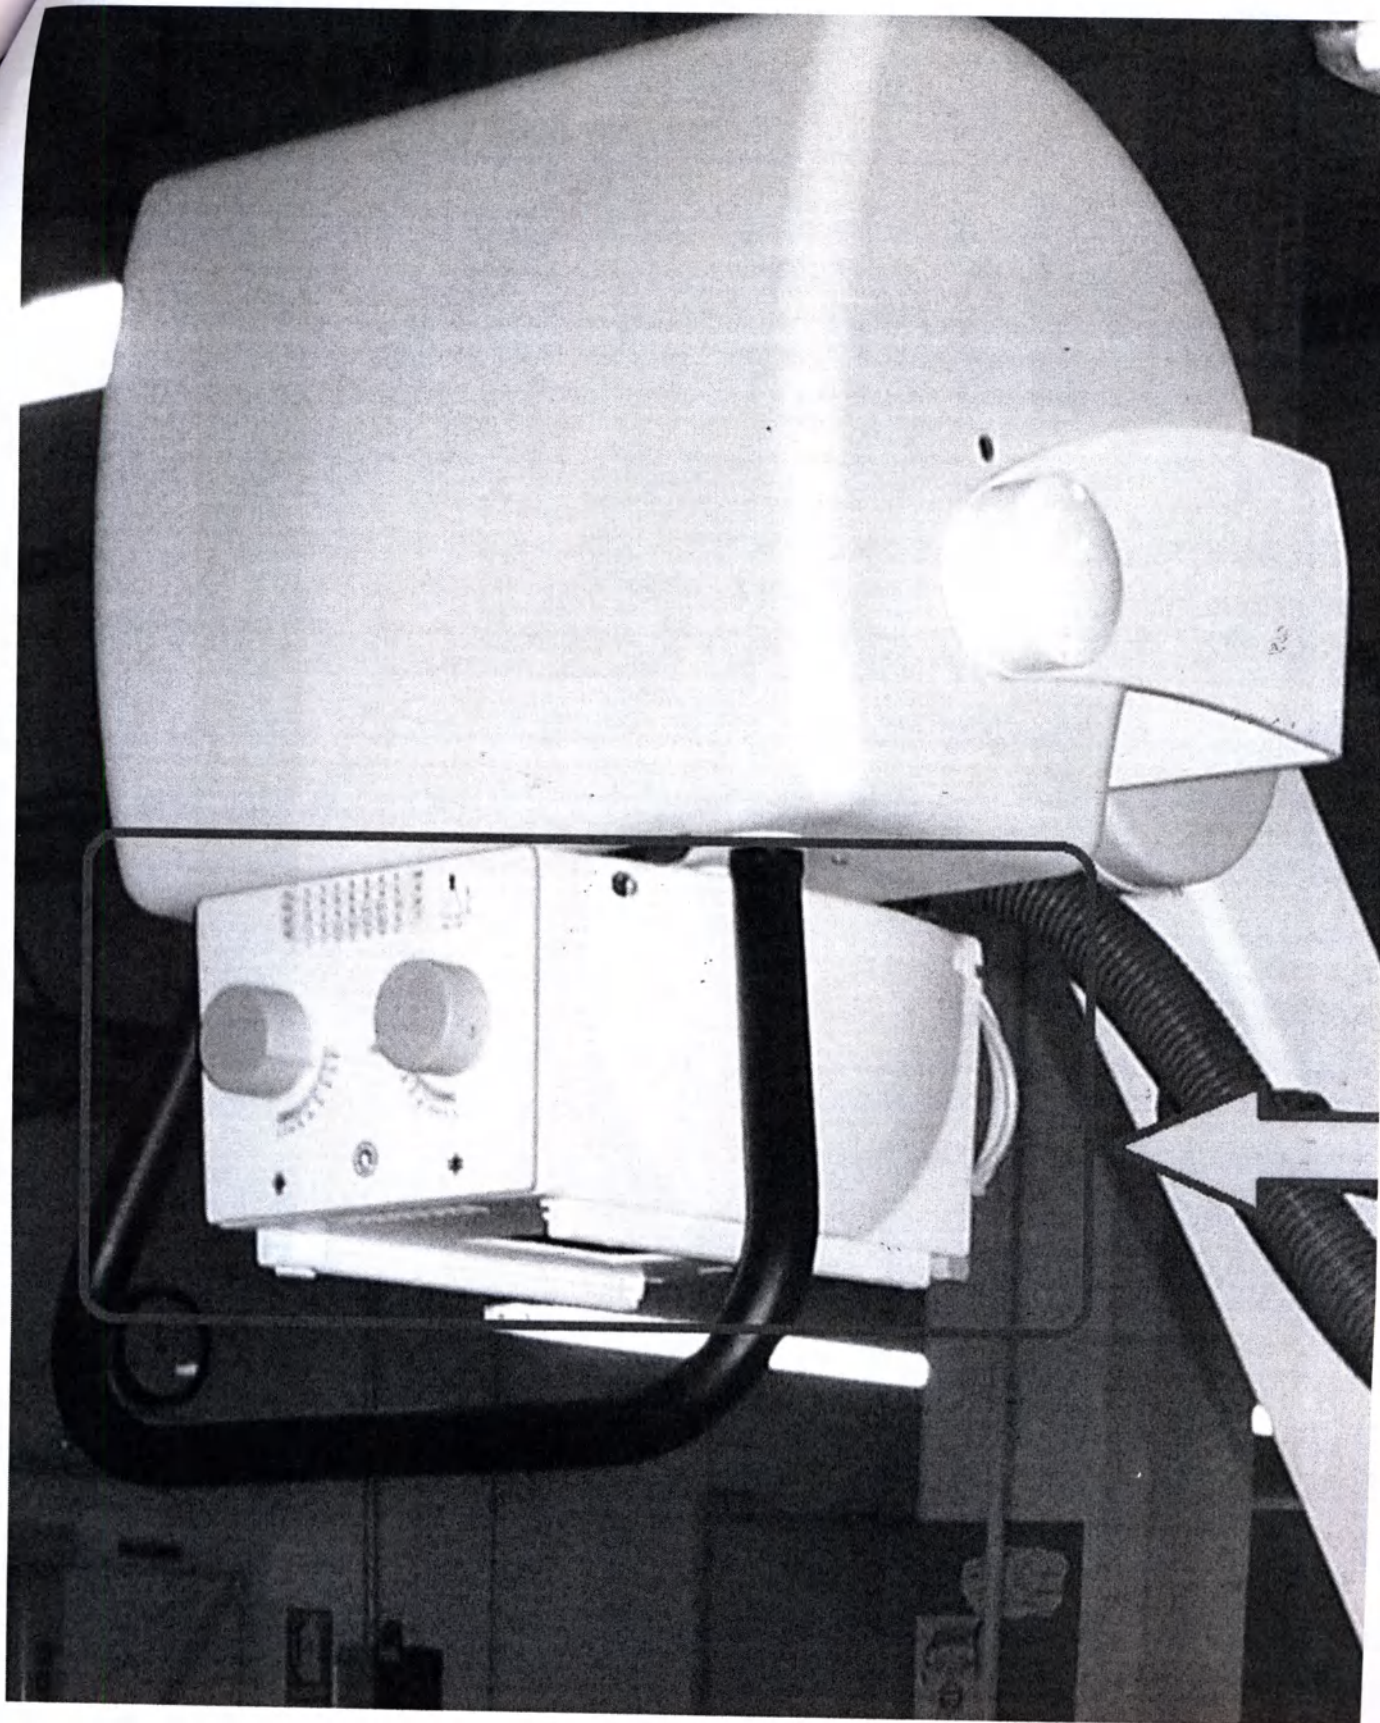


Консоль управления производства фирмы BMI Srl, Италия или фирмы SMAM Srl, Италия;

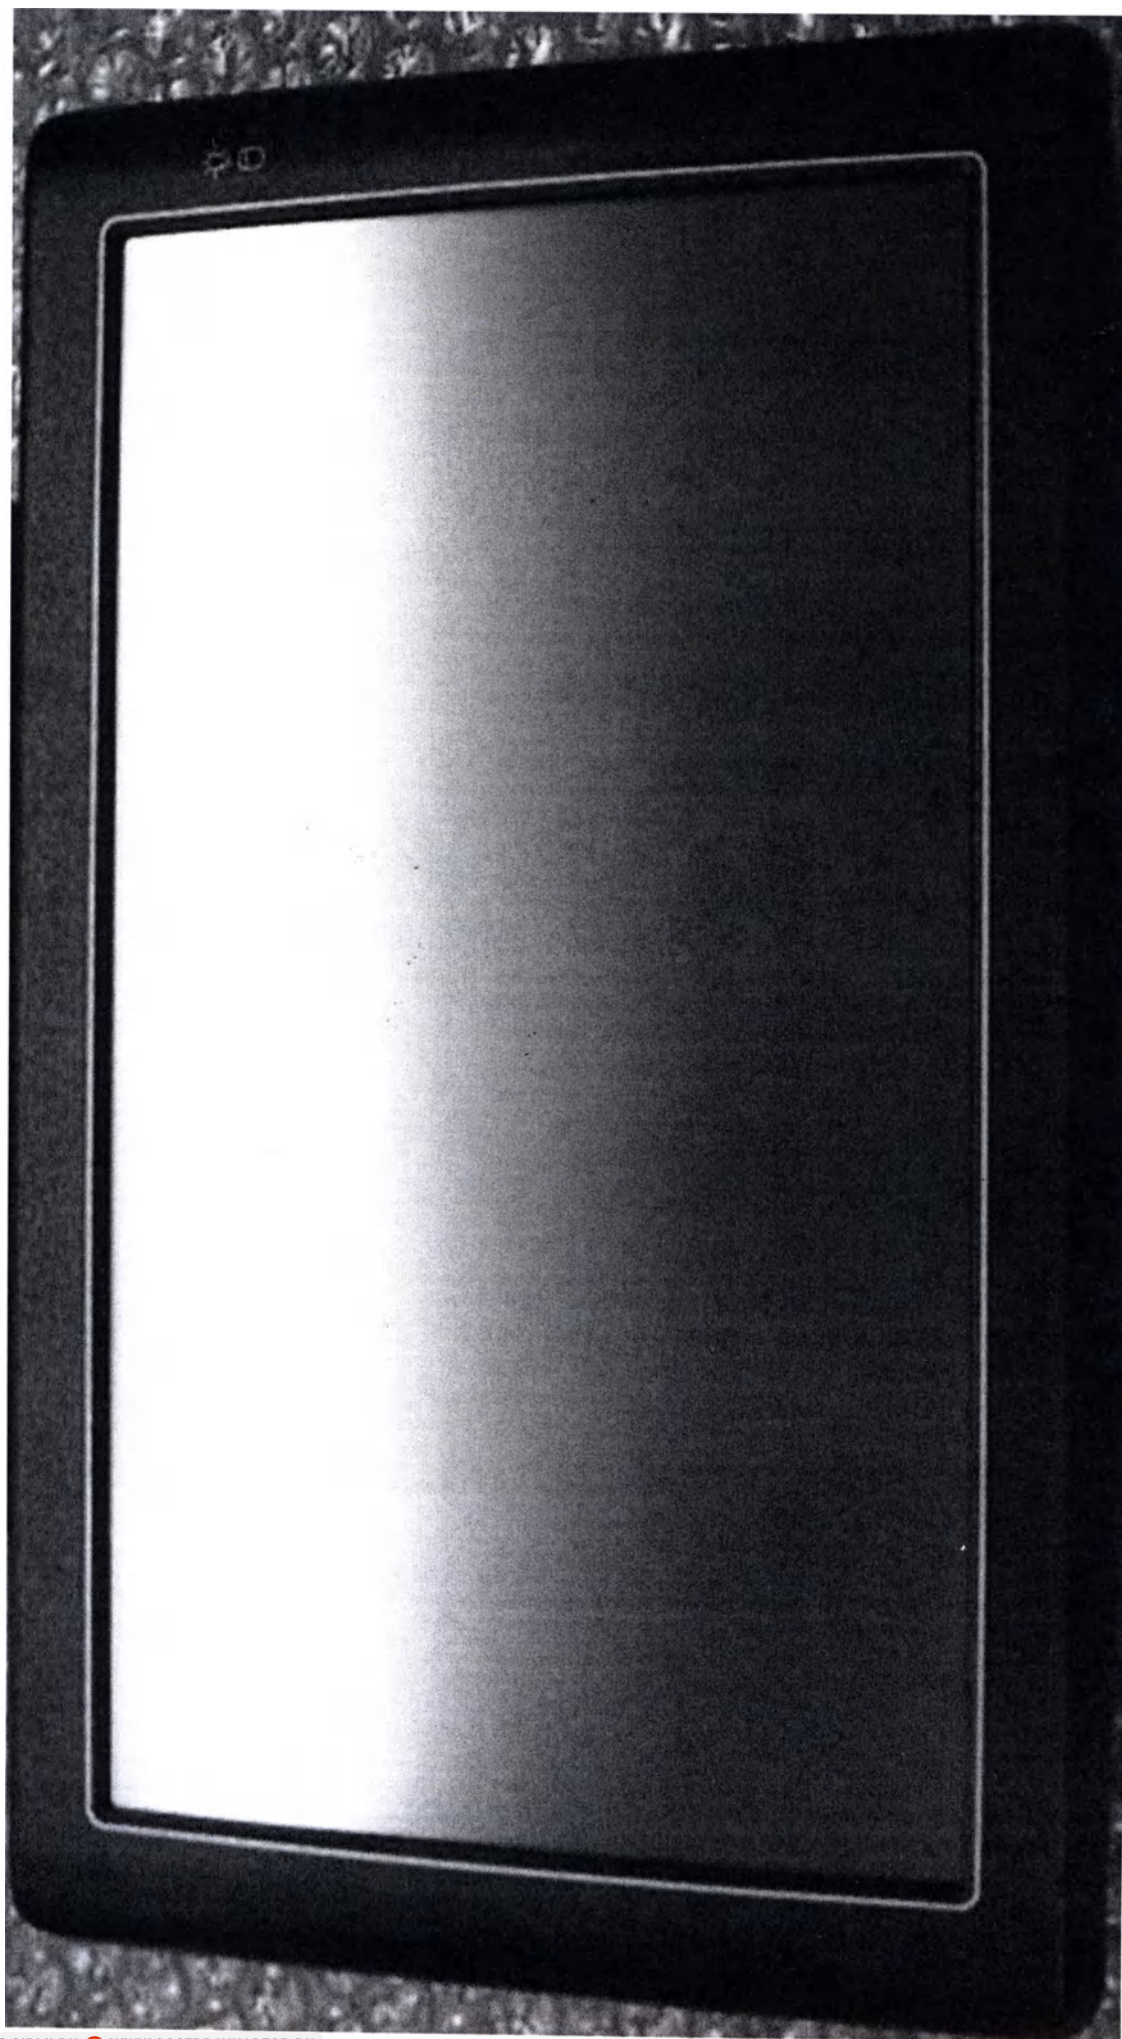

Устройство для хранения кассет производства фирмы BMI Srl, Италия или фирмы SMAM Srl, Италия;

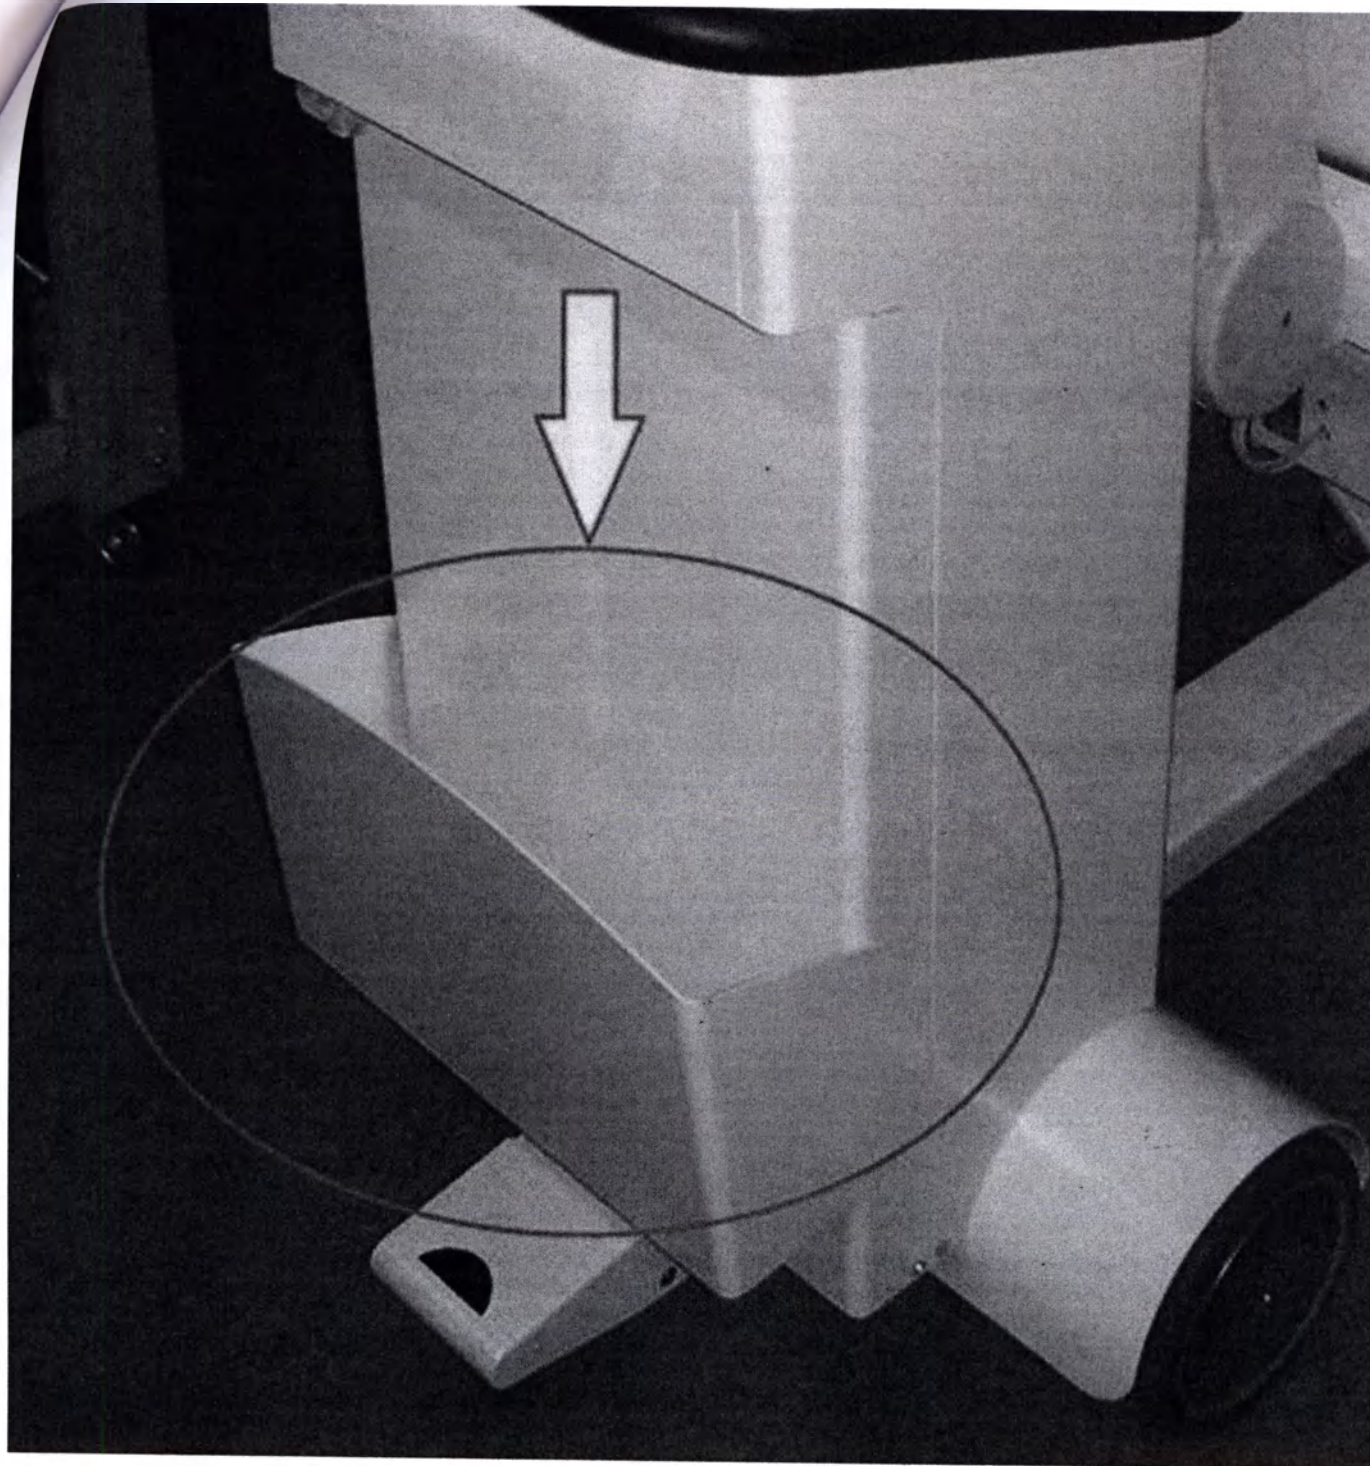


кабели высоковольтные с комплектом монтажных частей производства фирмы BMI Srl, Италия или фирмы SMAM Srl, Италия;

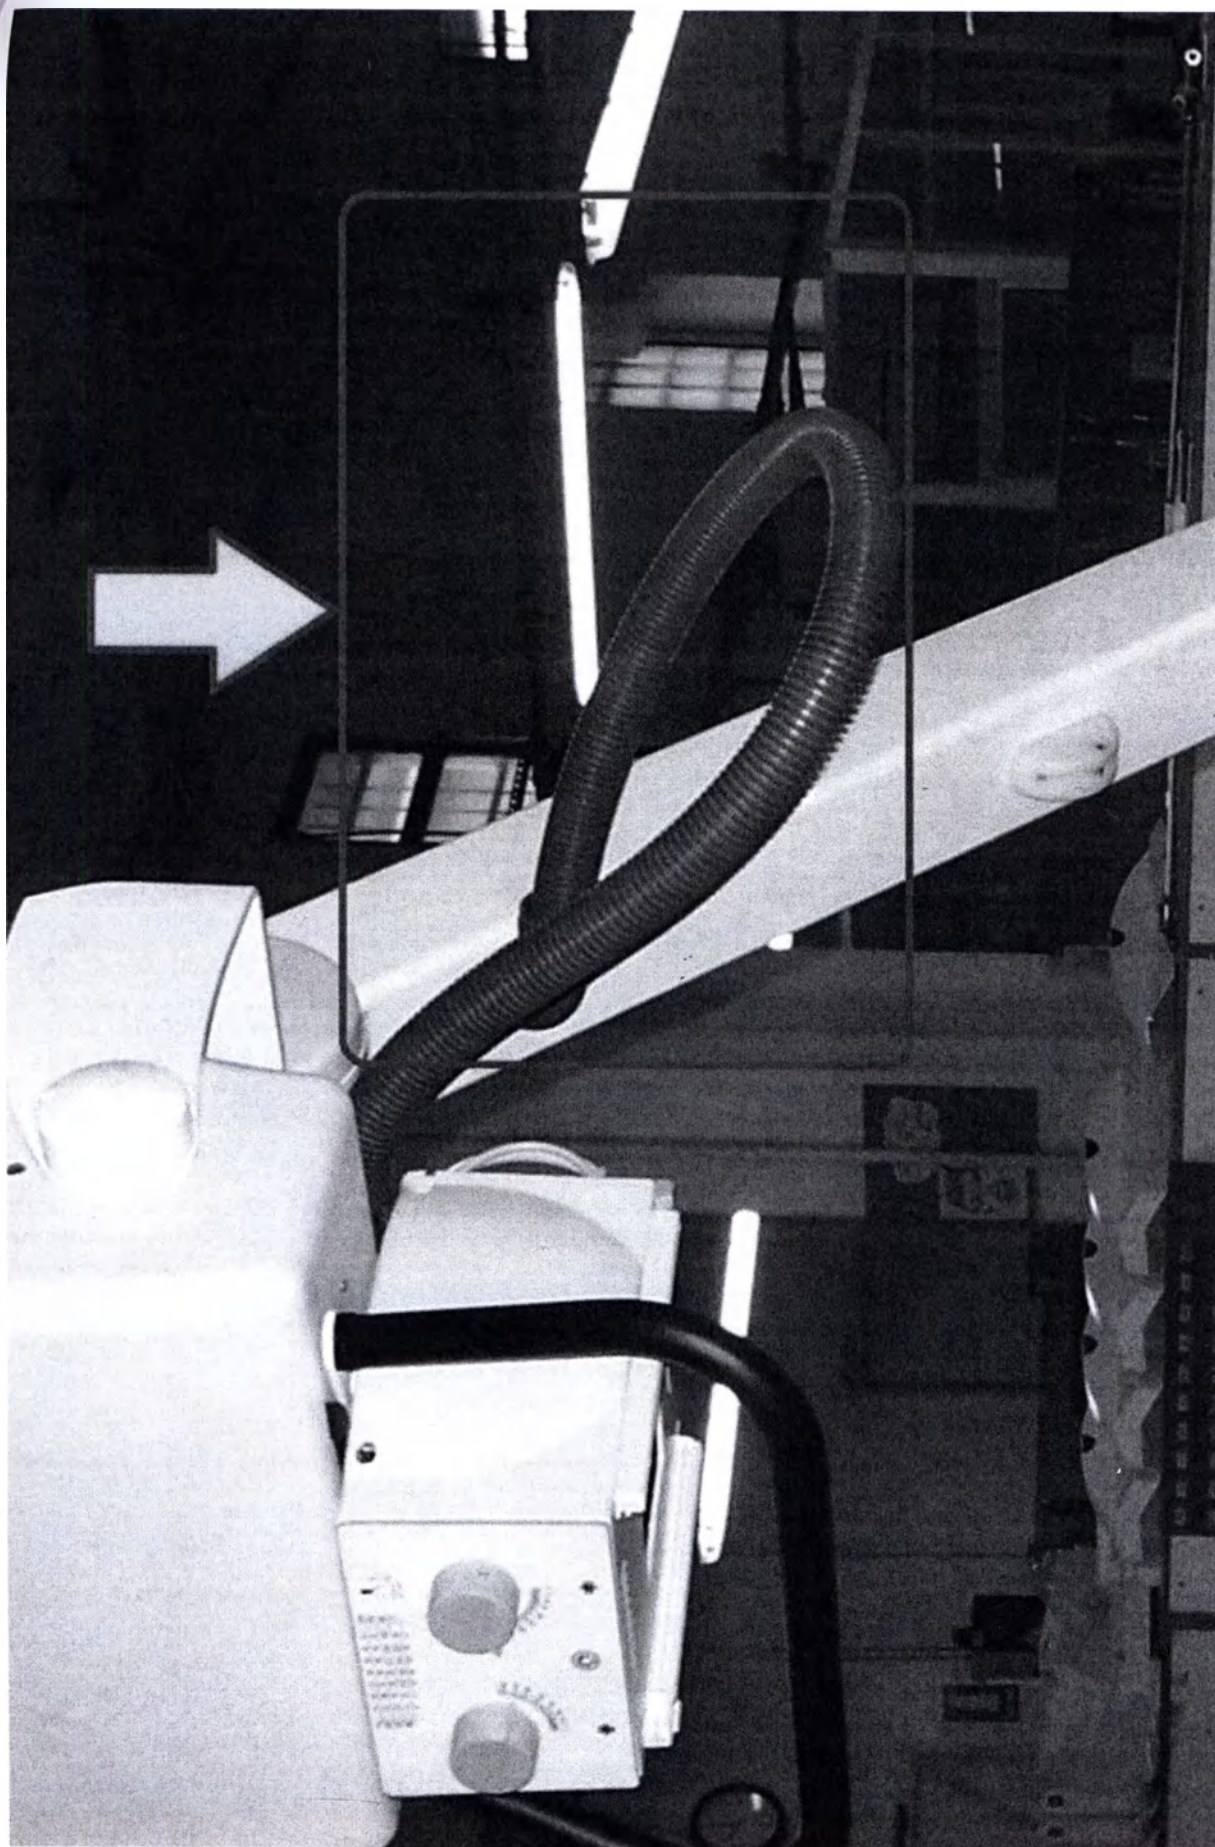

Принадлежности: Излучатель рентгеновский, производства фирмы IAE Spa, Италия или
фирмы C.E.I. Srl, Италия;




двигатель, производства фирмы BMI Srl, Италия или SMAM Srl, Италия;

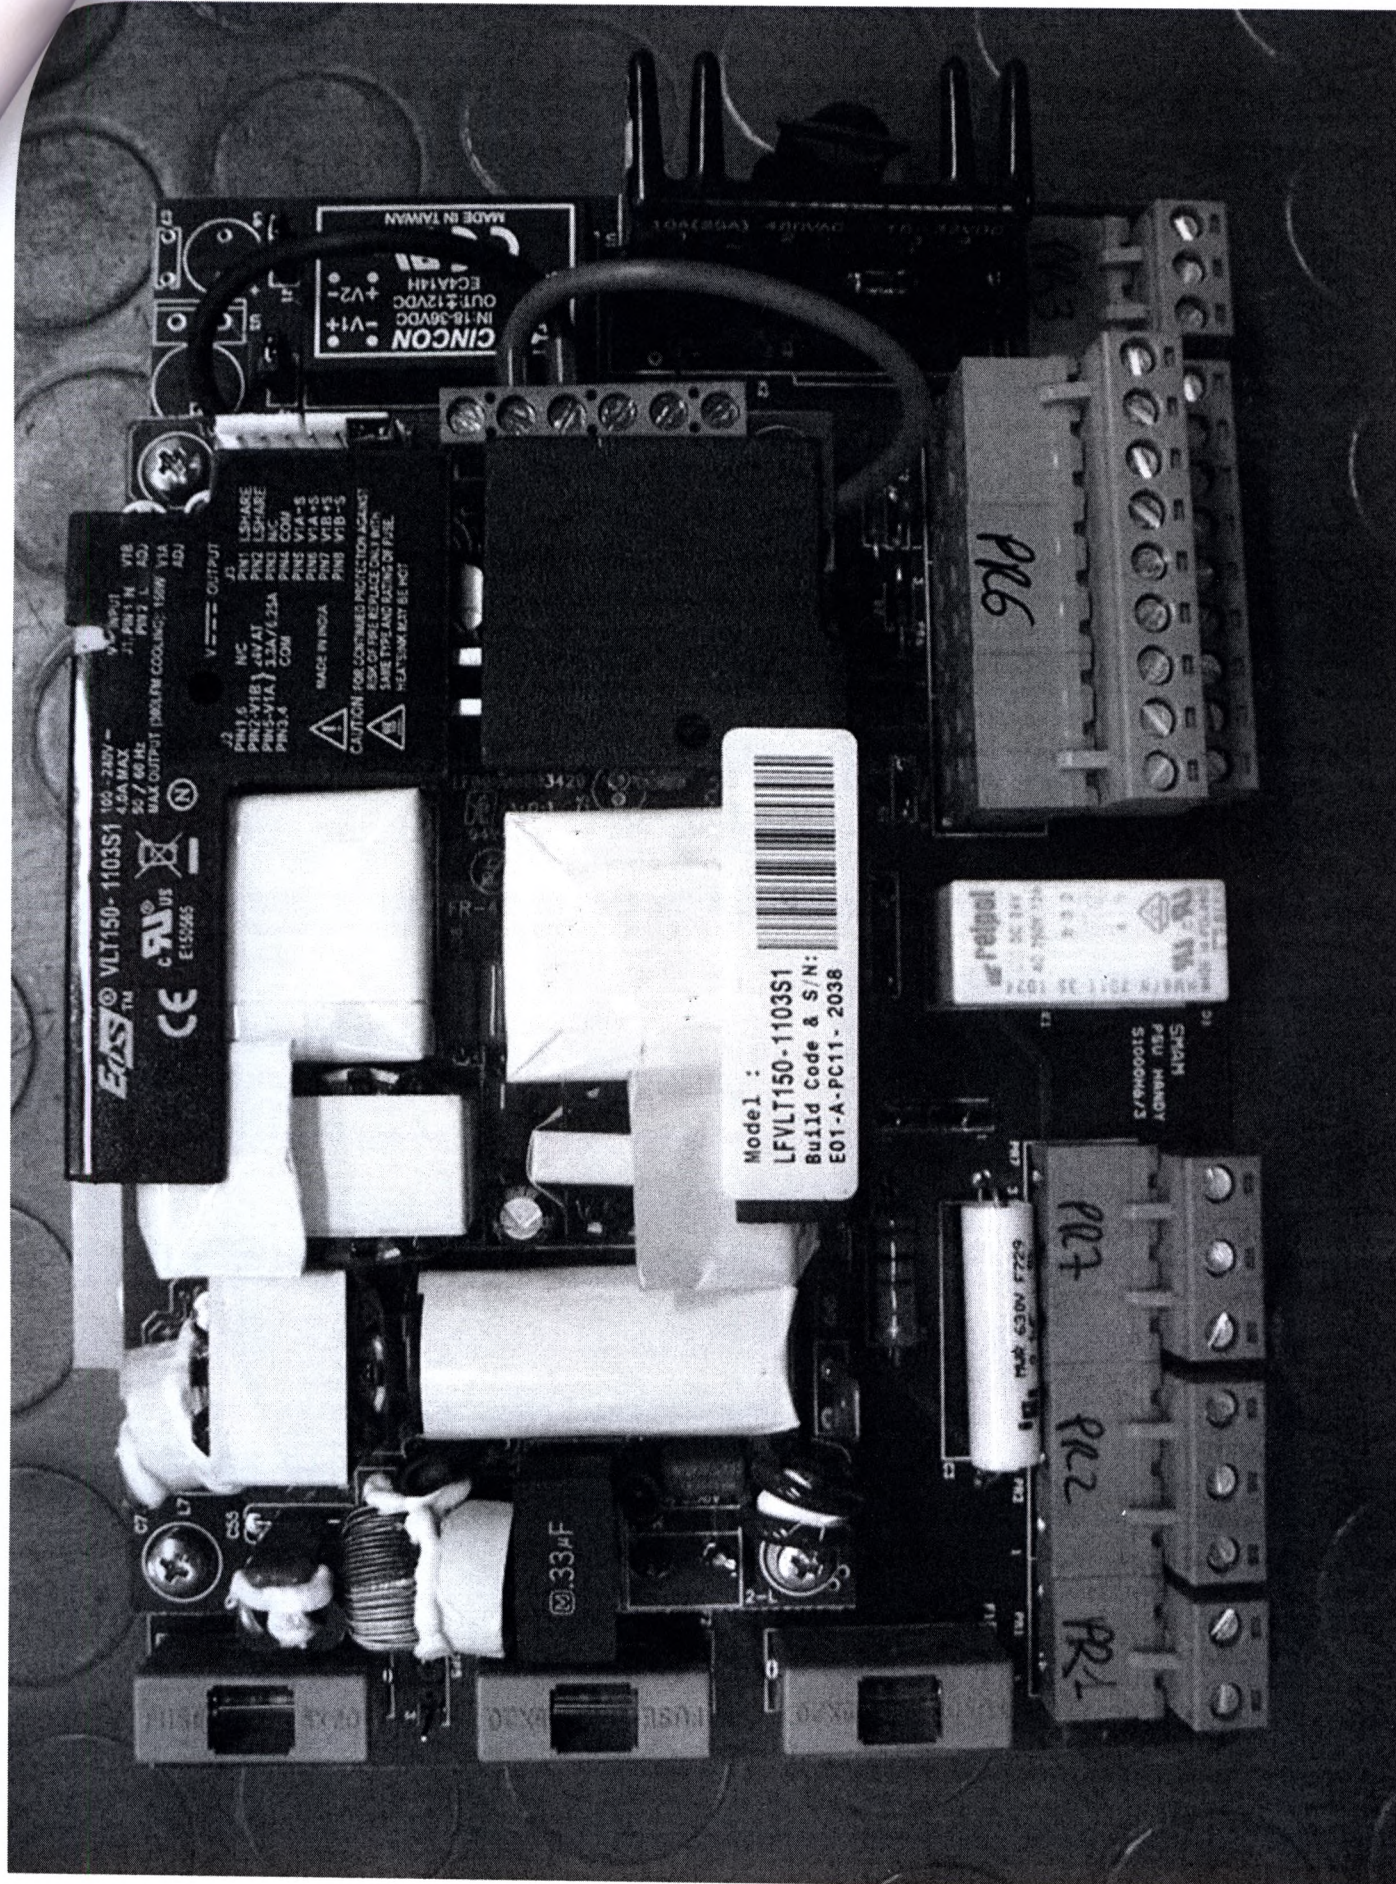


камера ионизационная серии SSMC, производства фирмы Claymount Assemblies B.V,
Нидерланды или Varian Medical Systems Inc., США или камера ионизационная производства
фирмы VacuTec Medtechnik GmbH, Германия;



метр серии ДРК-1, производства НПО «Доза», Россия или VacuDAP производства фирмы
Tec Medtechnik GmbH, Германия;

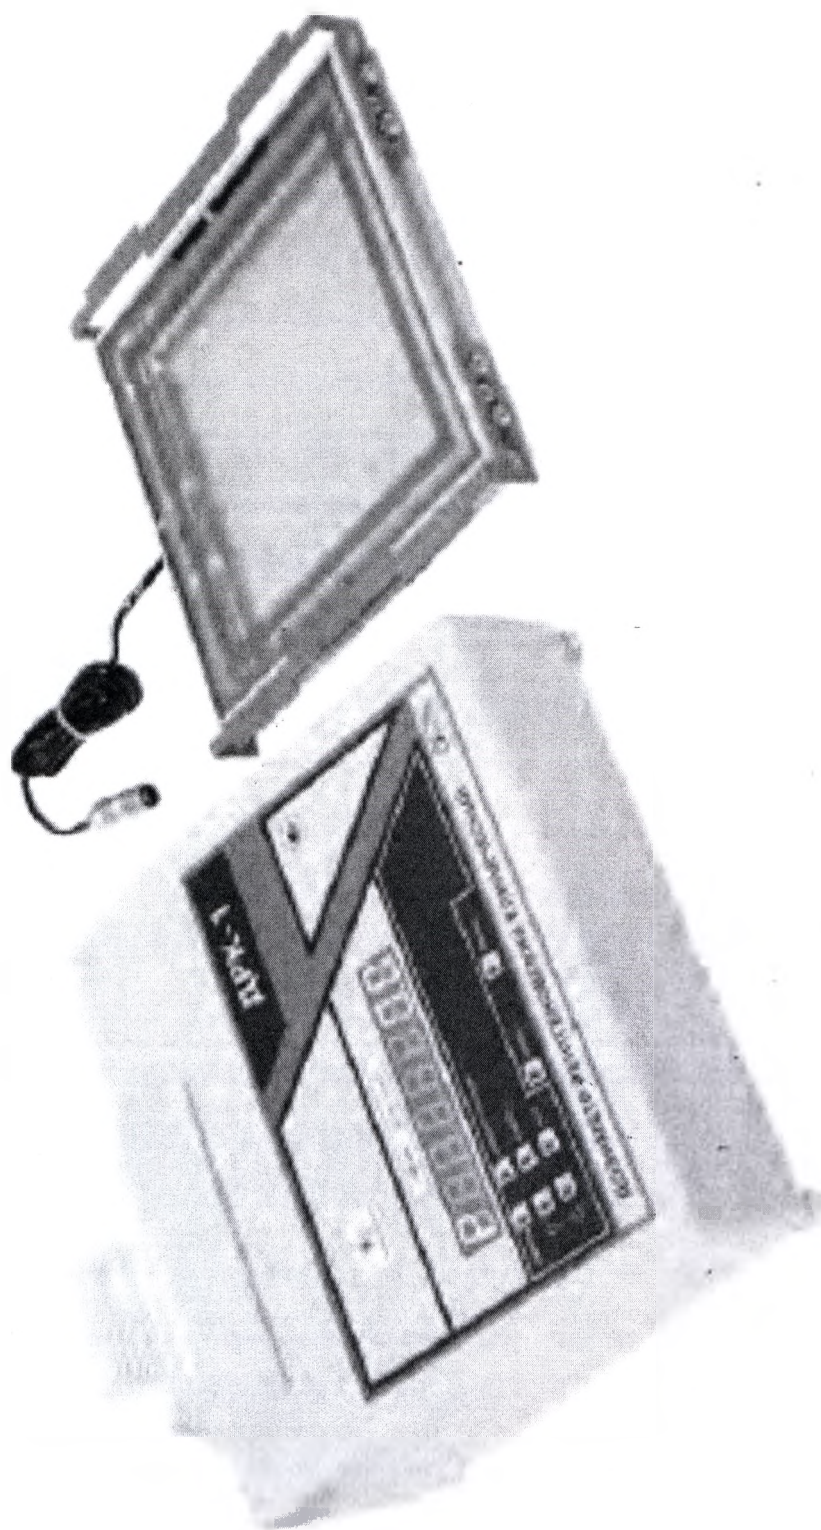


системы цифровой радиологии на базе плоскостанельного детектора производства фирмы Minolta Medical and Graphic Inc, Япония или ЗАО «Медицинские Технологии Лтд», Россия;

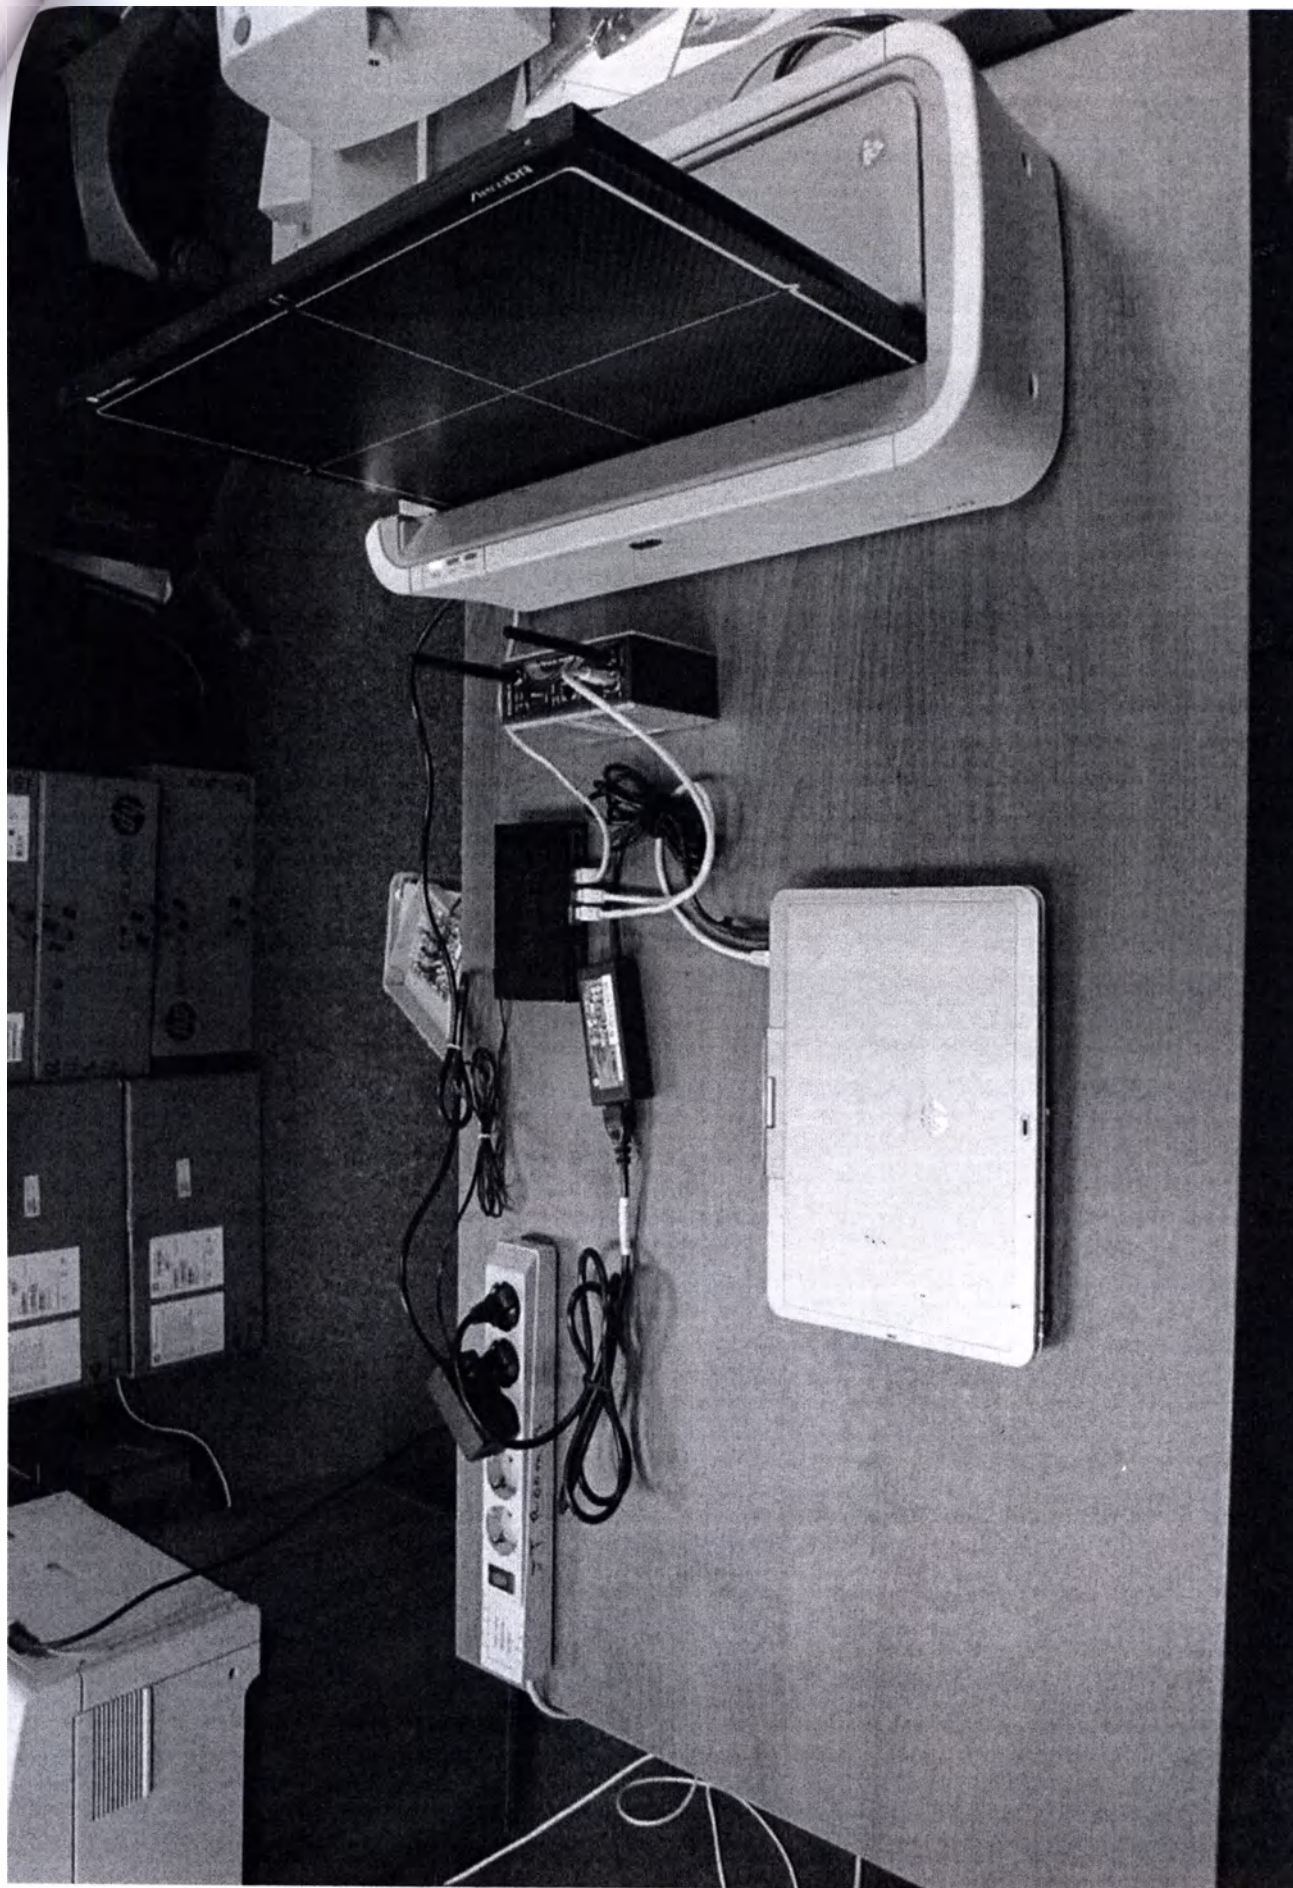


Система компьютерной радиографии серии Regius, производства фирмы Konica Minolta Medical and Graphic Inc., Япония или серии Agfa Gevaert N. V., Бельгия;




Комплекс аппаратно-программный для ввода, обработки и хранения диагностической информации АРМ врача-диагноста «Гамма Мультивокс Д1» производства ООО НПФ «Гаммамед-П», Россия;

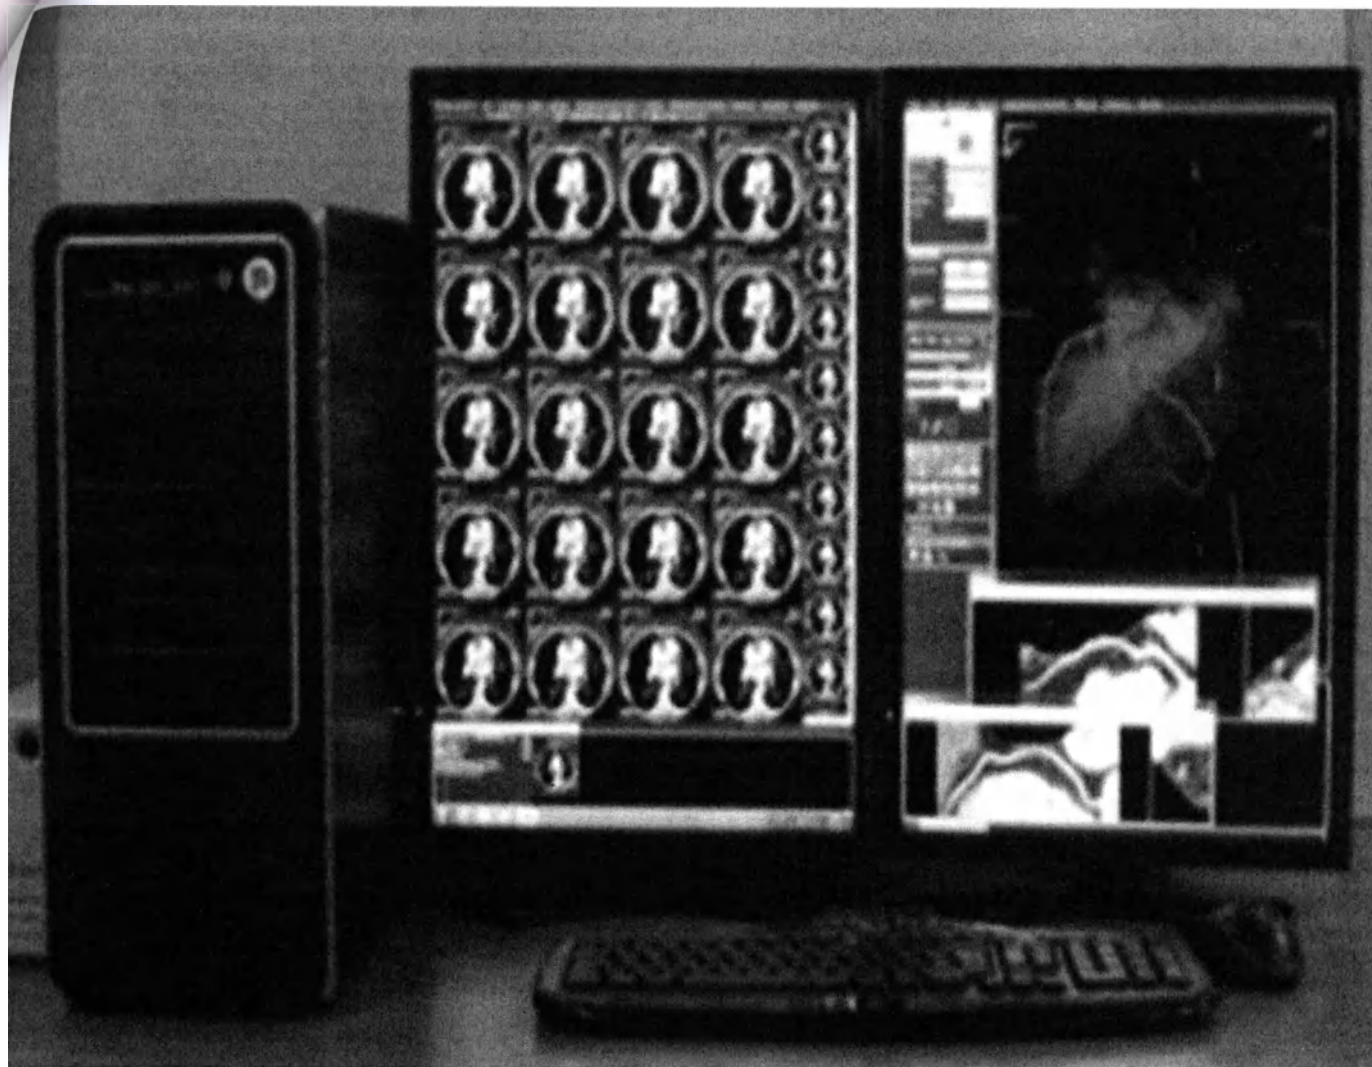

...шина проявочная автоматическая для листовых пленок производства фирмы
CareStreamHelth, США или принтер лазерный производства фирм CareStreamHelth Inc., США,
Konica Minolta Medical and Graphic Inc., Япония или Agfa Gevaert N. V., Бельгия;

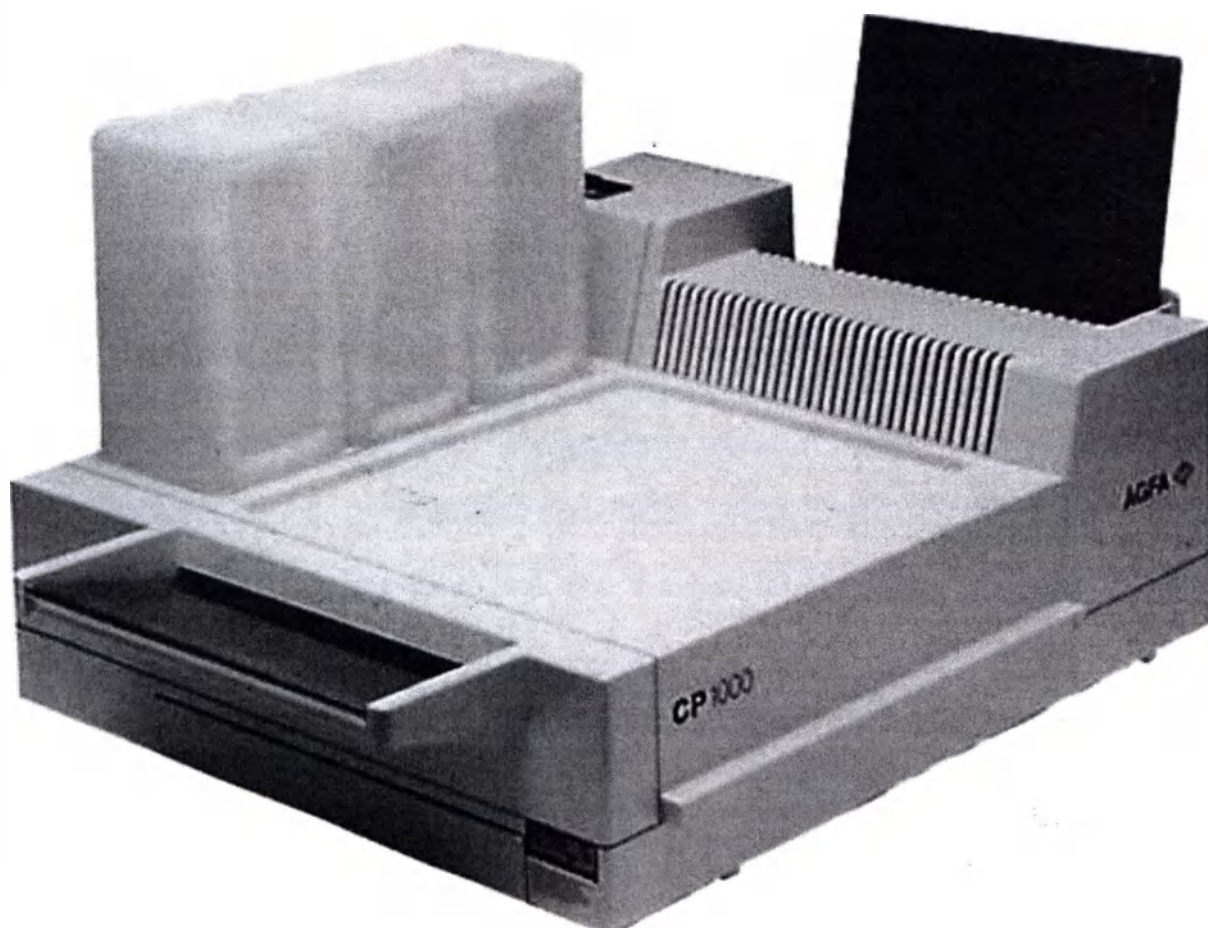

комплект кассет KODAK Medical X-RAY или комплект кассет РЕНЕКС КРЦр
палатных аппаратов: 18х24-2 шт., 2х30-2 шт., 35х35-2шт., Производства ЗАО «Ренекс»,
Россия;

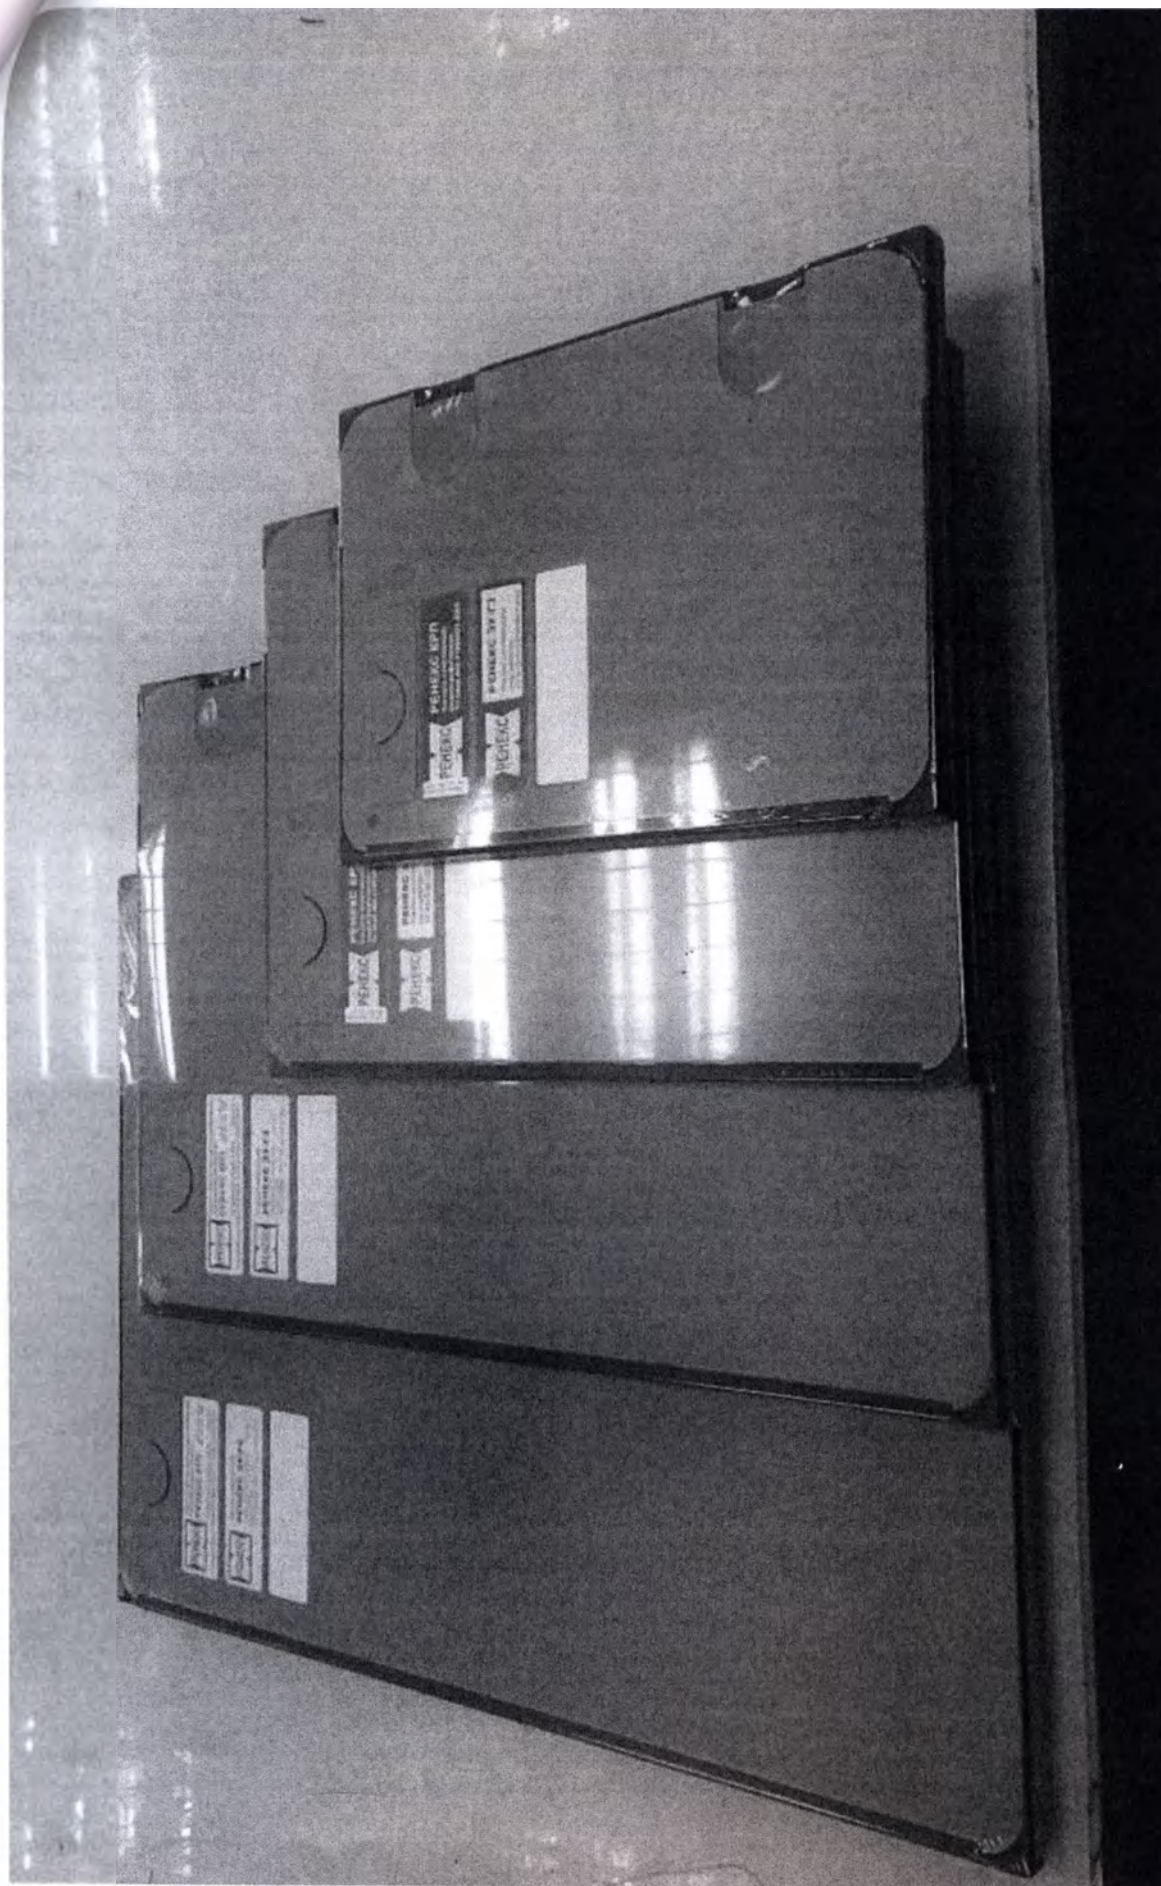

ства индивидуальной защиты, производства ООО НПФ «Гаммамед-П», Россия.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 25 листов
Генеральный директор
А.И. Генин

