



PHILIPS

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Аппарат наркозно-дыхательный Siesta i с принадлежностями»


УТВЕРЖДАЮ

Директор по нормативно-правовому
регулированию и качеству


ООО «ФИЛИПС»

О.В.Бахвалова


« 08 » апреля 2016 г.

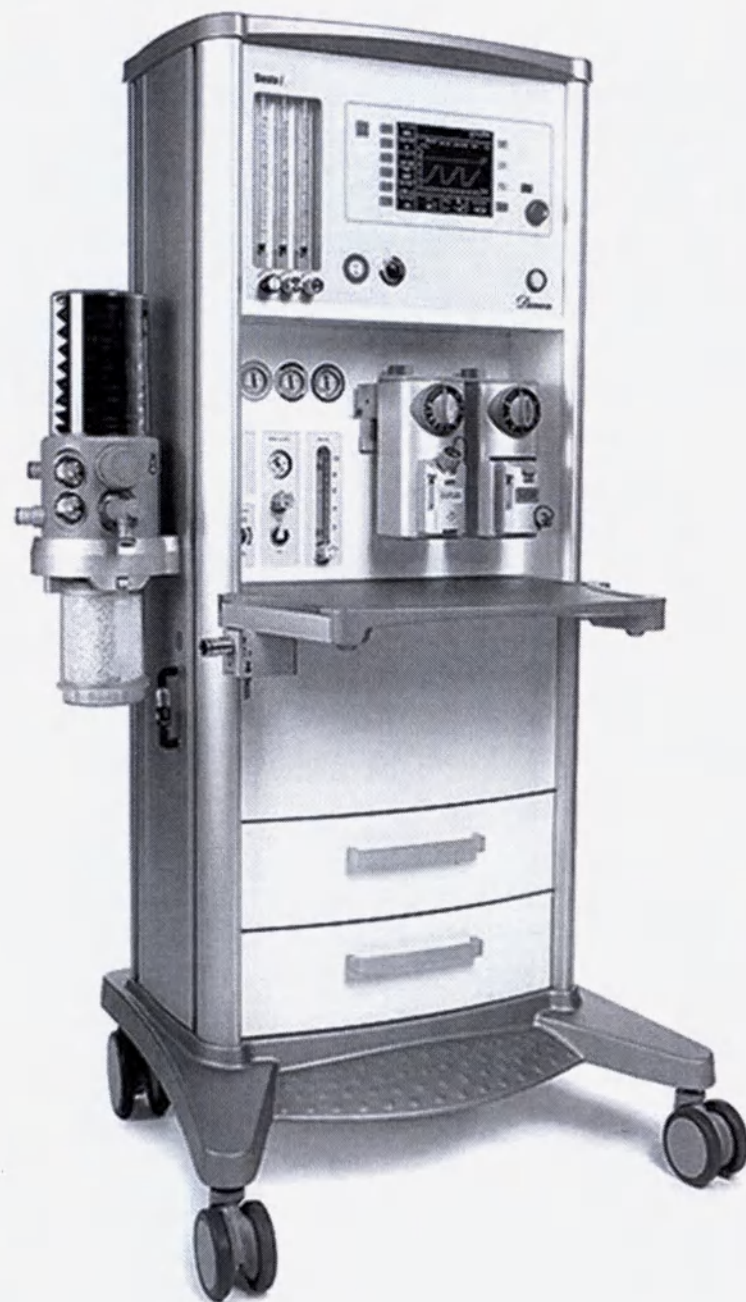


Аппарат наркозно-дыхательный Siesta i, вариант исполнения: Siesta i Whispa (Блок основной)

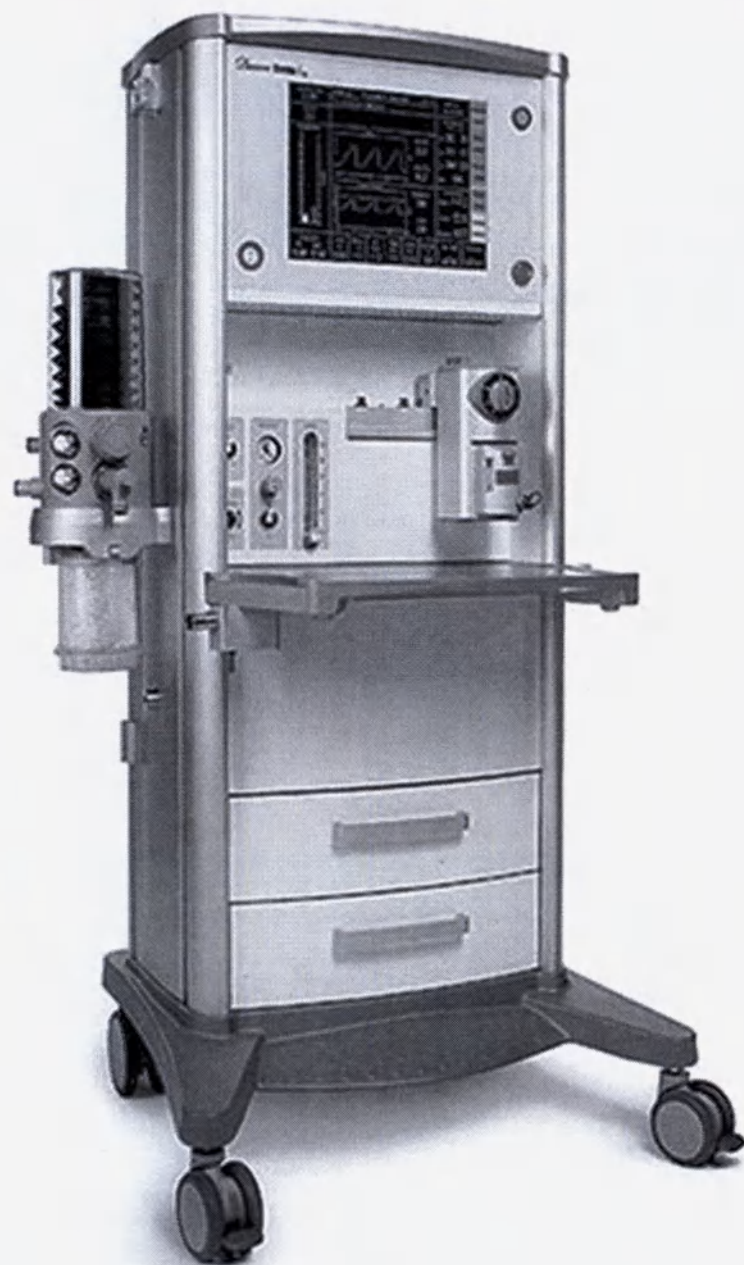


Аппарат наркозно-дыхательный Siesta i, вариант исполнения: Siesta i TS (Блок основной)

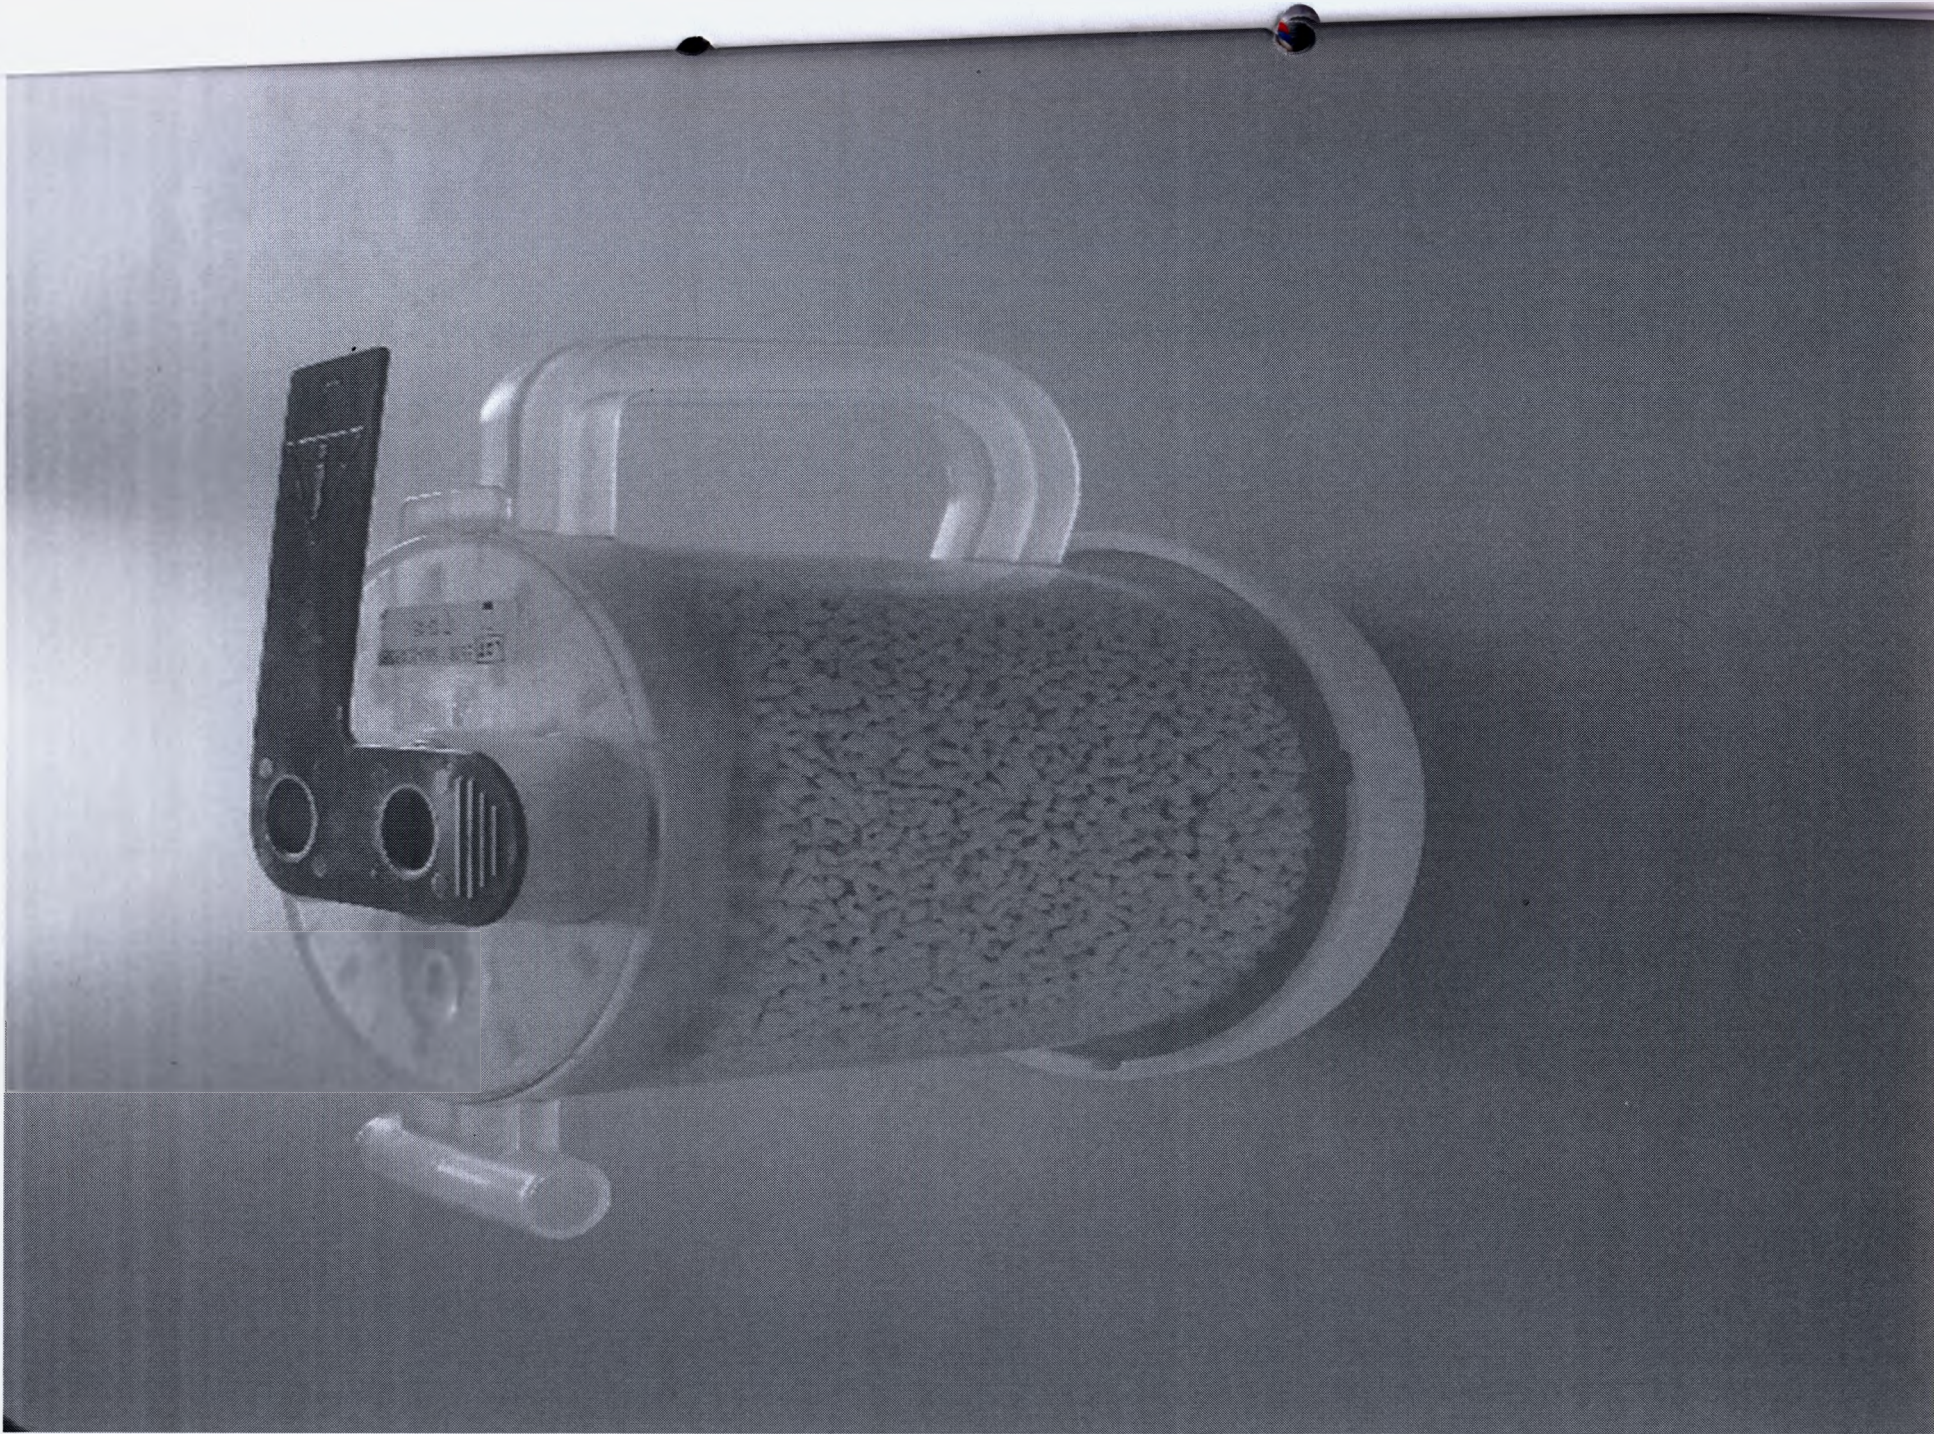


Принадлежности: Абсорберы для дыхательной системы одноразовые (не более 2 уп.)

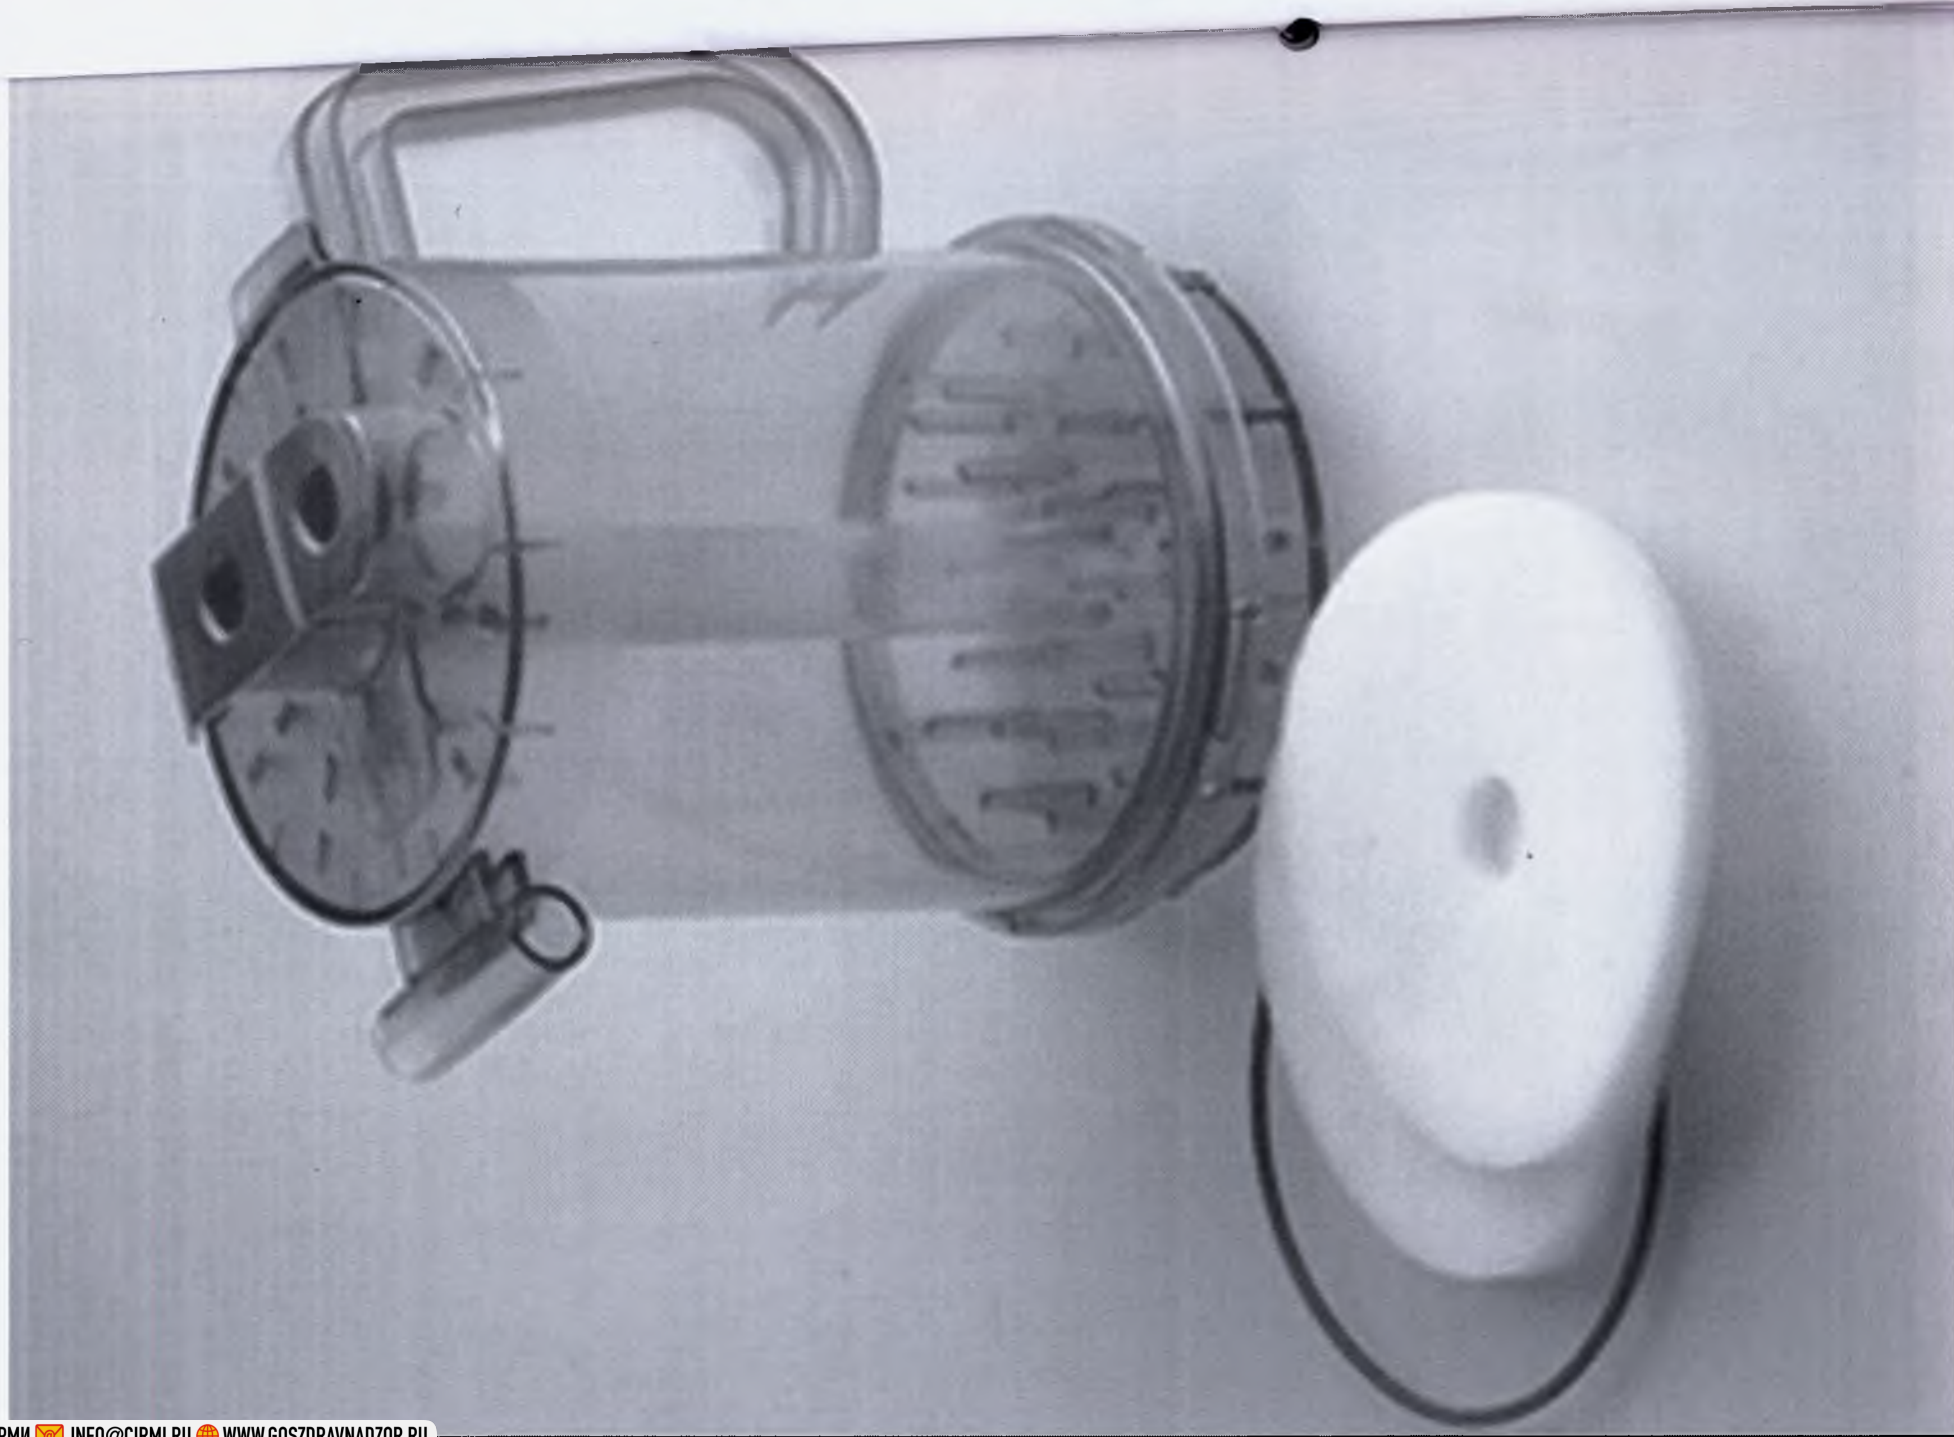

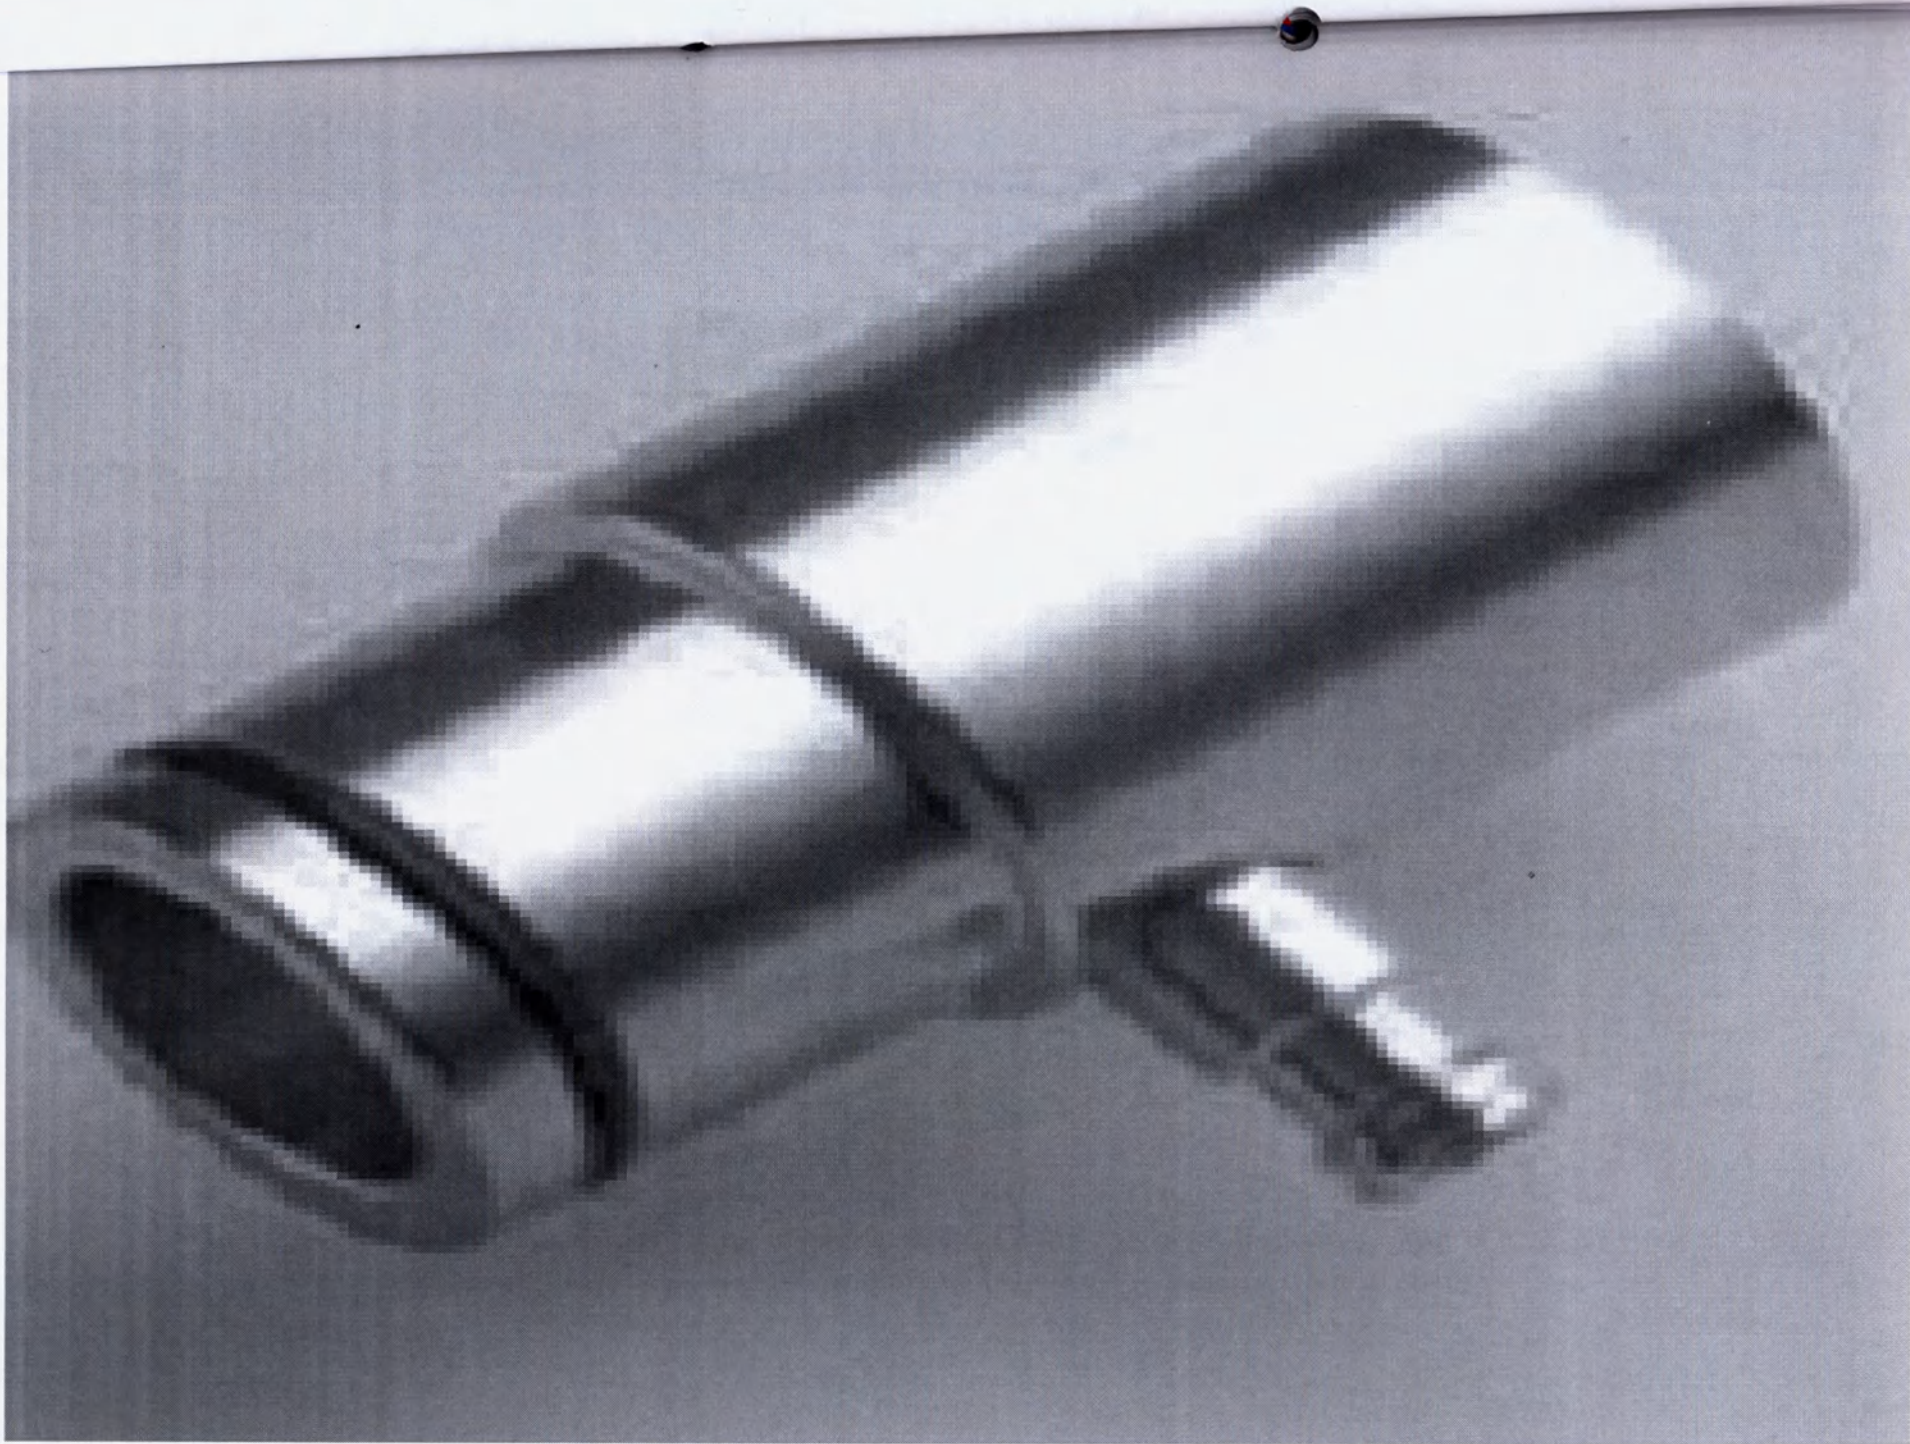





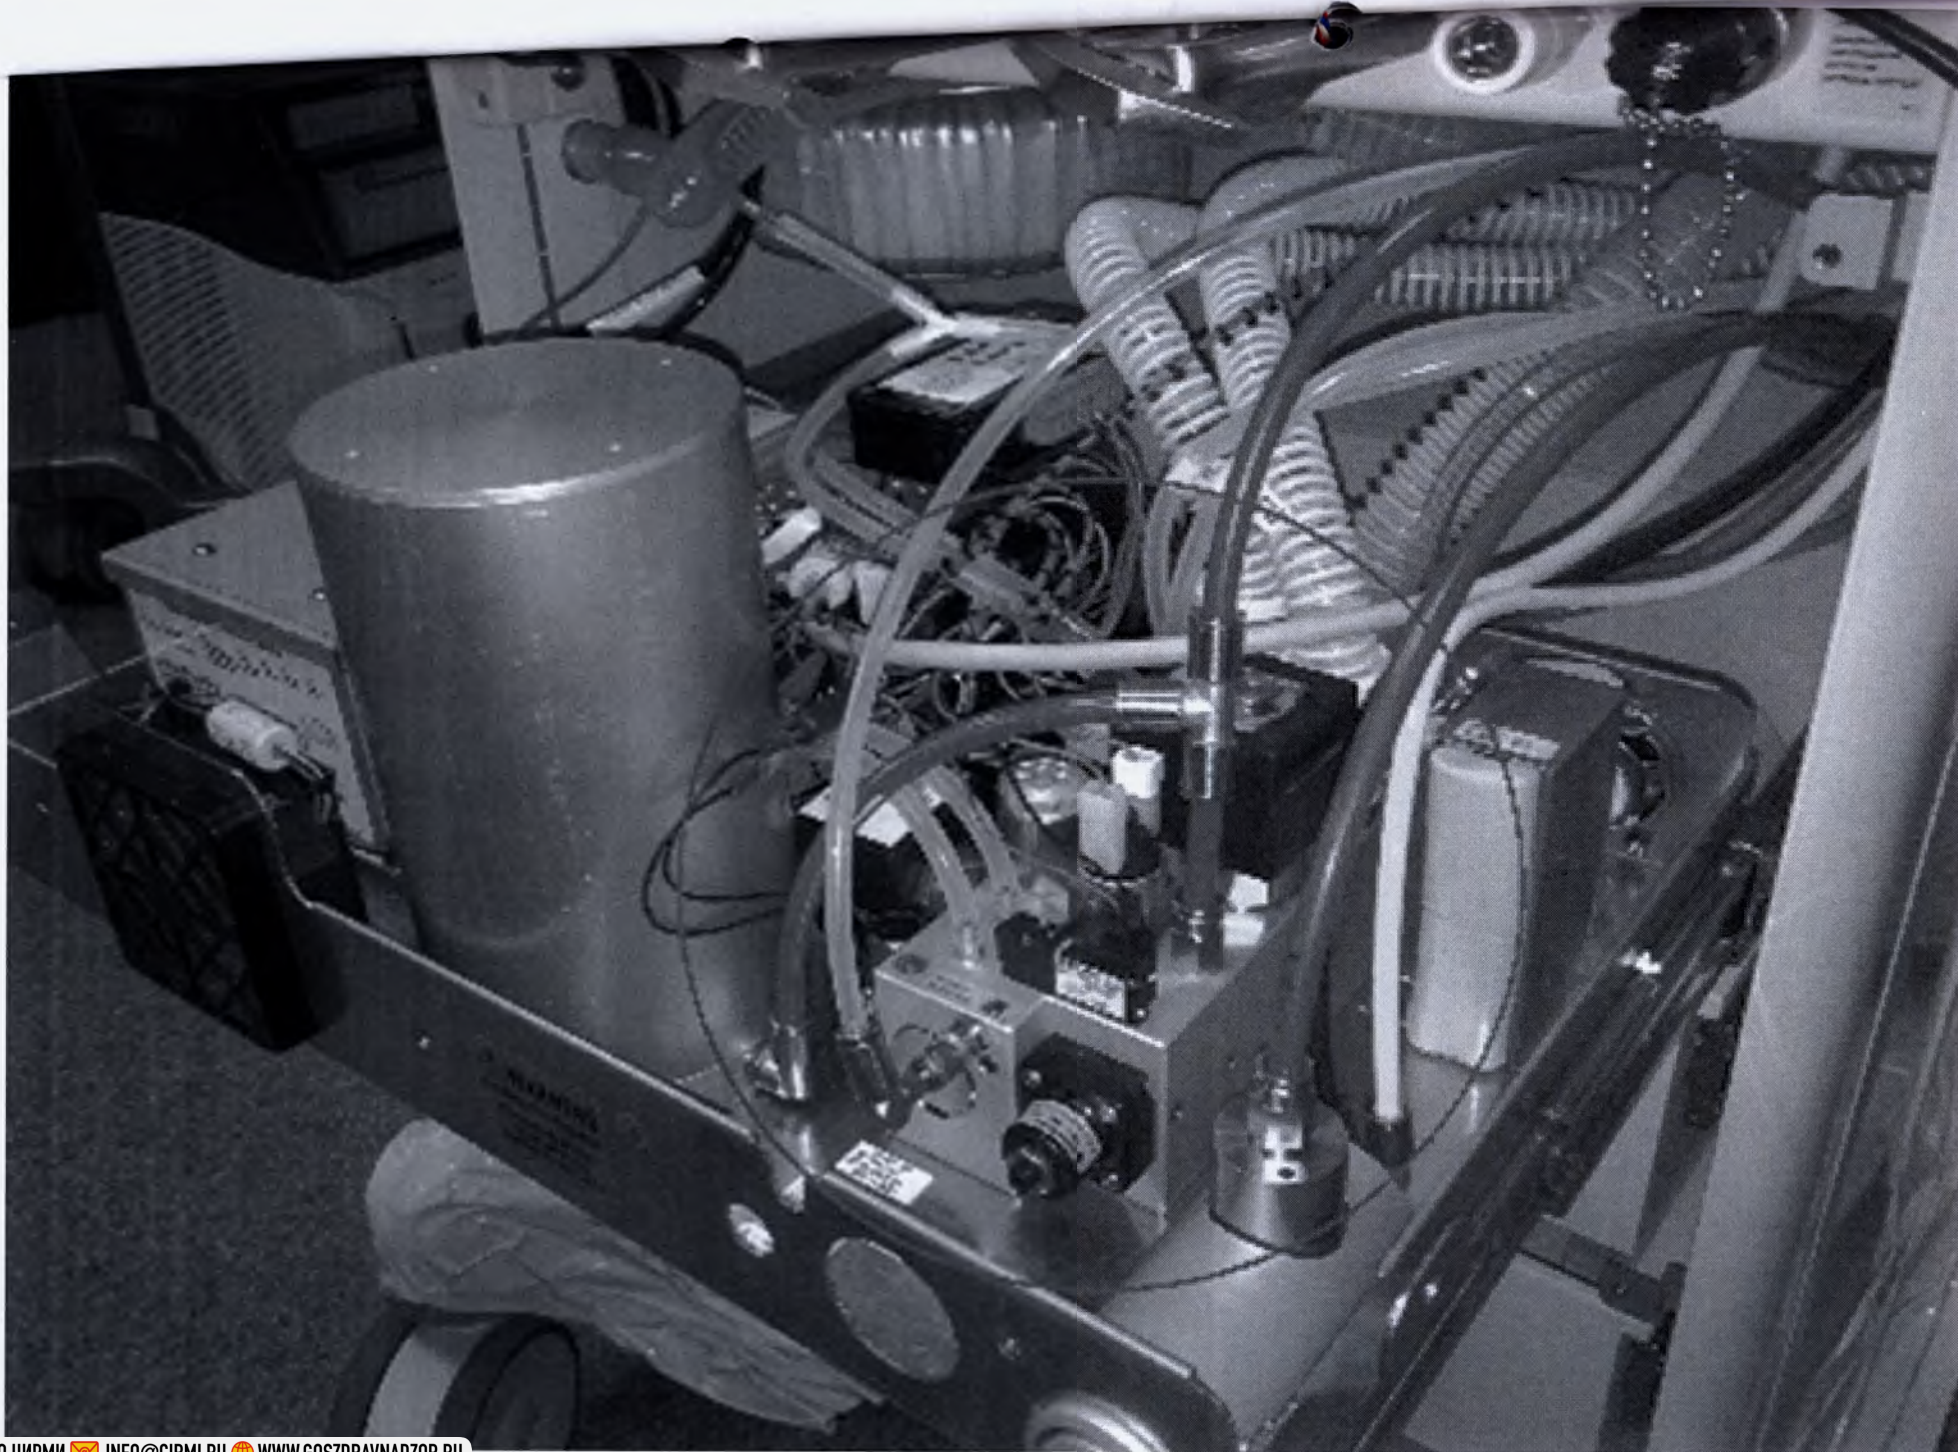






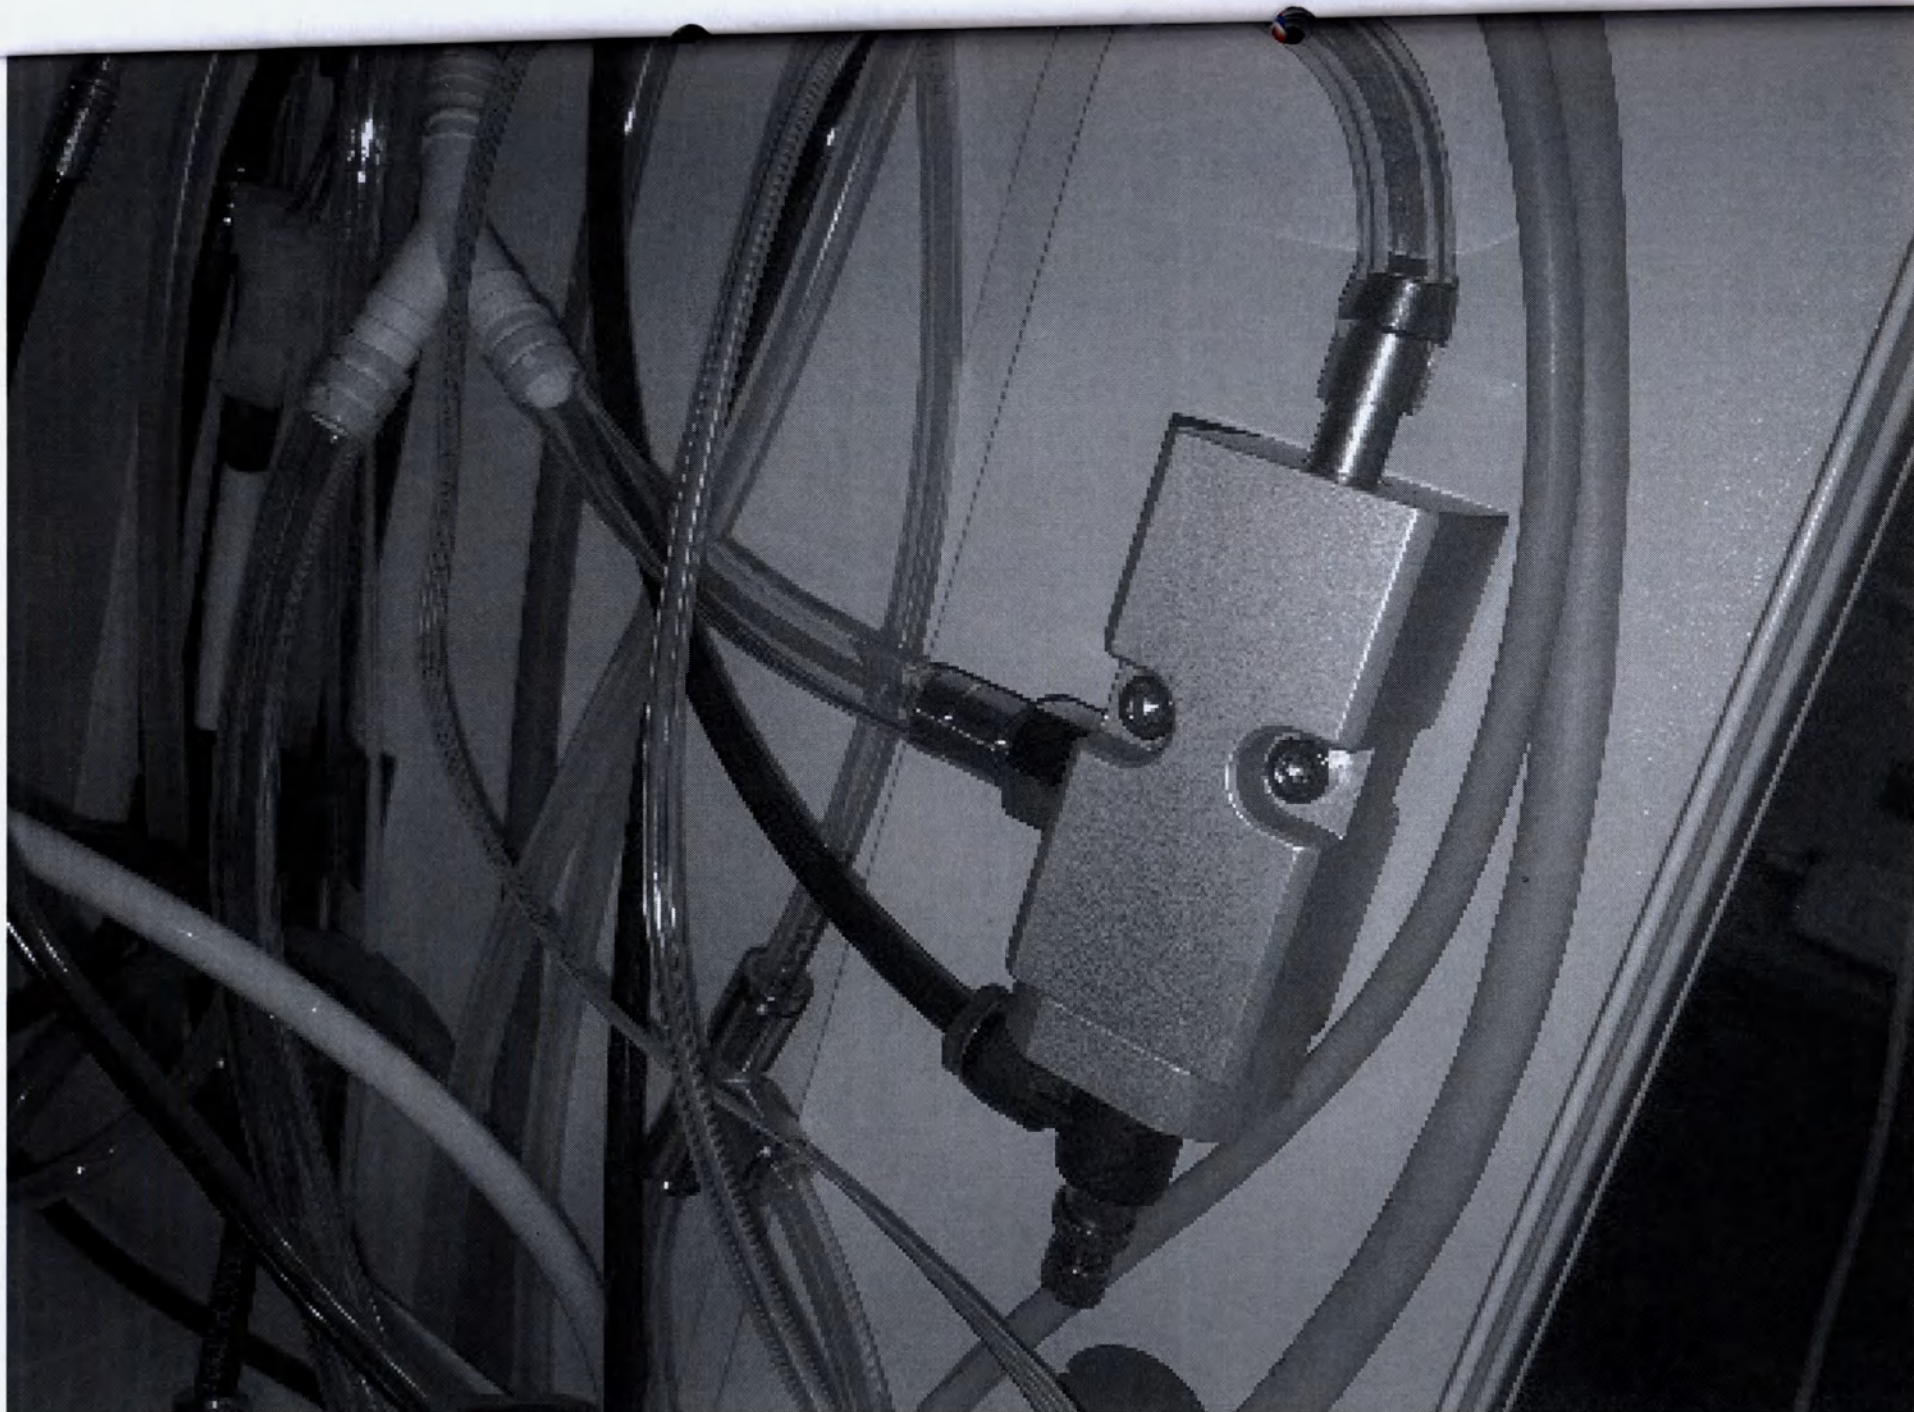


Блоки для аспирации (не более 5 шт.)

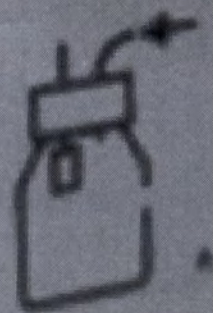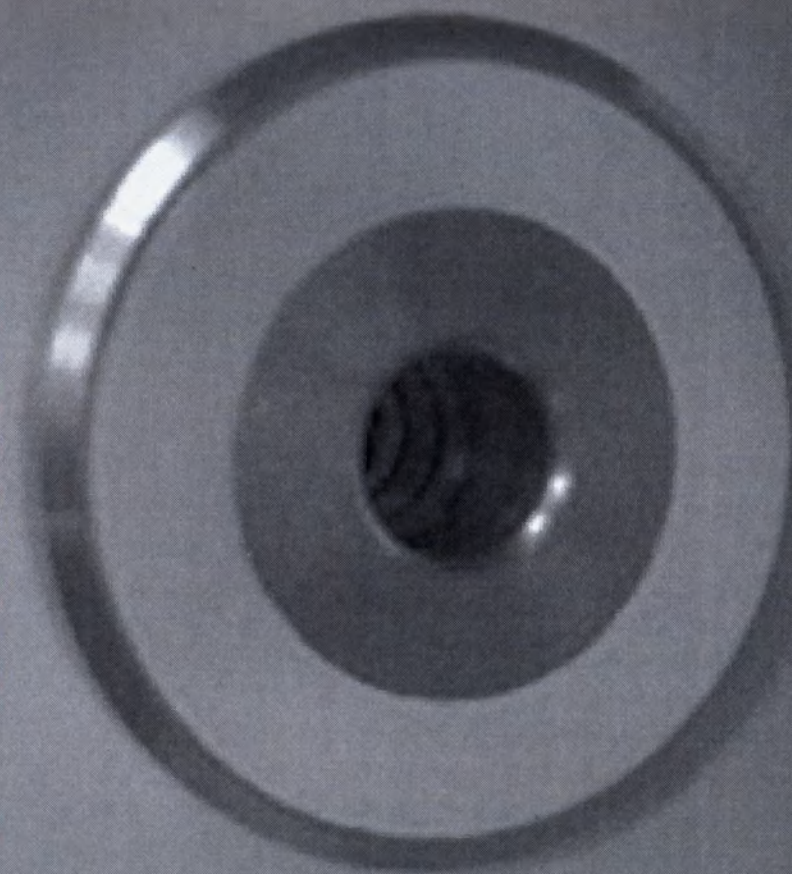


Блоки вакуумные для аспирации (не более 5 шт.).



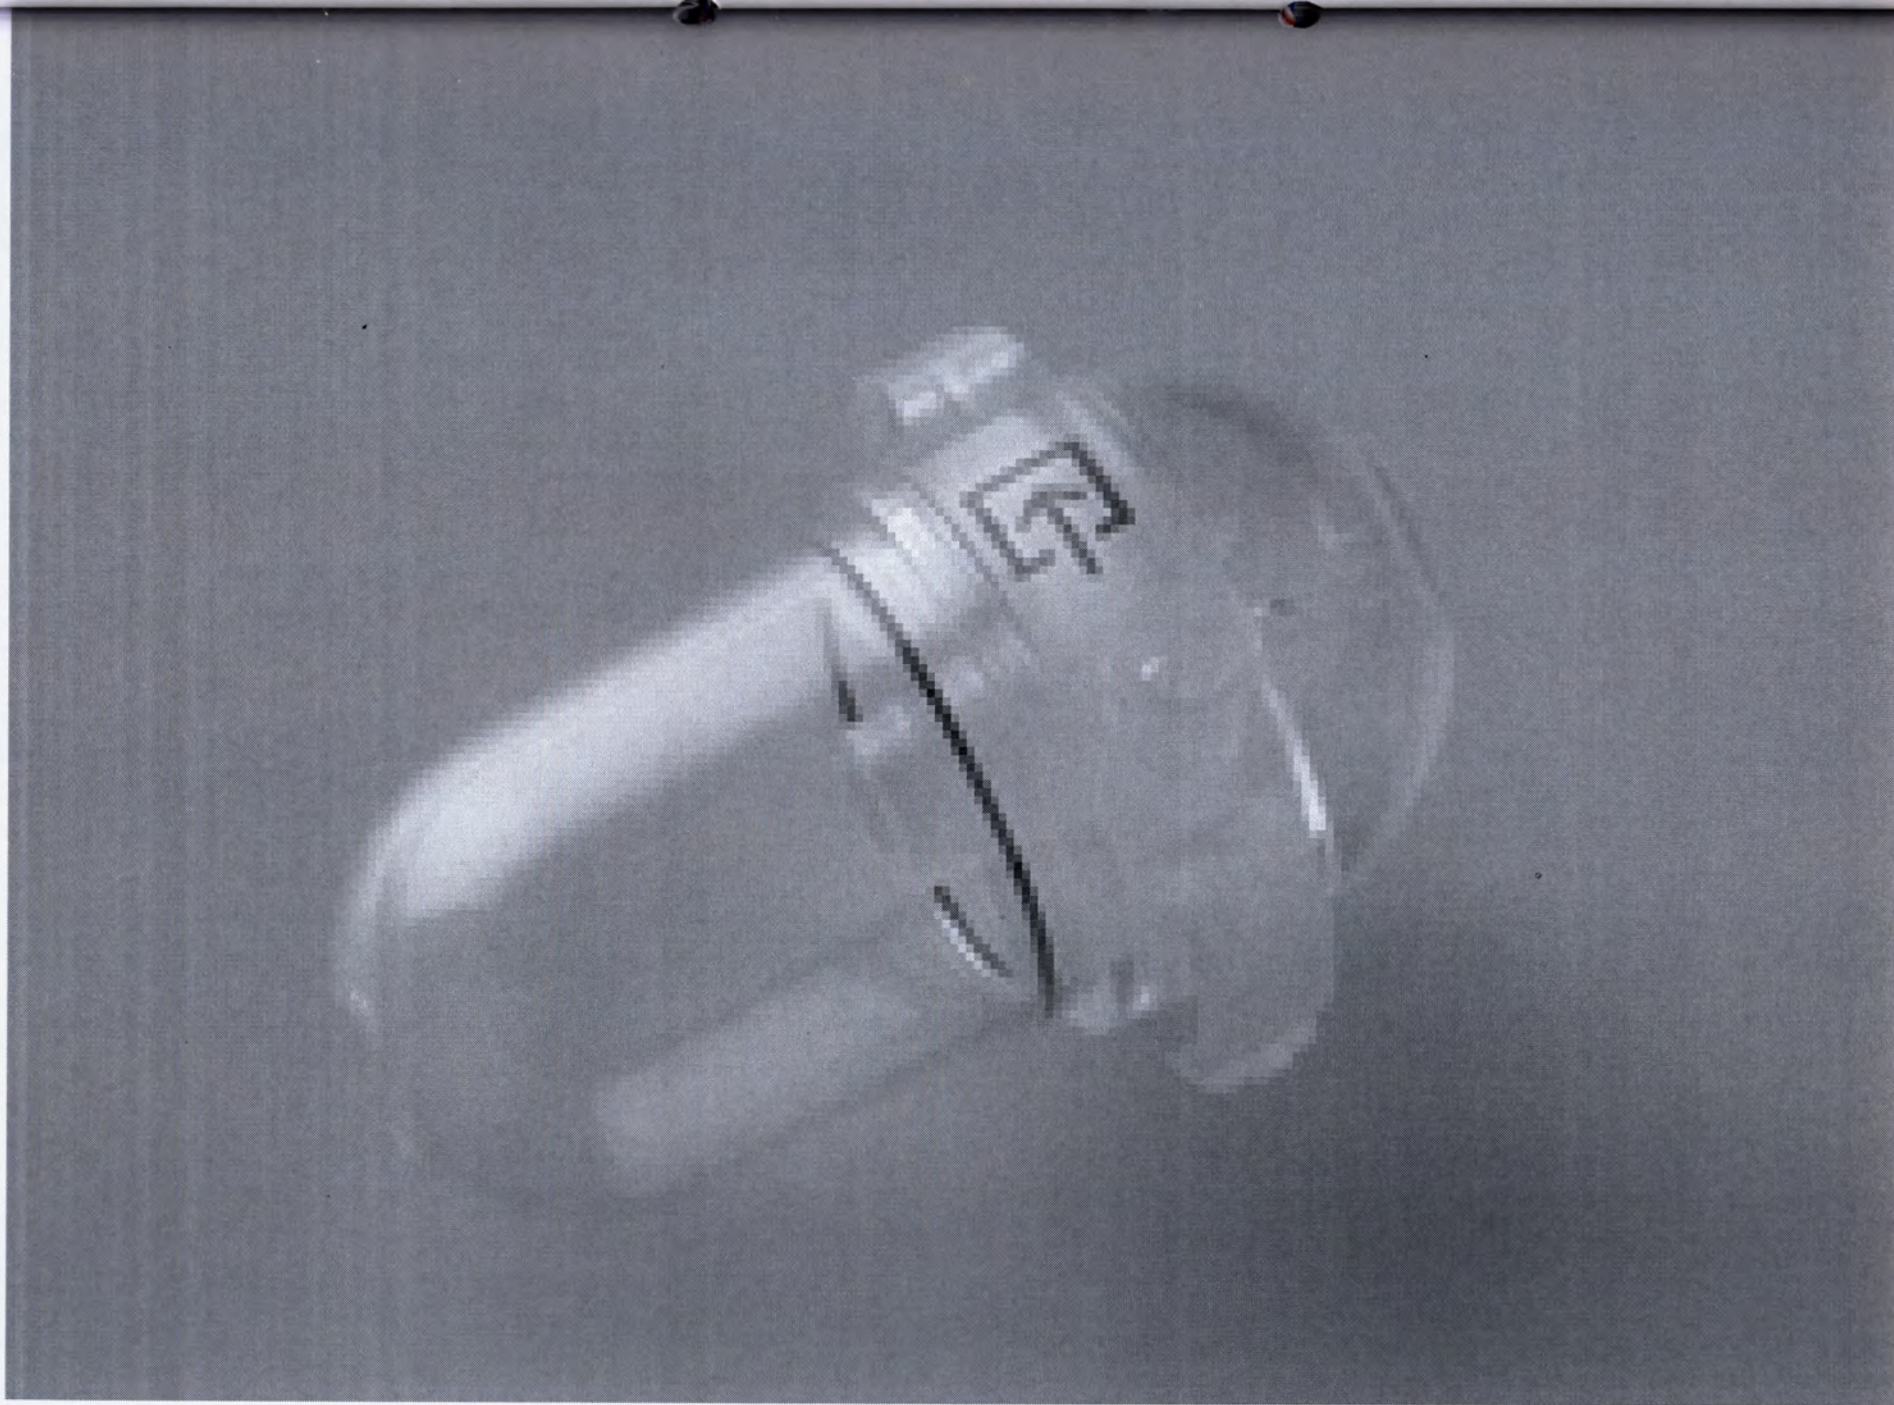


Водосборники (не более 5 шт.).

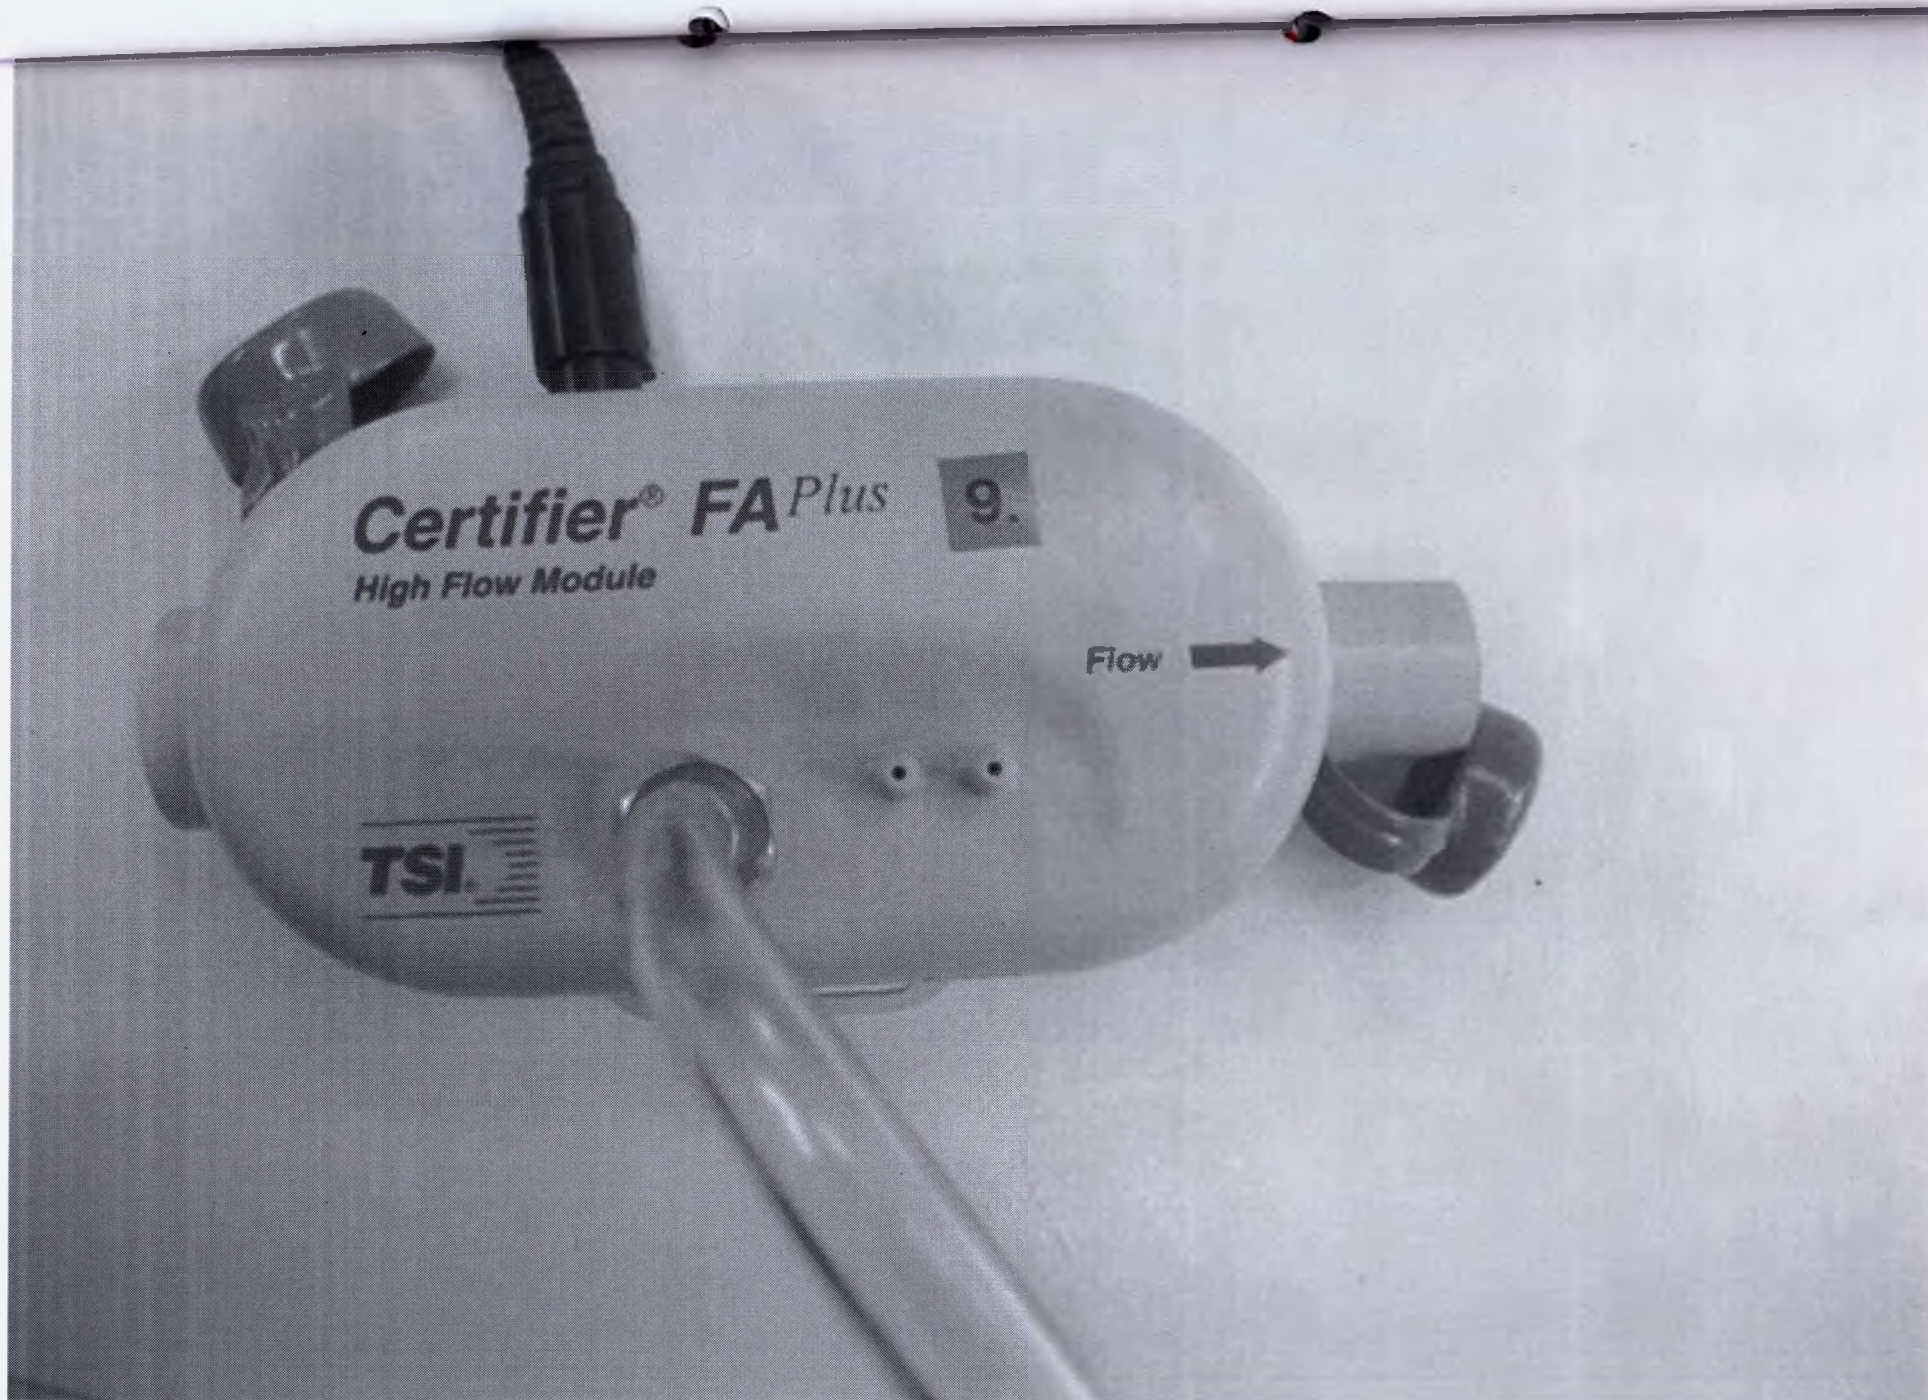

Газоанализаторы (не более 5 шт.)




Головки клапана (не более 10 шт.)

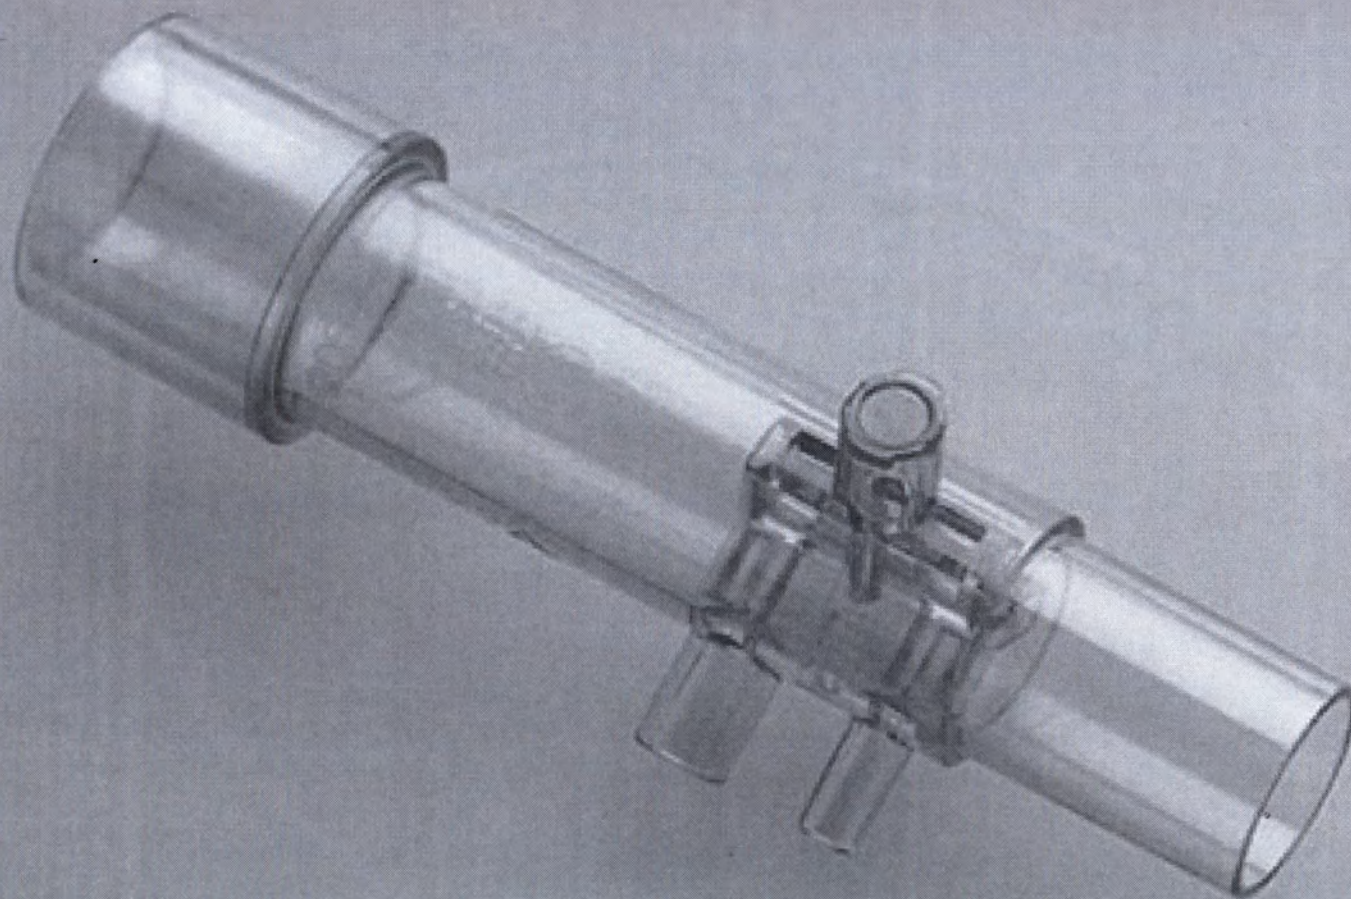


Датчики потока (не более 5 шт.)




Держатели (не более 10 шт.)

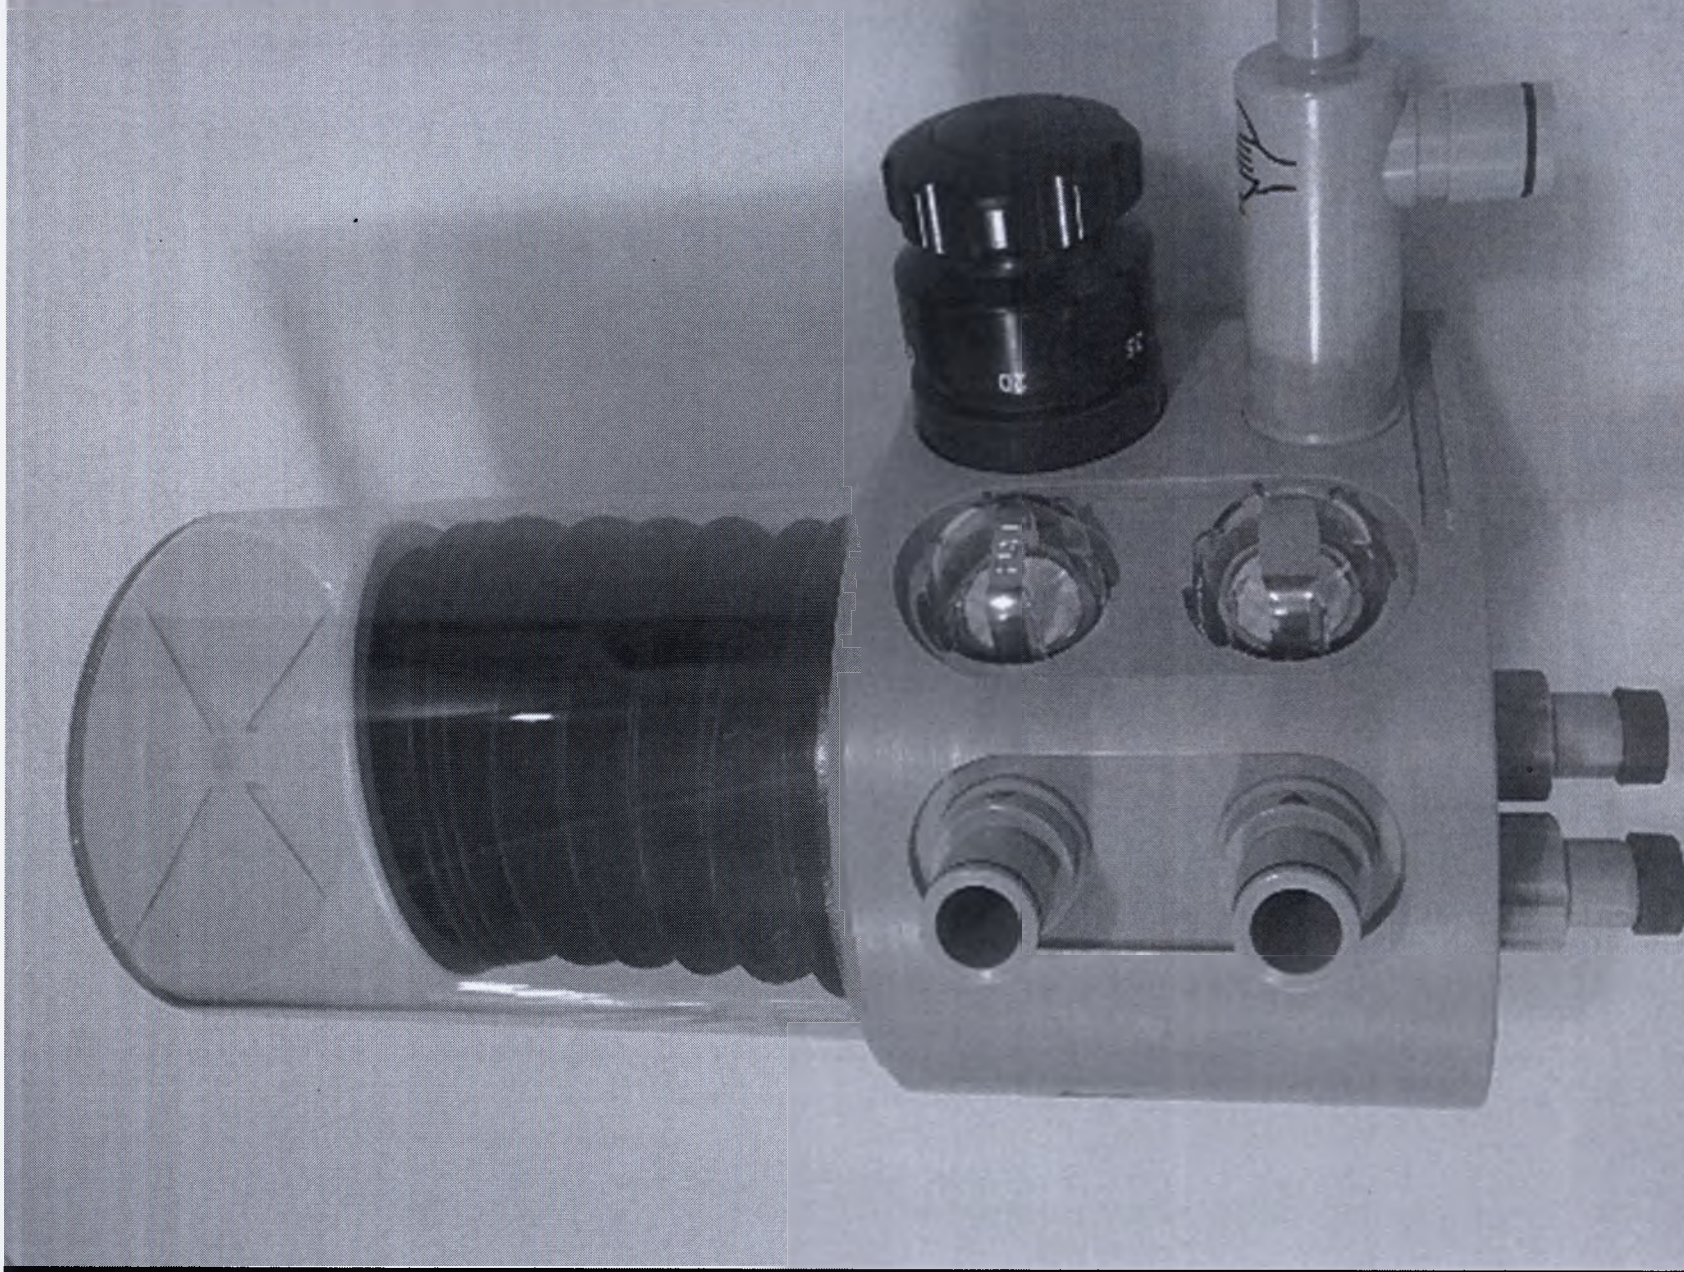


Системы дыхательные интегрированные (не более 2 шт.).

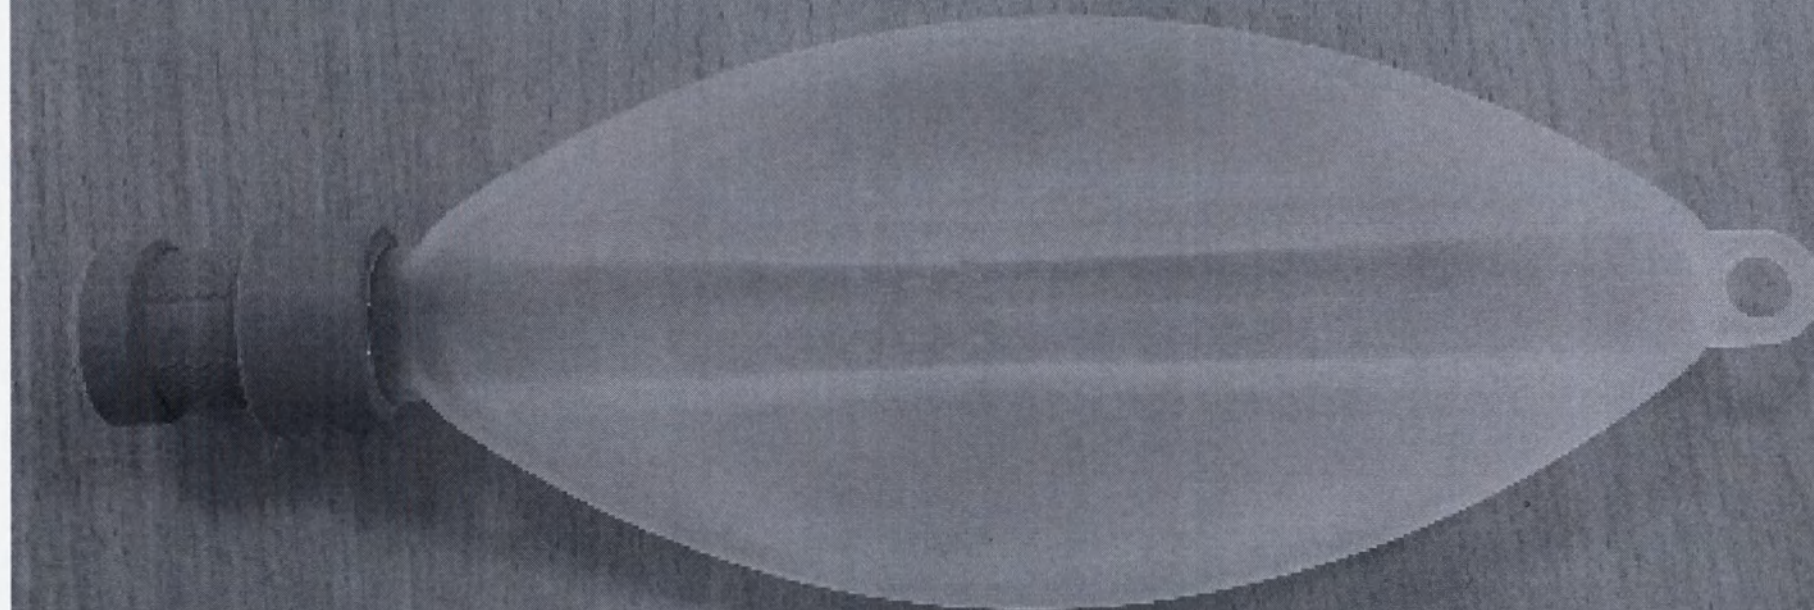


Мешки дыхательные (не более 5 шт.)

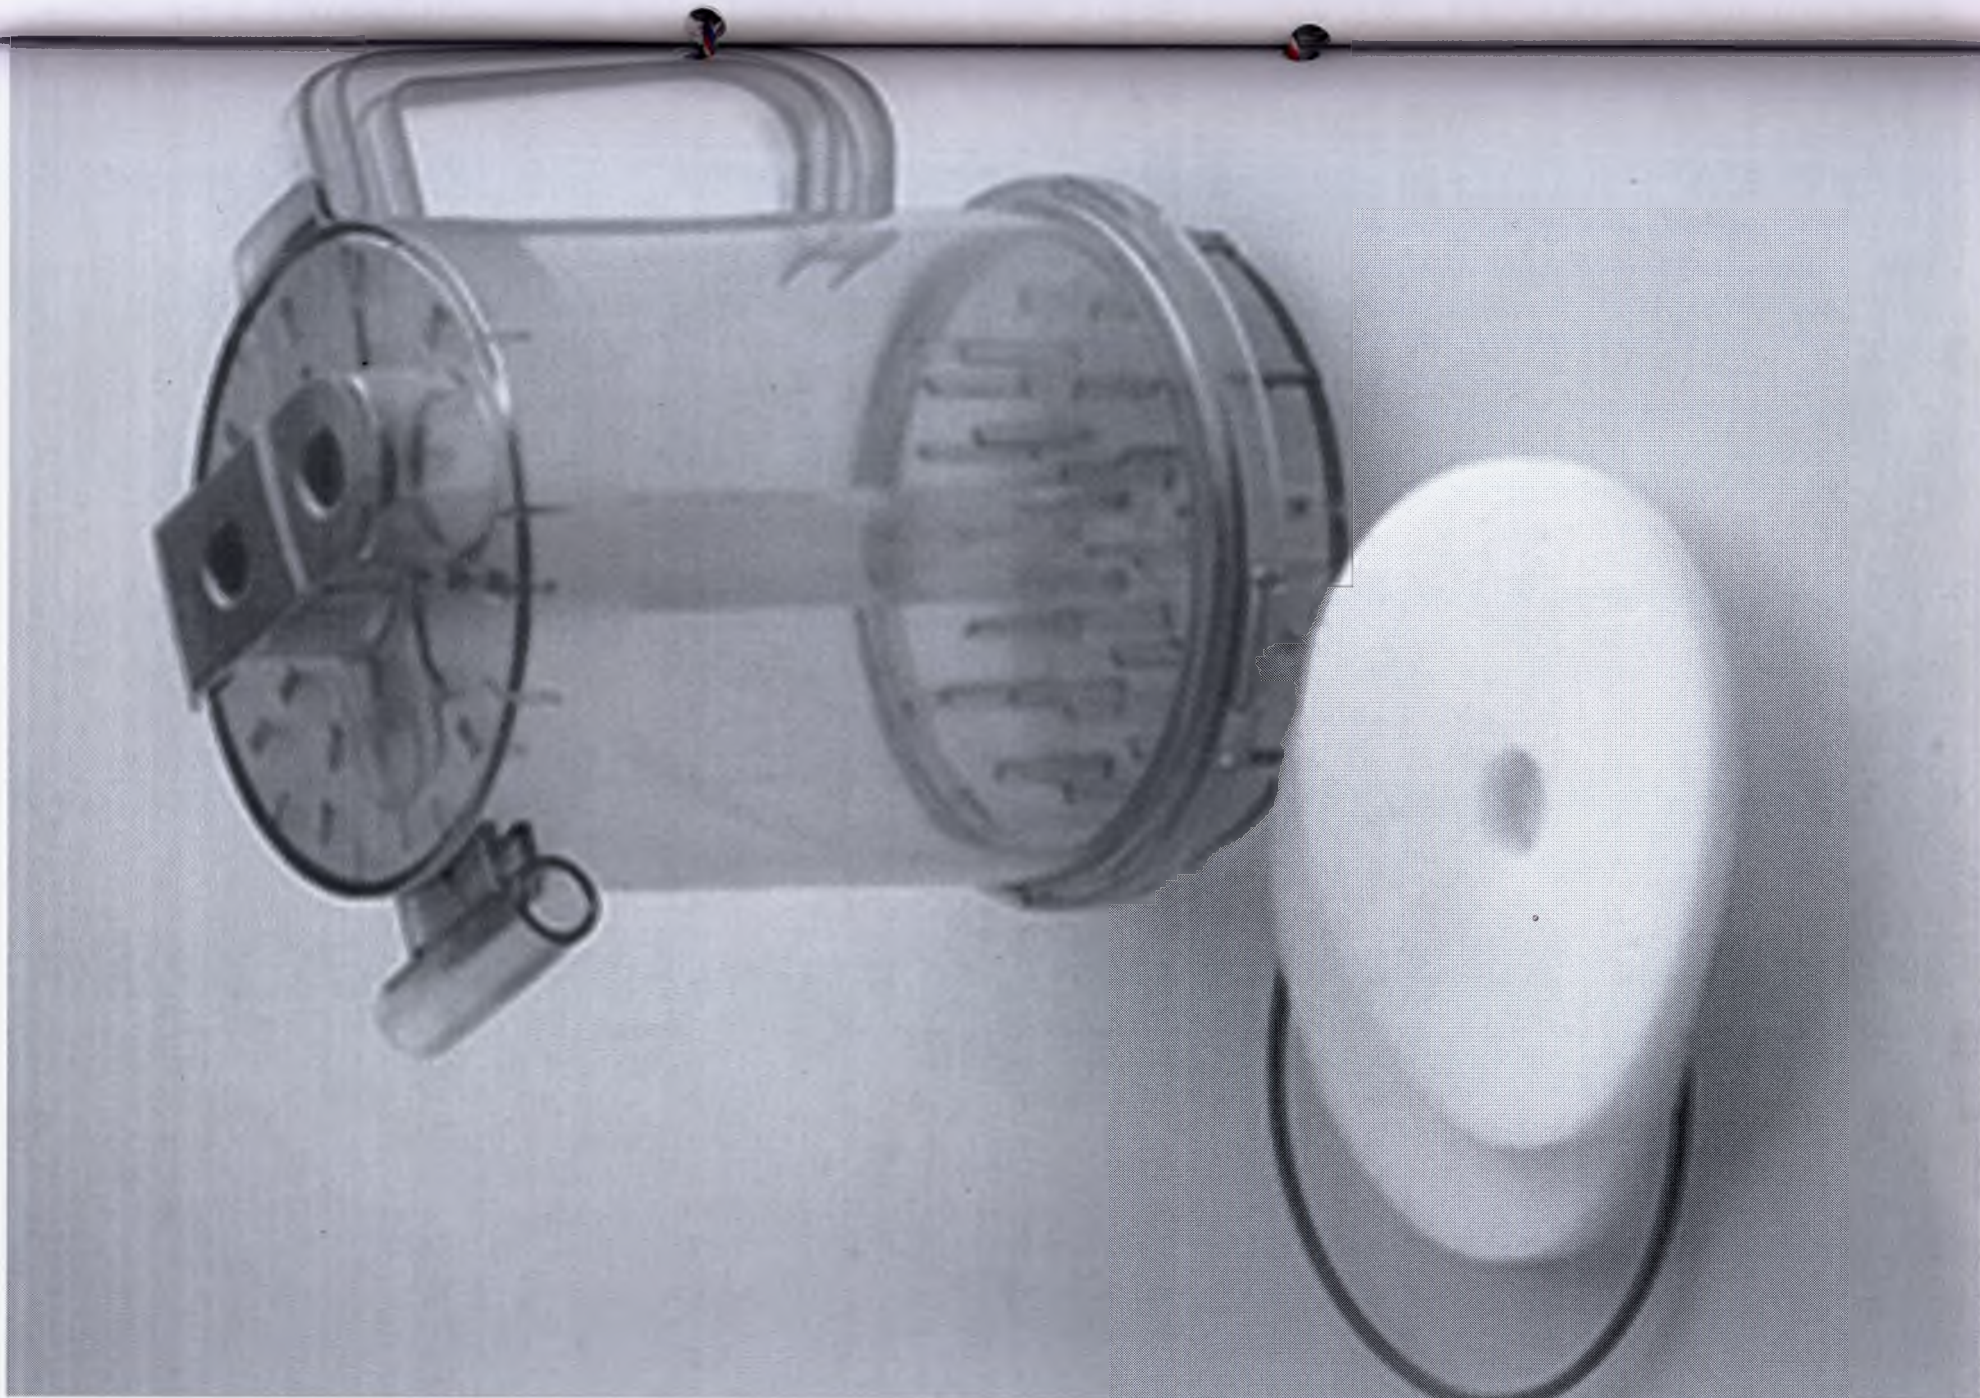


Емкости абсорбера (не более 5 шт.)

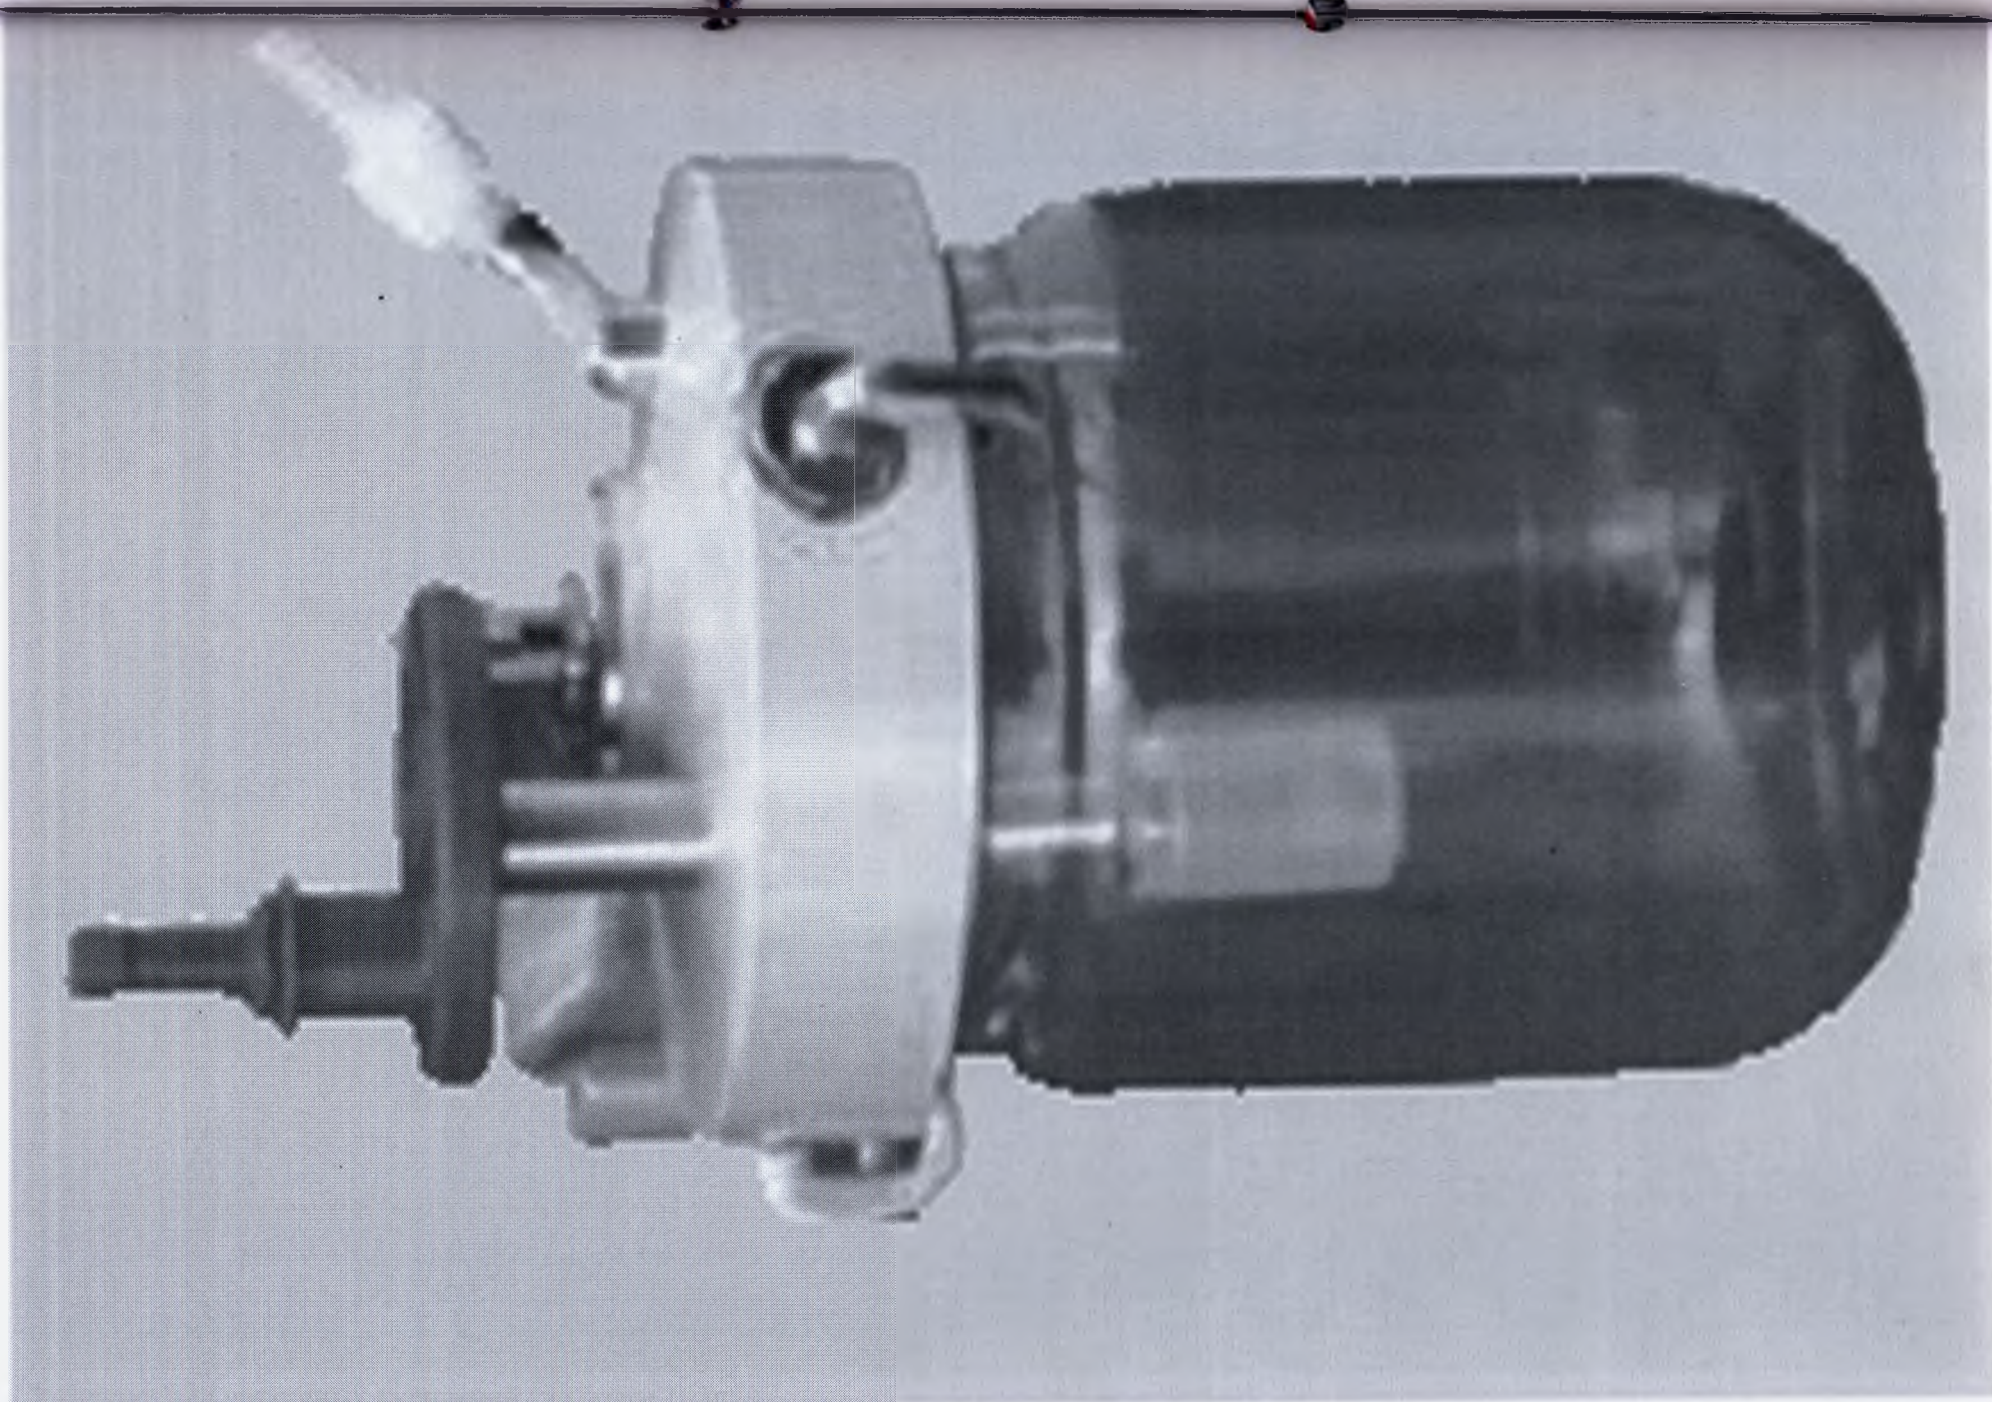

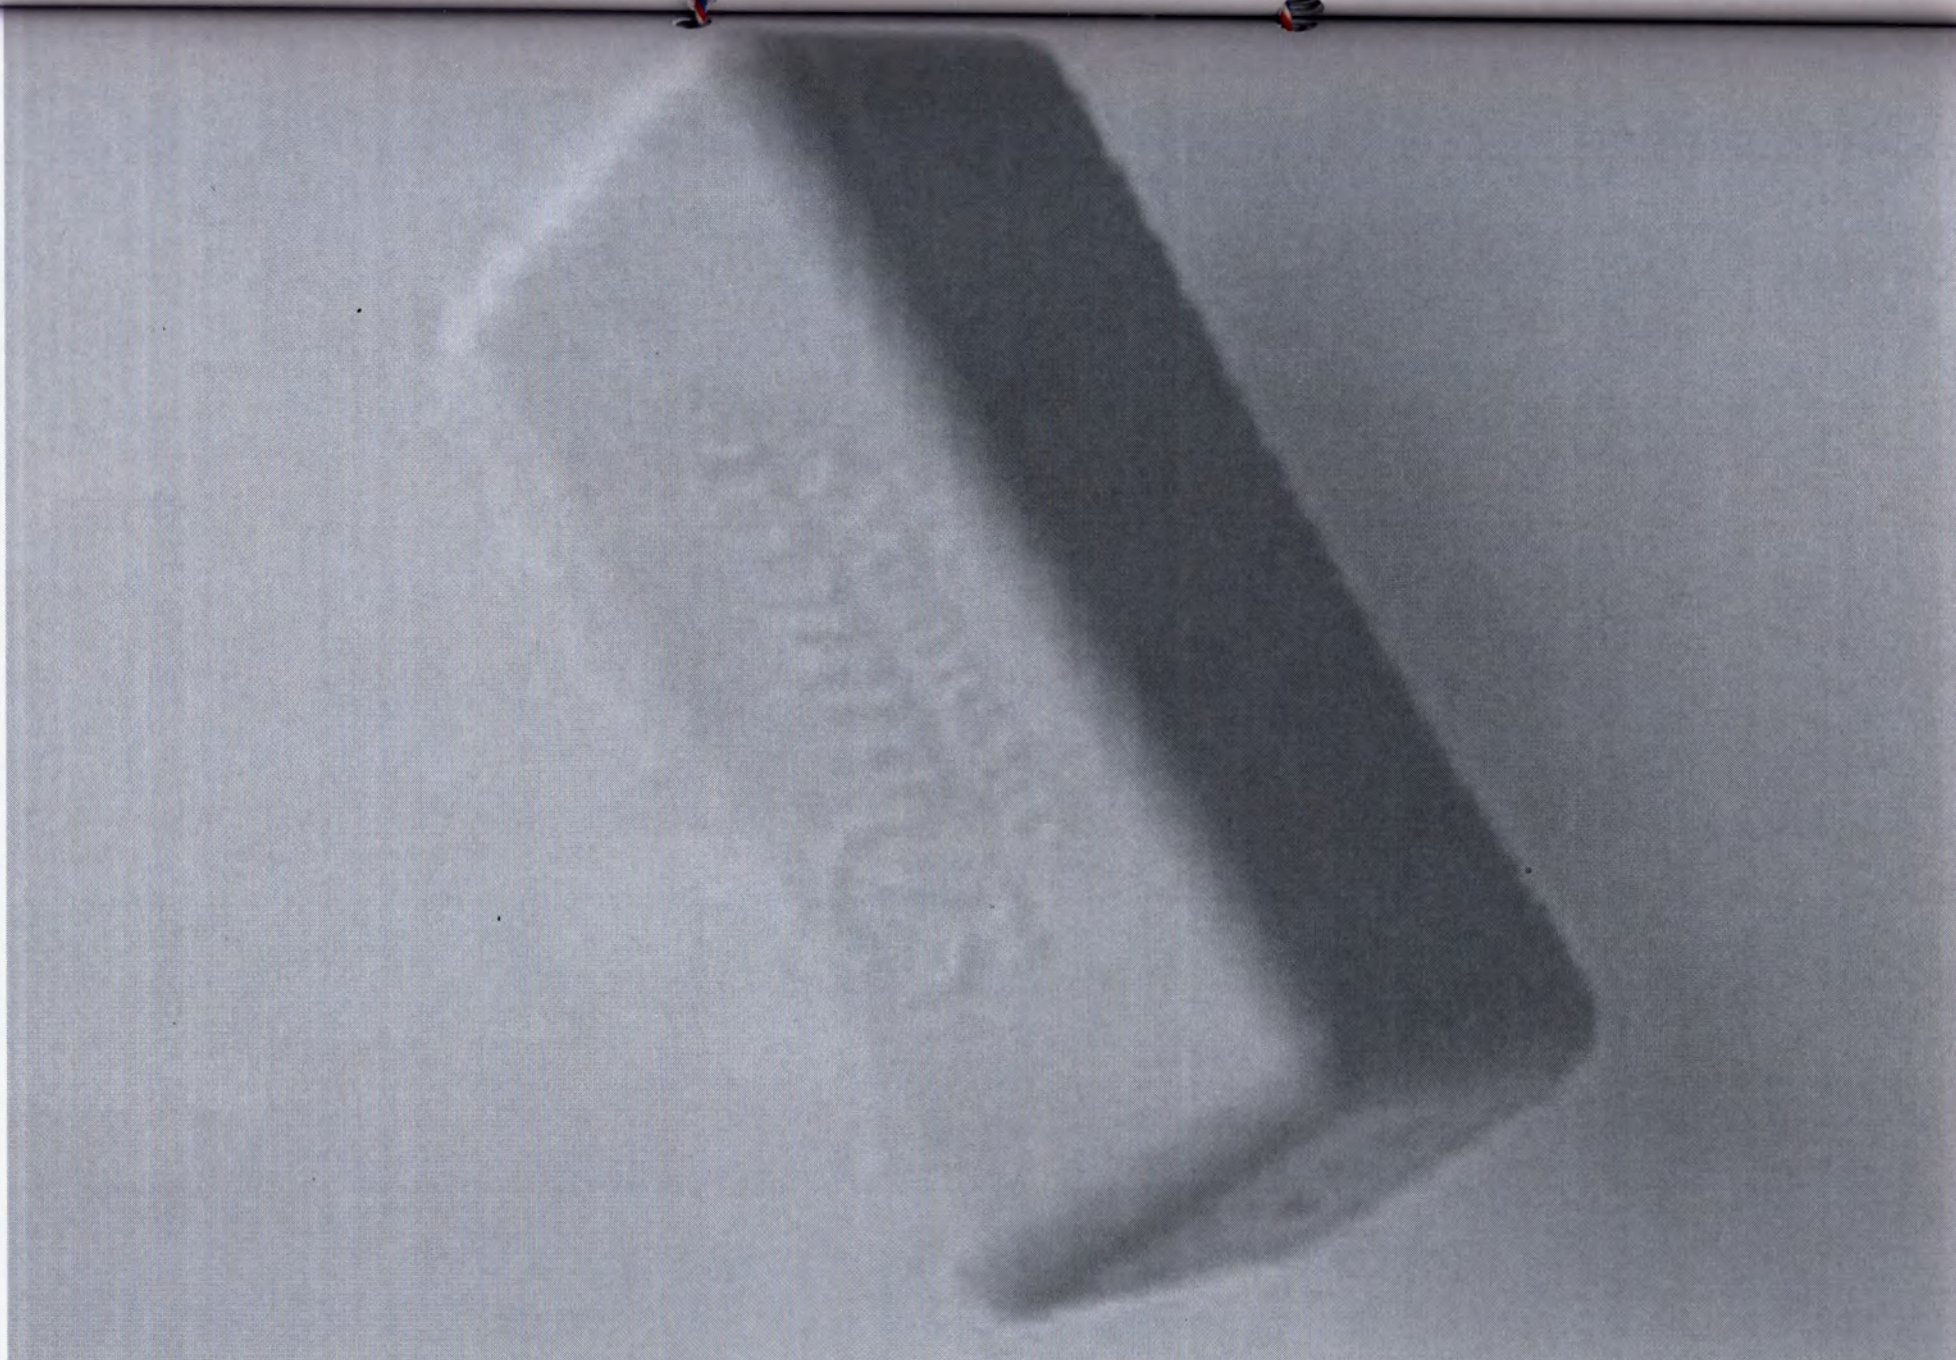


Заглушки для настенных креплений (не более 10 шт.)

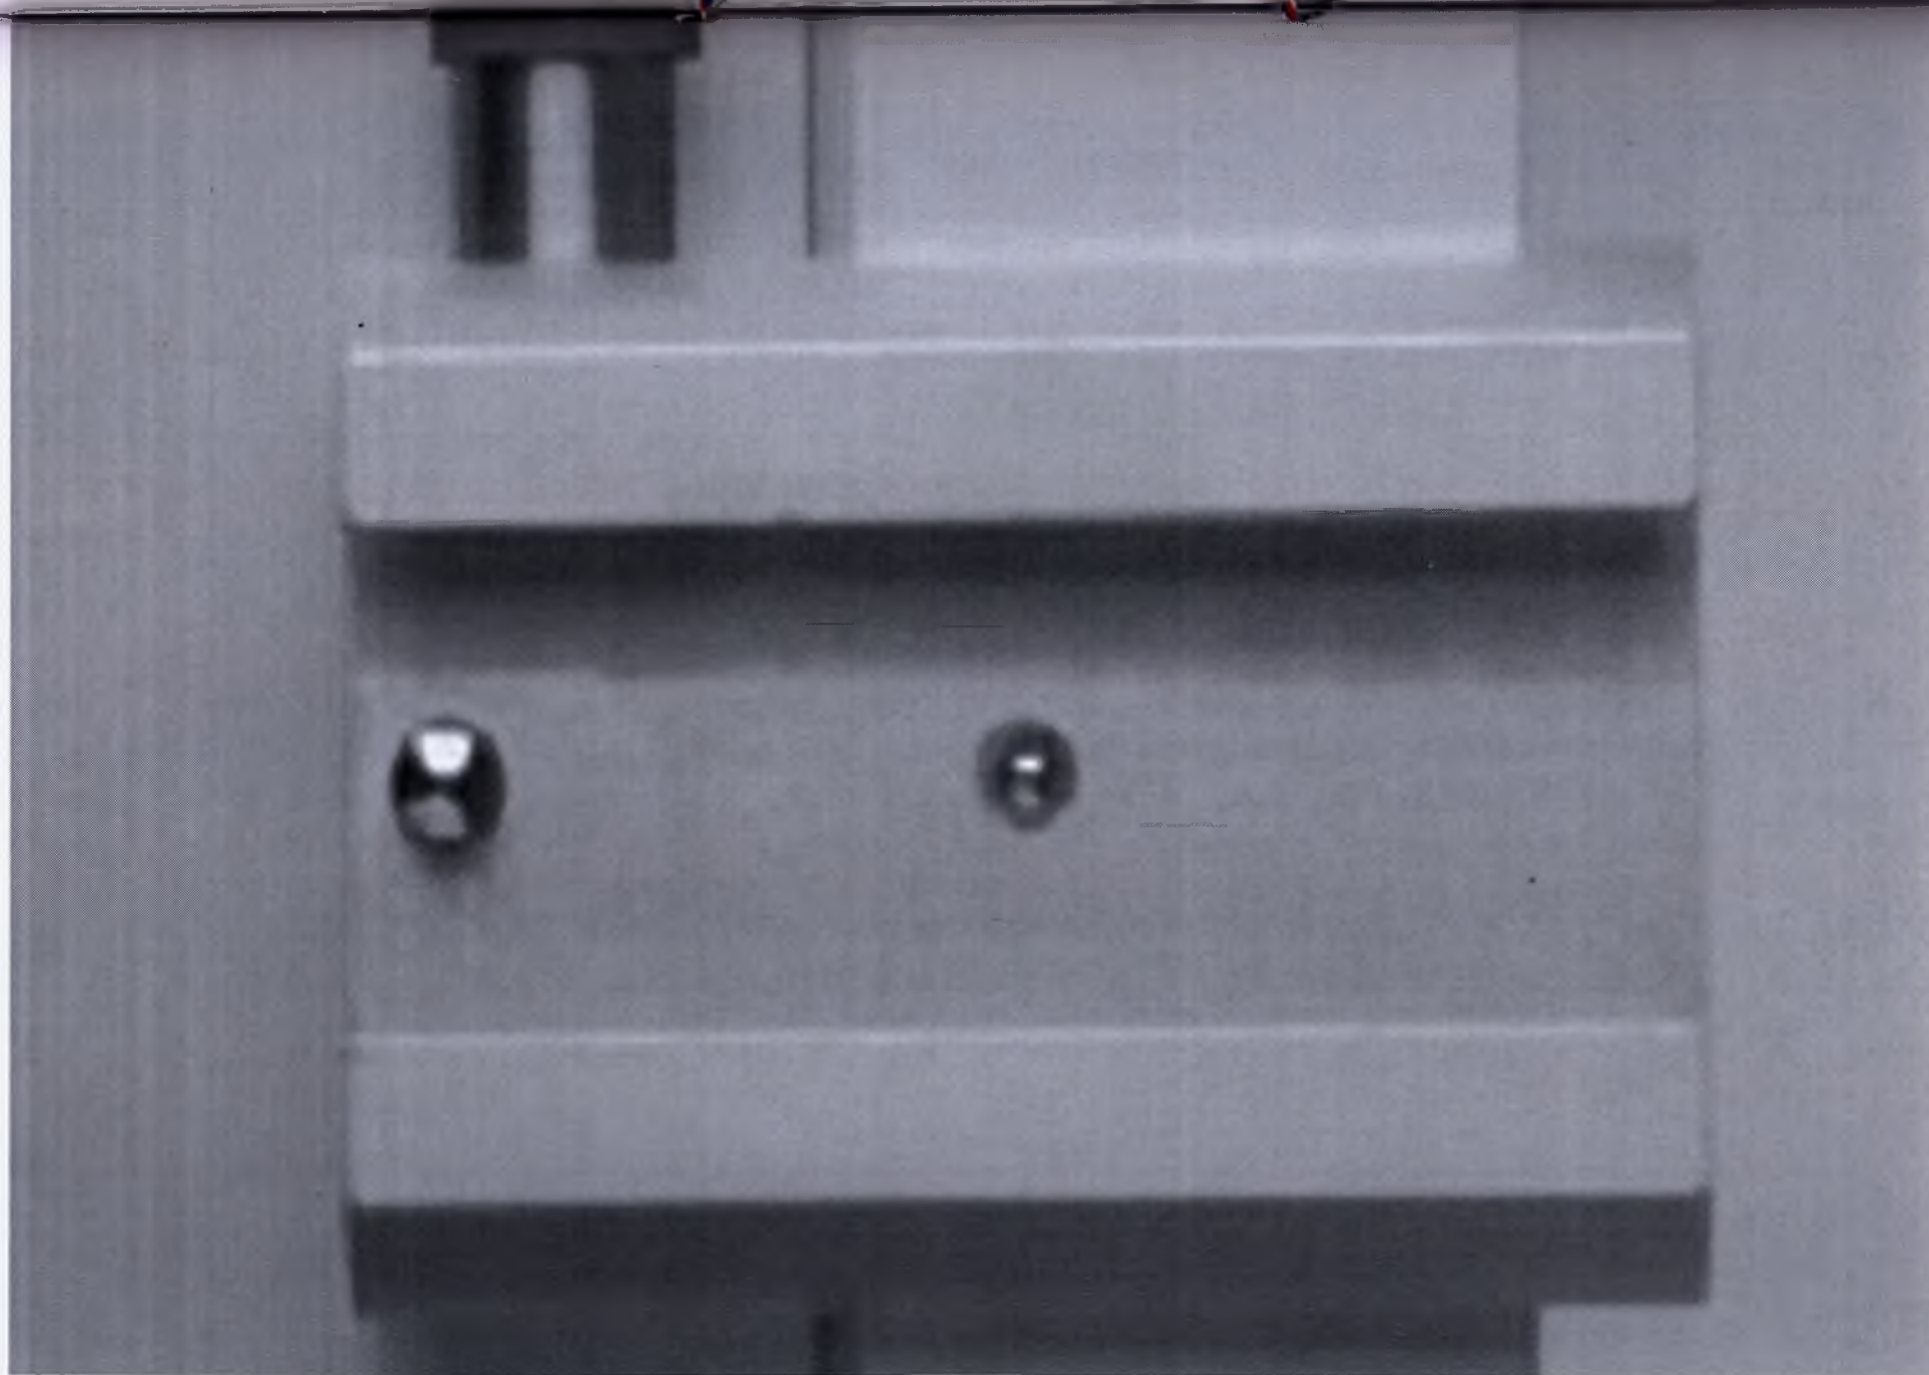

Зажимы (не более 20 шт.)



Заслонки клапана (не более 10 шт.)

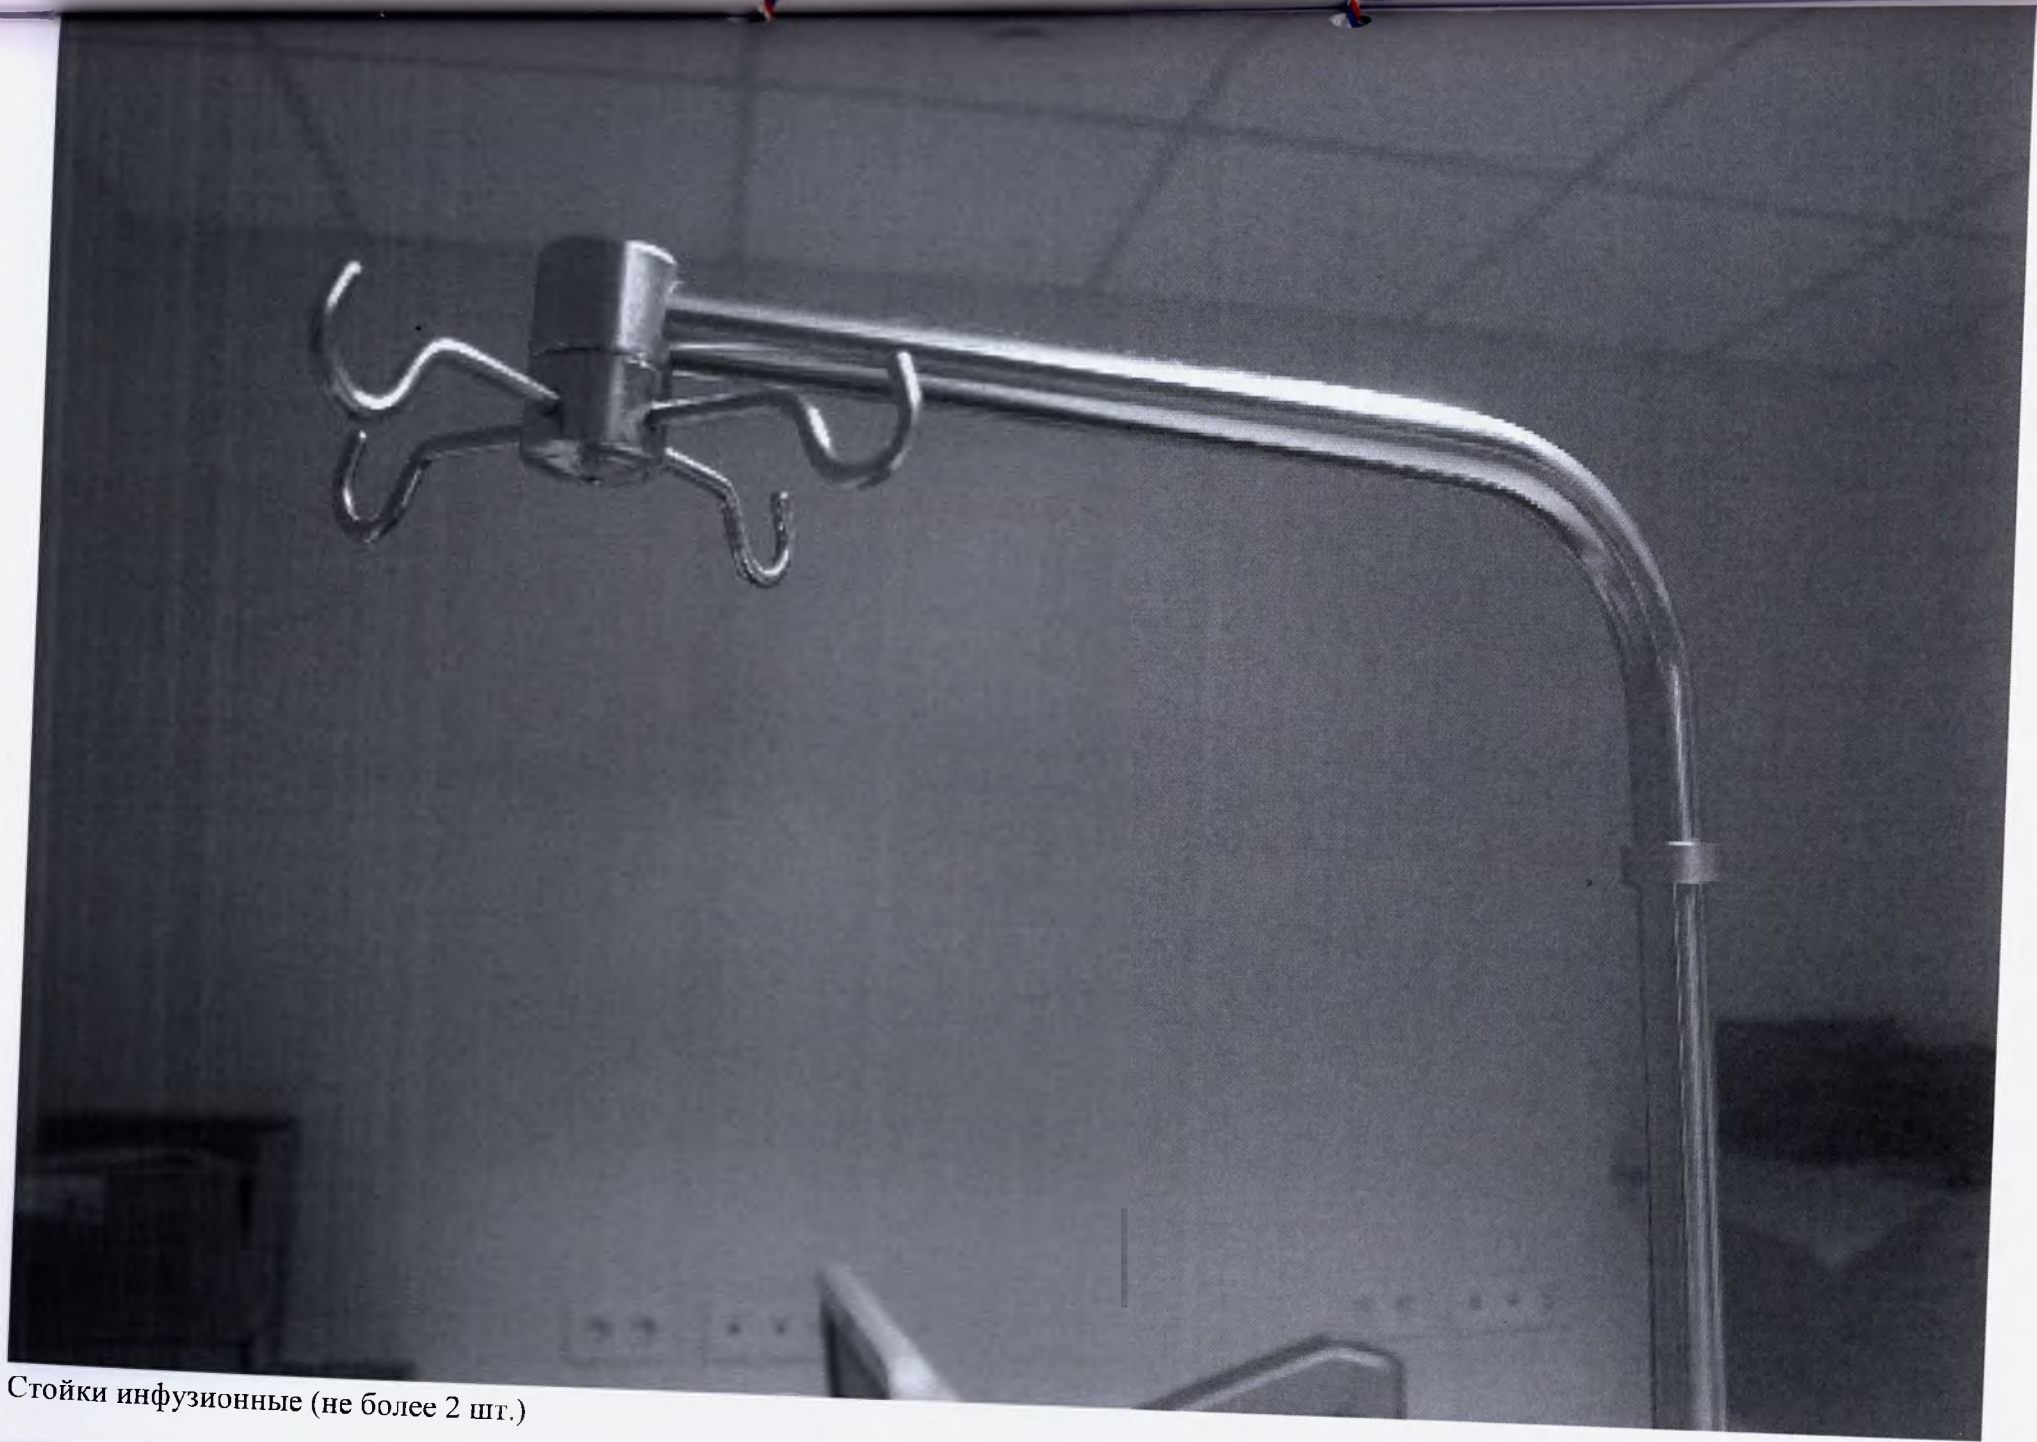


Стойки инфузионные (не более 2 шт.)



Испарители (не более 5 шт.)




Кабели (не более 5 шт.)

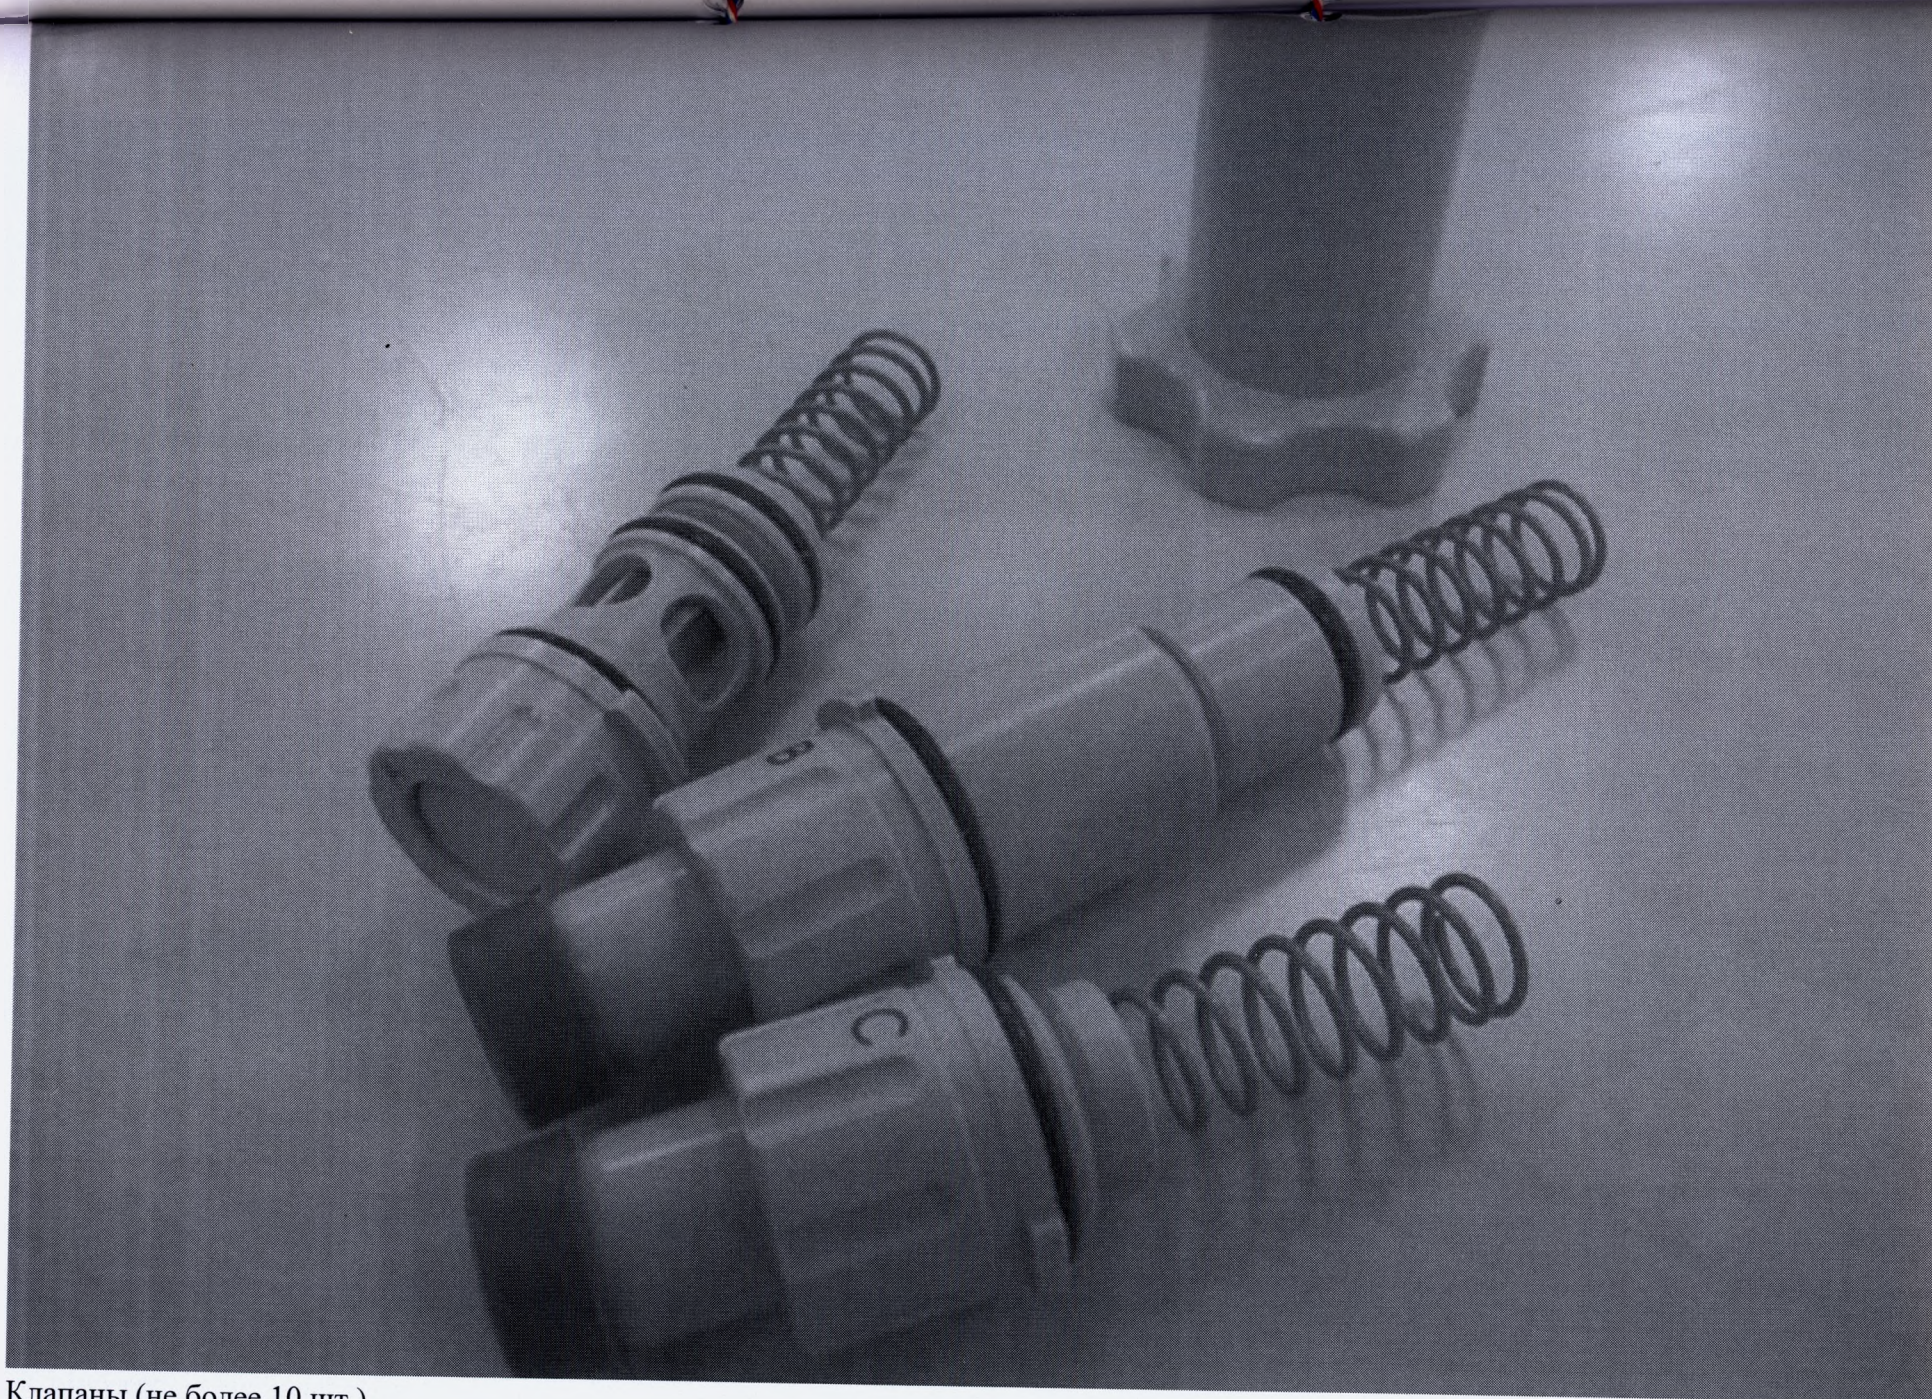


Клапаны (не более 10 шт.)




Компрессоры (не более 2 шт.)

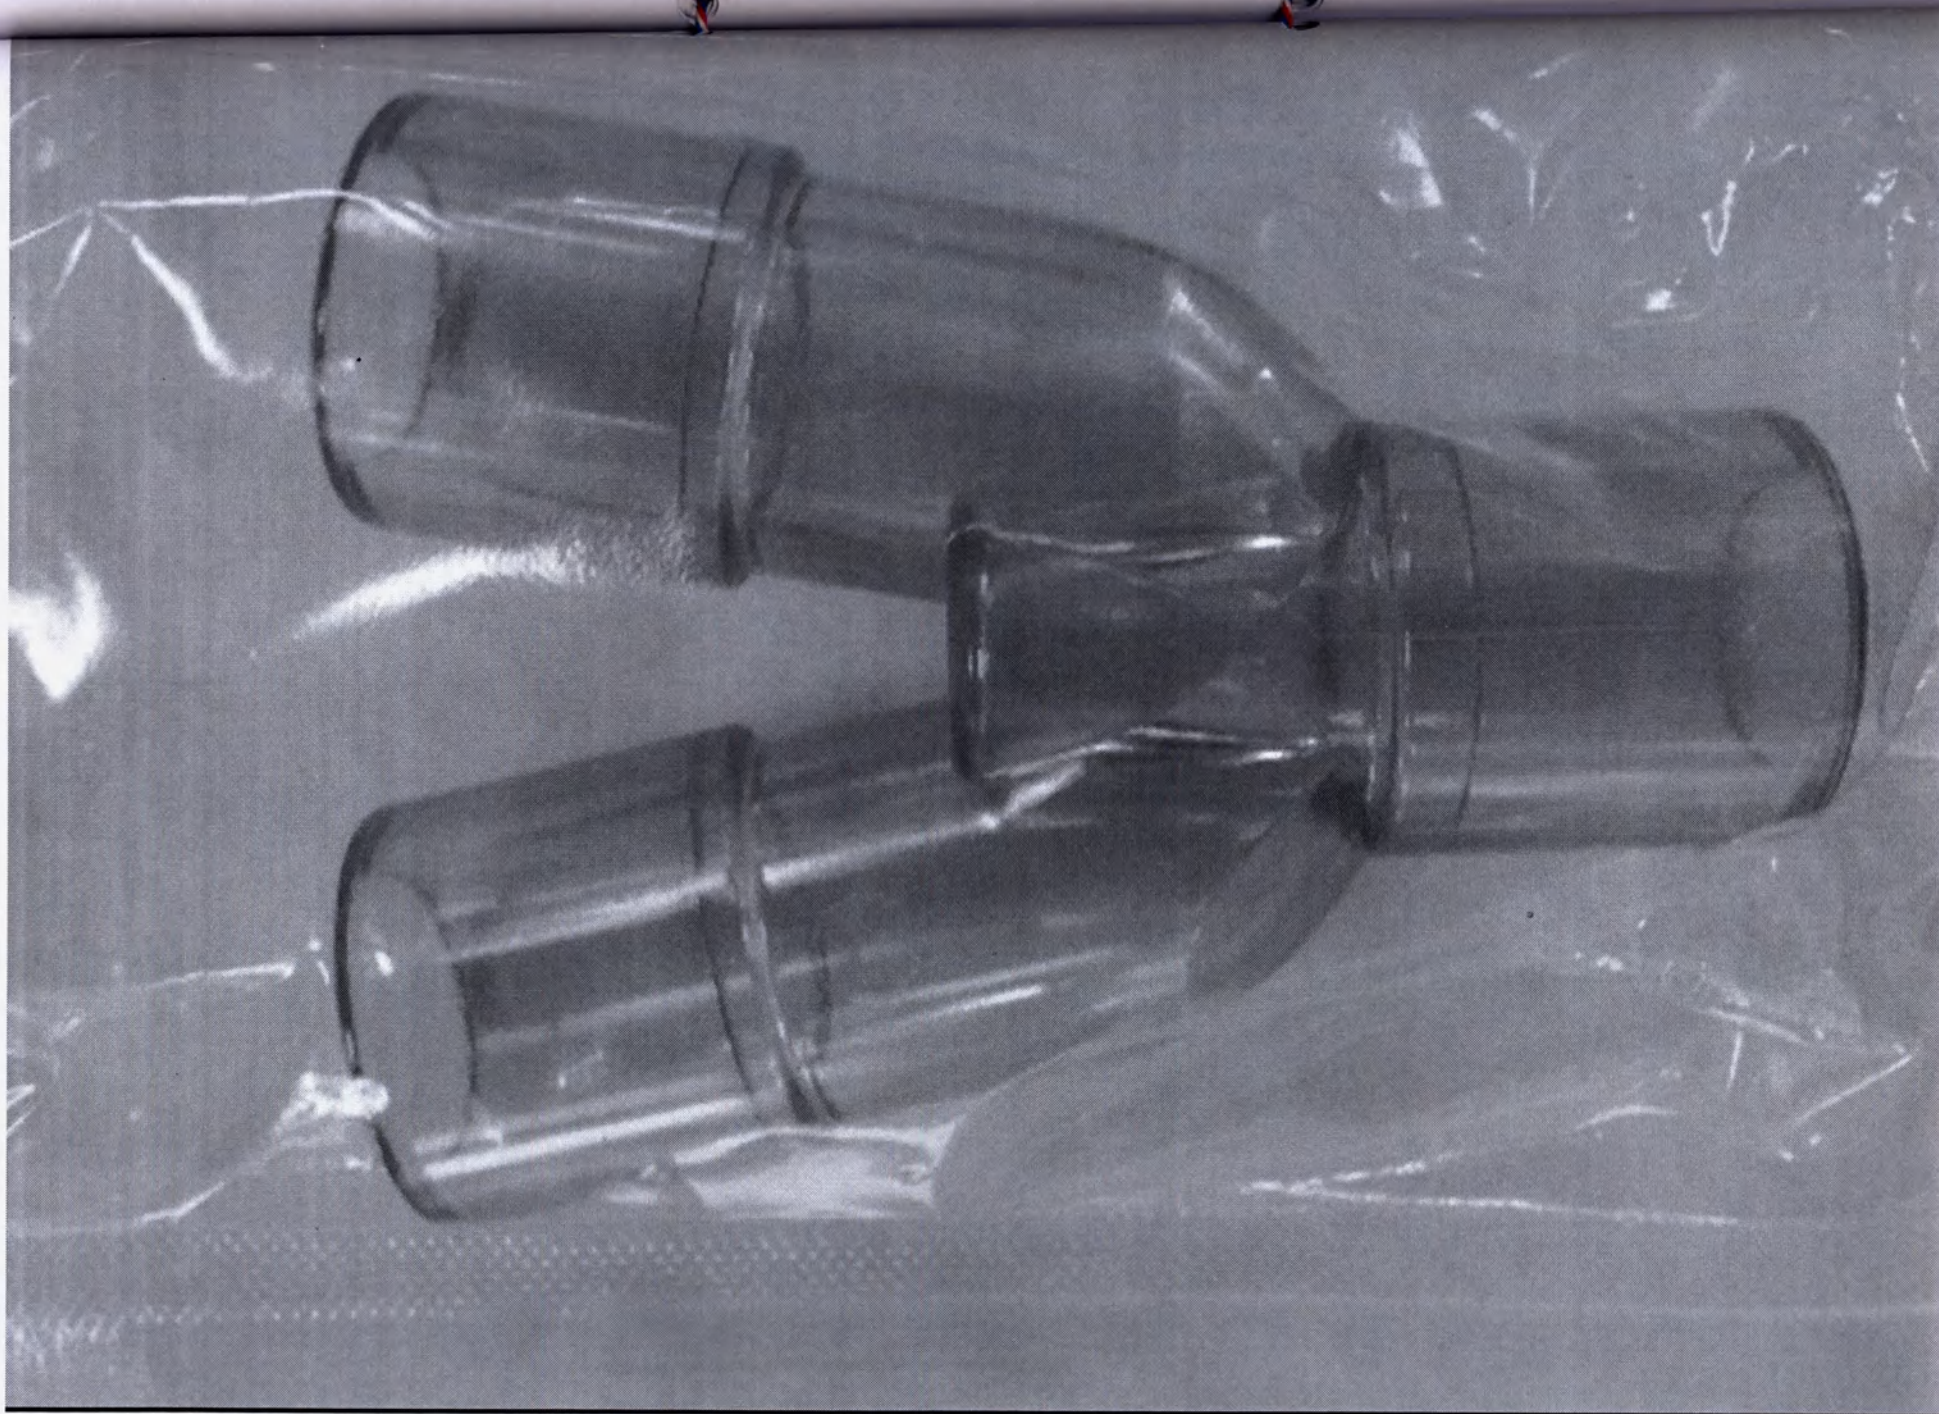

Коннекторы (не более 20 шт.)

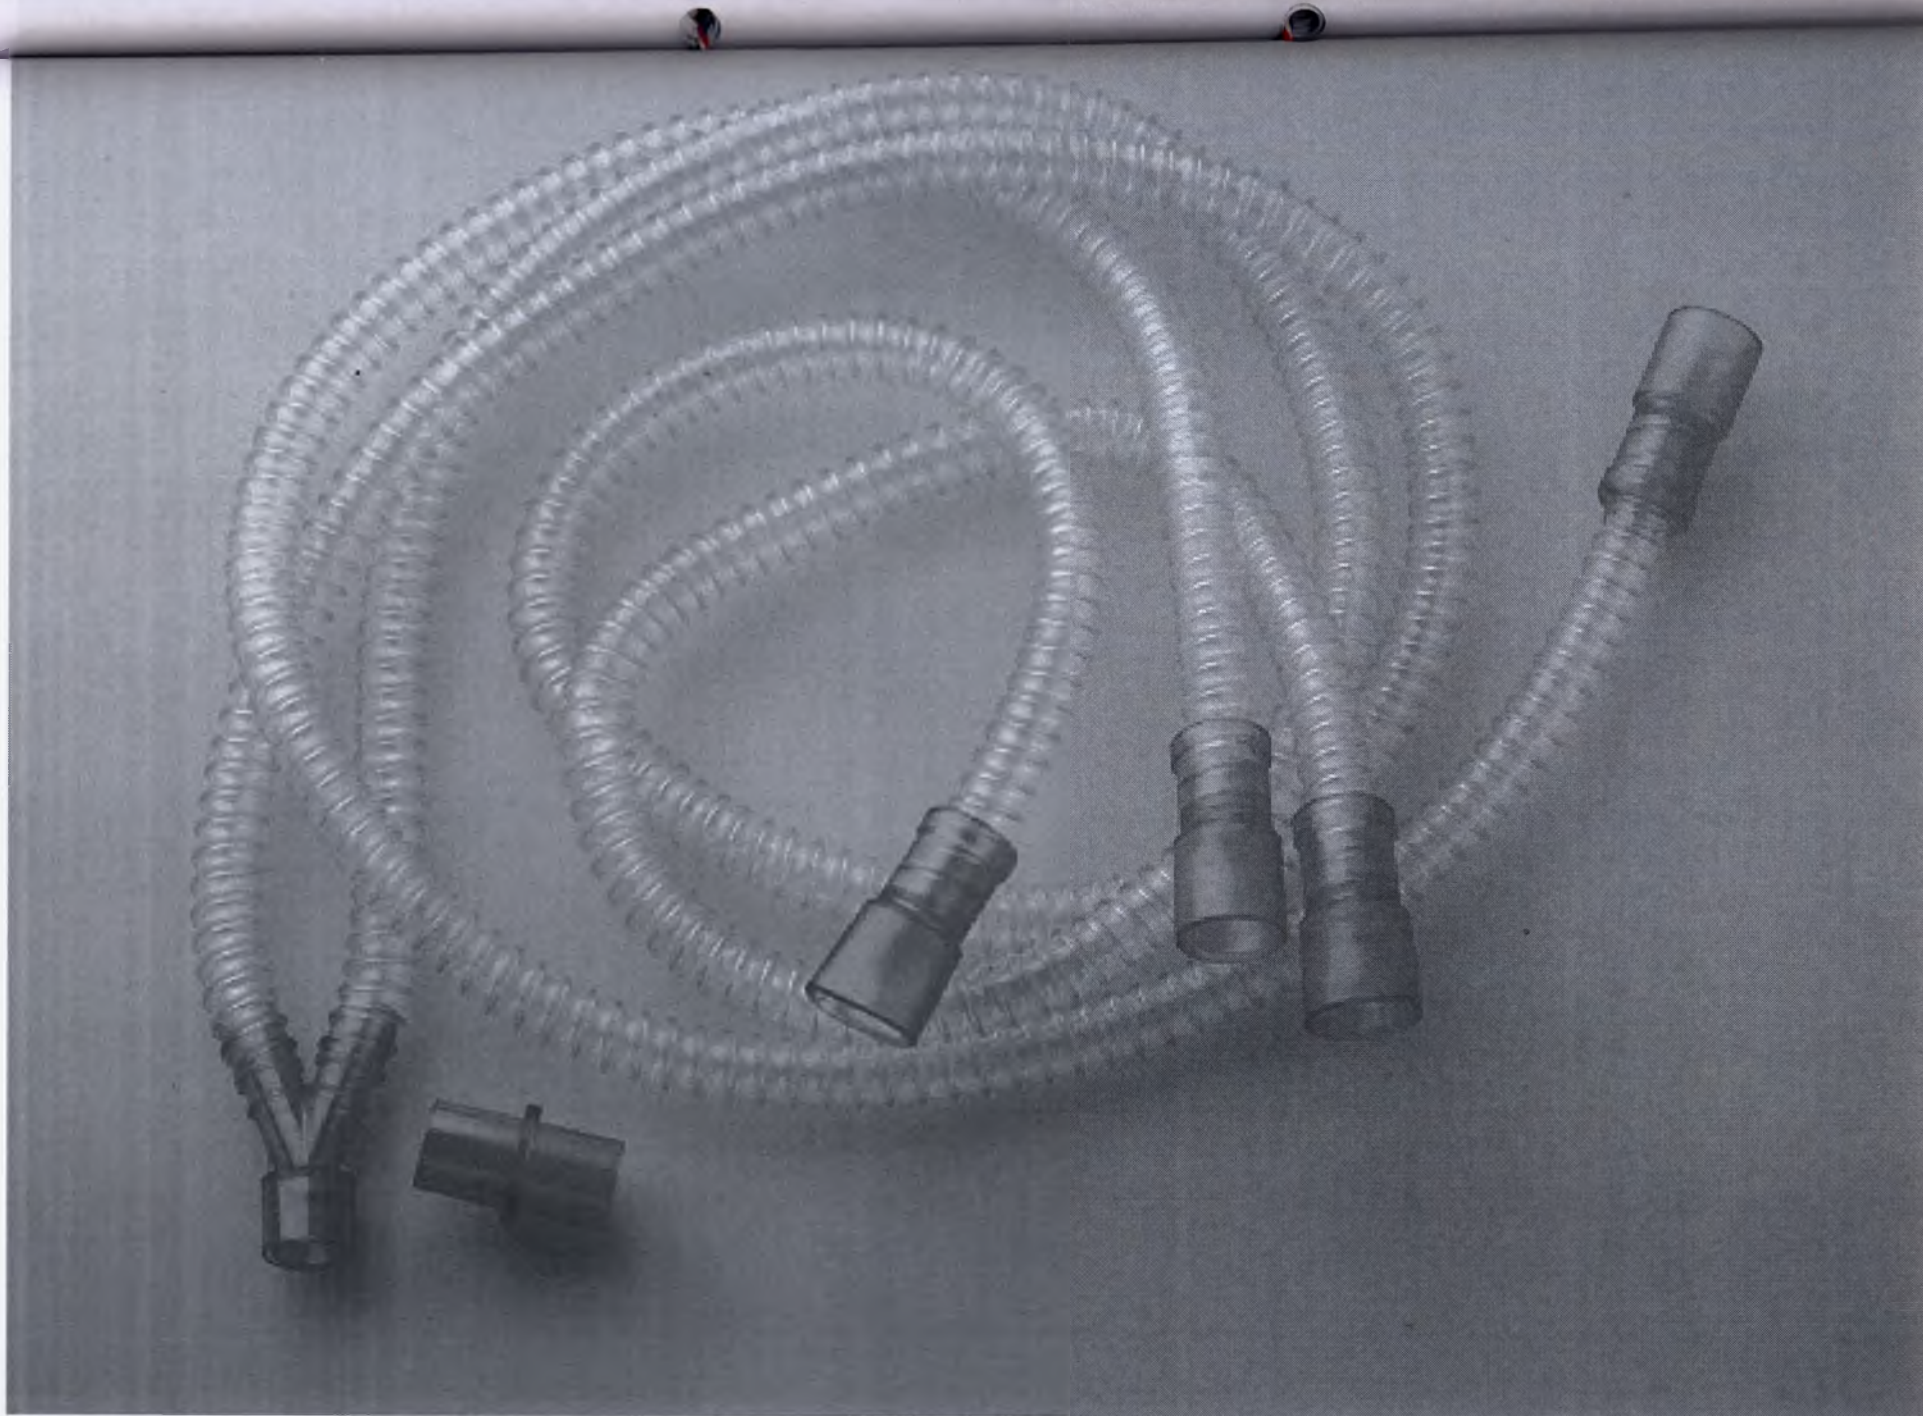


Контурь для анестезии (не более 5 шт.).

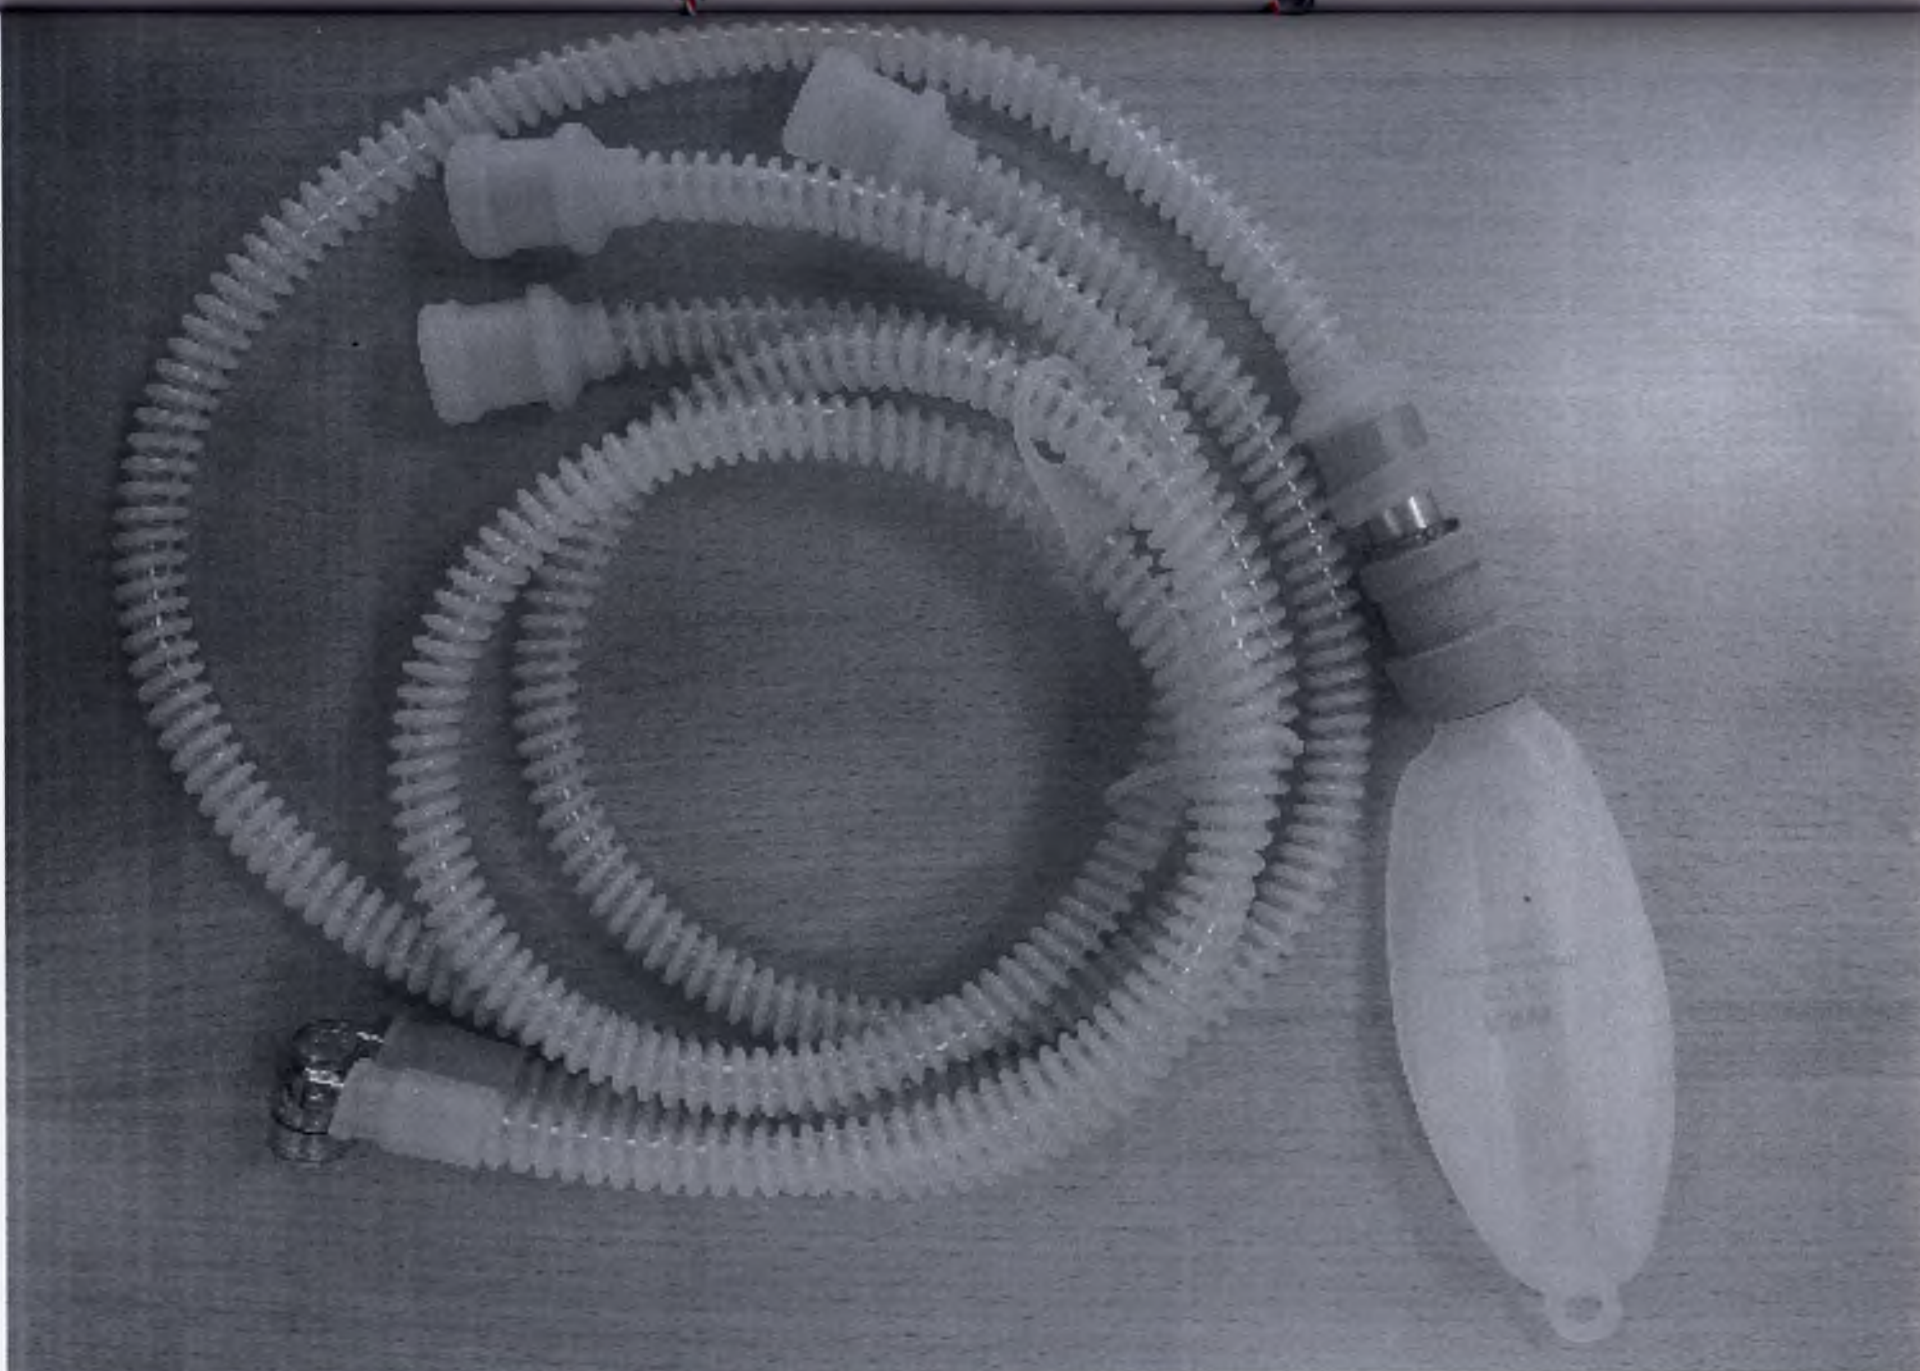


Контурь дыхательные (не более 15 шт.)



Концентраторы (не более 2 шт.)

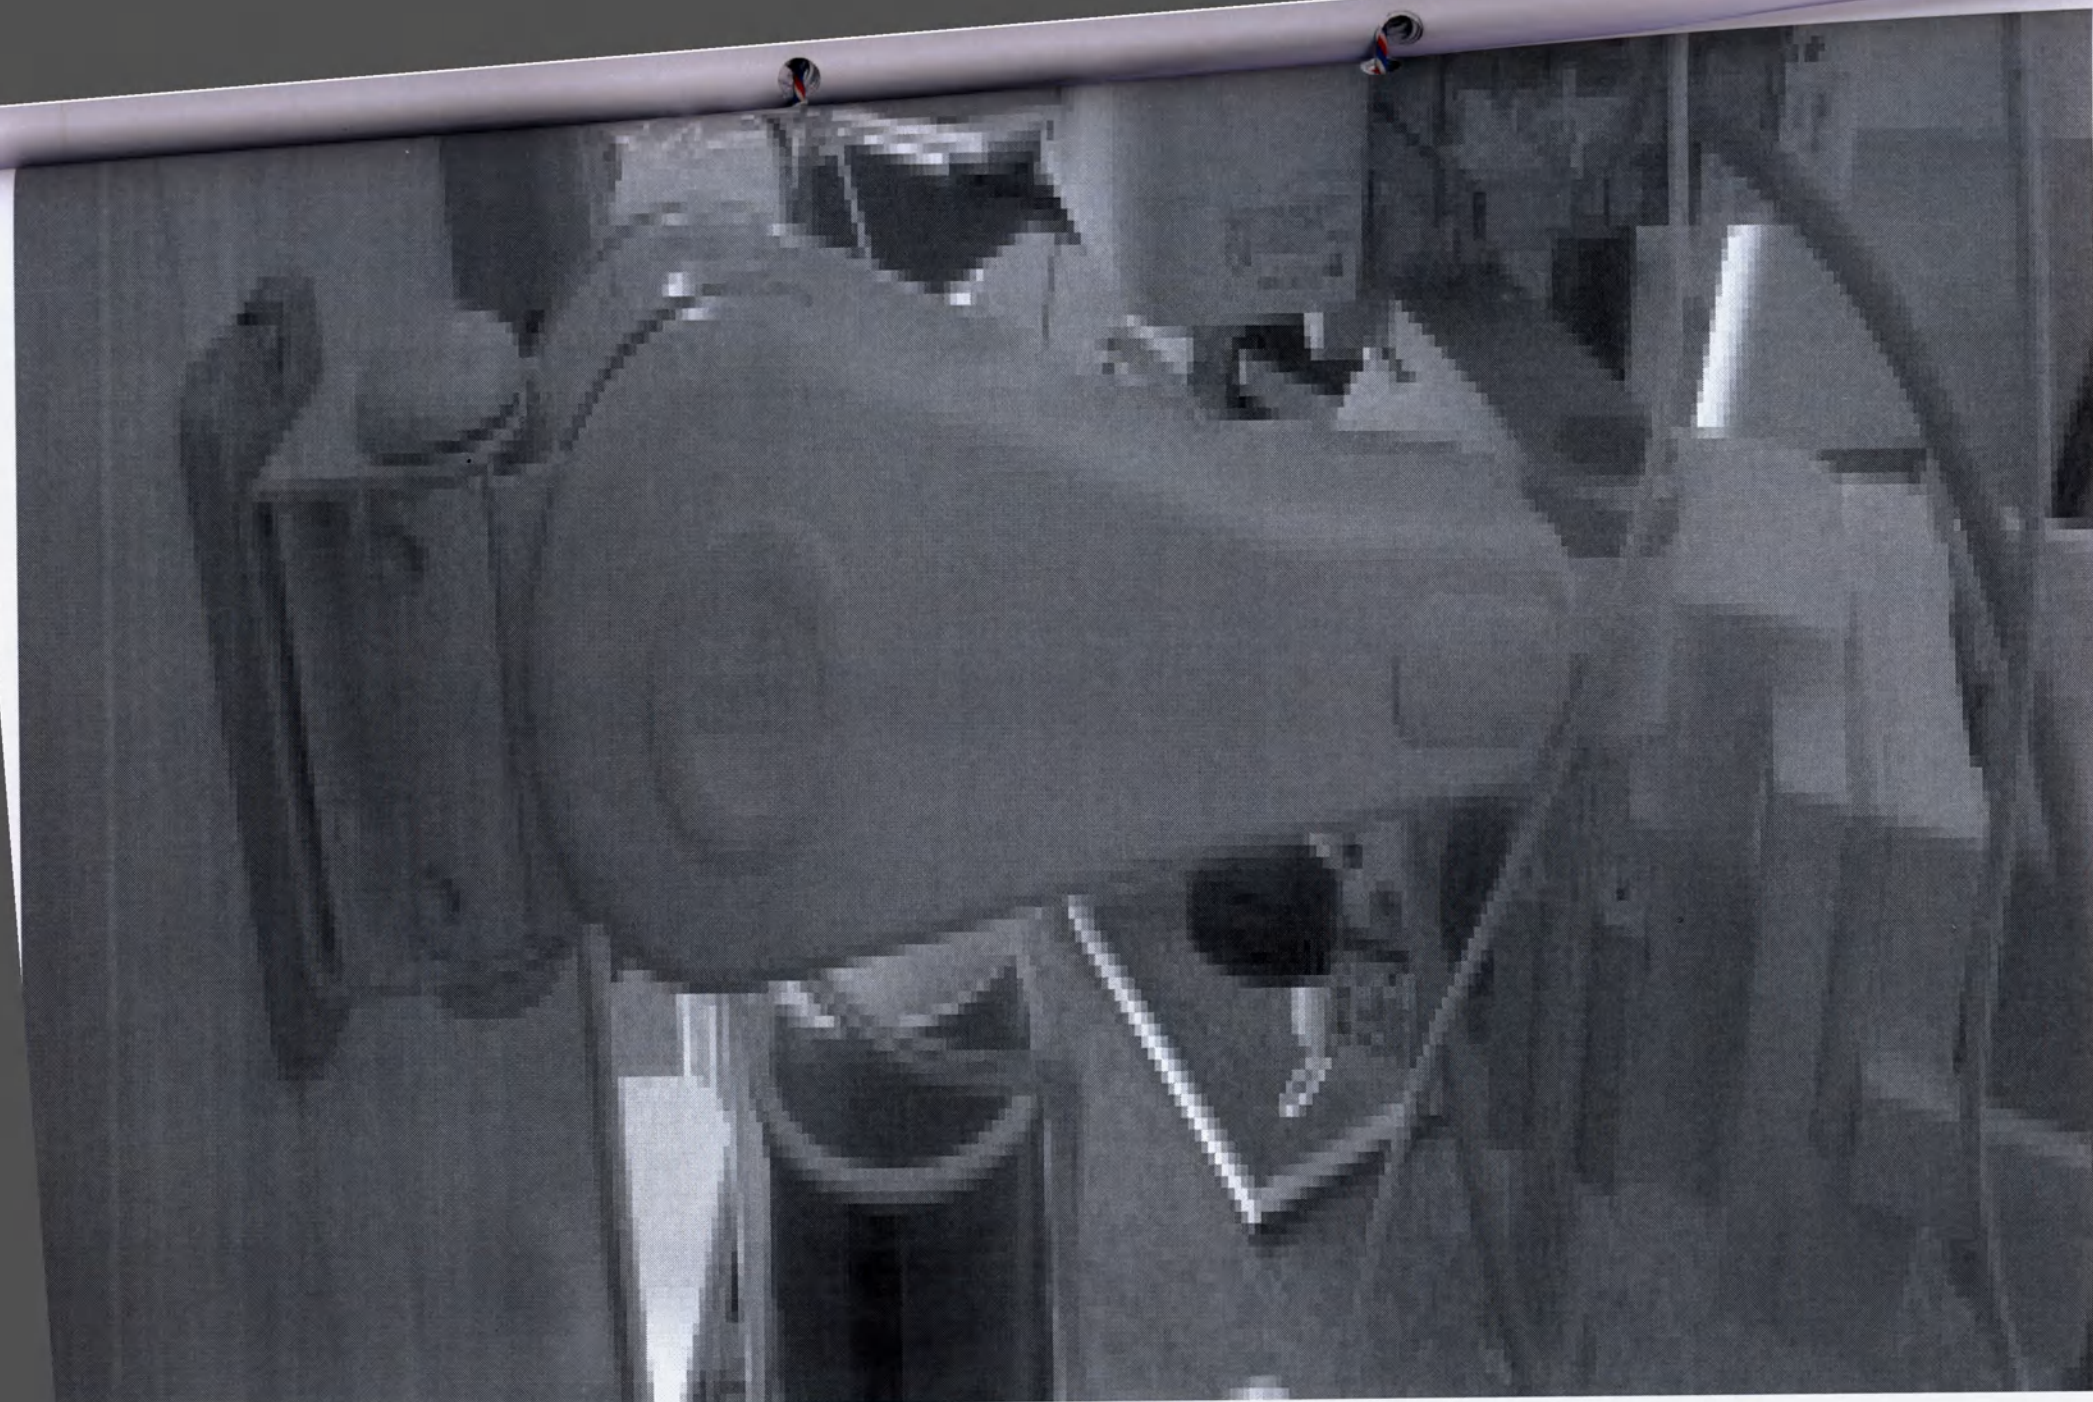


Кронштейны (не более 5 шт.)

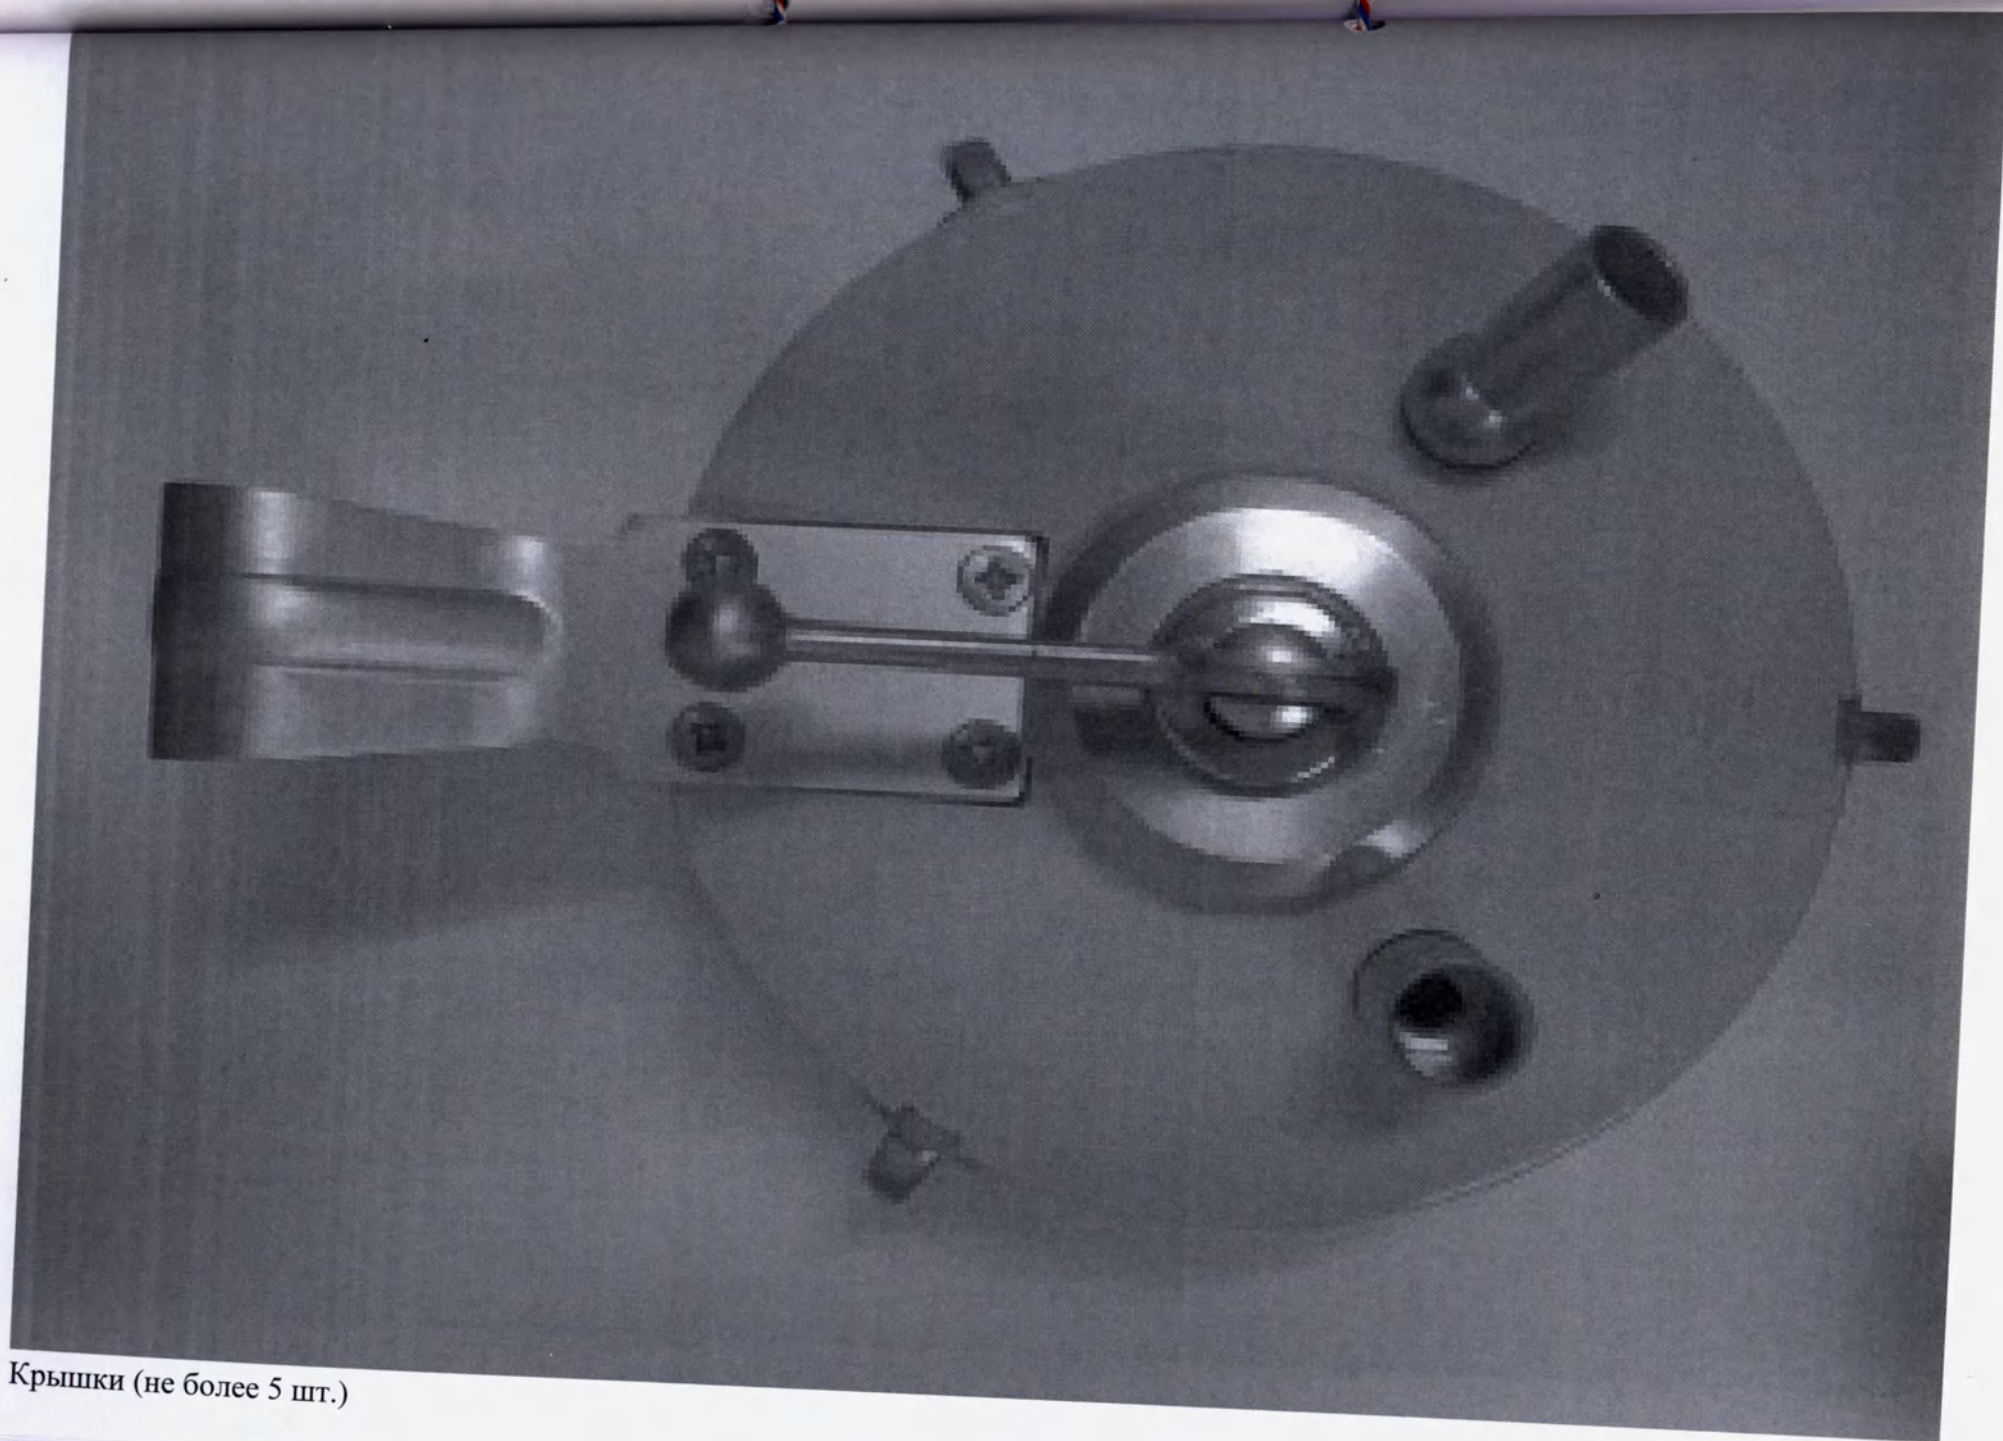

Крышки (не более 5 шт.)



Манометры (не более 5 шт.)

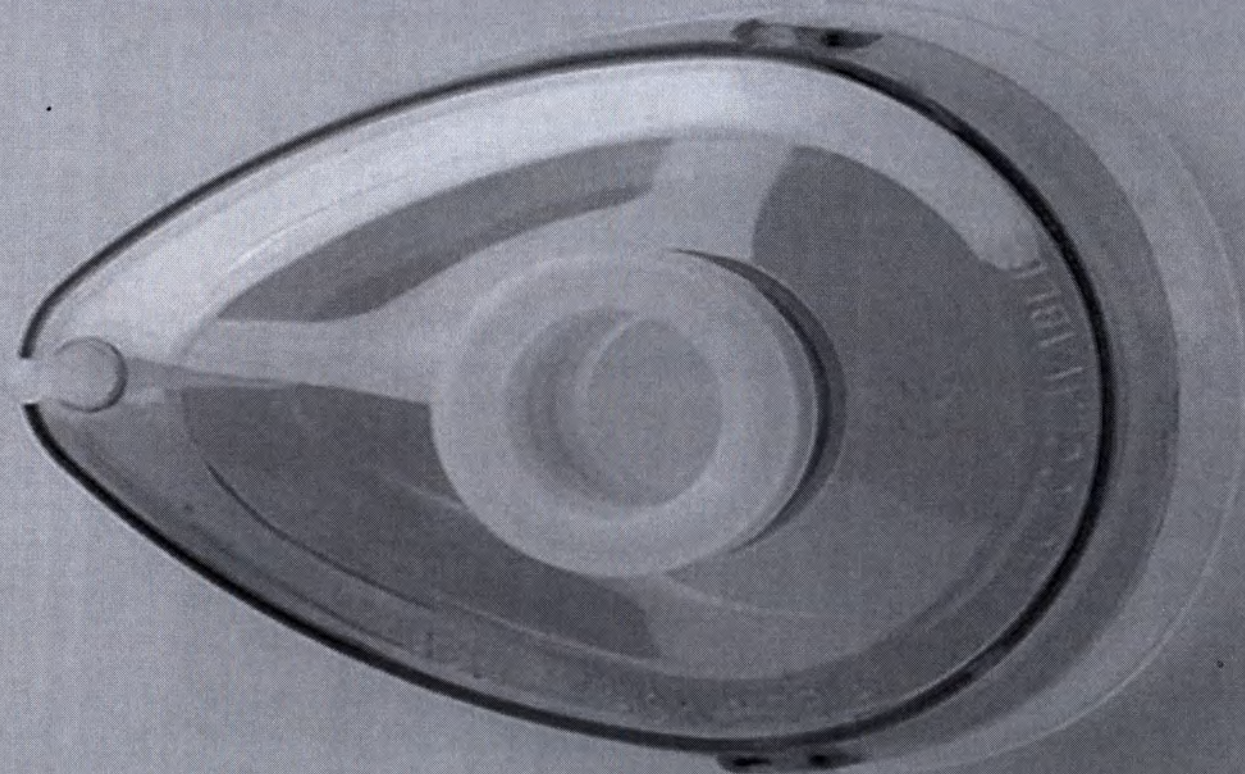

Маски (не более 10 шт.)






Мониторы (не более 3 шт.)



Муфты (не более 10 шт.)




Накладки (не более 10 шт.)

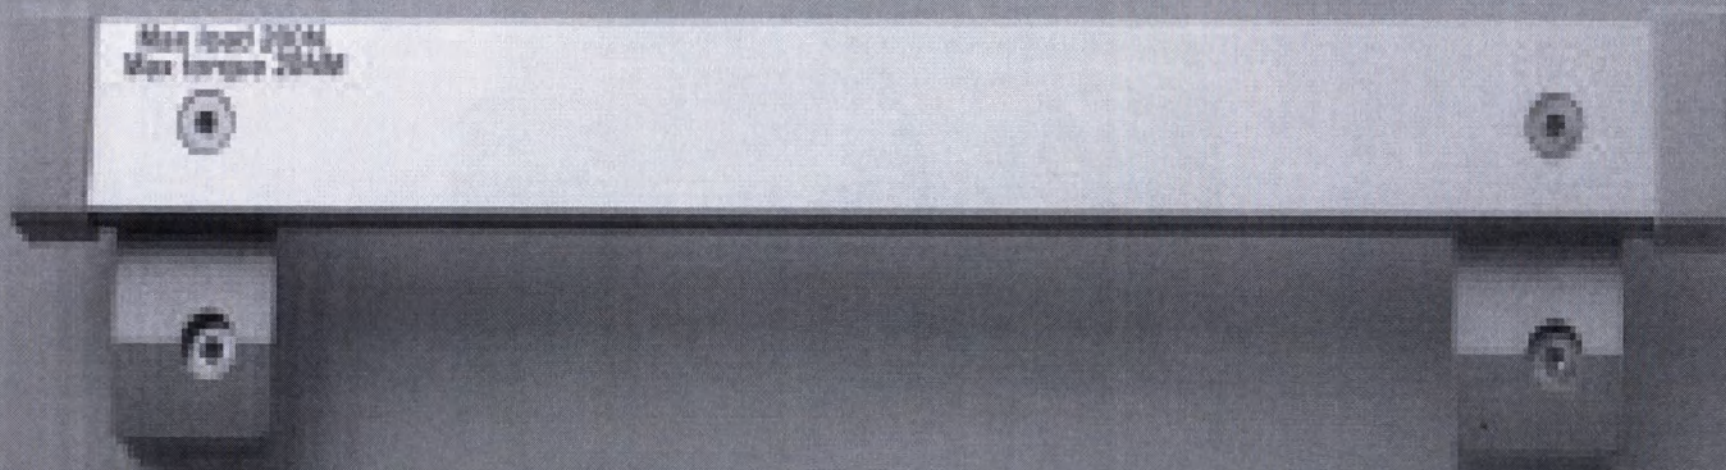


Max load 200kg
Max torque 20Nm

Крепления настенные (не более 10 шт.)

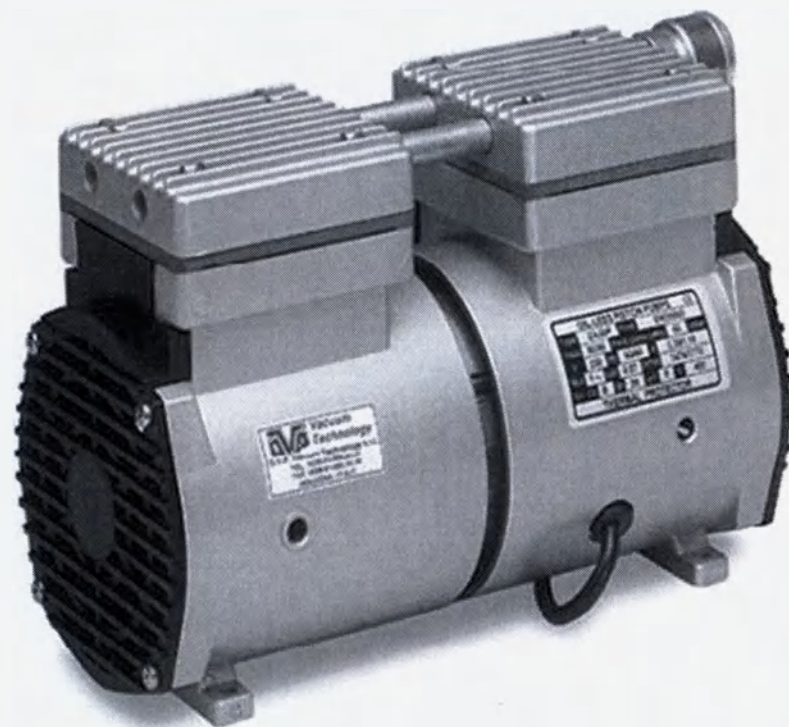


Насосы (не более 2 шт.)




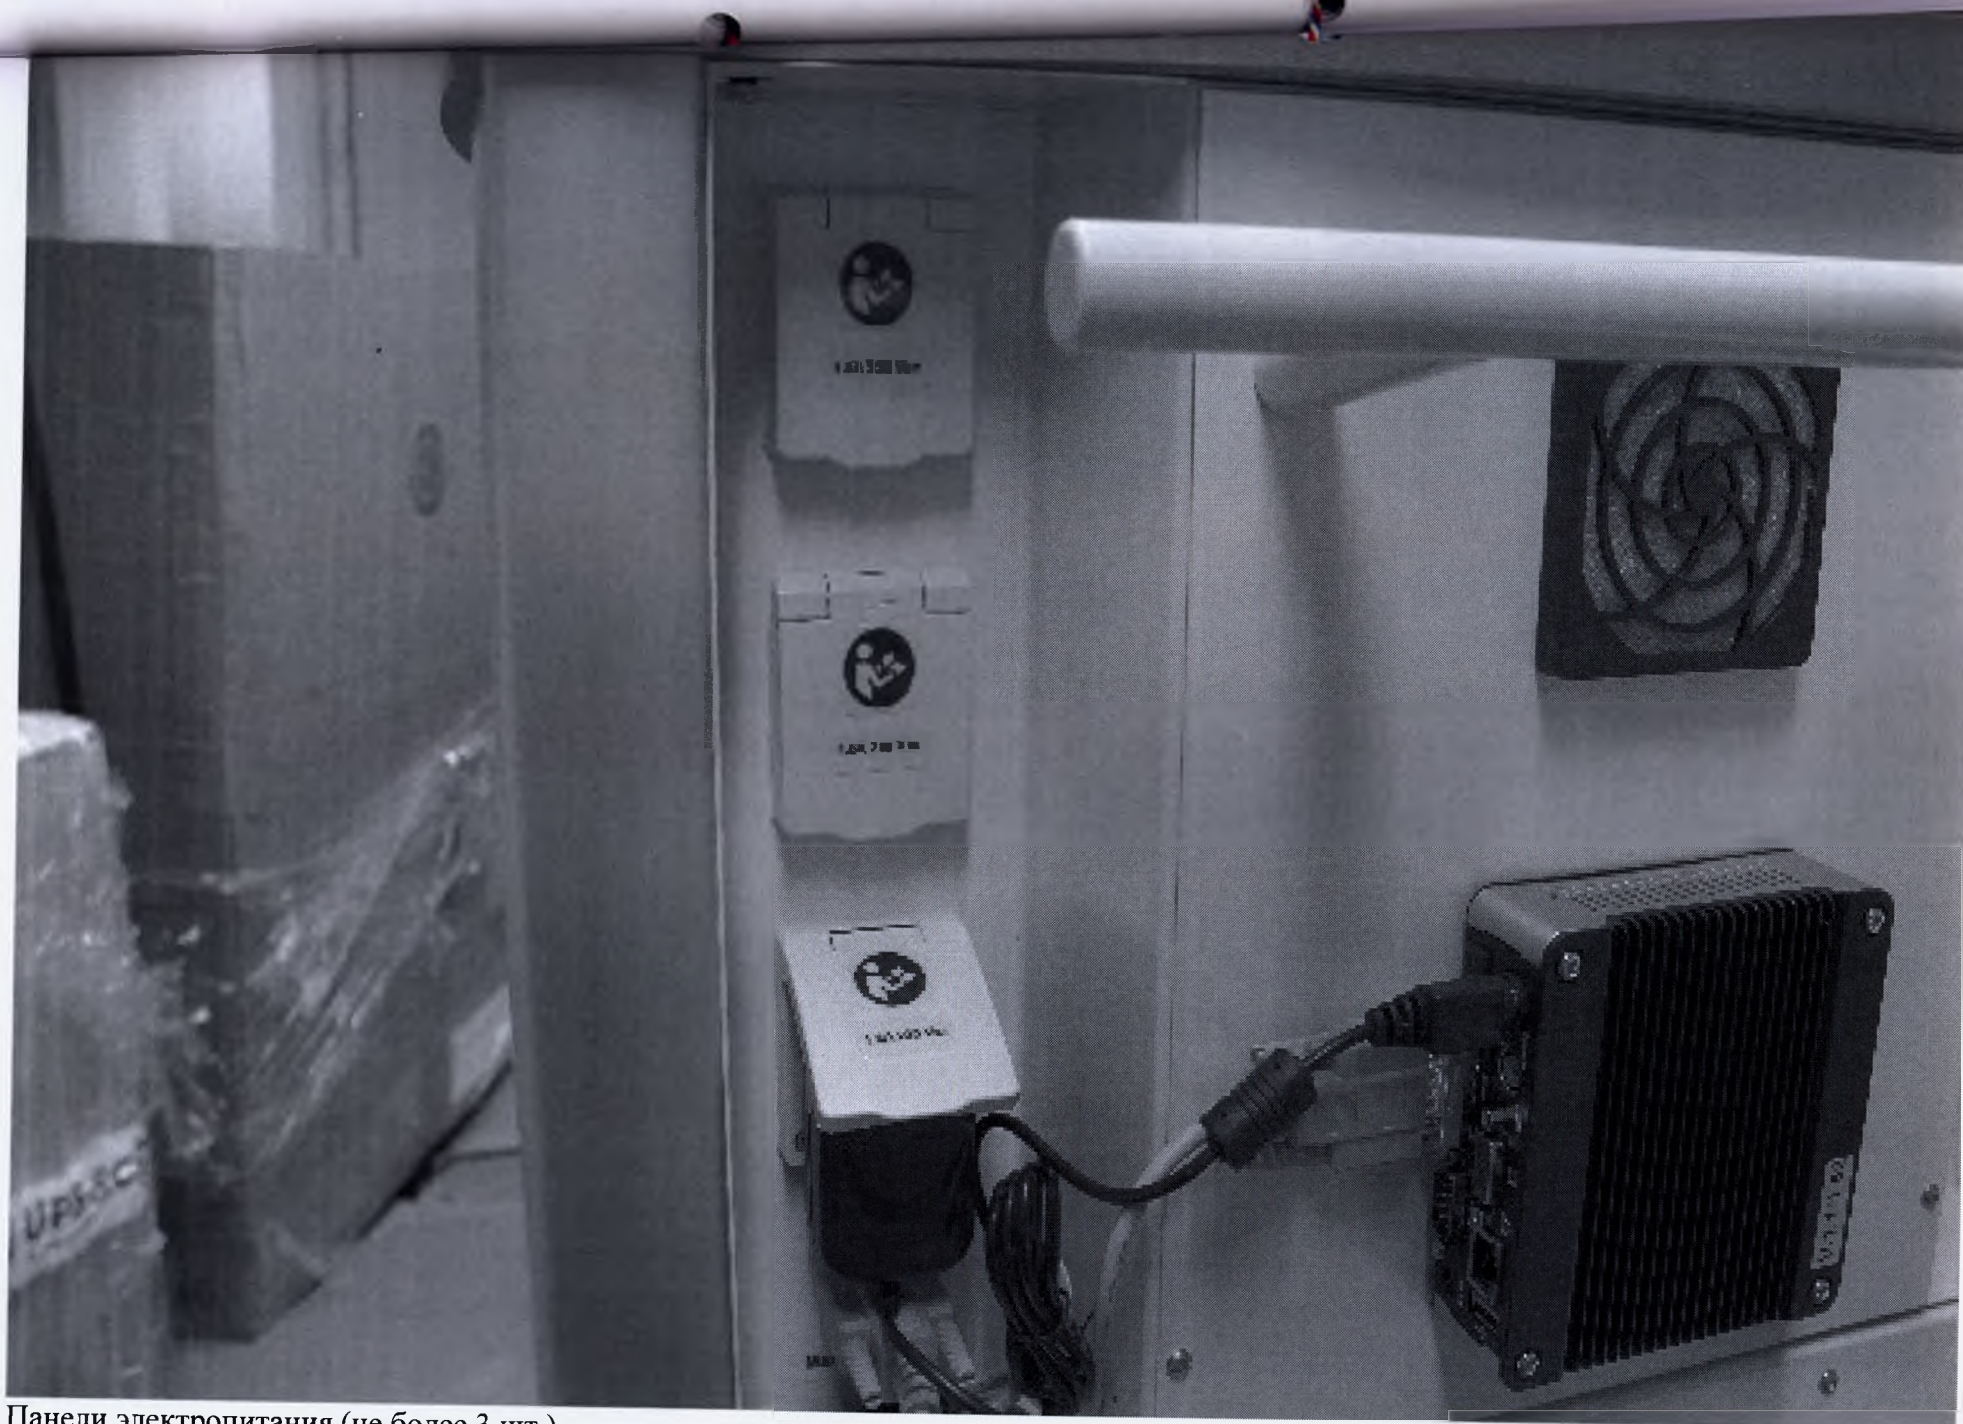

Панели электропитания (не более 3 шт.)

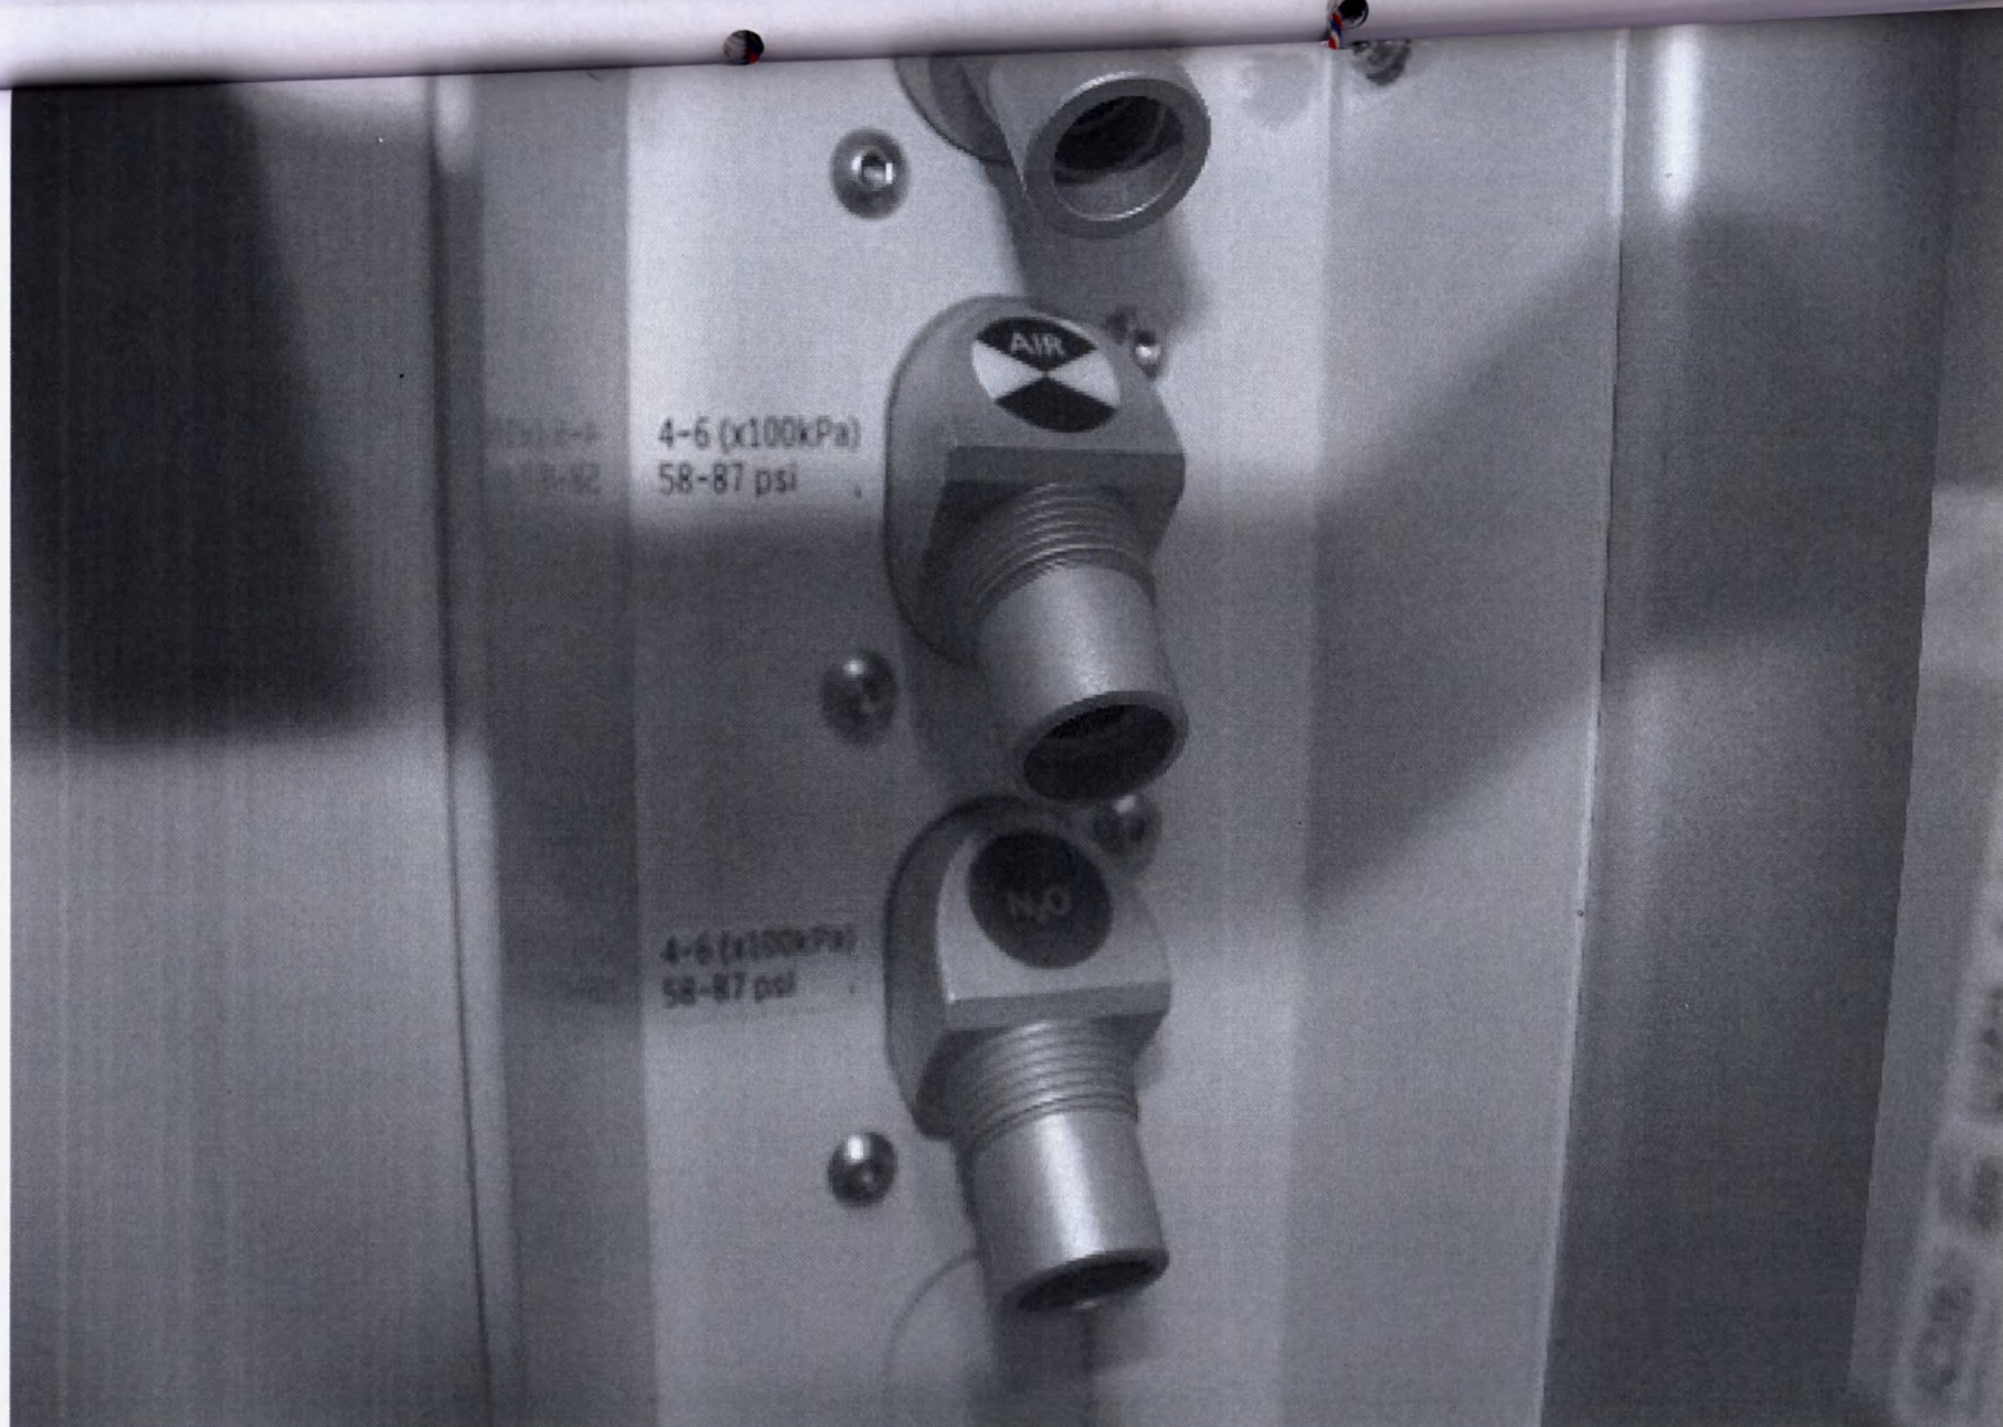

Патрубки (не более 10 шт.)

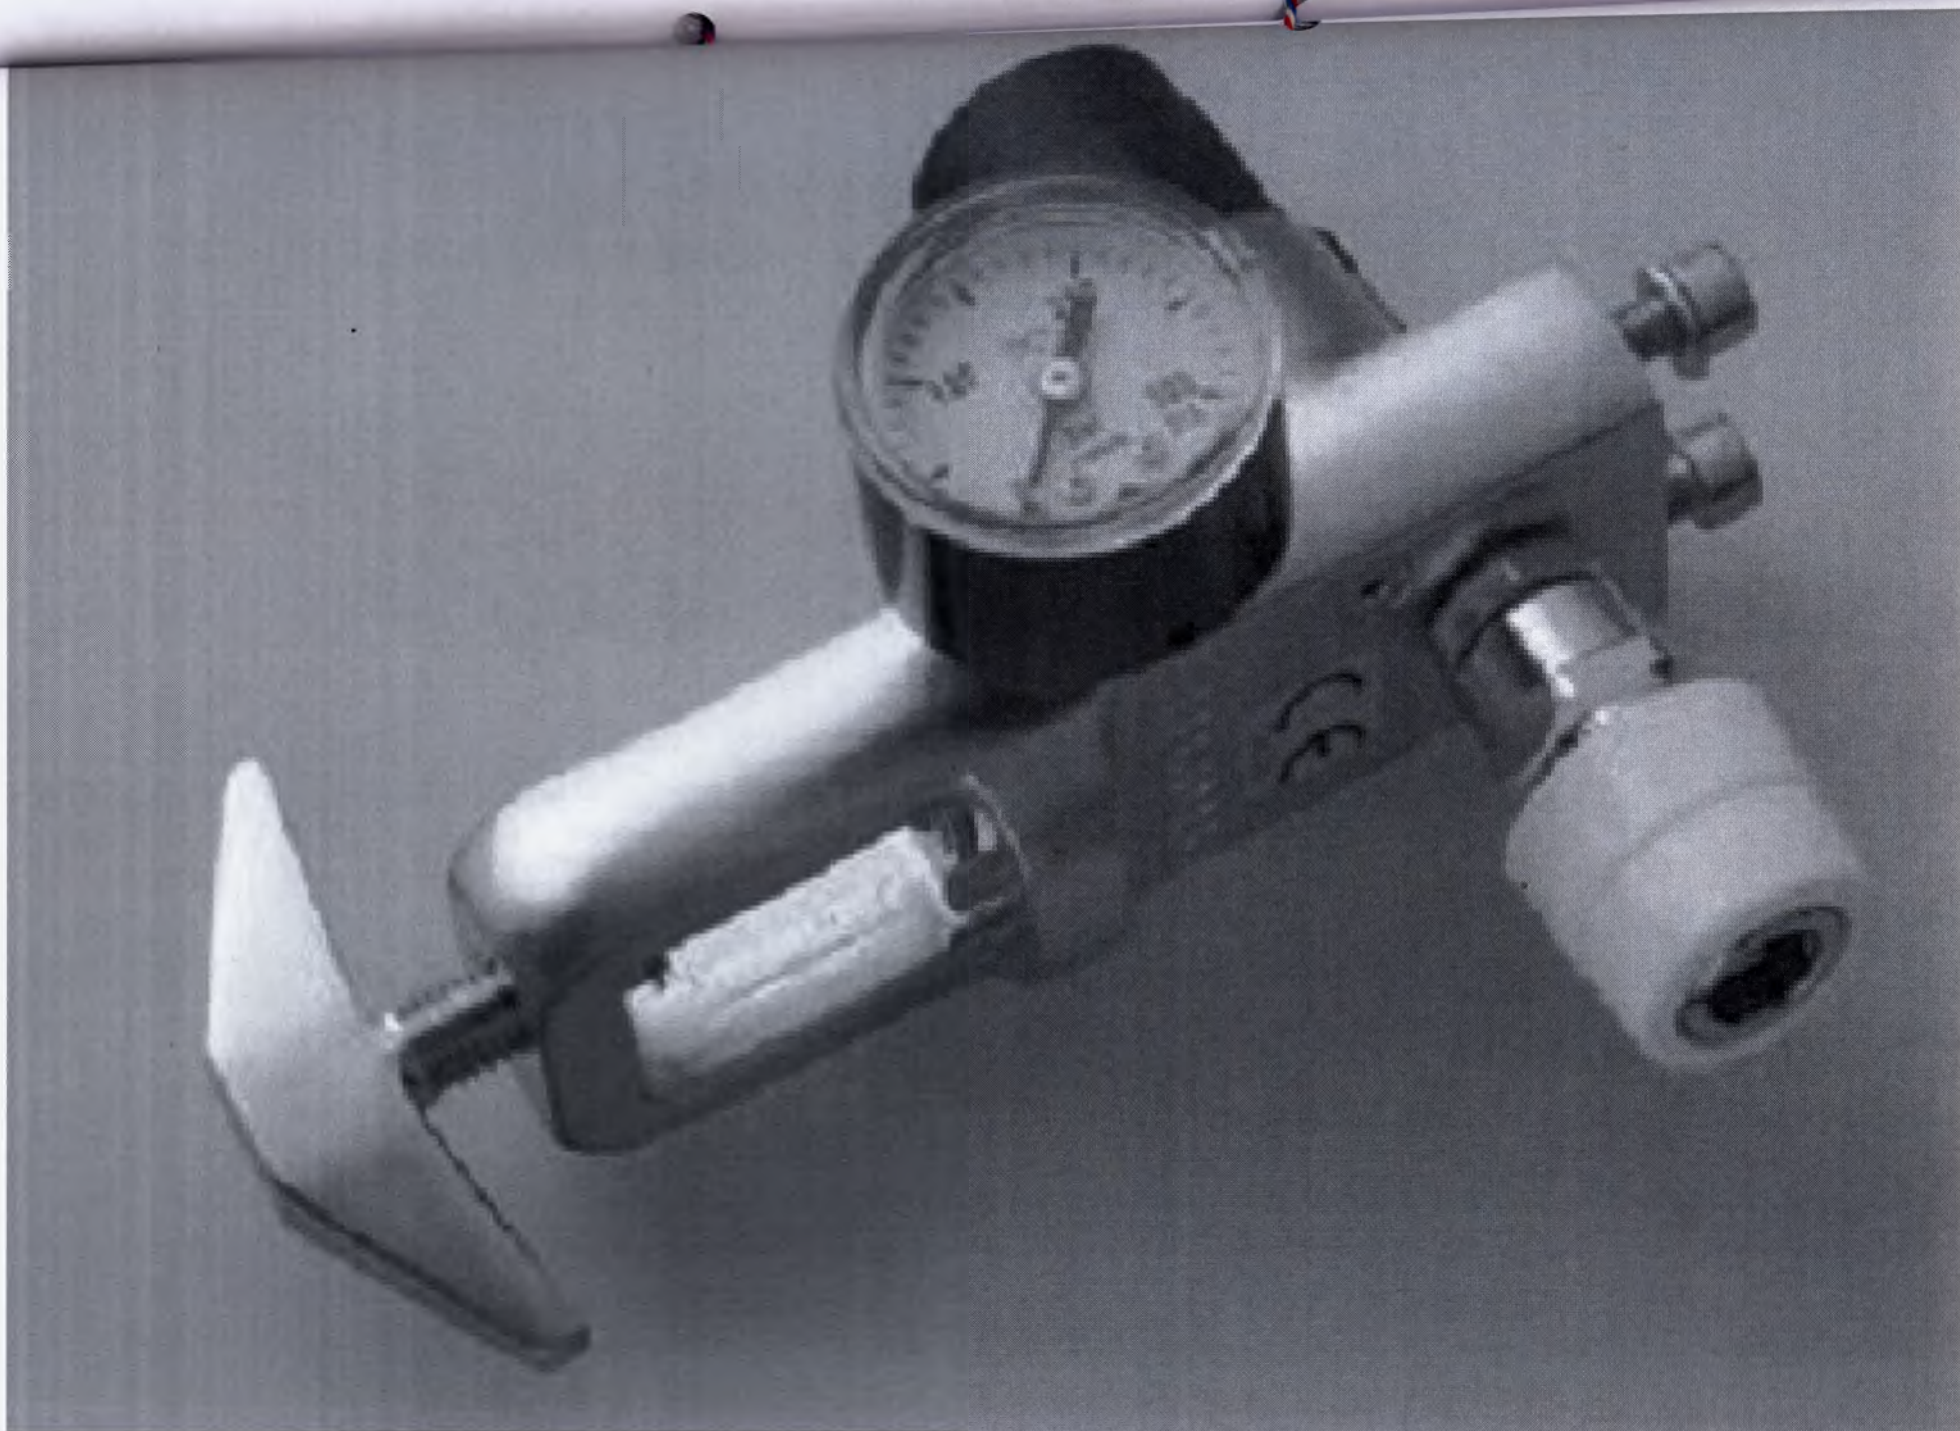




Переходники (не более 15 шт.)




Подставки (не более 2 шт.)

Предохранители

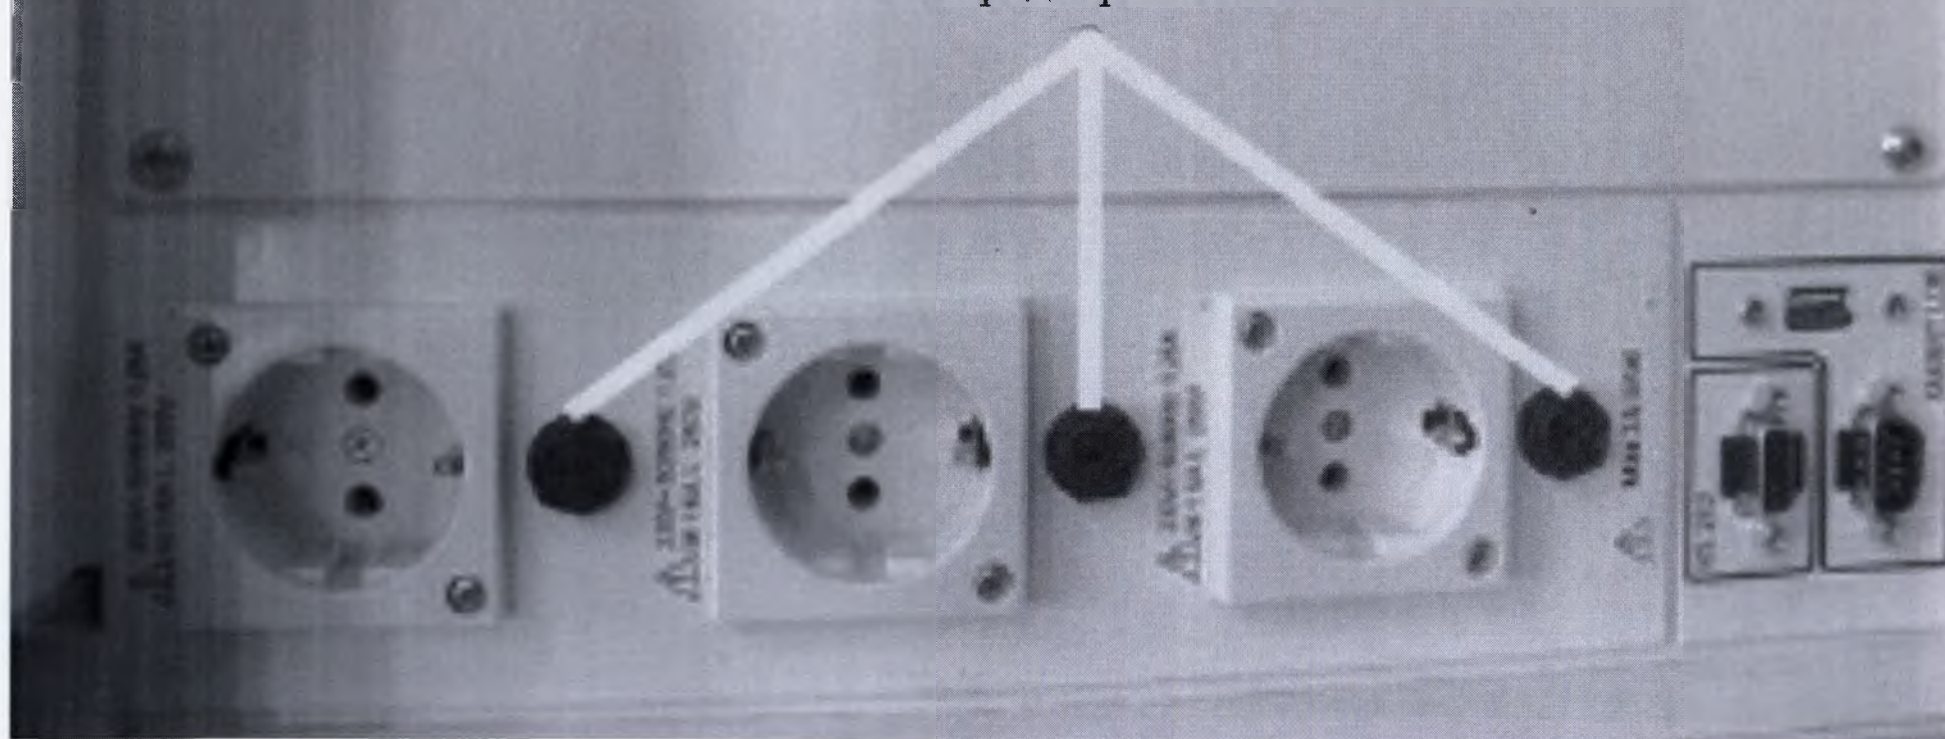

Предохранители (не более 20 шт.)


Siesta *i* Whispa

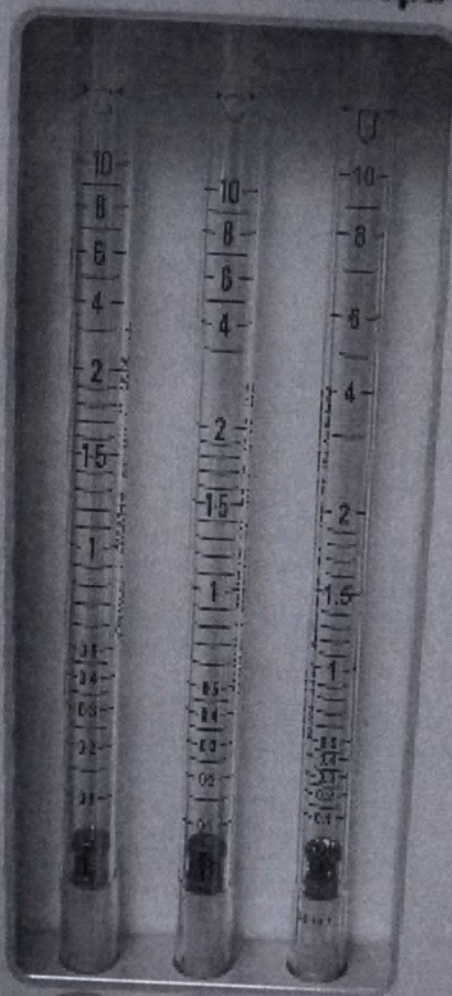


Расходомеры (не более 5 шт.)




Регуляторы (не более 10 шт.)

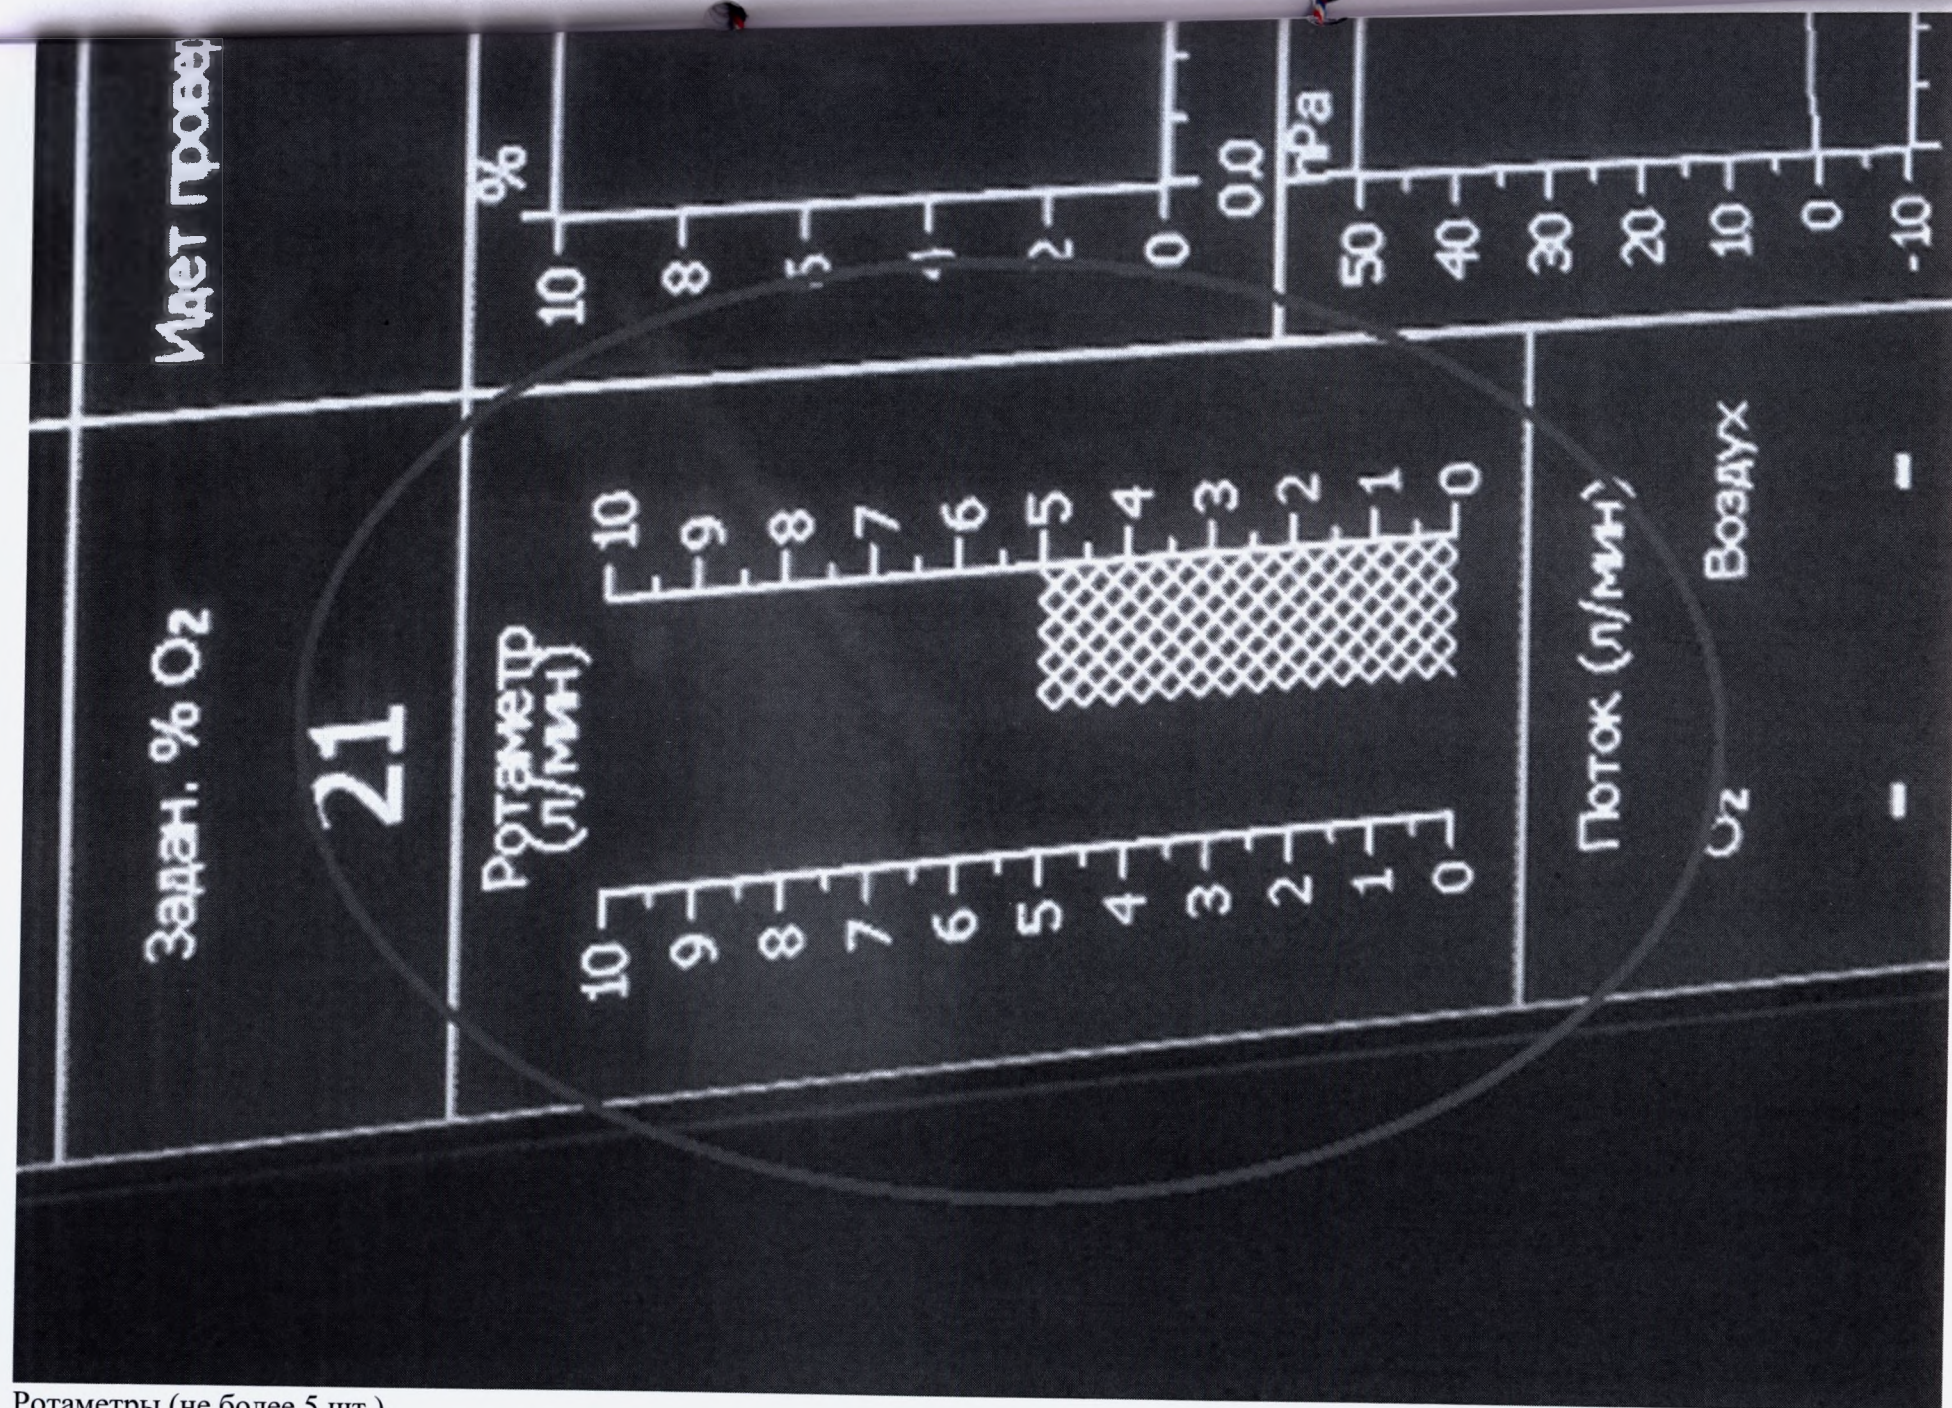


Ротаметры (не более 5 шт.)

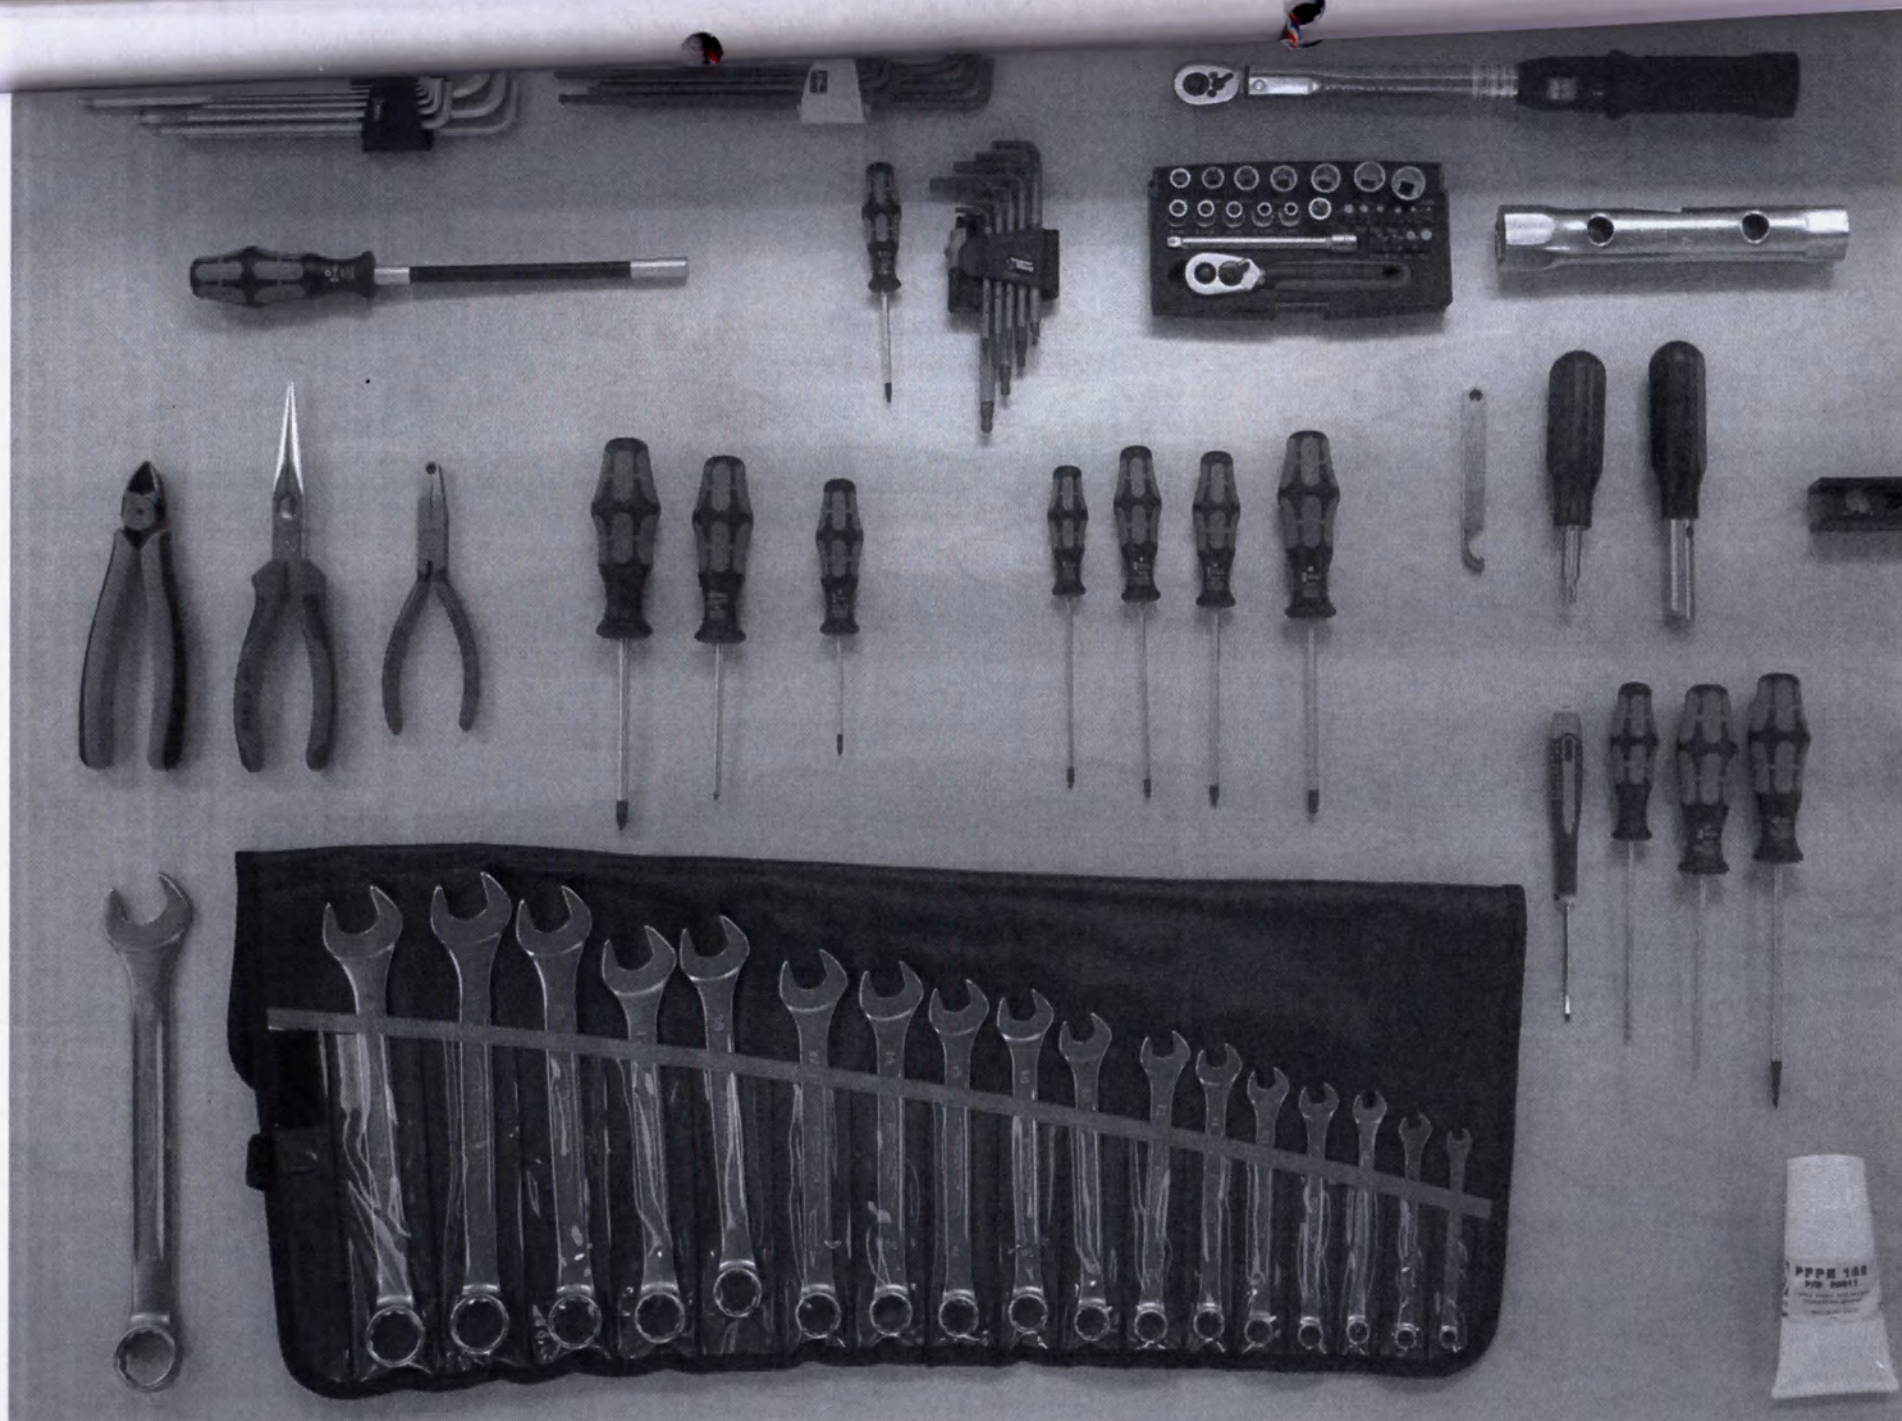


Инструменты сервисные (не более 5 шт.)

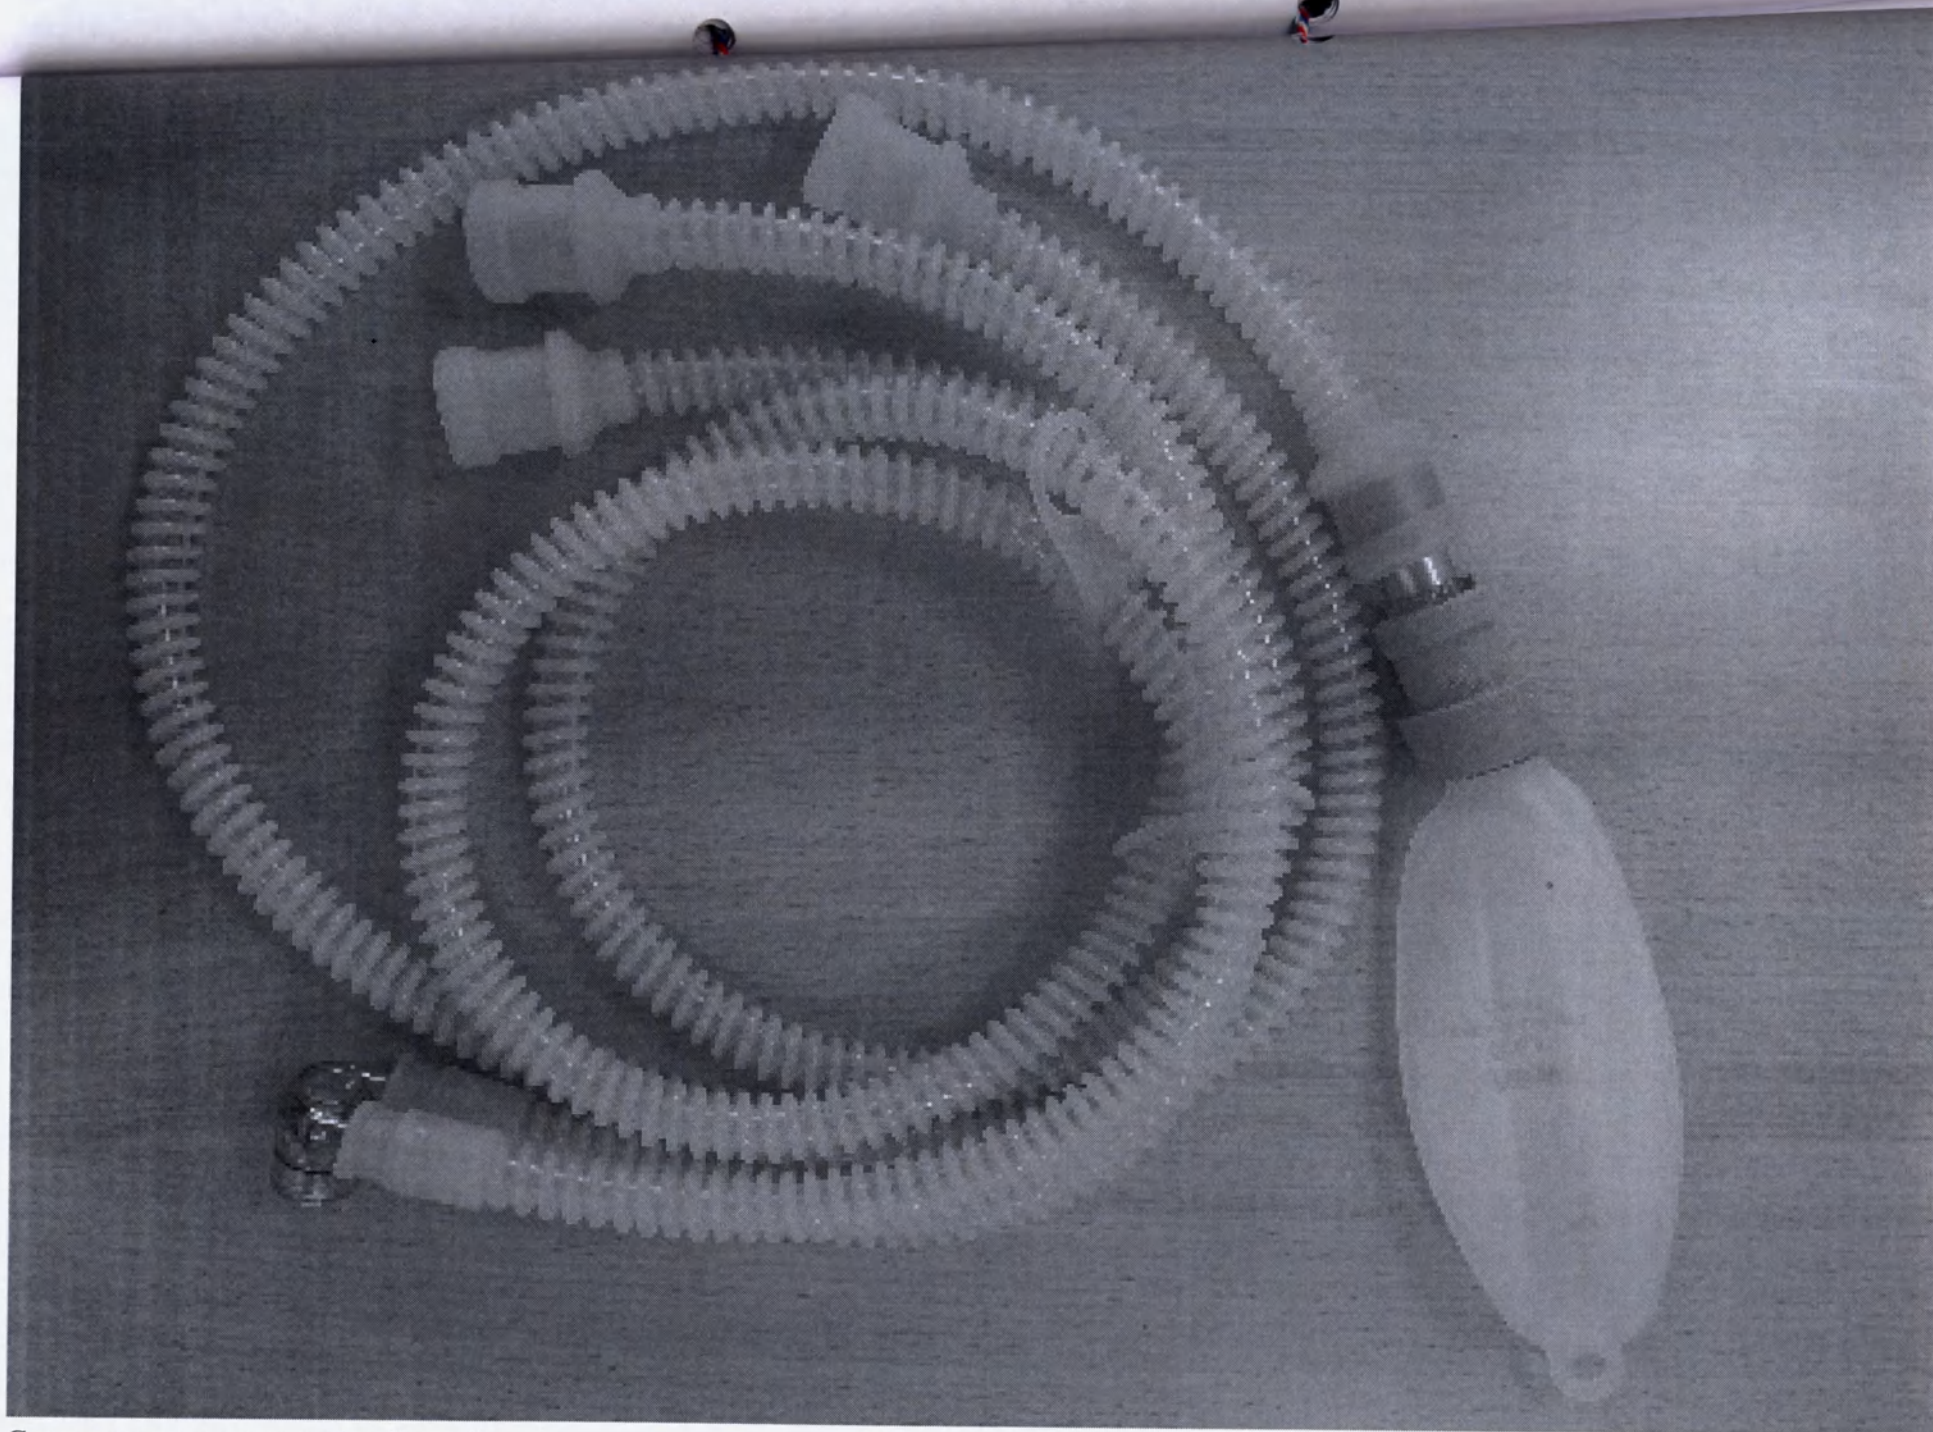

Системы для анестезии (не более 2 шт.)

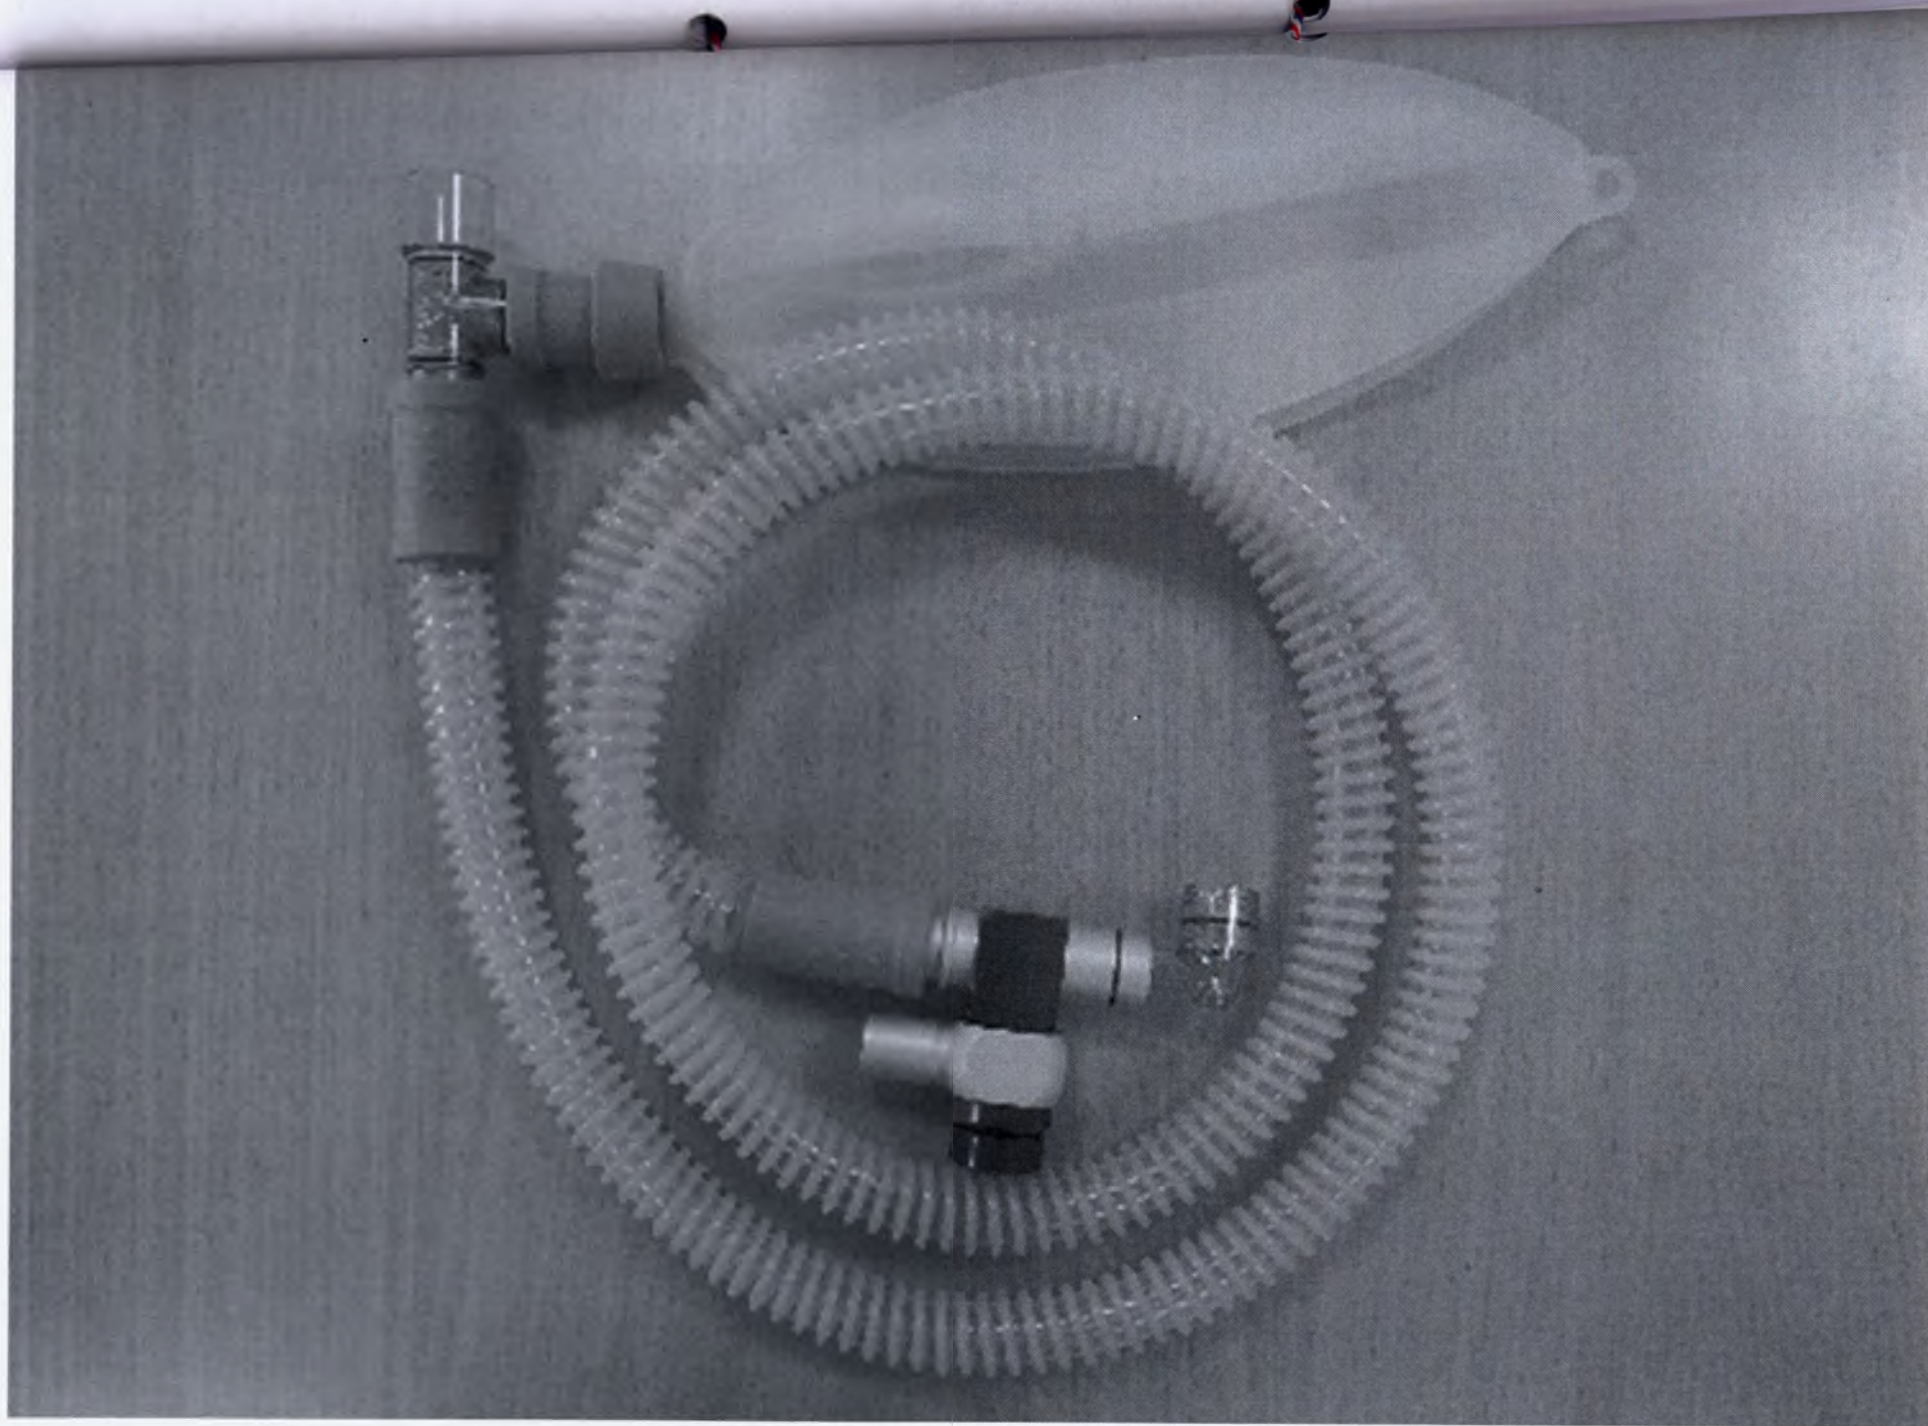

Системы дыхательные (не более 5 шт.)

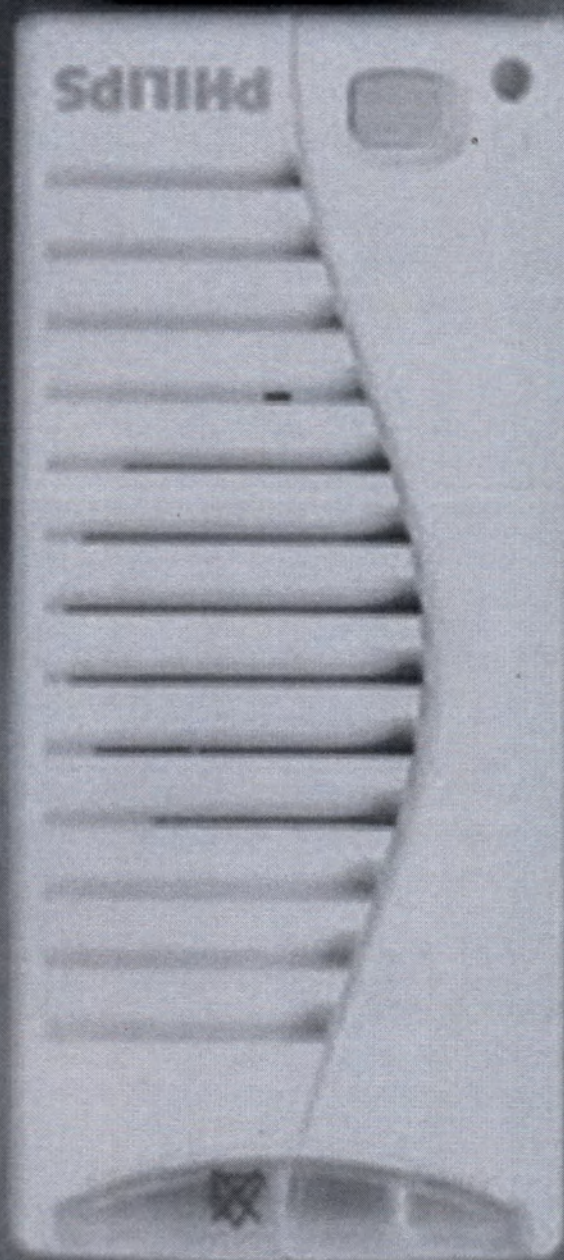




Системы эвакуации газов (не более 10 шт.)




Смазка кислородная, оксидная (не более 10 уп.)

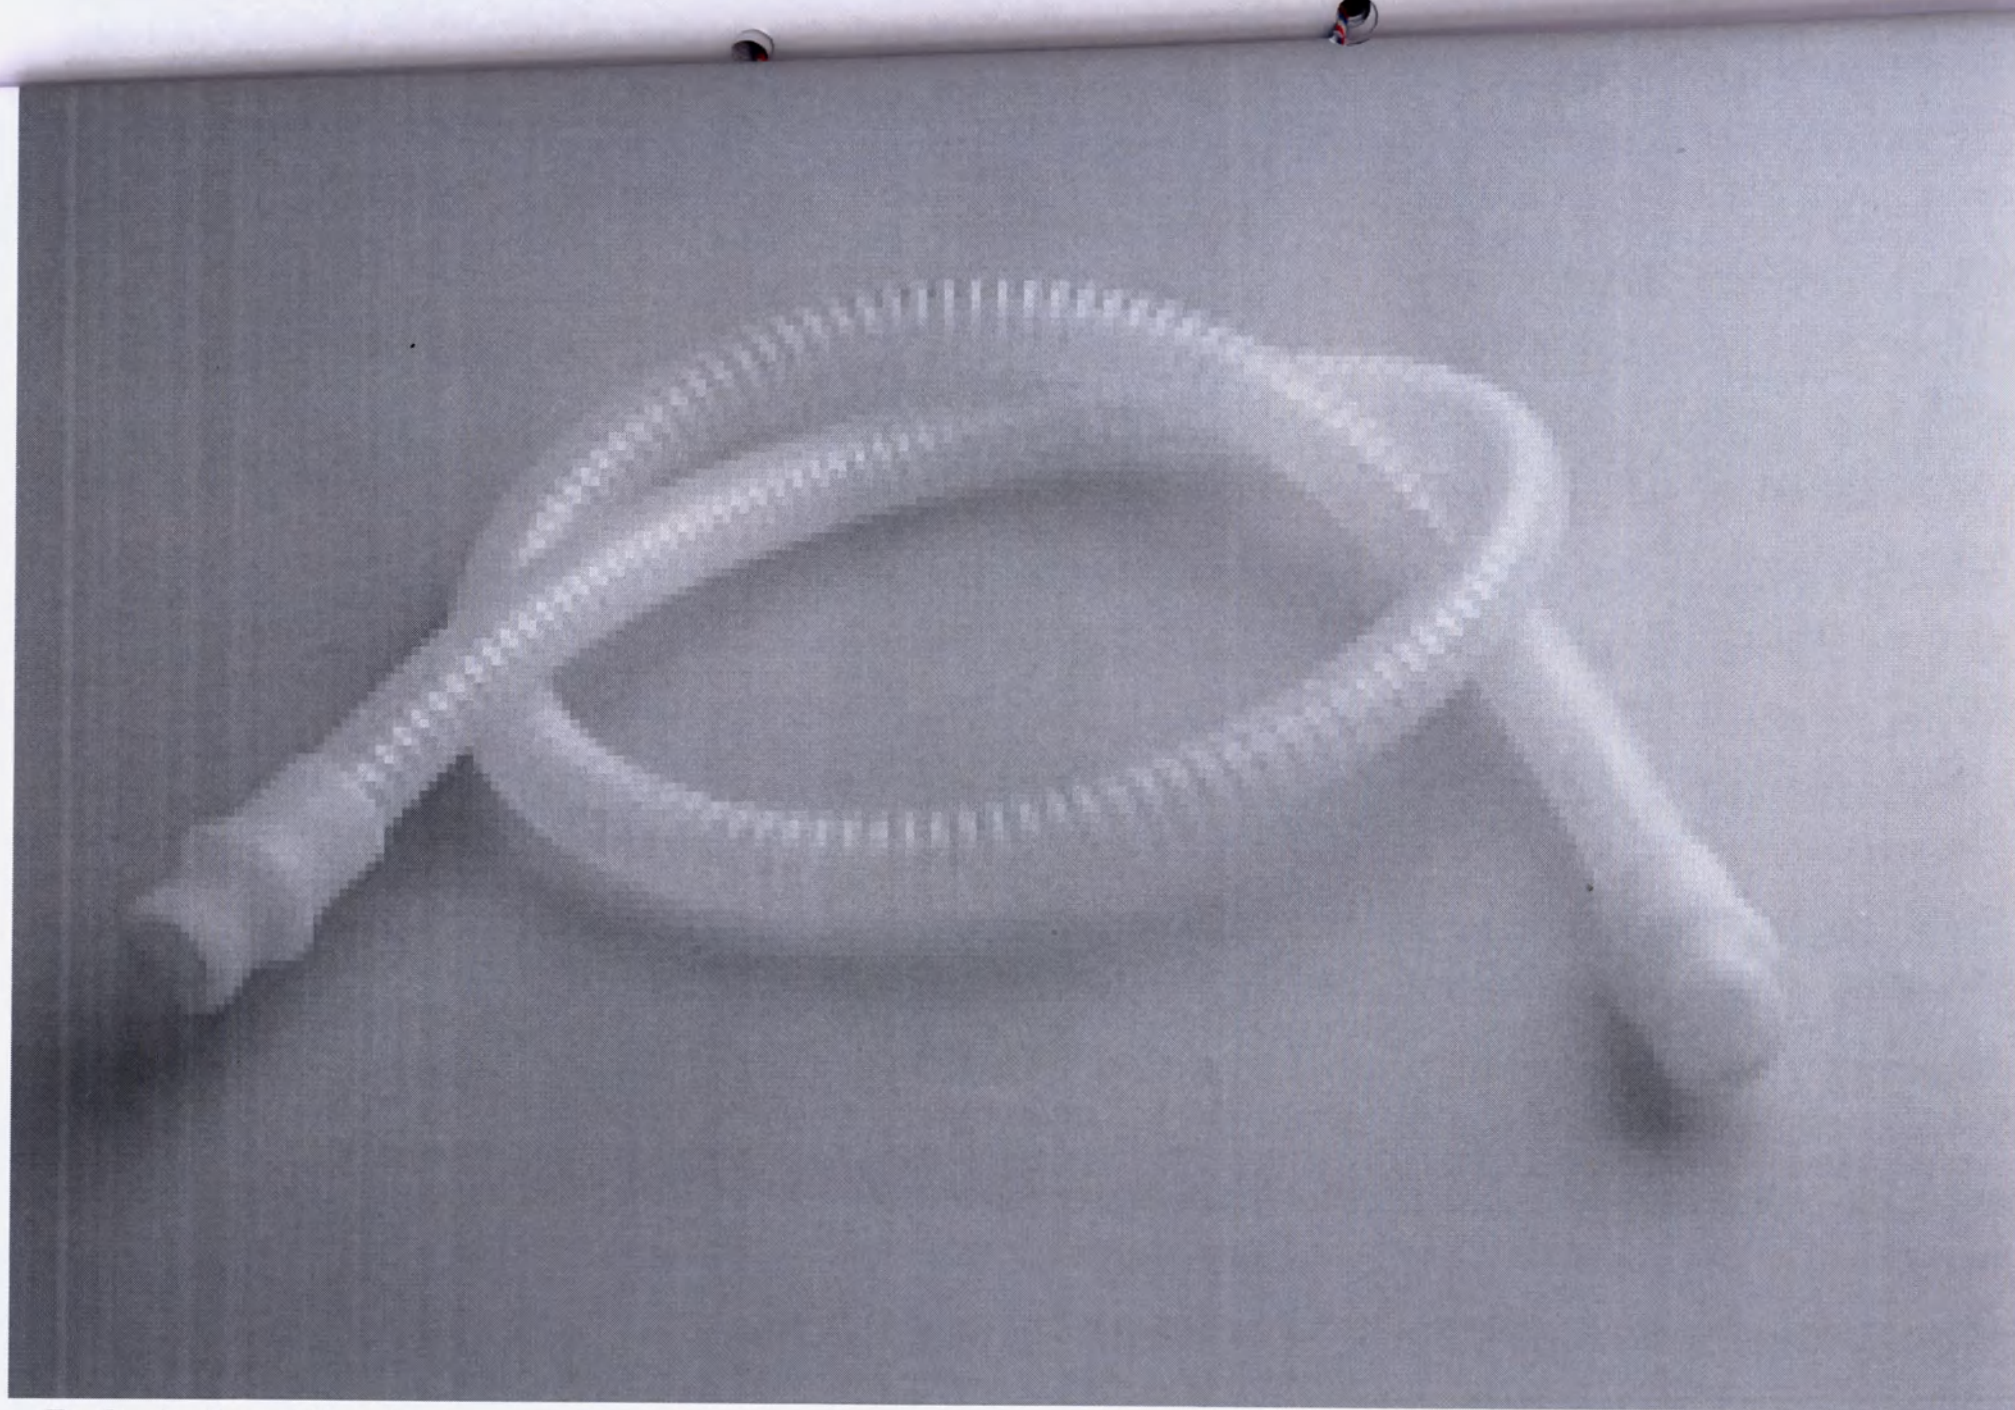

Трубки (не более 100 шт.)




Увлажнители воздуха (не более 5 шт.)

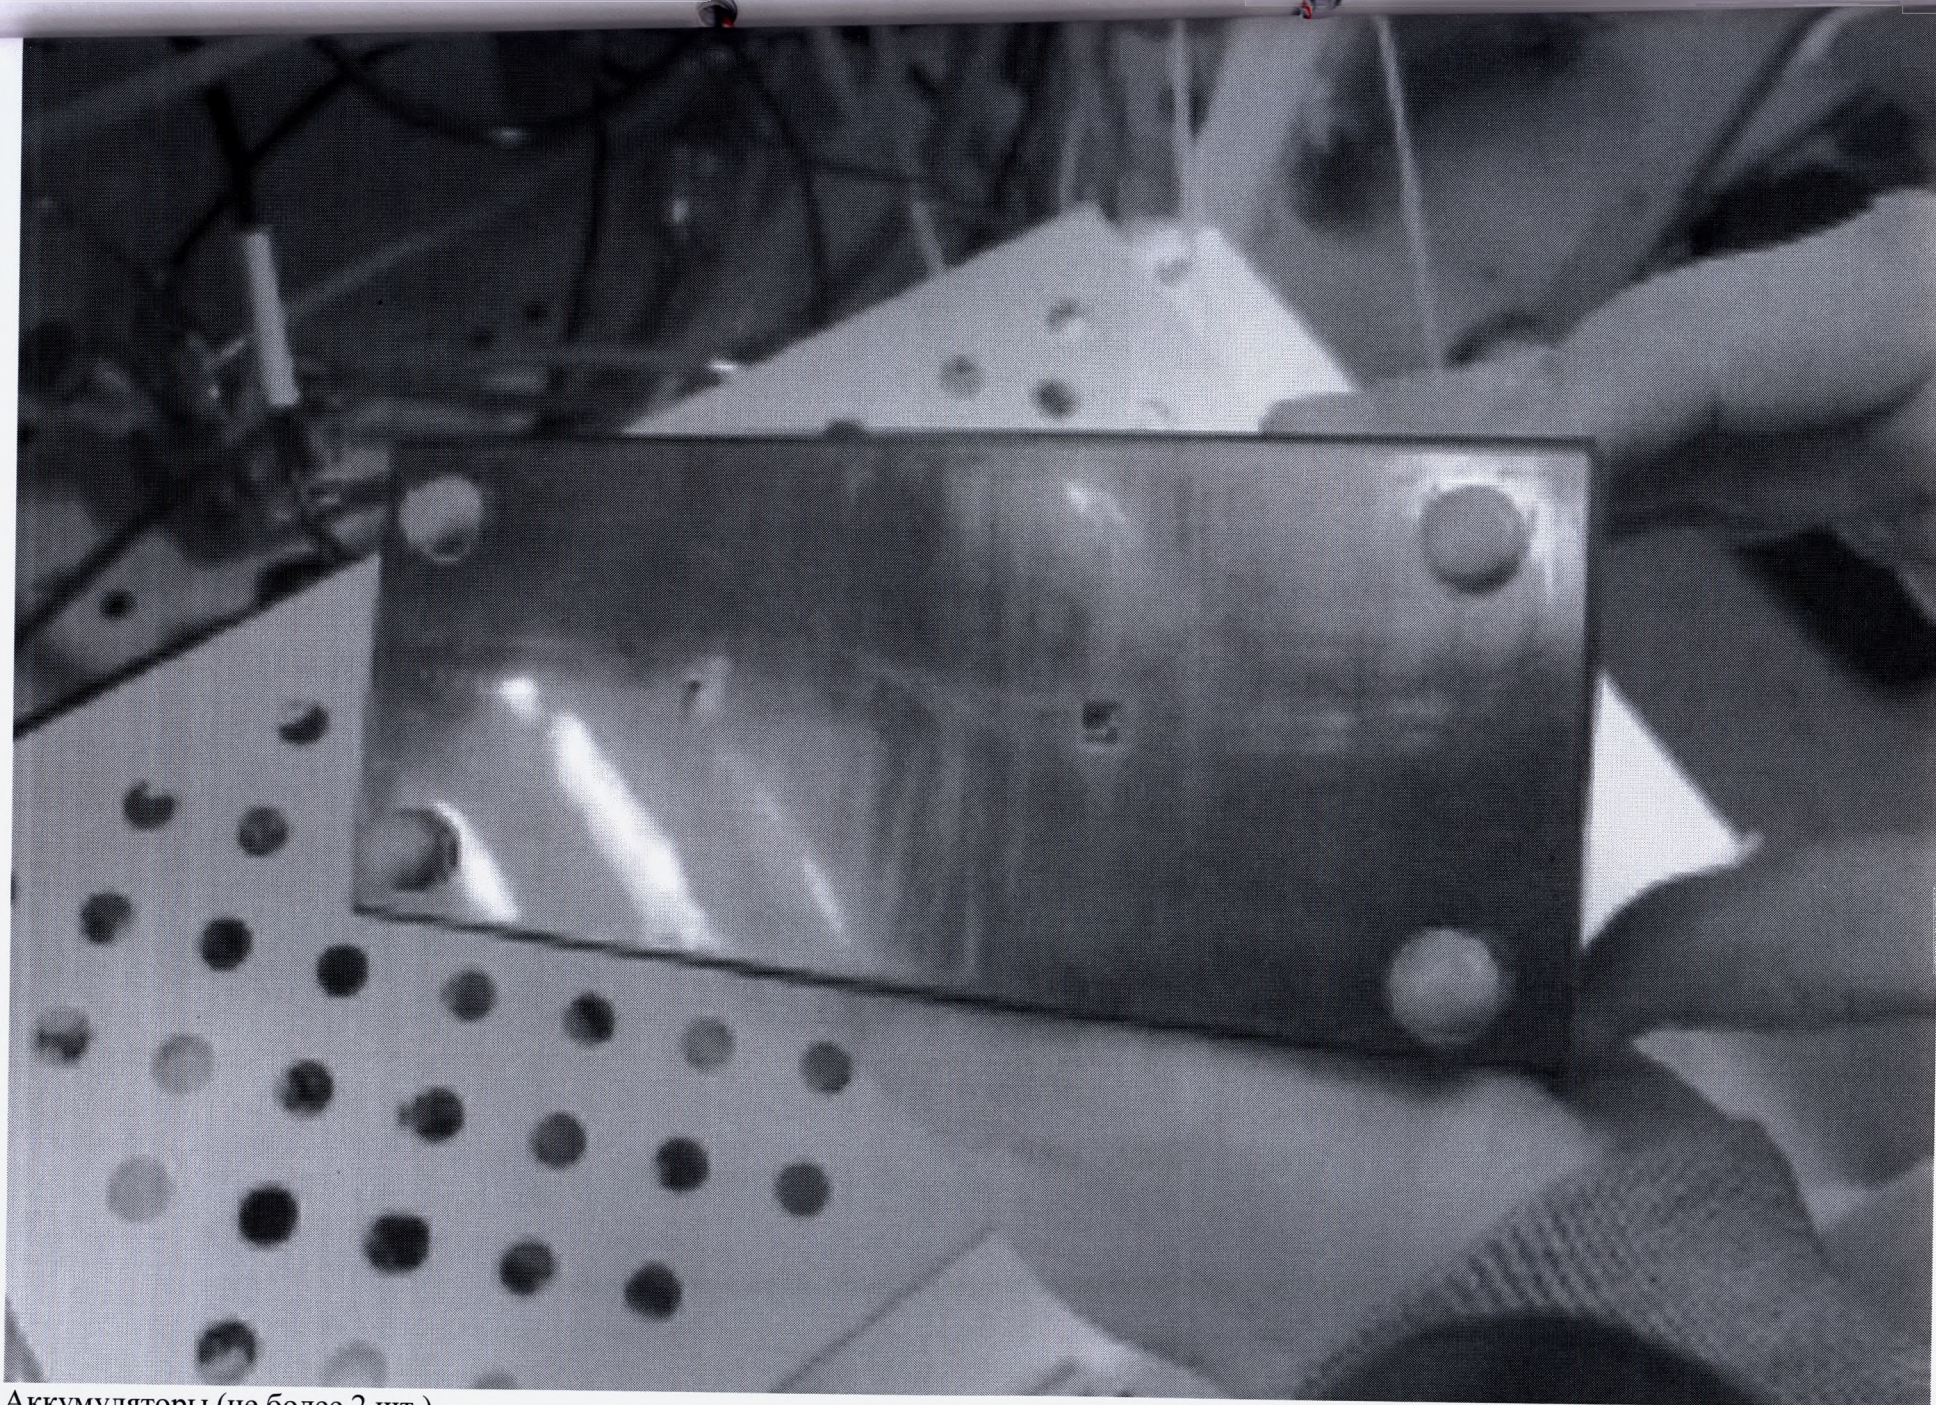

Аккумуляторы (не более 2 шт.)

Siesta i Whispa

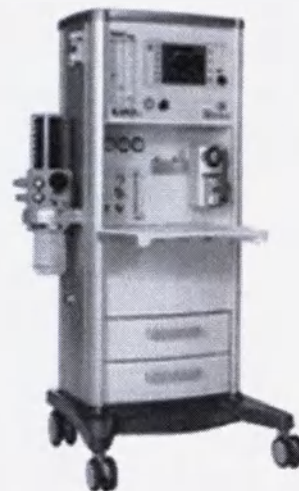

Руководство по эксплуатации


Наркозный аппарат Siesta i Whispa

Анестезия

Номер по каталогу: 1005 100-90 12 072015

PHILIPS

Siesta ITS

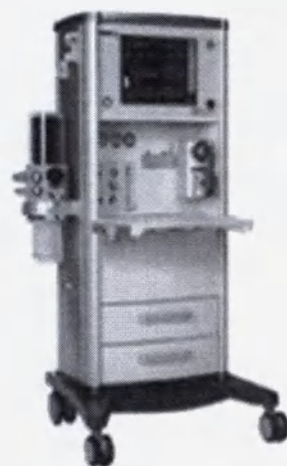

Руководство по эксплуатации


Siesta ITS Наркозный аппарат


Анестезия

Номер по каталогу 11000000 00-00 000005

PHILIPS



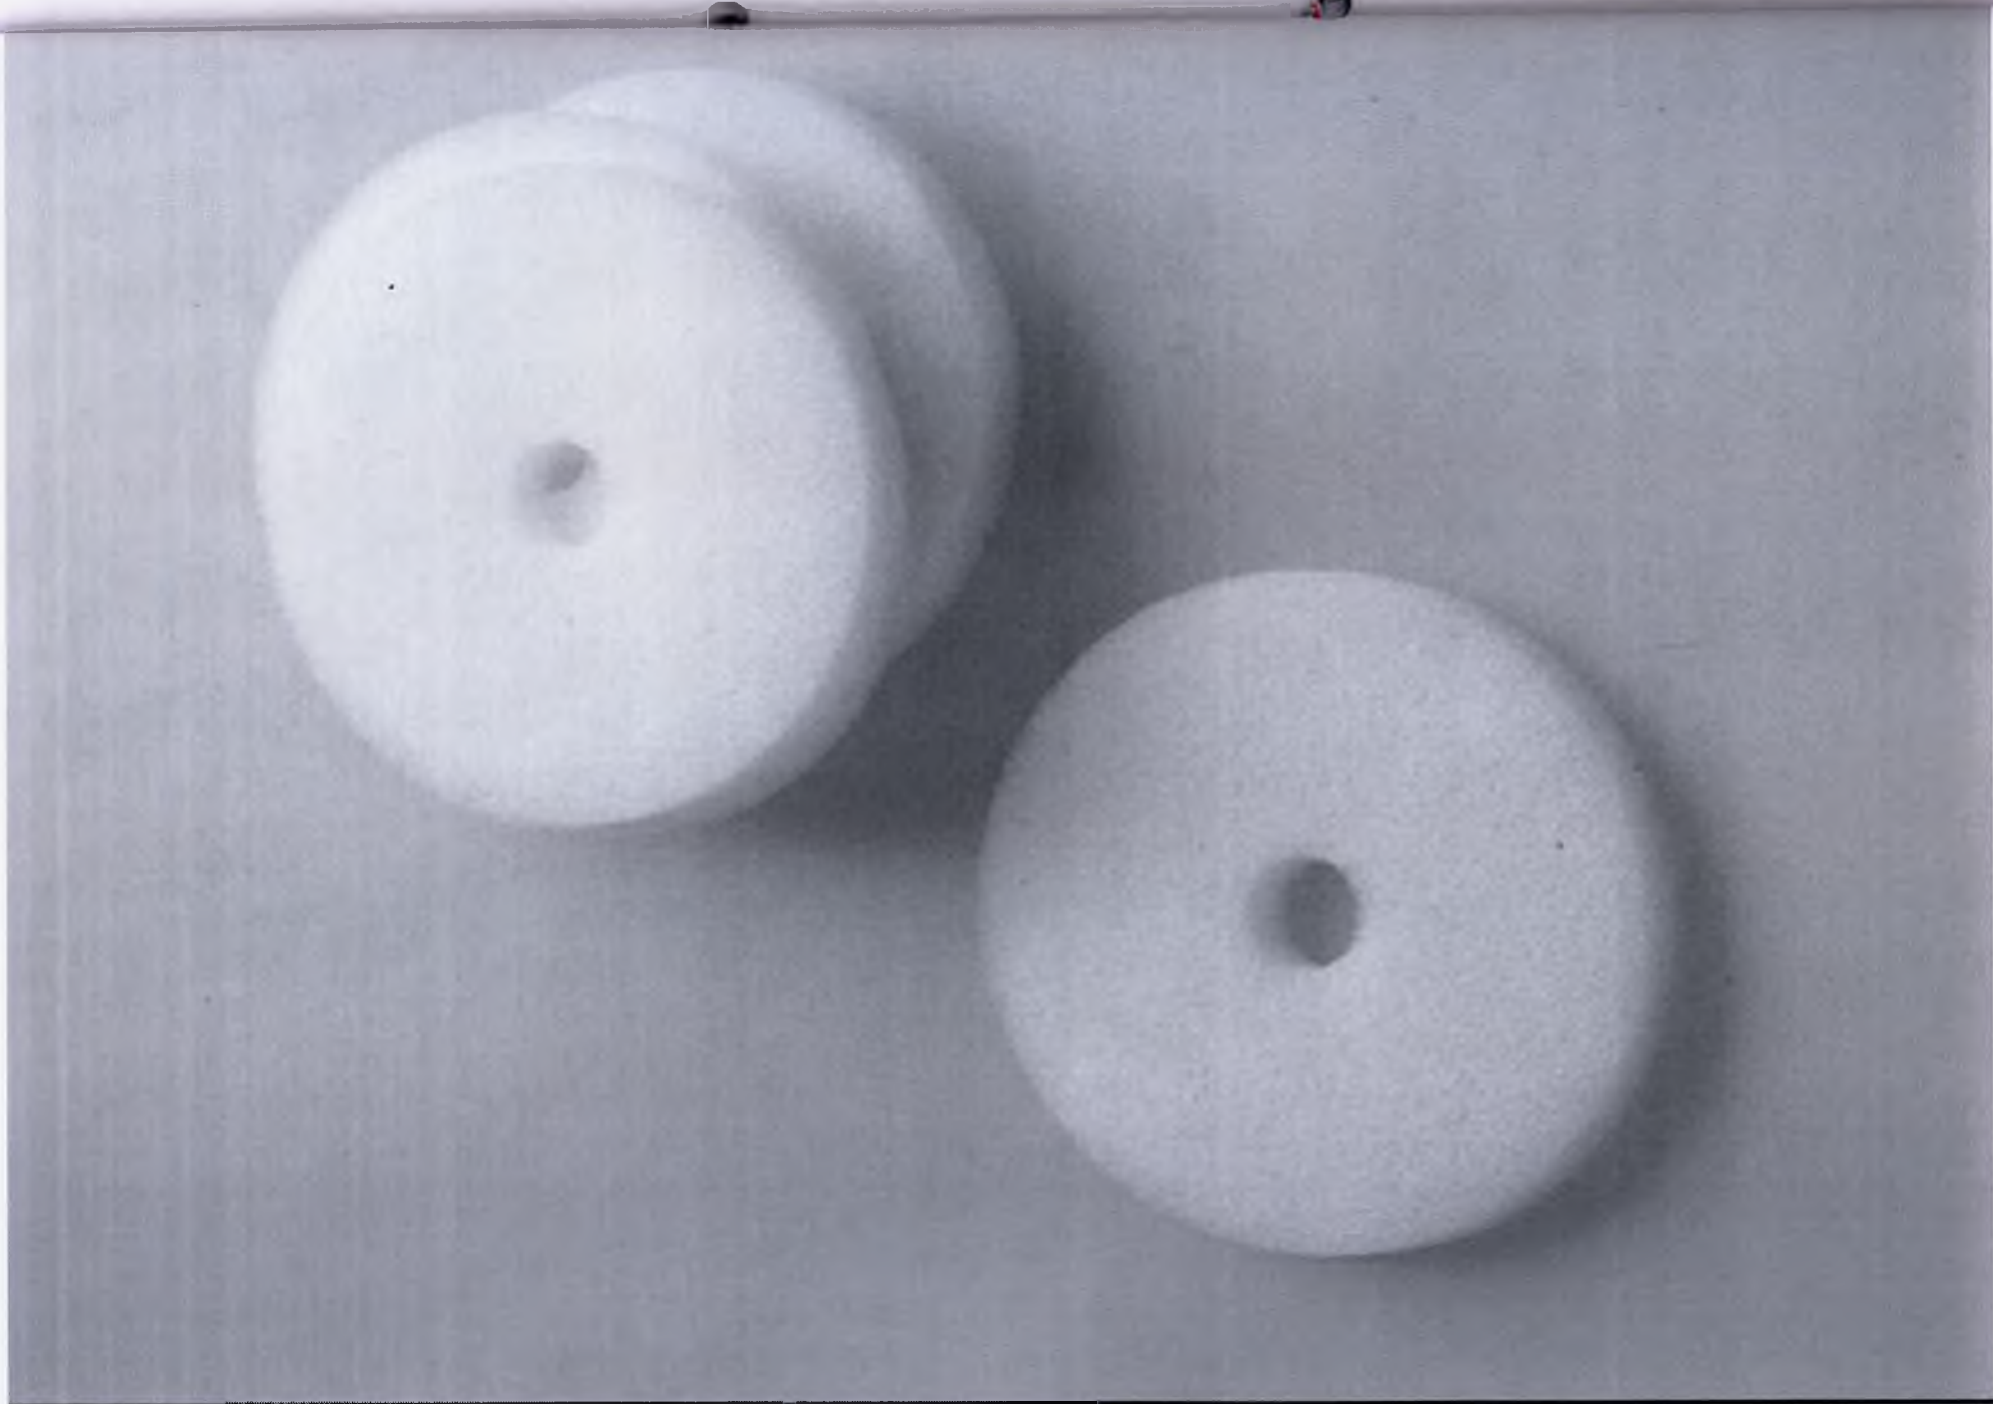


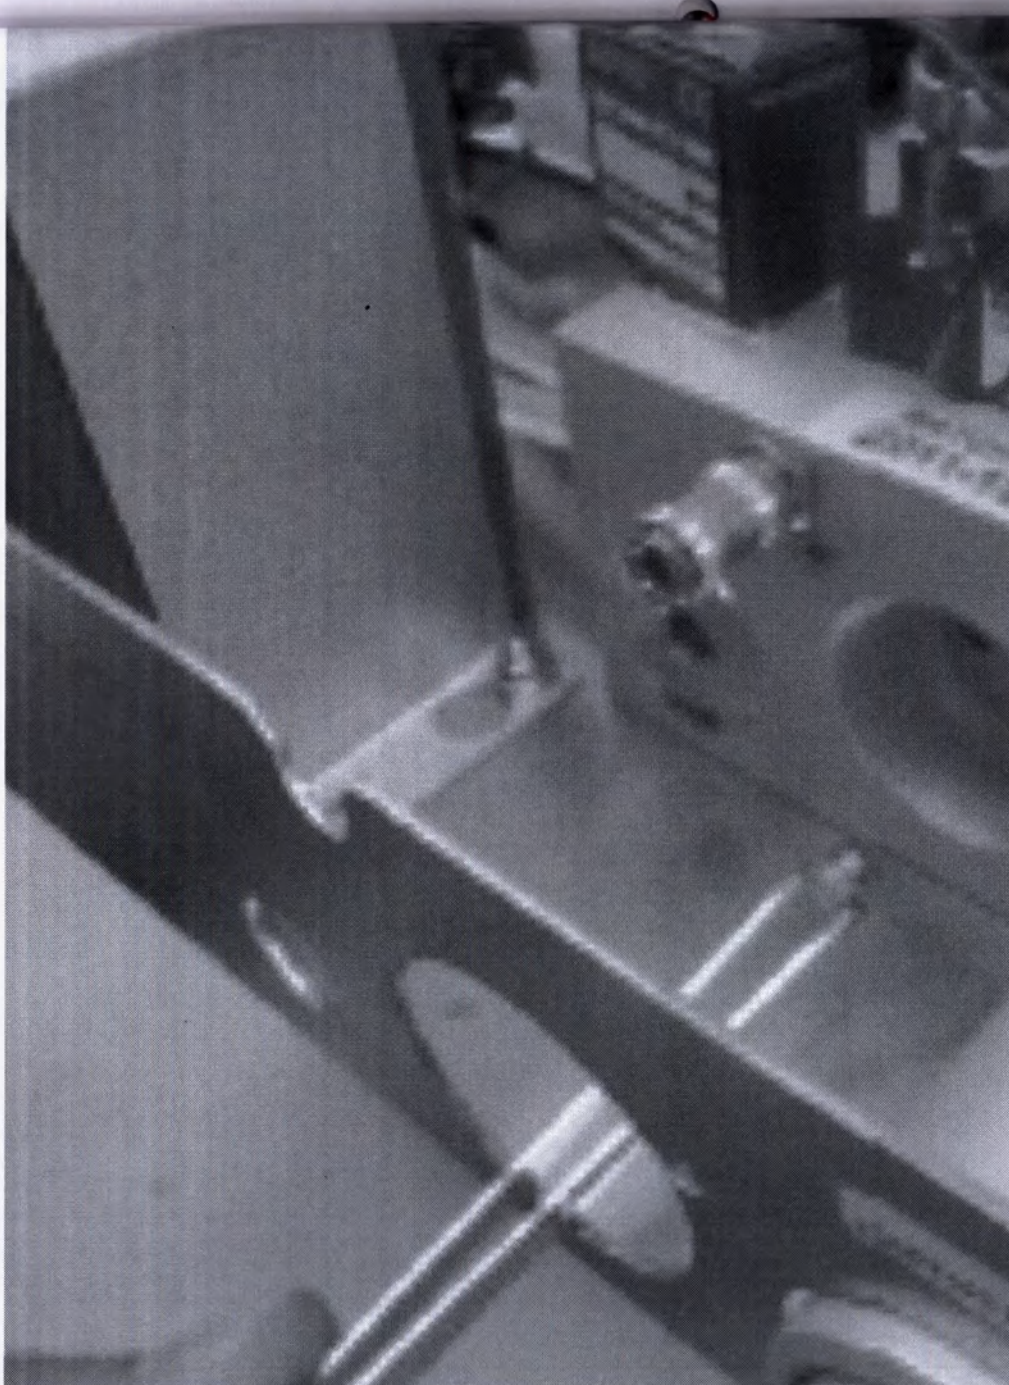


Лампы электрические встроенные (не более 5 шт.)




Лампы электрические навесные (не более 5 шт.)

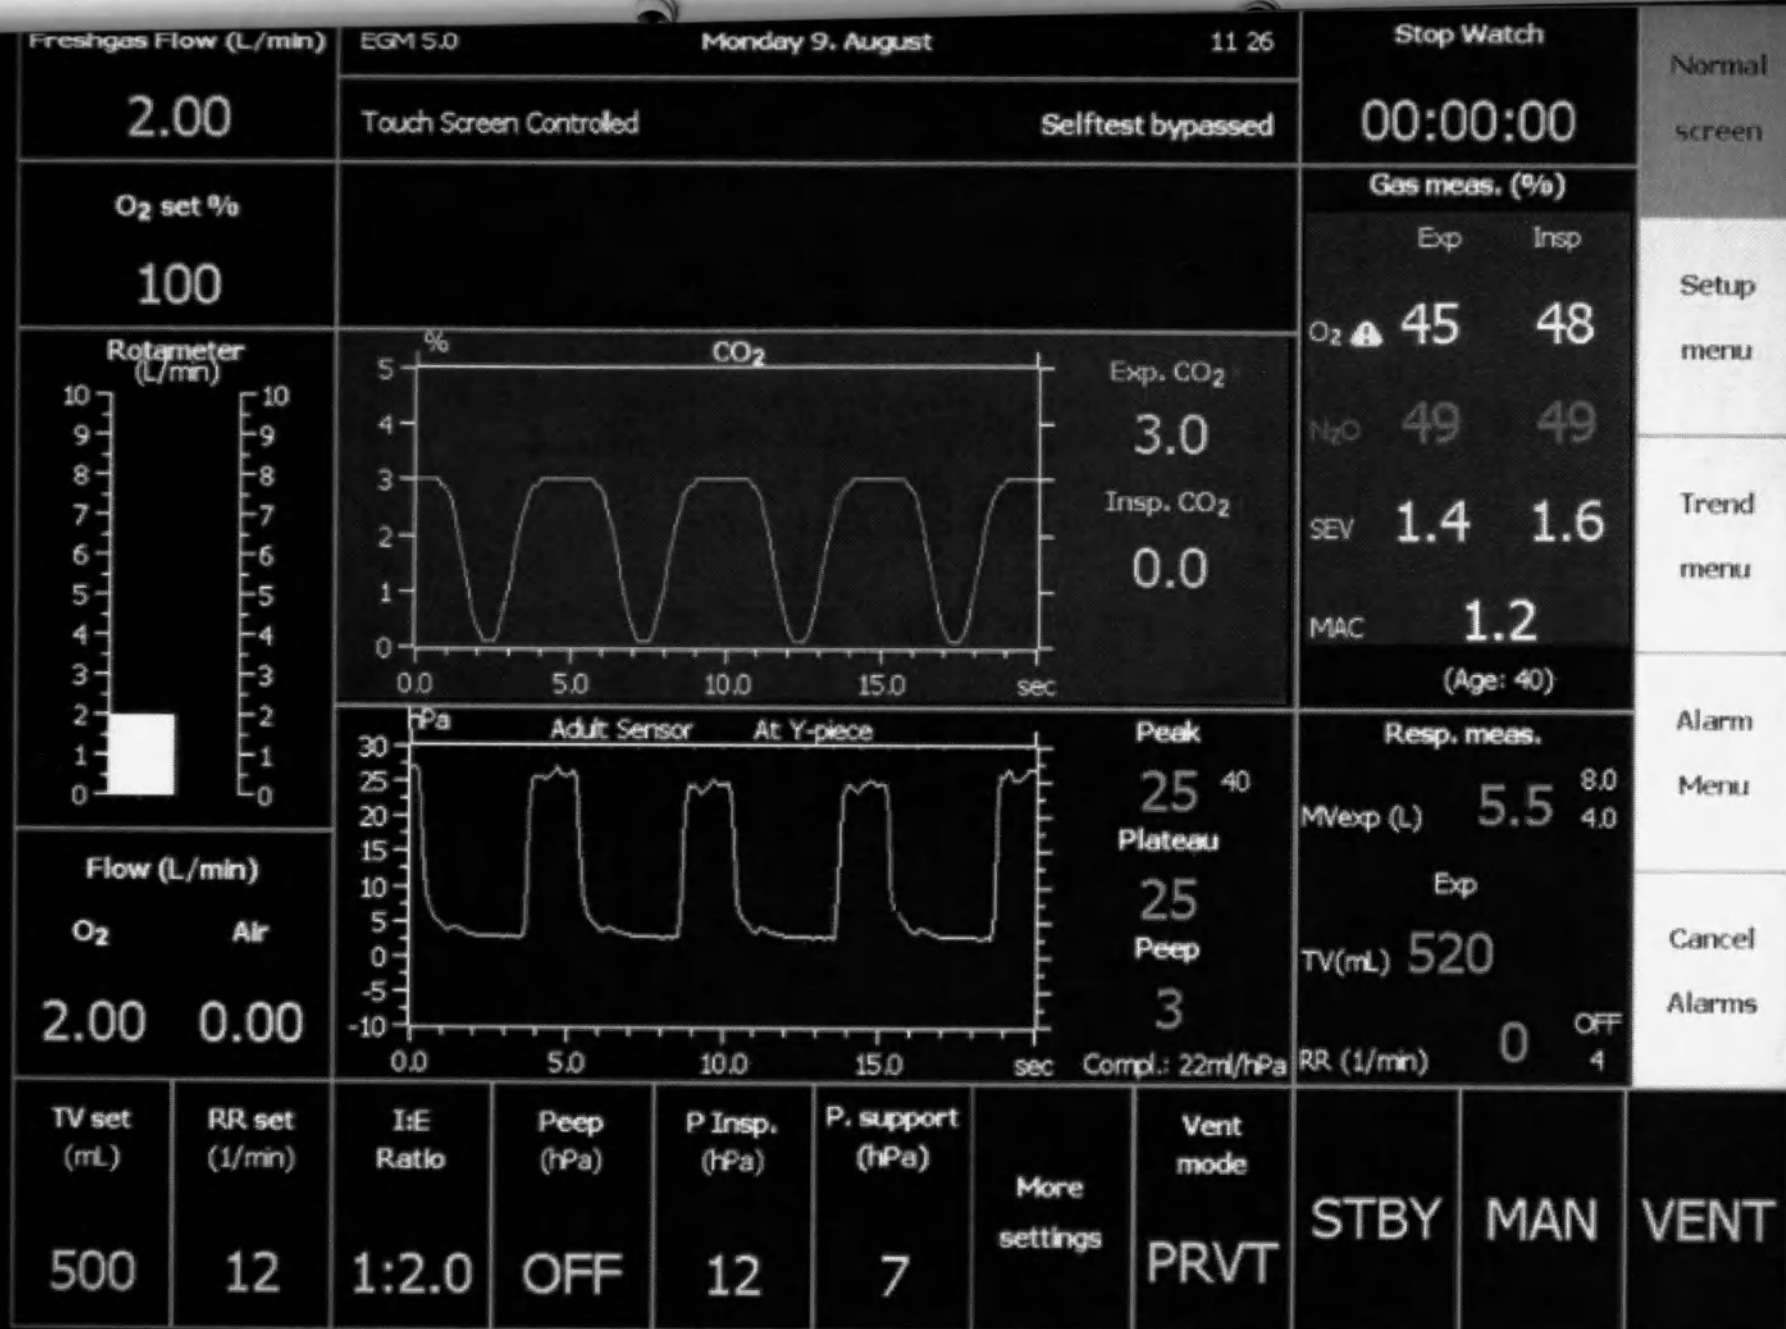



Программное обеспечение специальное медицинское на электронных носителях (не более 15 шт.)

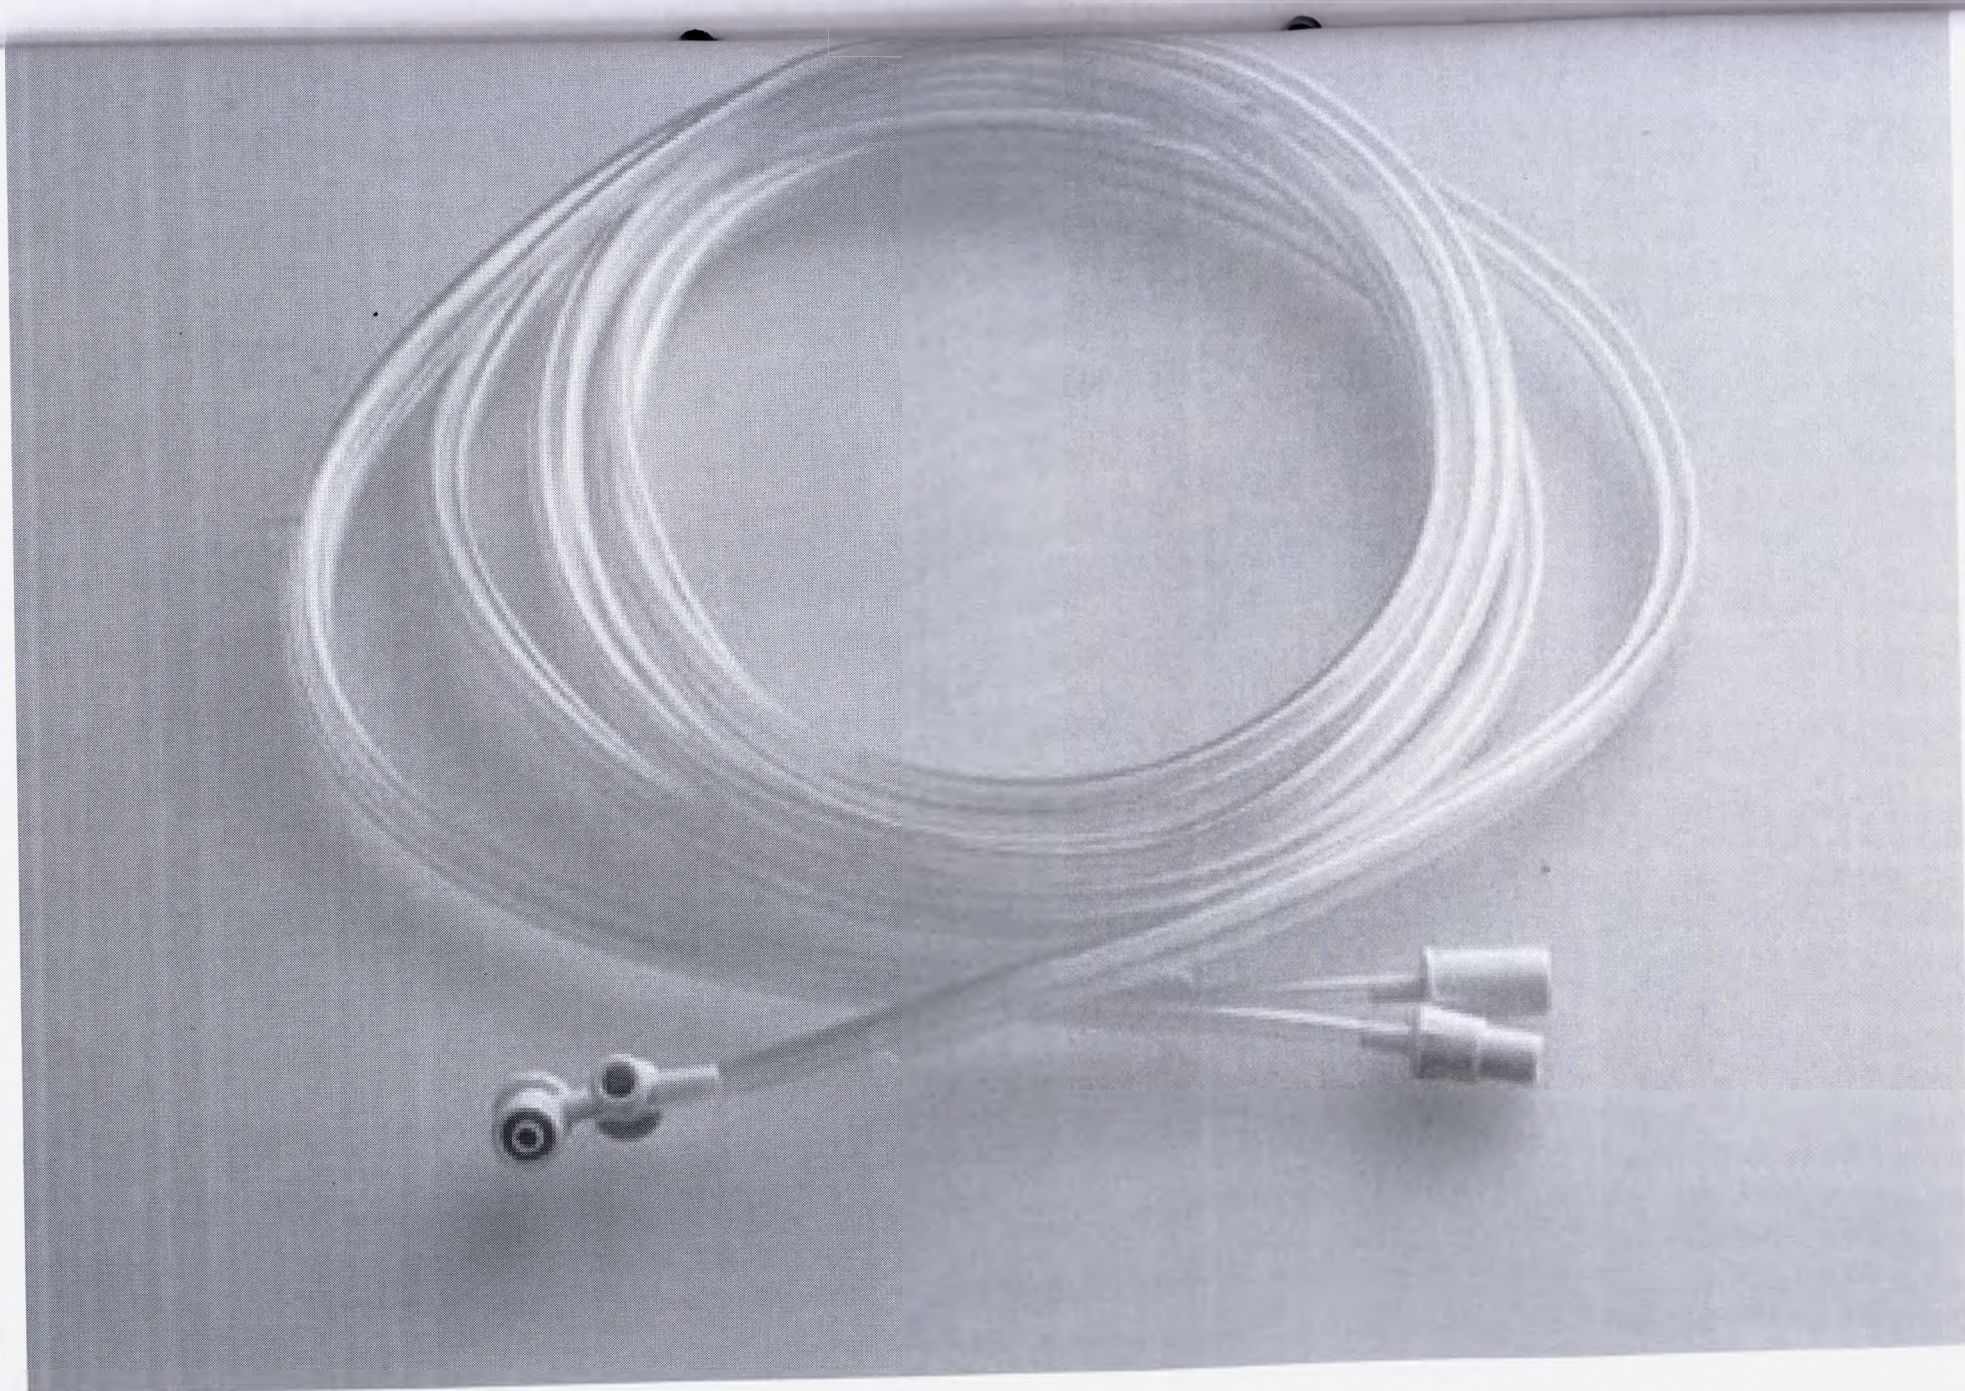


Наборы для спирометрии: трубки для спирометрии (25 шт.)

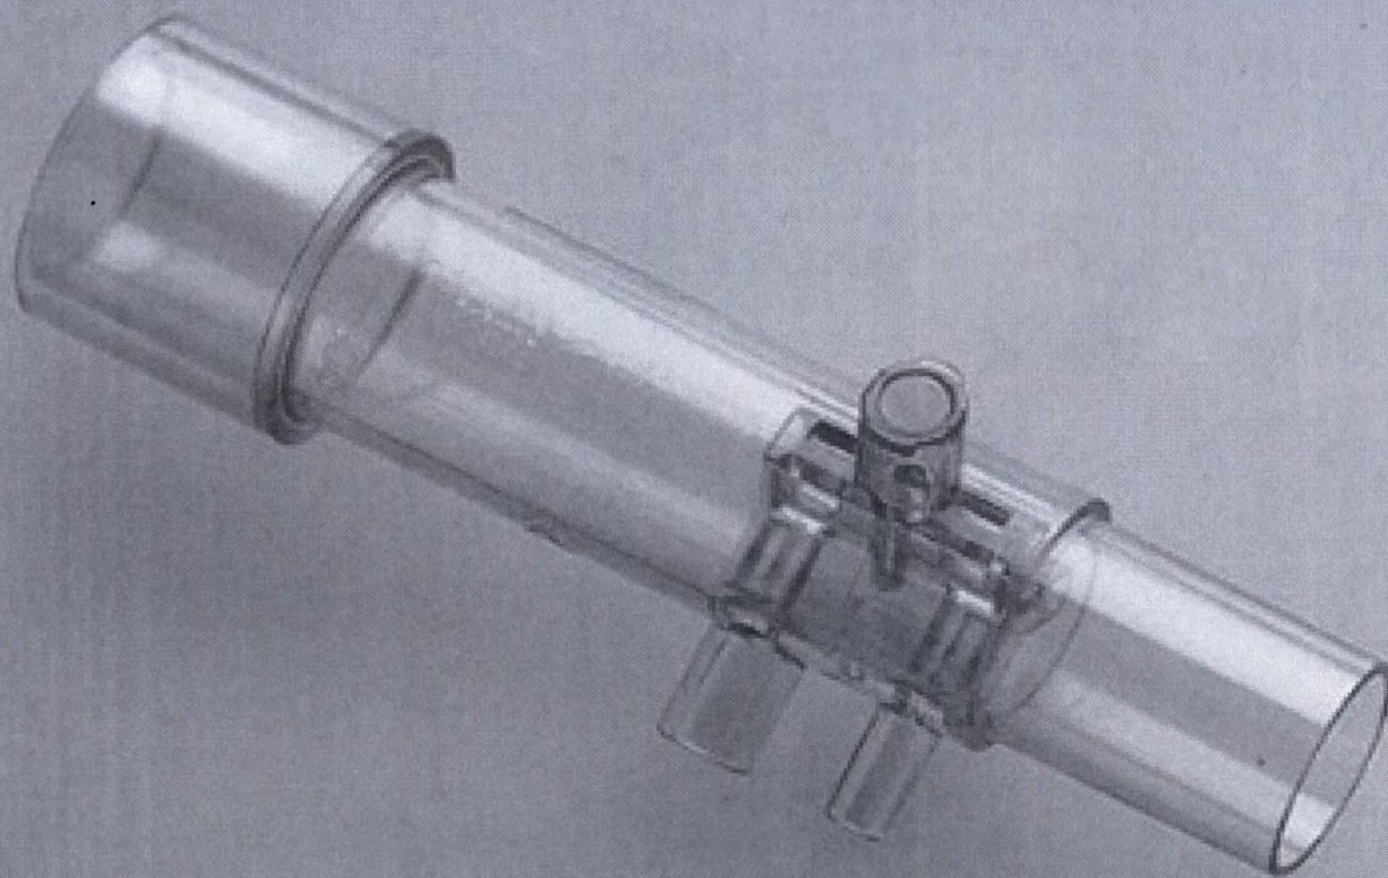

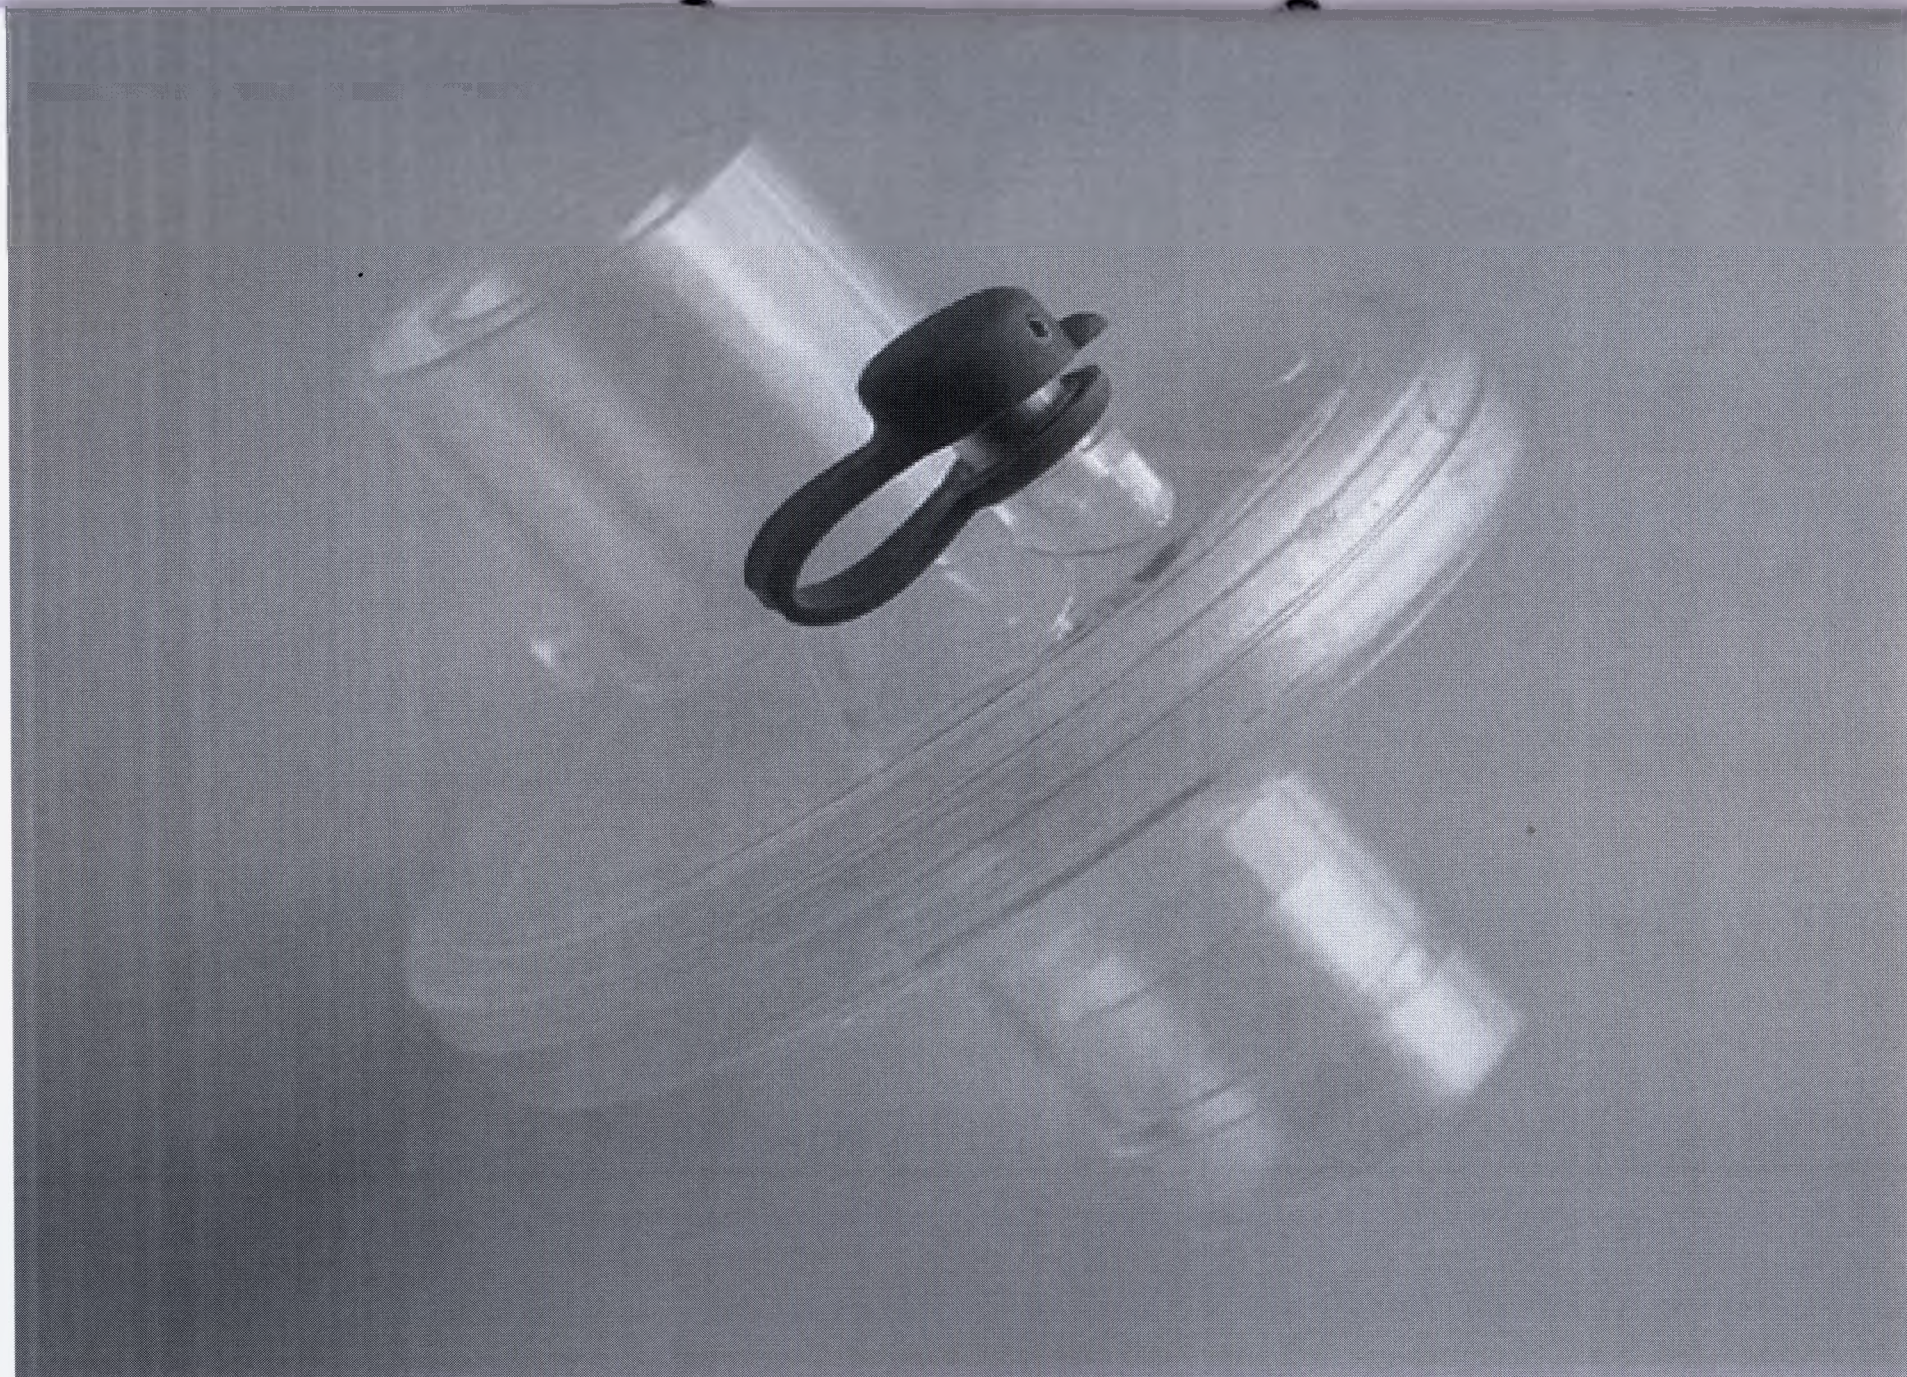

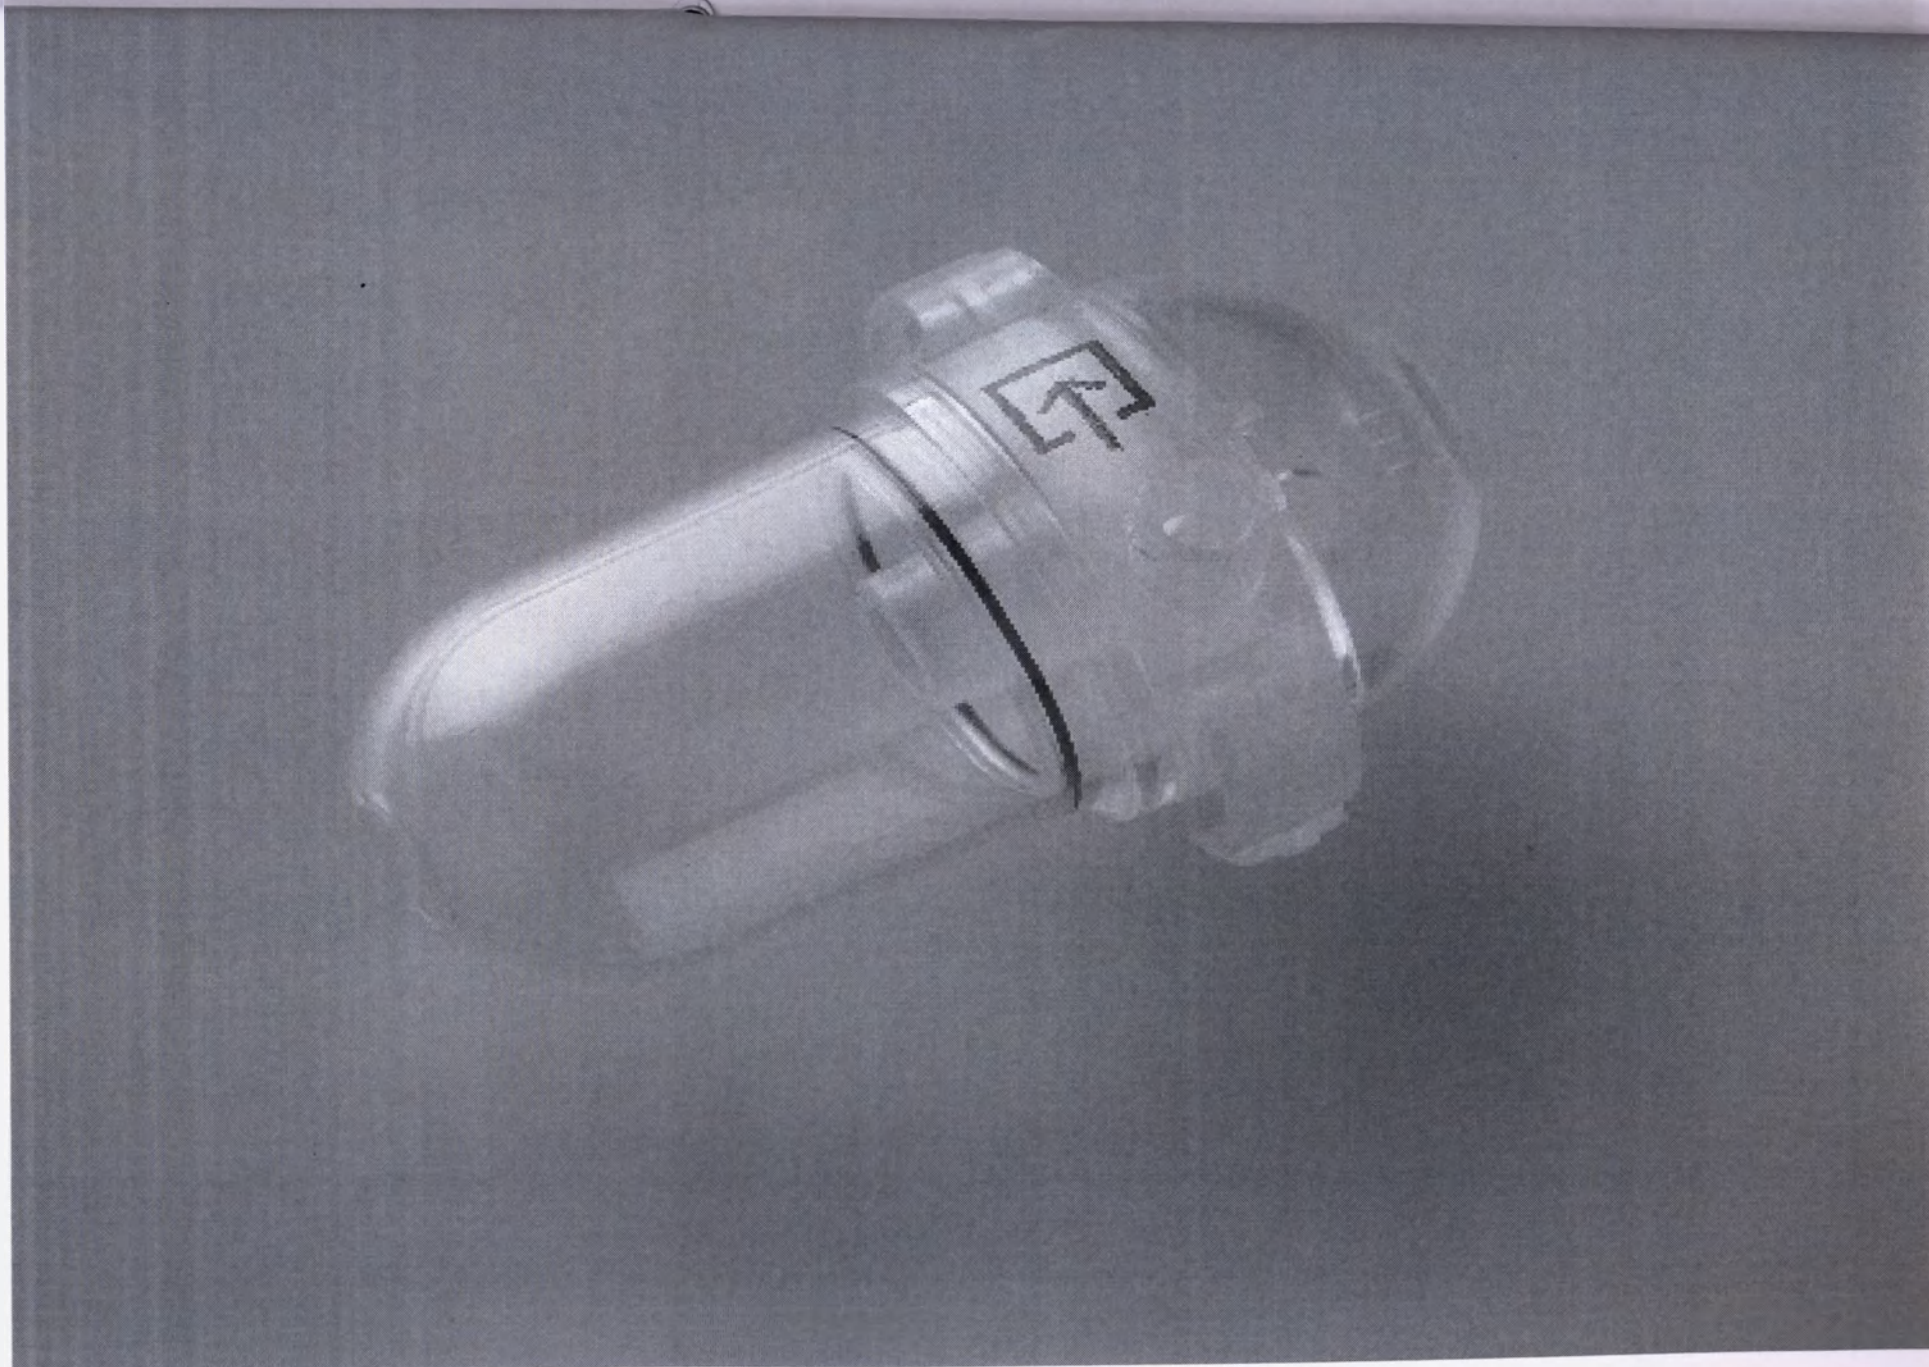

Наборы для спирометрии: водосборники с фильтрами, одноразовые (2 шт.)

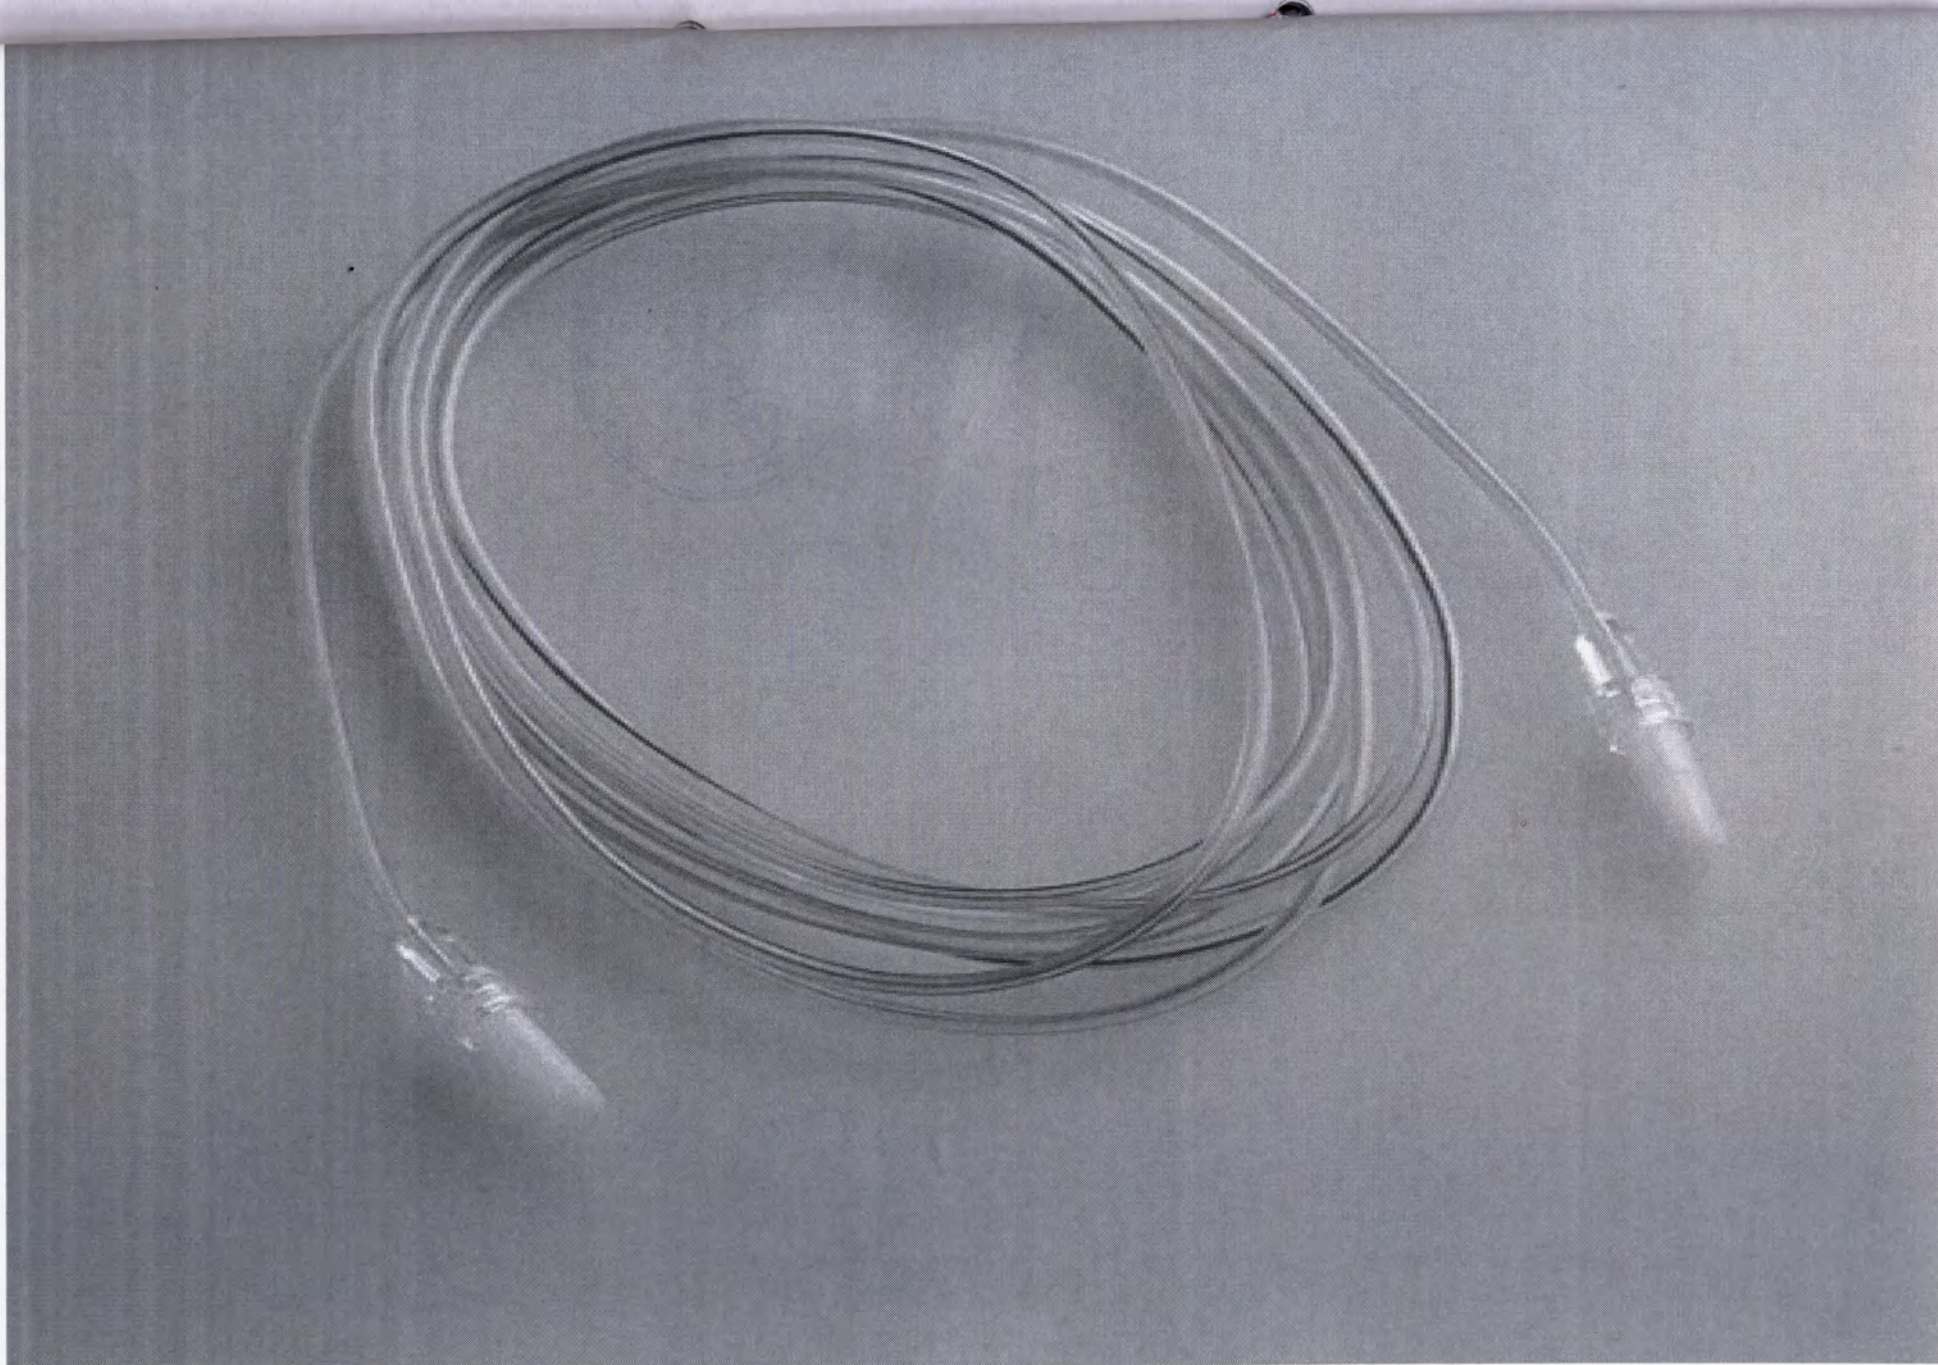

ПРОШИТО
Листов 75 (сепьдесят
пять)

