

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «МЕДОНЛАЙН»**



Л.Б. Бронникова

"30" октября 2015 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC,
с принадлежностями,**

производства FONA S.r.l. (ФОНА С.р.л.), Италия


СОДЕРЖАНИЕ


Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC, с принадлежностями		
I.	Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC, мобильный	3
1.	Моноблок рентгеновский дентальный	4
2.	Блок управления	5
3.	Пульт управления	6
4.	Штатив мобильный	7
5.	Устройство ограничения луча (BLD) круговое диаметром 5,8 см	8
6.	Шнур питания	9
7.	Руководство по эксплуатации	10
II.	Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC, стационарный	11
1.	Моноблок рентгеновский дентальный	12
2.	Блок управления	13
3.	Пульт управления	14
4.	Штатив настенный с длиной манипулятора размера S (короткий) 30 см или размера M (Средний) 60см или размера L (длинный) 80 см или размера XL (очень длинный) 100 см	15
5.	Устройство ограничения луча (BLD) круговое диаметром 5,8 см	16
6.	Шнур питания	17
7.	Руководство по эксплуатации	18
Маркировка идентифицирующее медицинское изделие		19
III.	Принадлежности	
1.	Устройство ограничения луча (BLD) размер 2, прямоугольное 3,2 x 4,4 см	21
2.	Устройство ограничения луча (BLD) размер 0, прямоугольное размером 2,2 x 3,2 см	22
3.	Расширения тубуса на 10 см.	23
	Приложение № 1	24



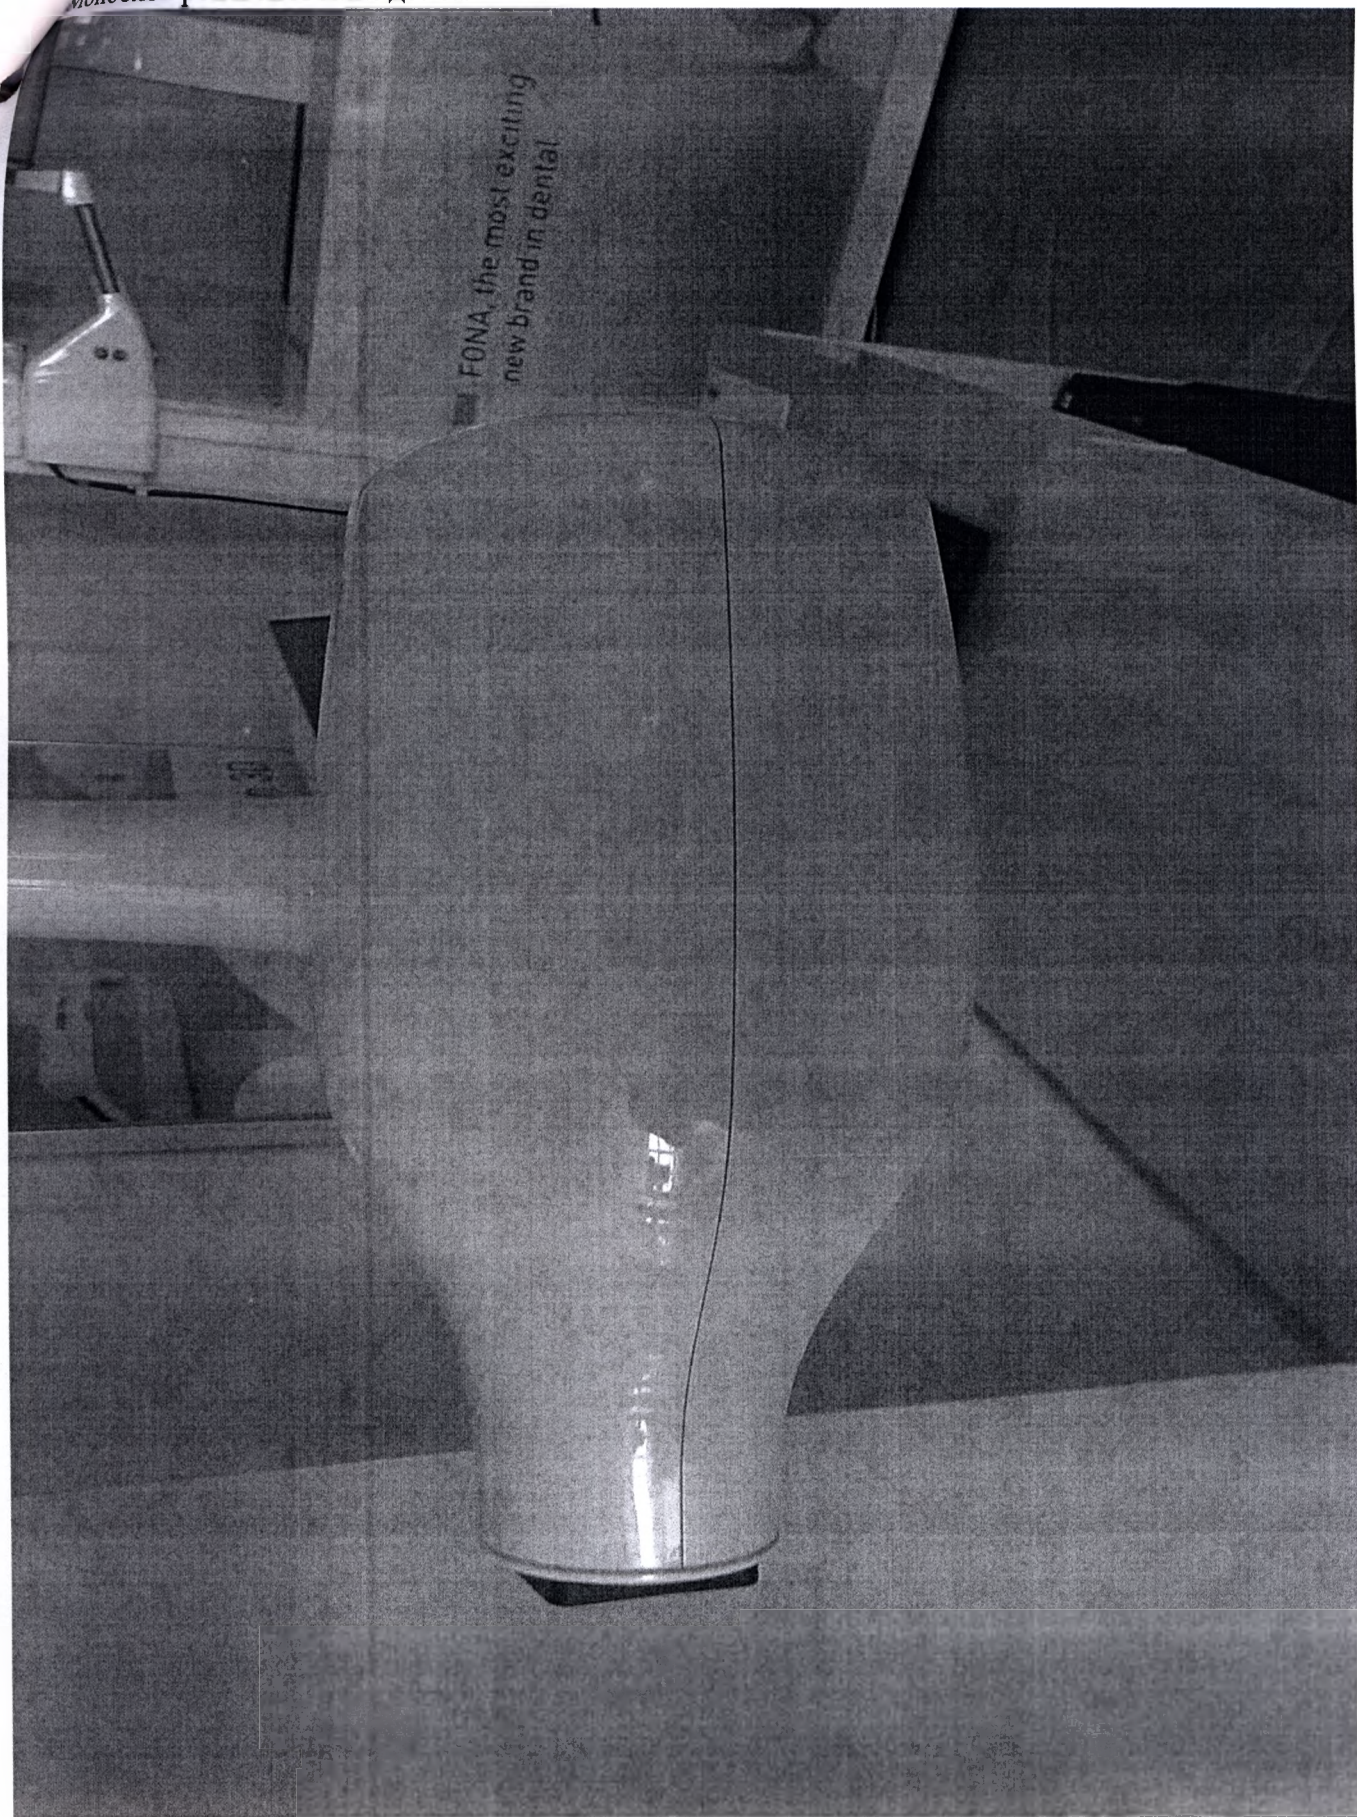


2. Блок управления

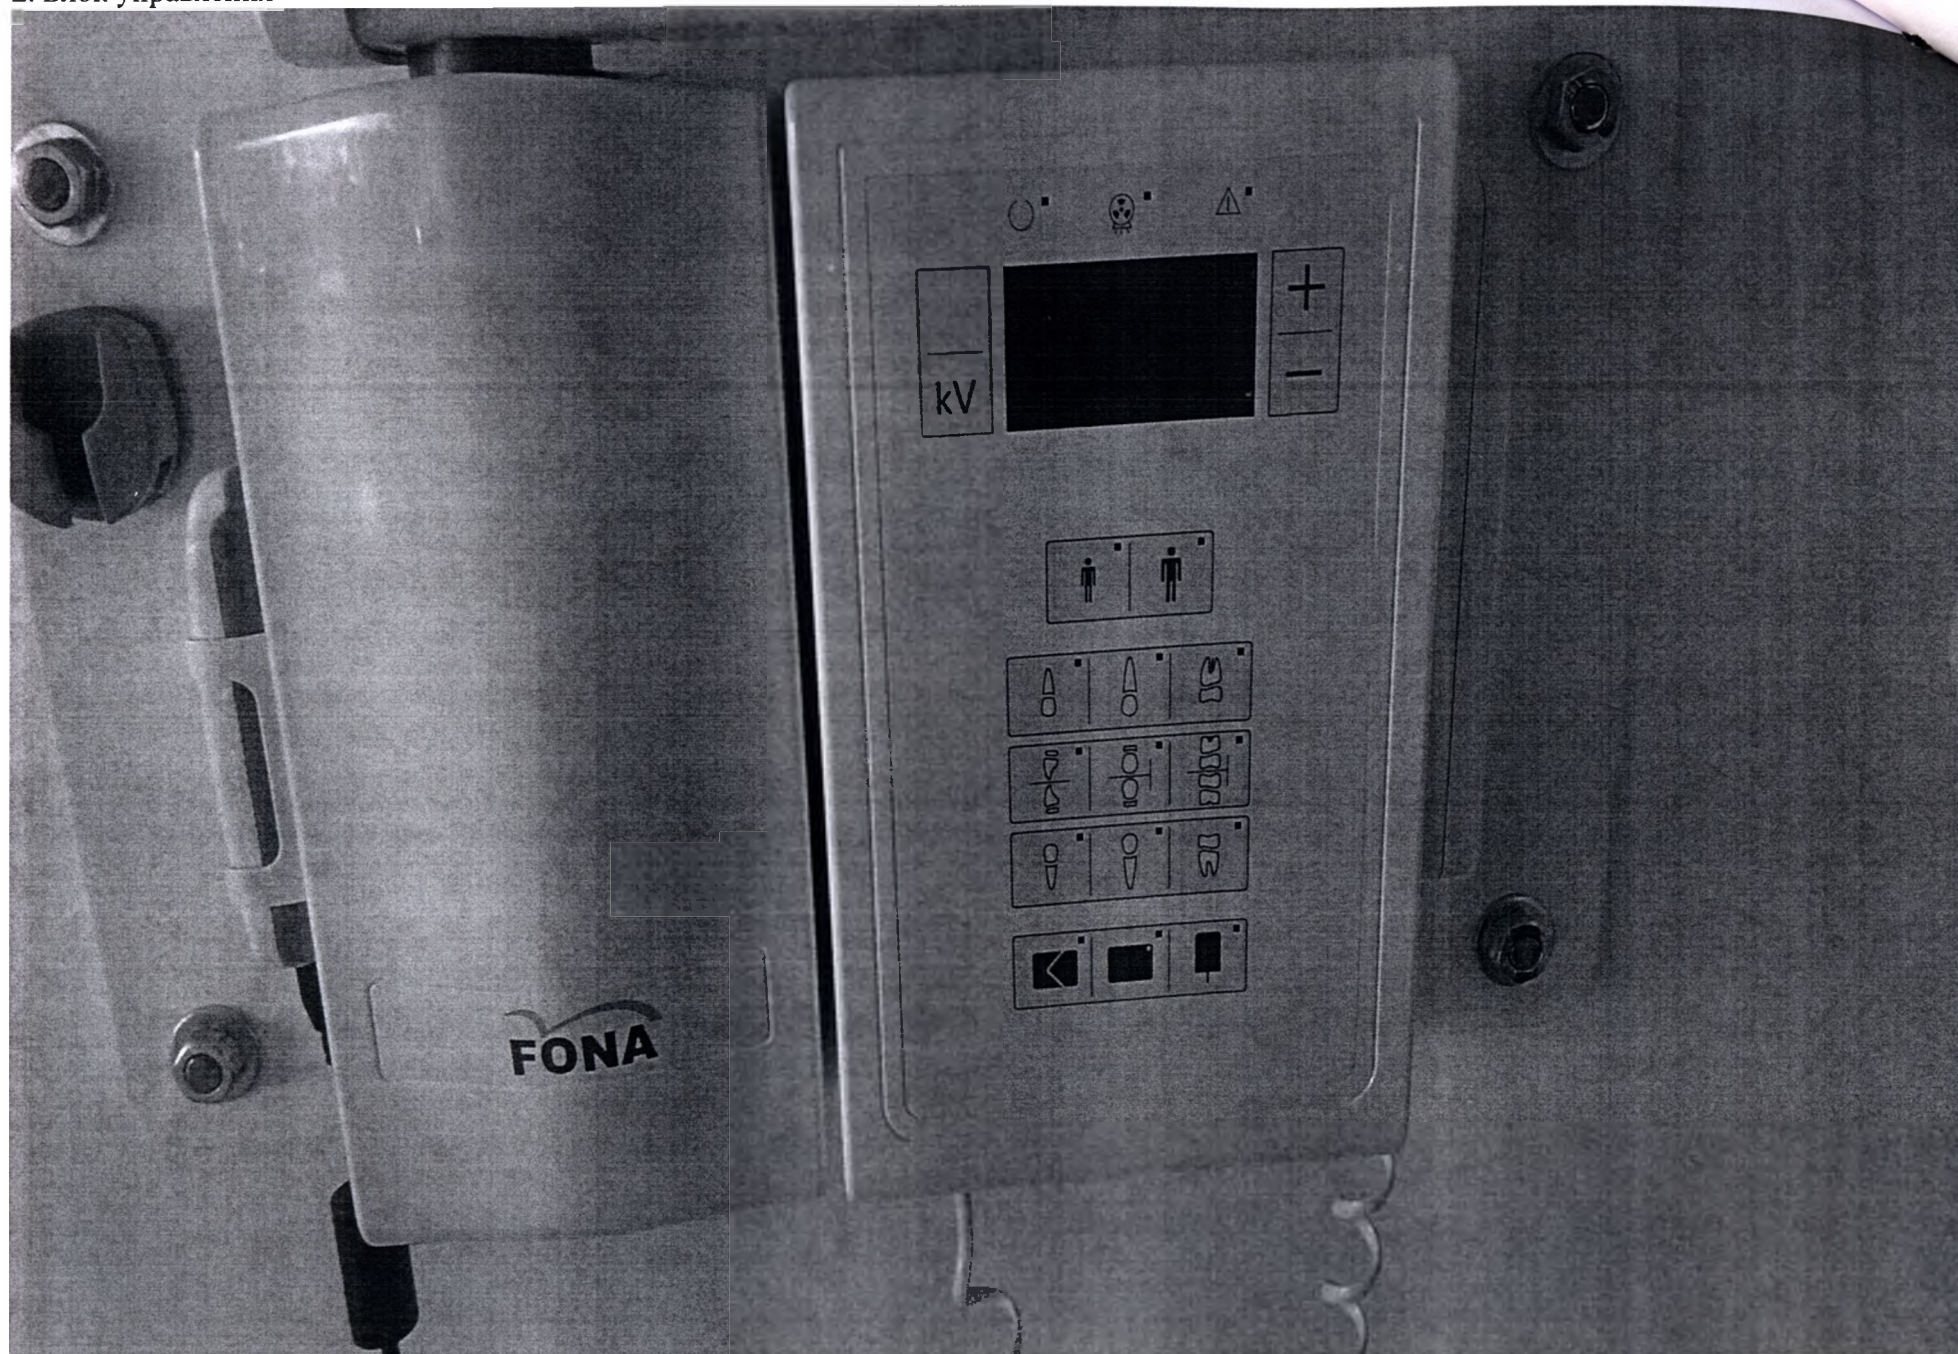

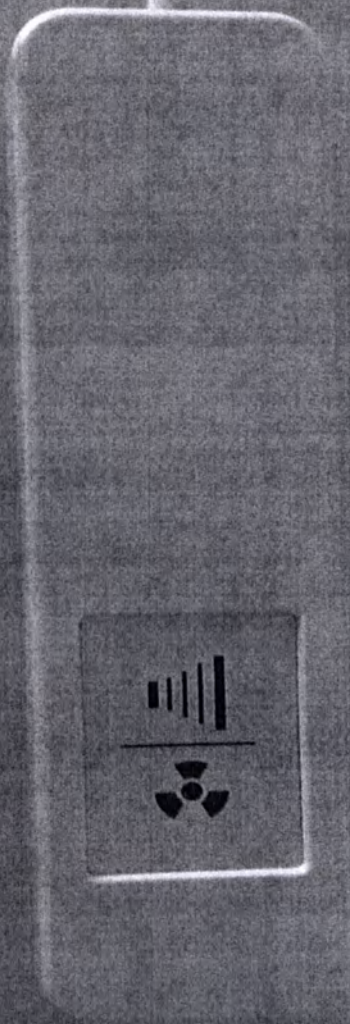




5. Устройство ограничения луча (BLD) круговое диаметром 5,8 см

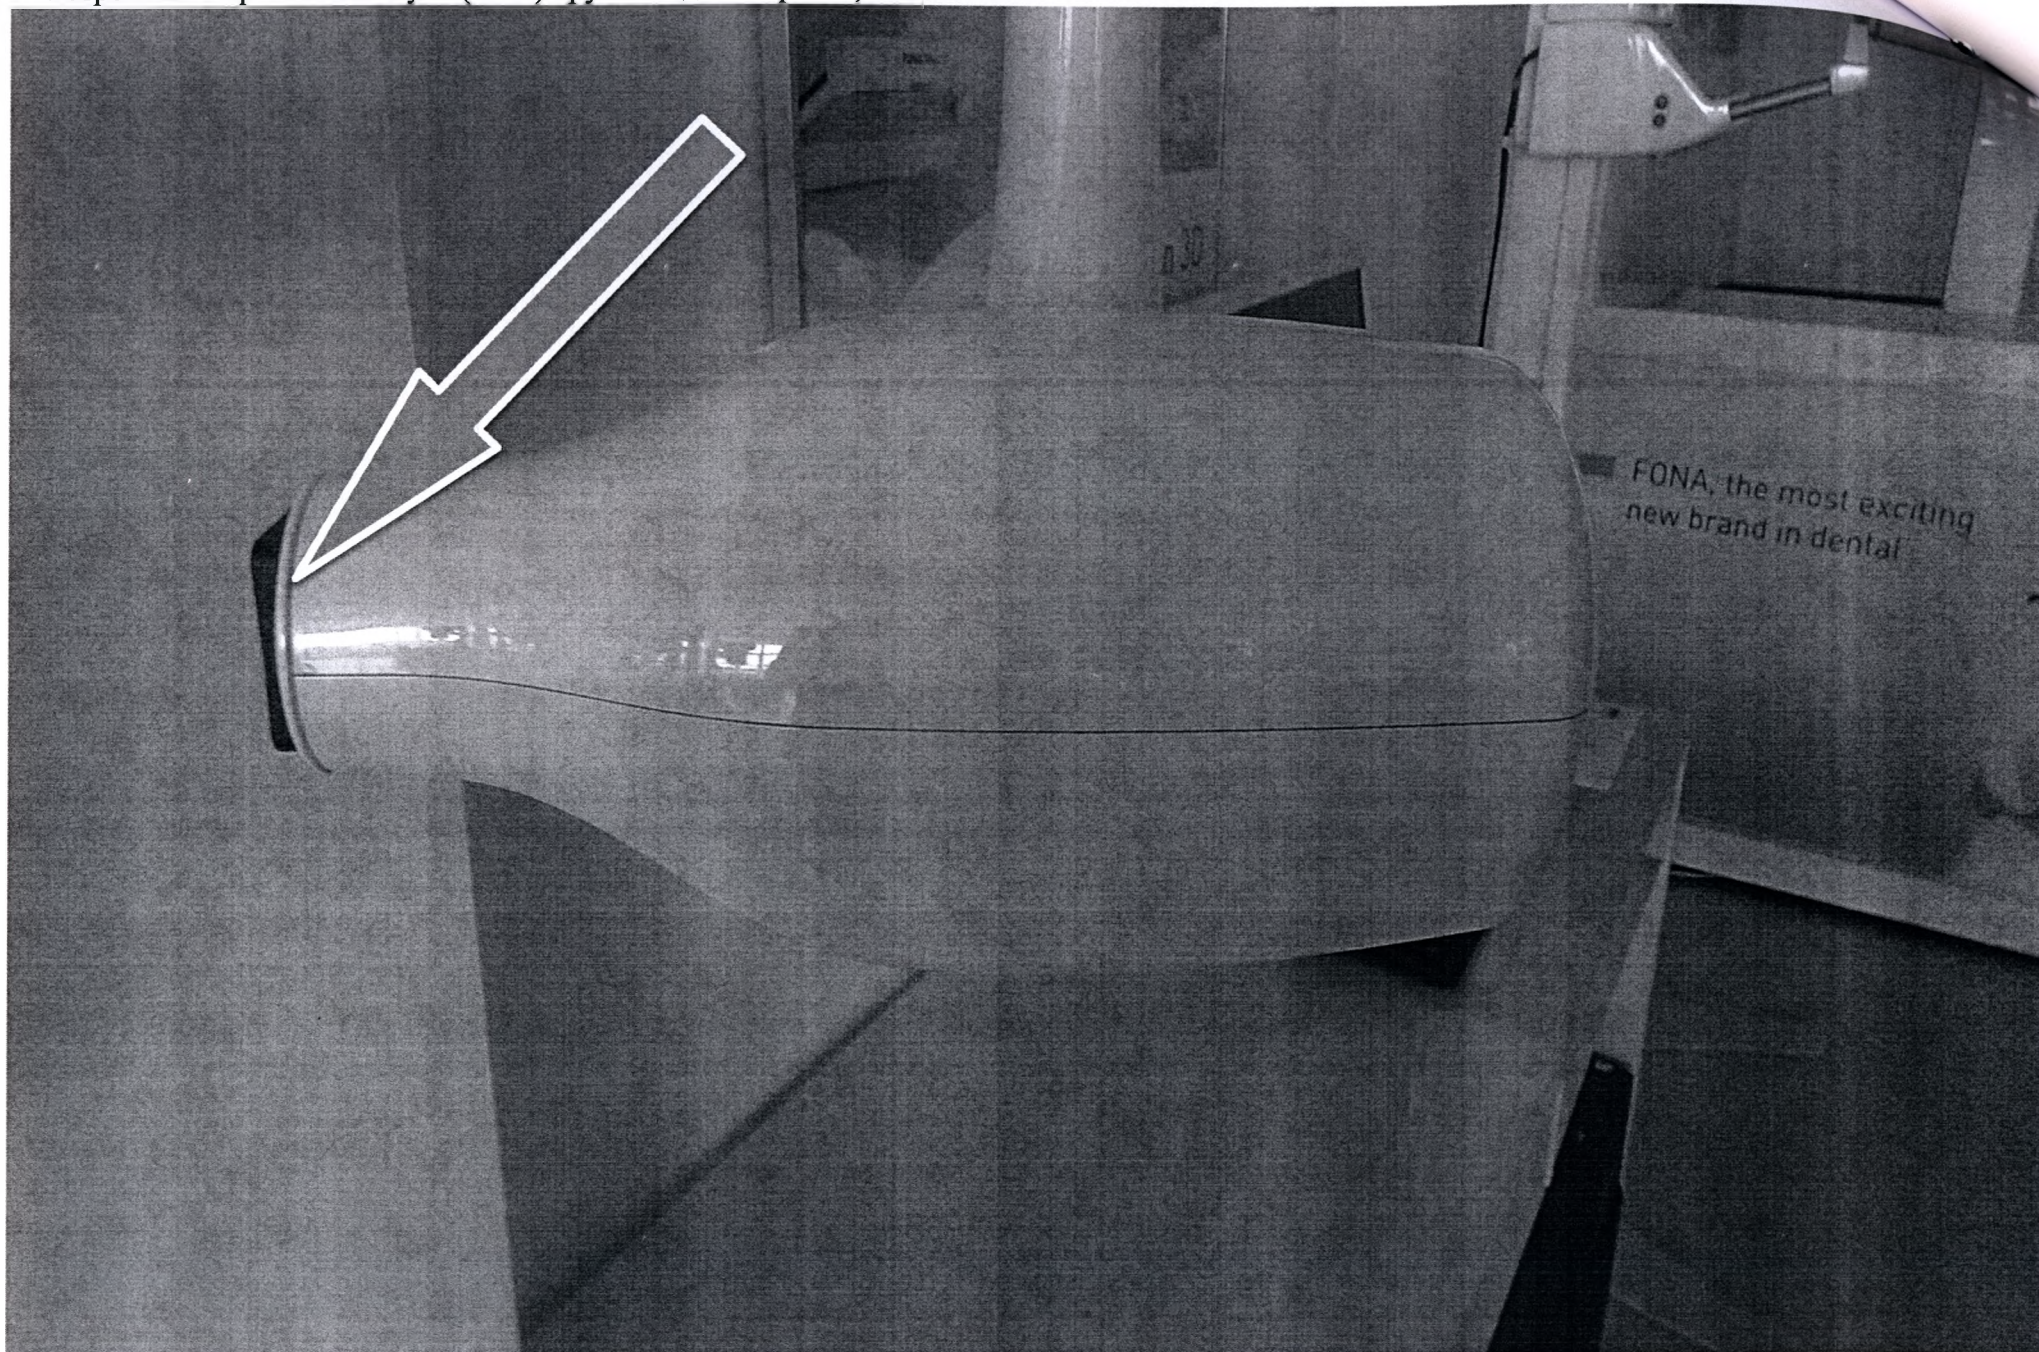

6. Шнур питания

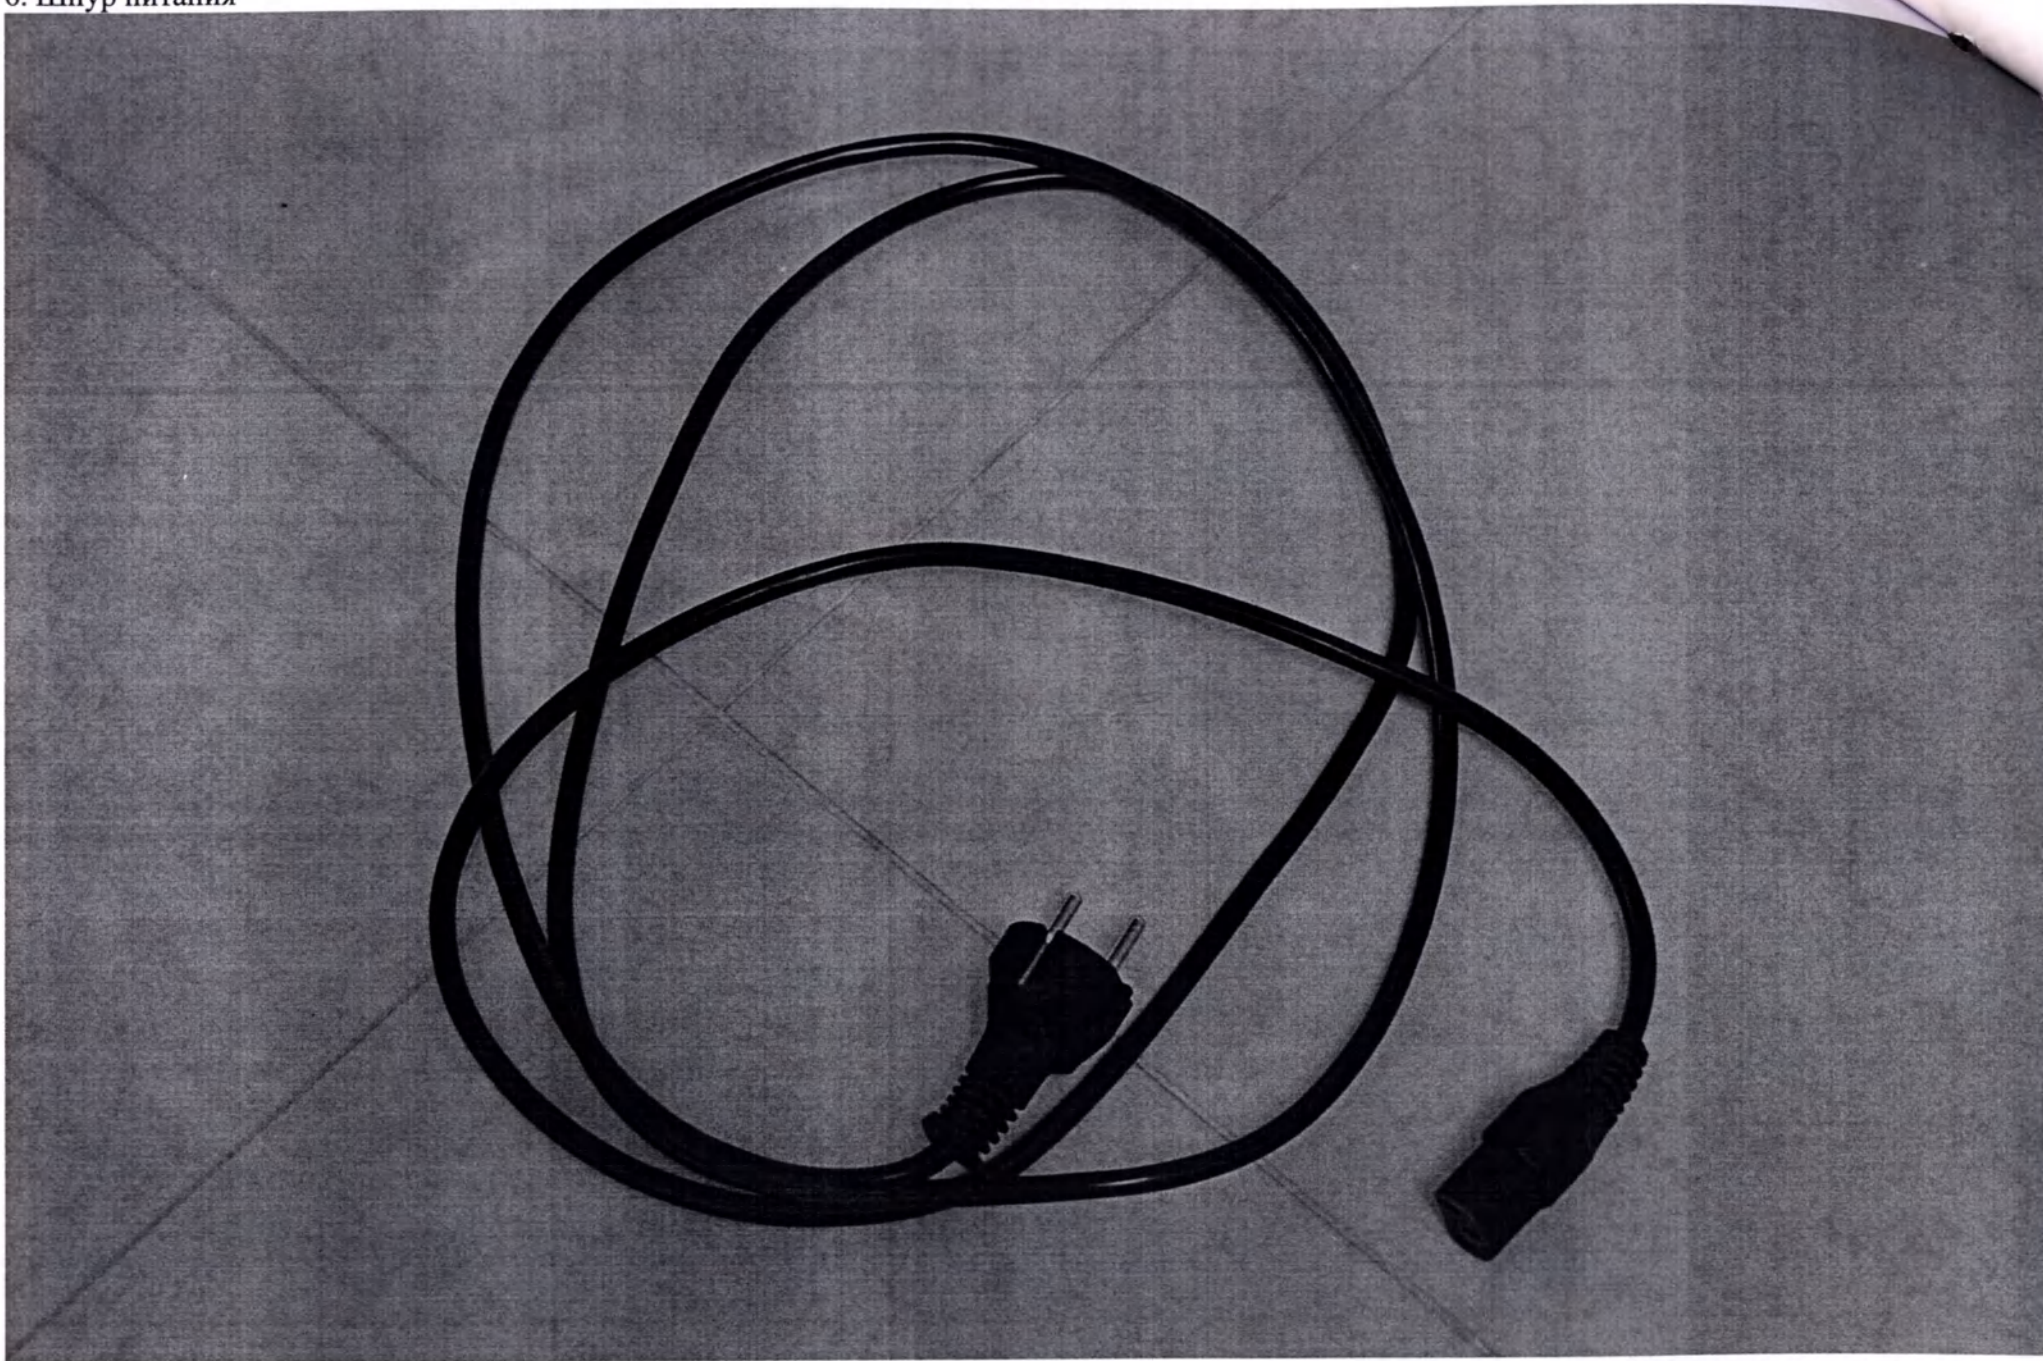

Approved by

/утверждаю/

Managing Director

/Генеральный директор /

FONA S.r.l., Italy,


/ФОНА С.р.л) Италия/

FONA S.r.l.

Via G. Galilei, 11

20090 - PREGATE (MI) - Italy

C.F. e P. IVA 12953700159



Derrick Andrew Colby

/Деррик Эндрю Колби/


October 20th, 2015

Руководство по эксплуатации медицинского изделия


Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC с принадлежностями,
FONA S.r.l., Italy (ФОНА С.р.л.), Италия

2015


1

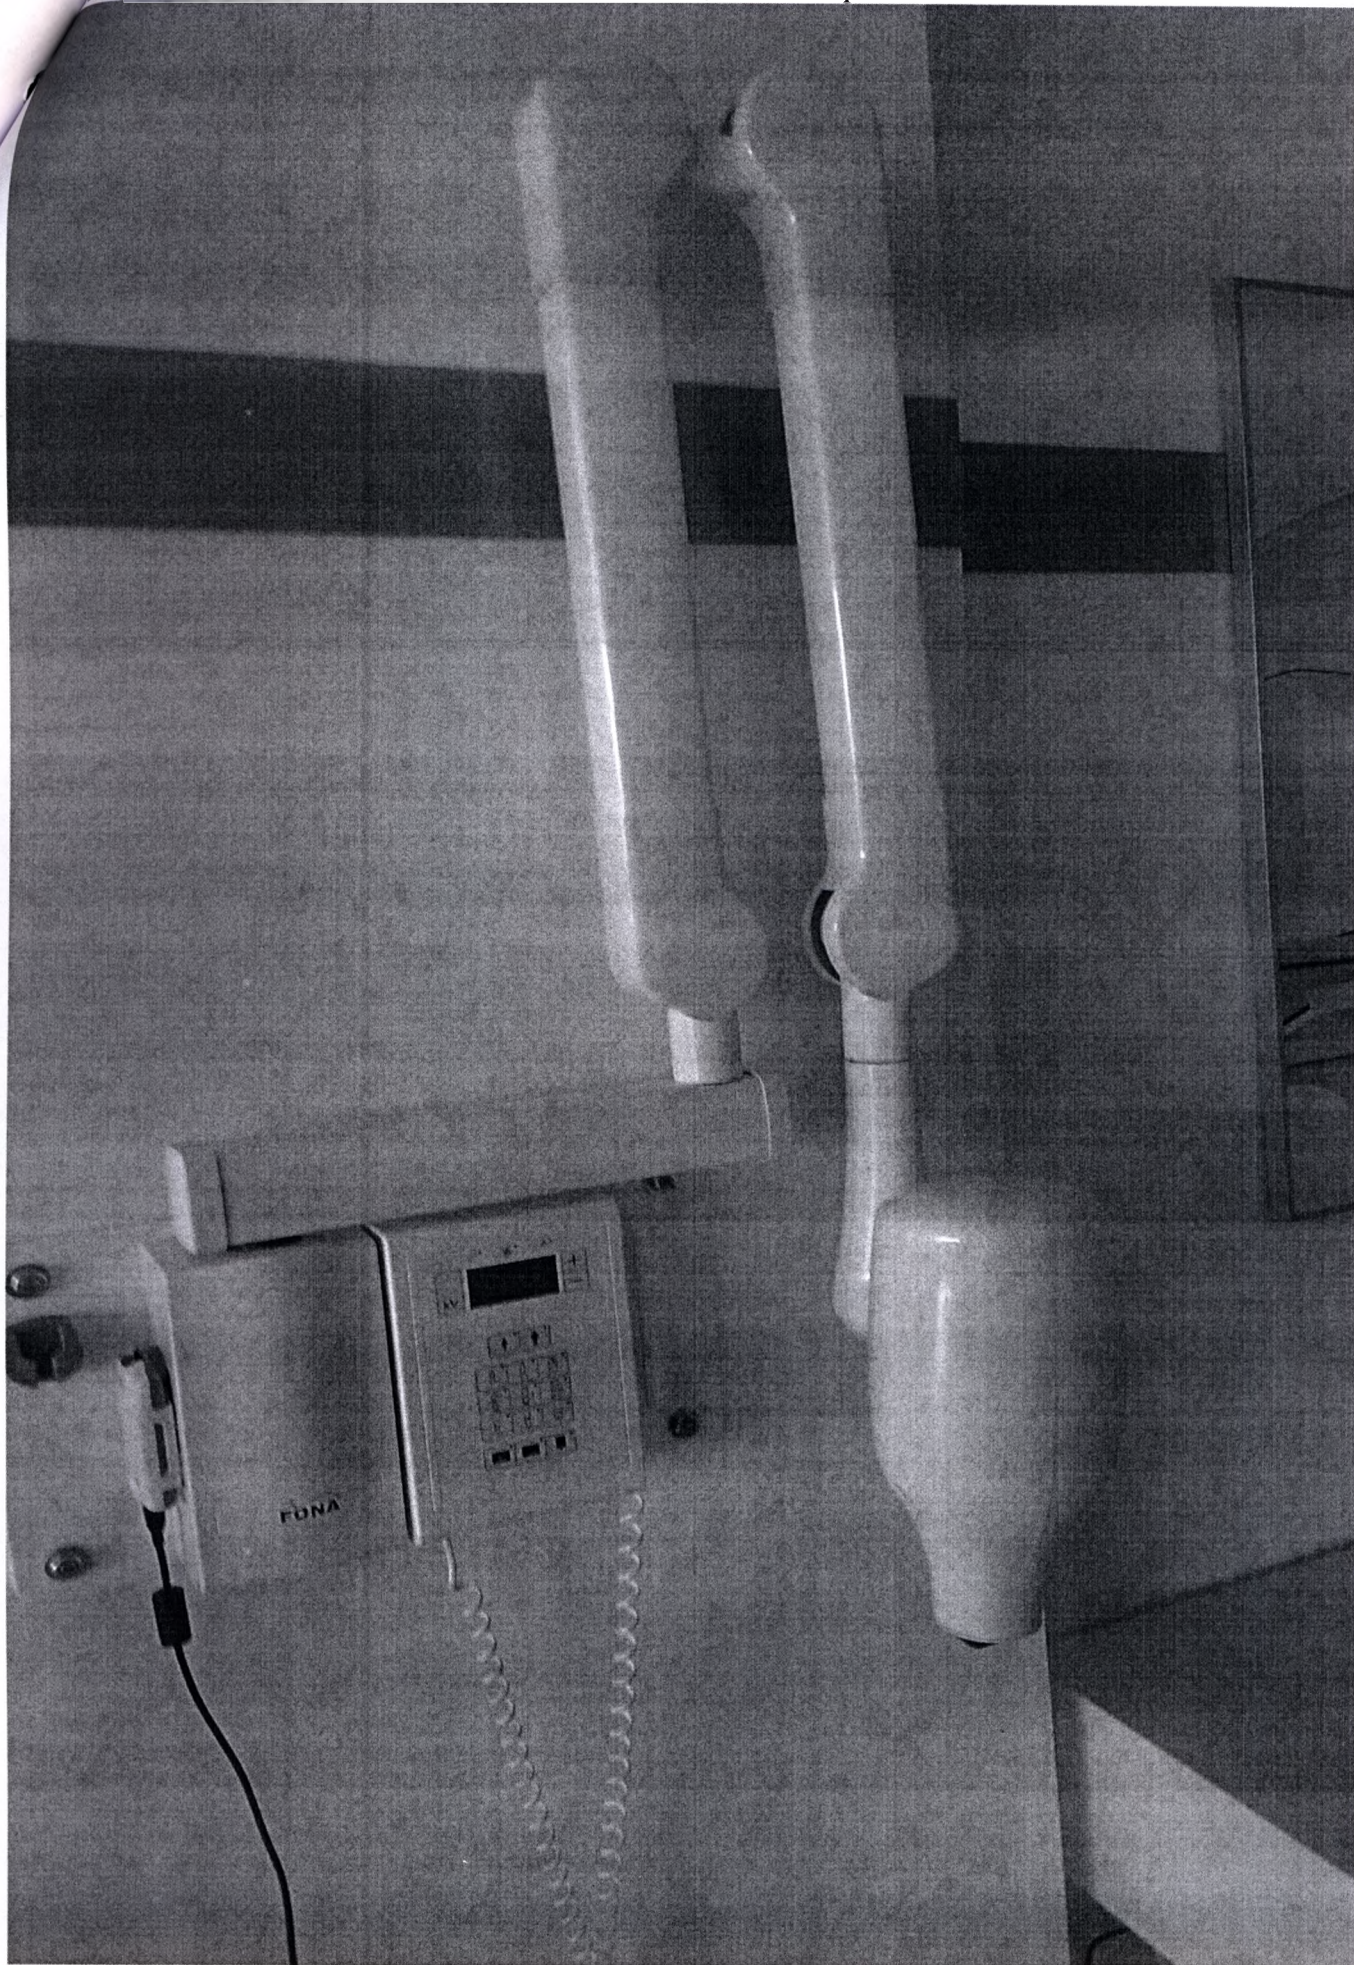

1. Моноблок рентгеновский дентальный

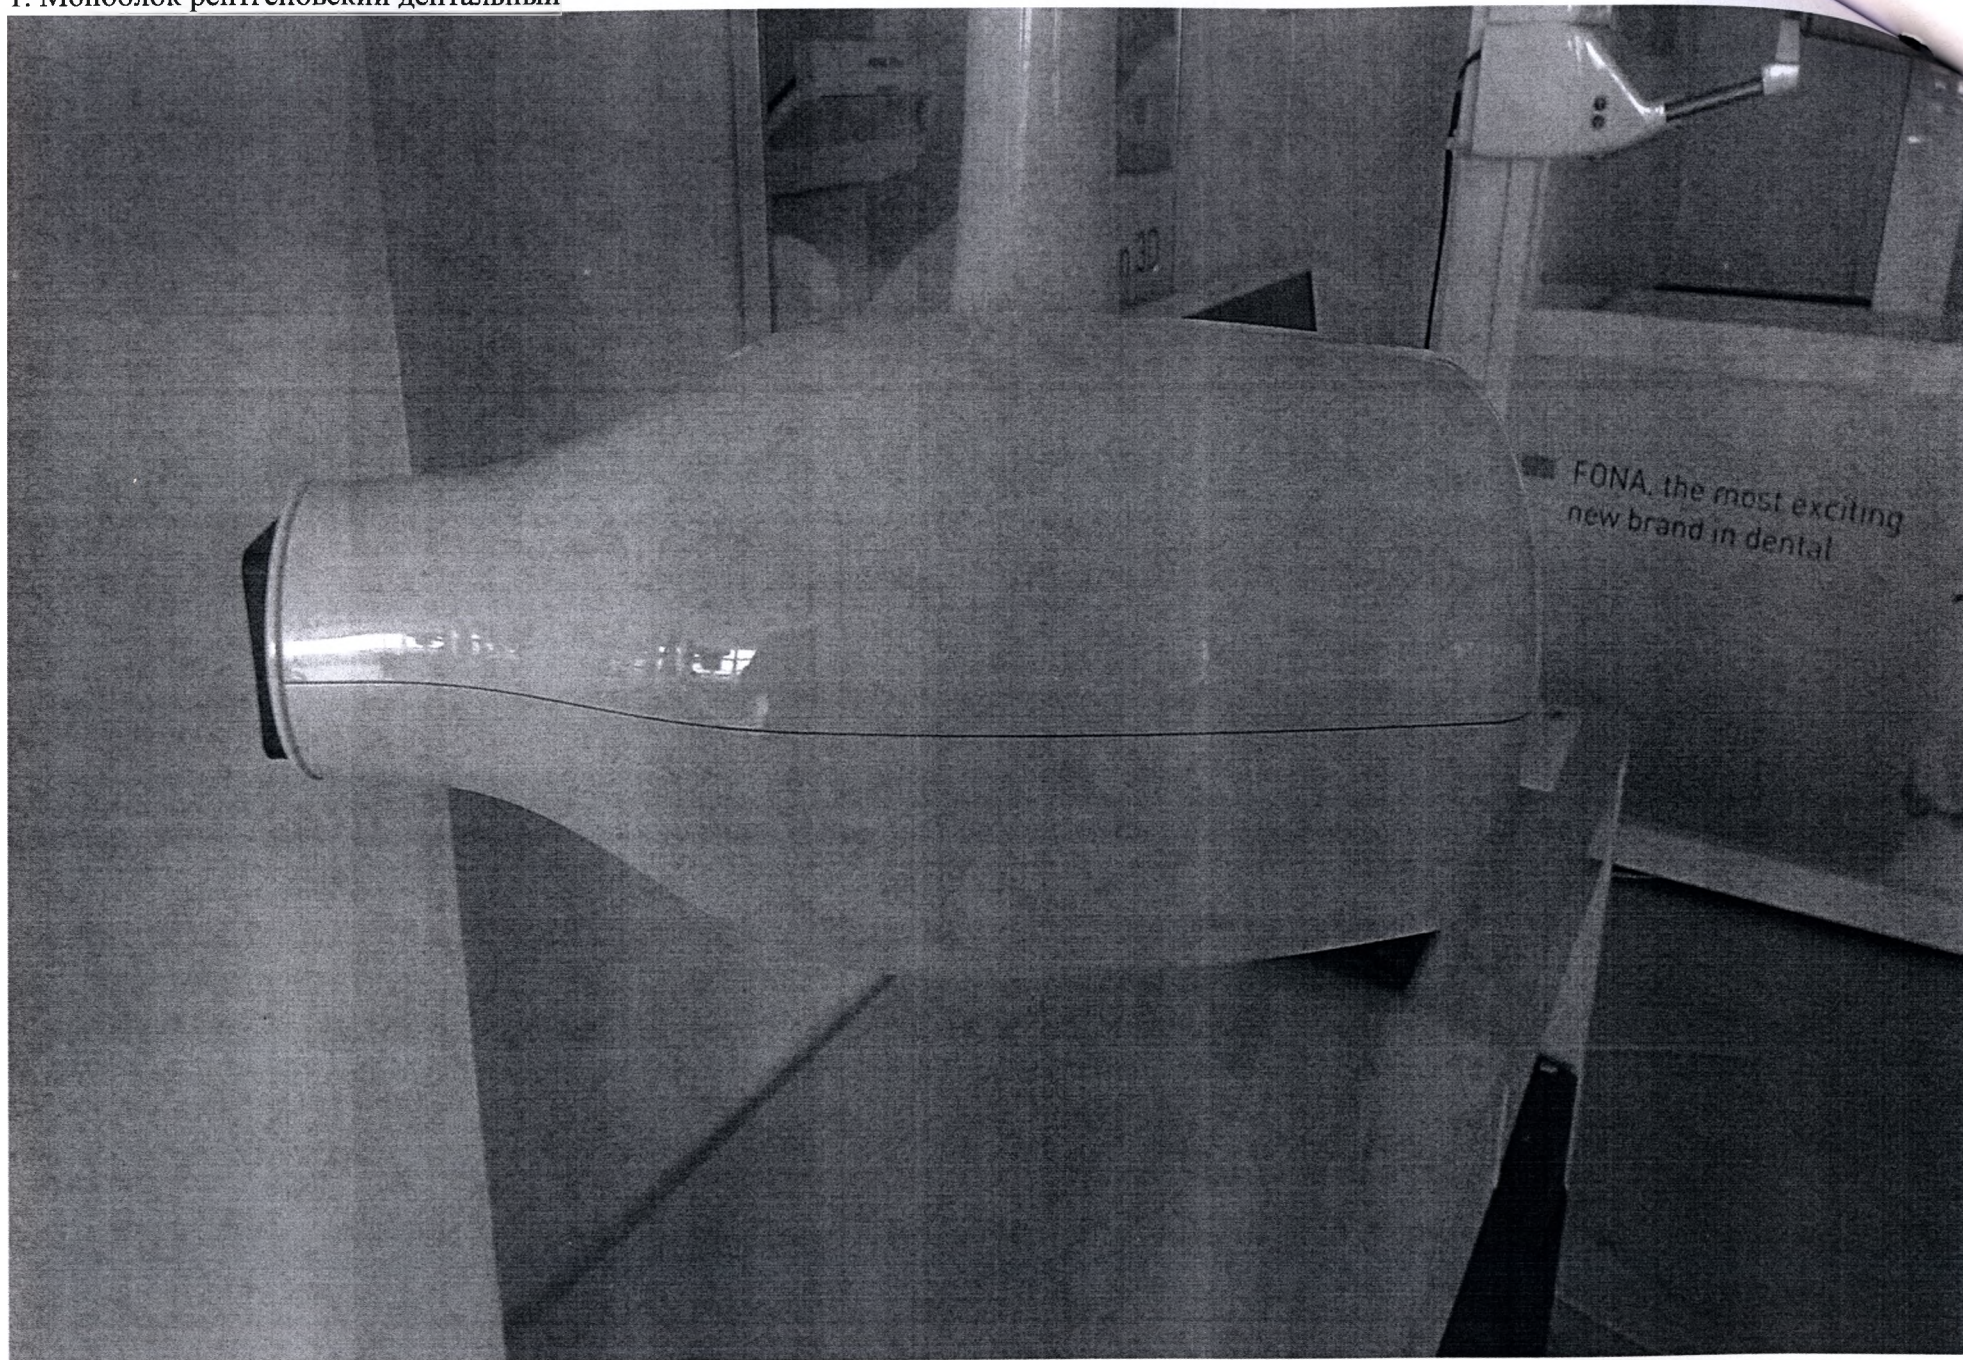


2. Блок управления

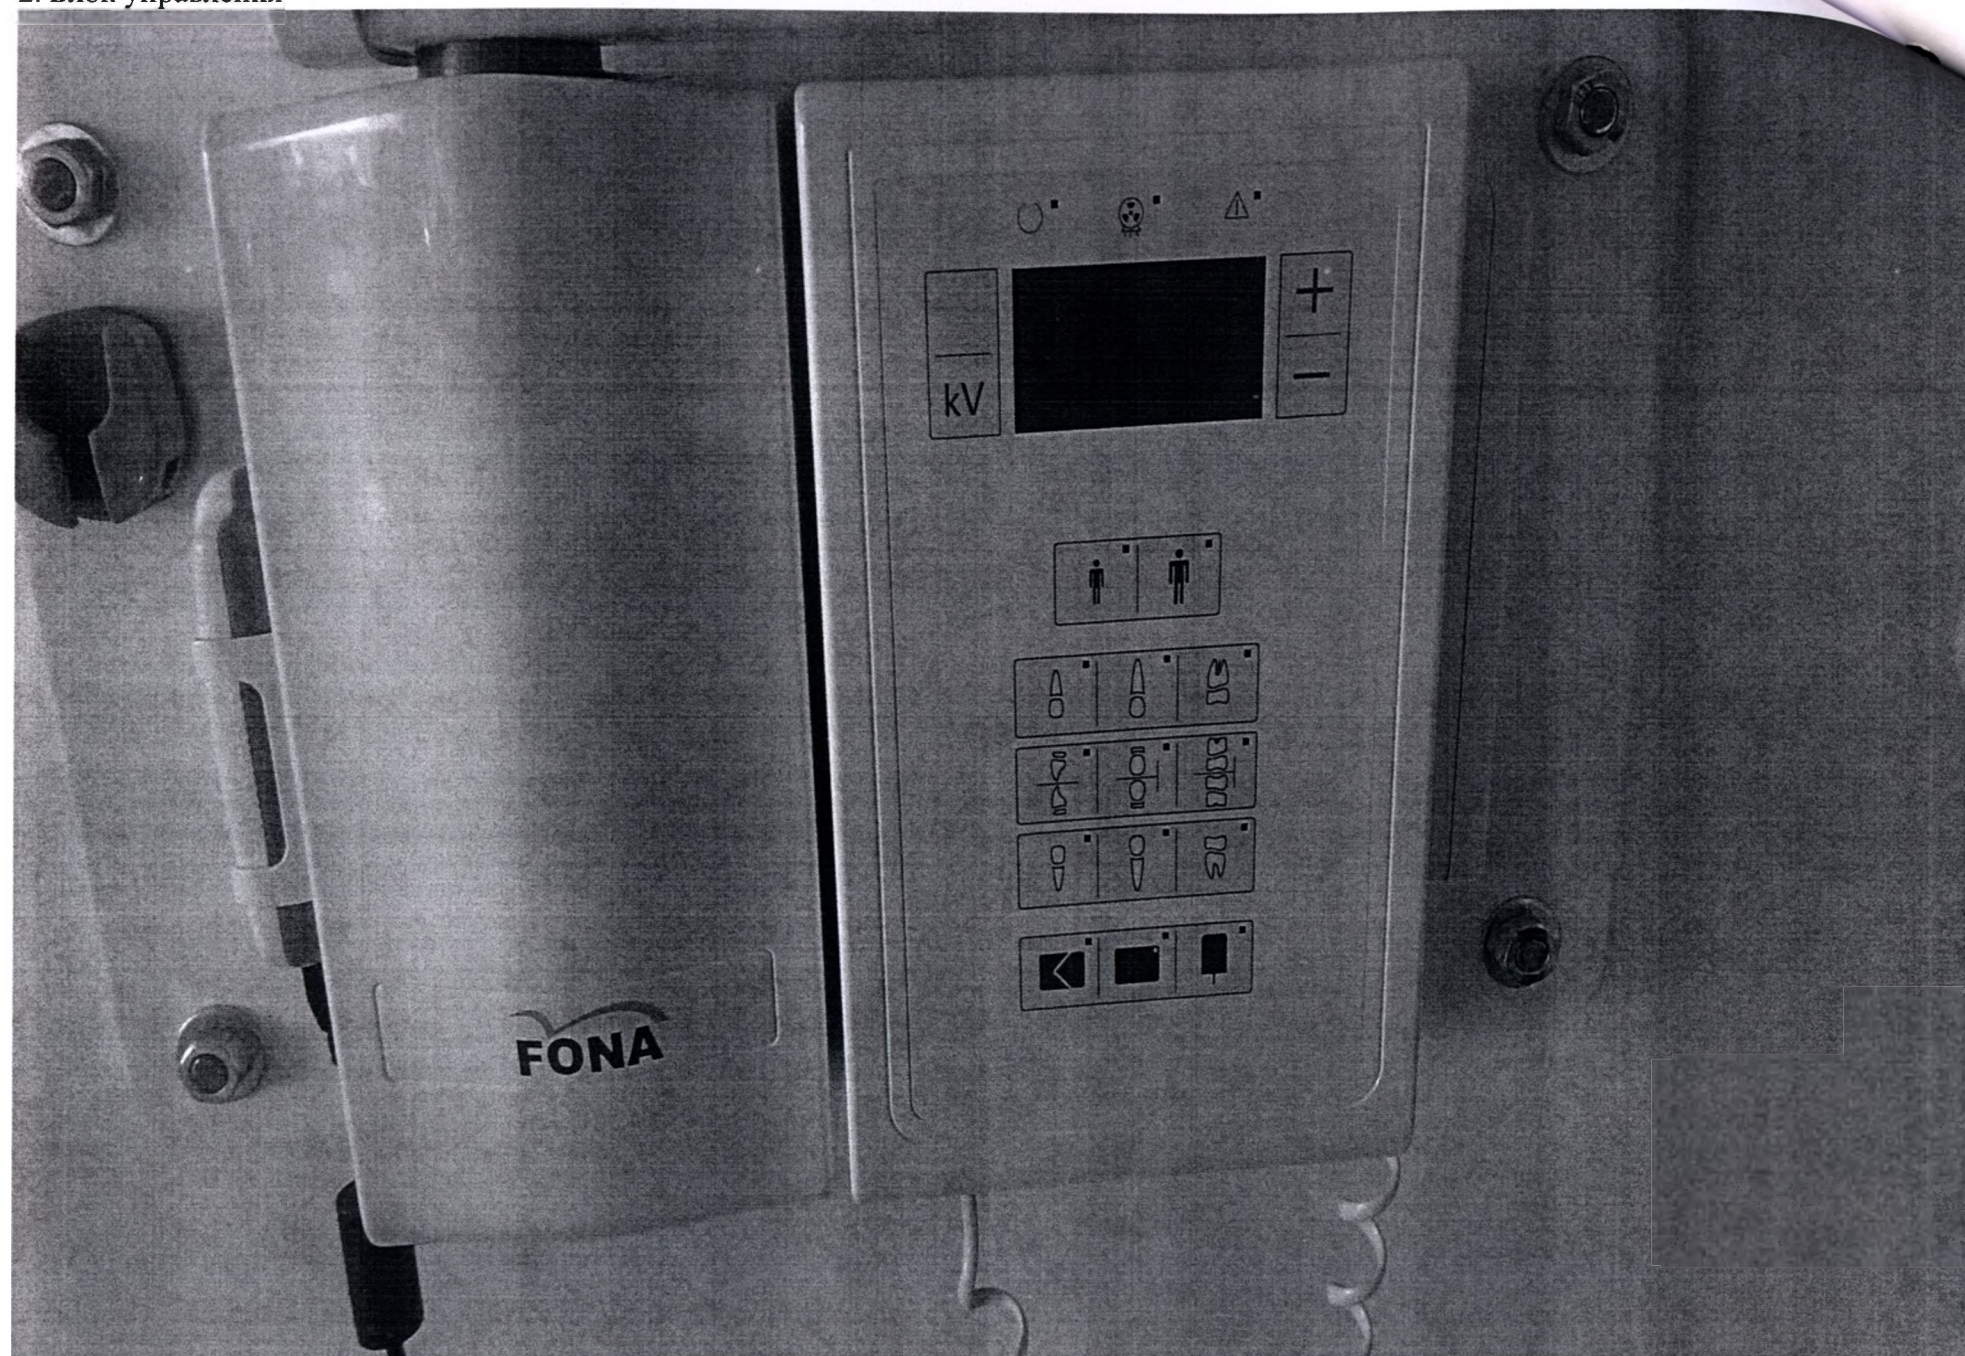





Адаптив настенный с длиной манипулятора размера S (короткий) 30 см. или размера М (Средний) 80 см. или размера L (длинный) 80см. или размера XL (очень длинный) 100см.

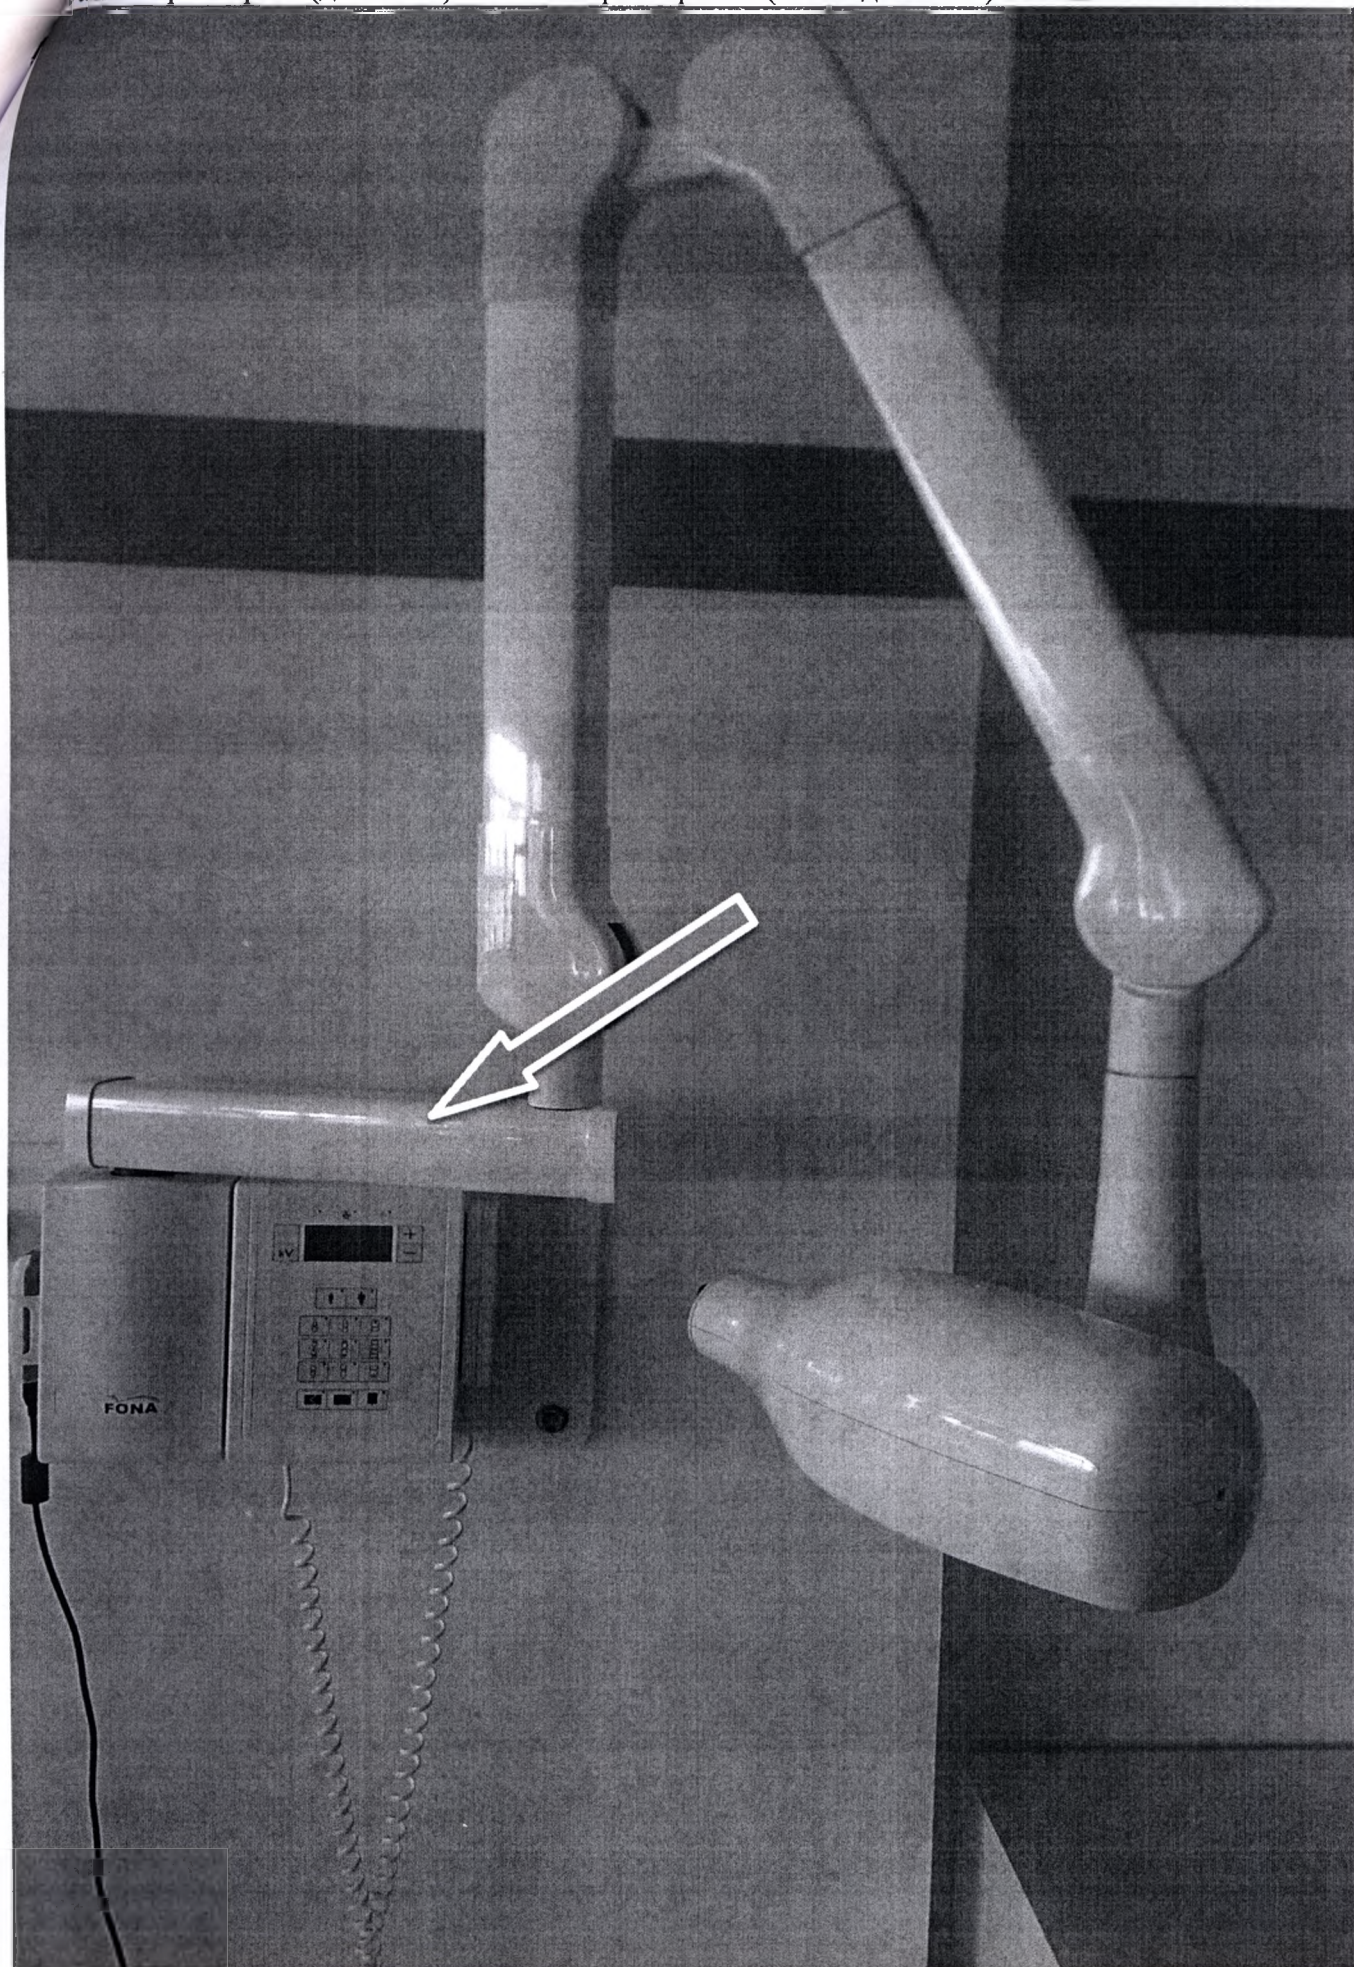

5. Устройство ограничения луча (BLD) круговое диаметром 5,8 см

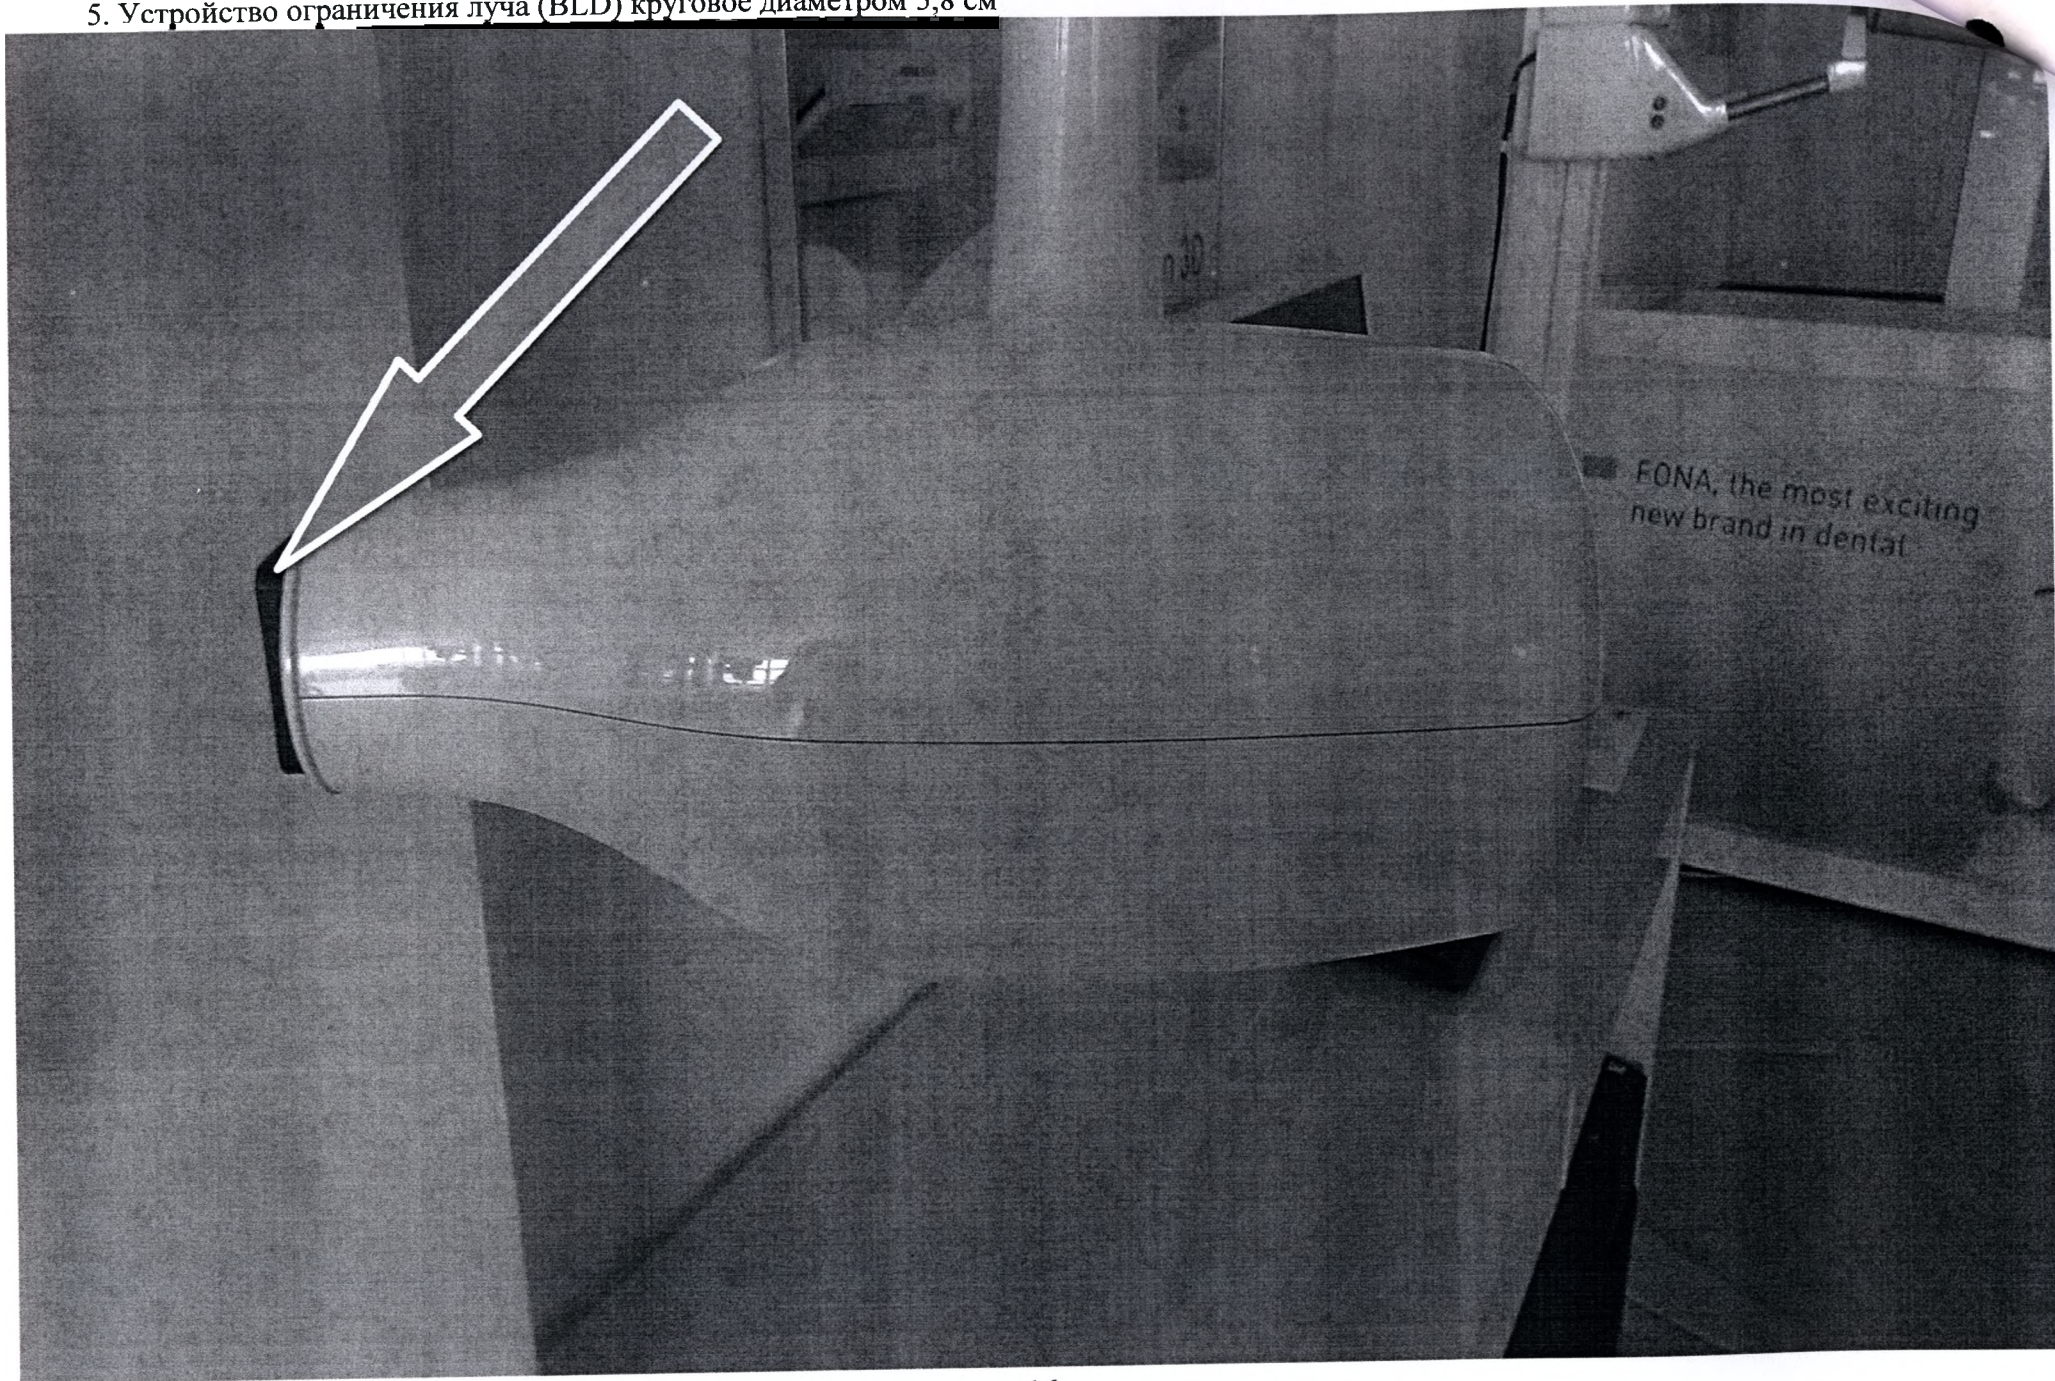


6. Шнур питания

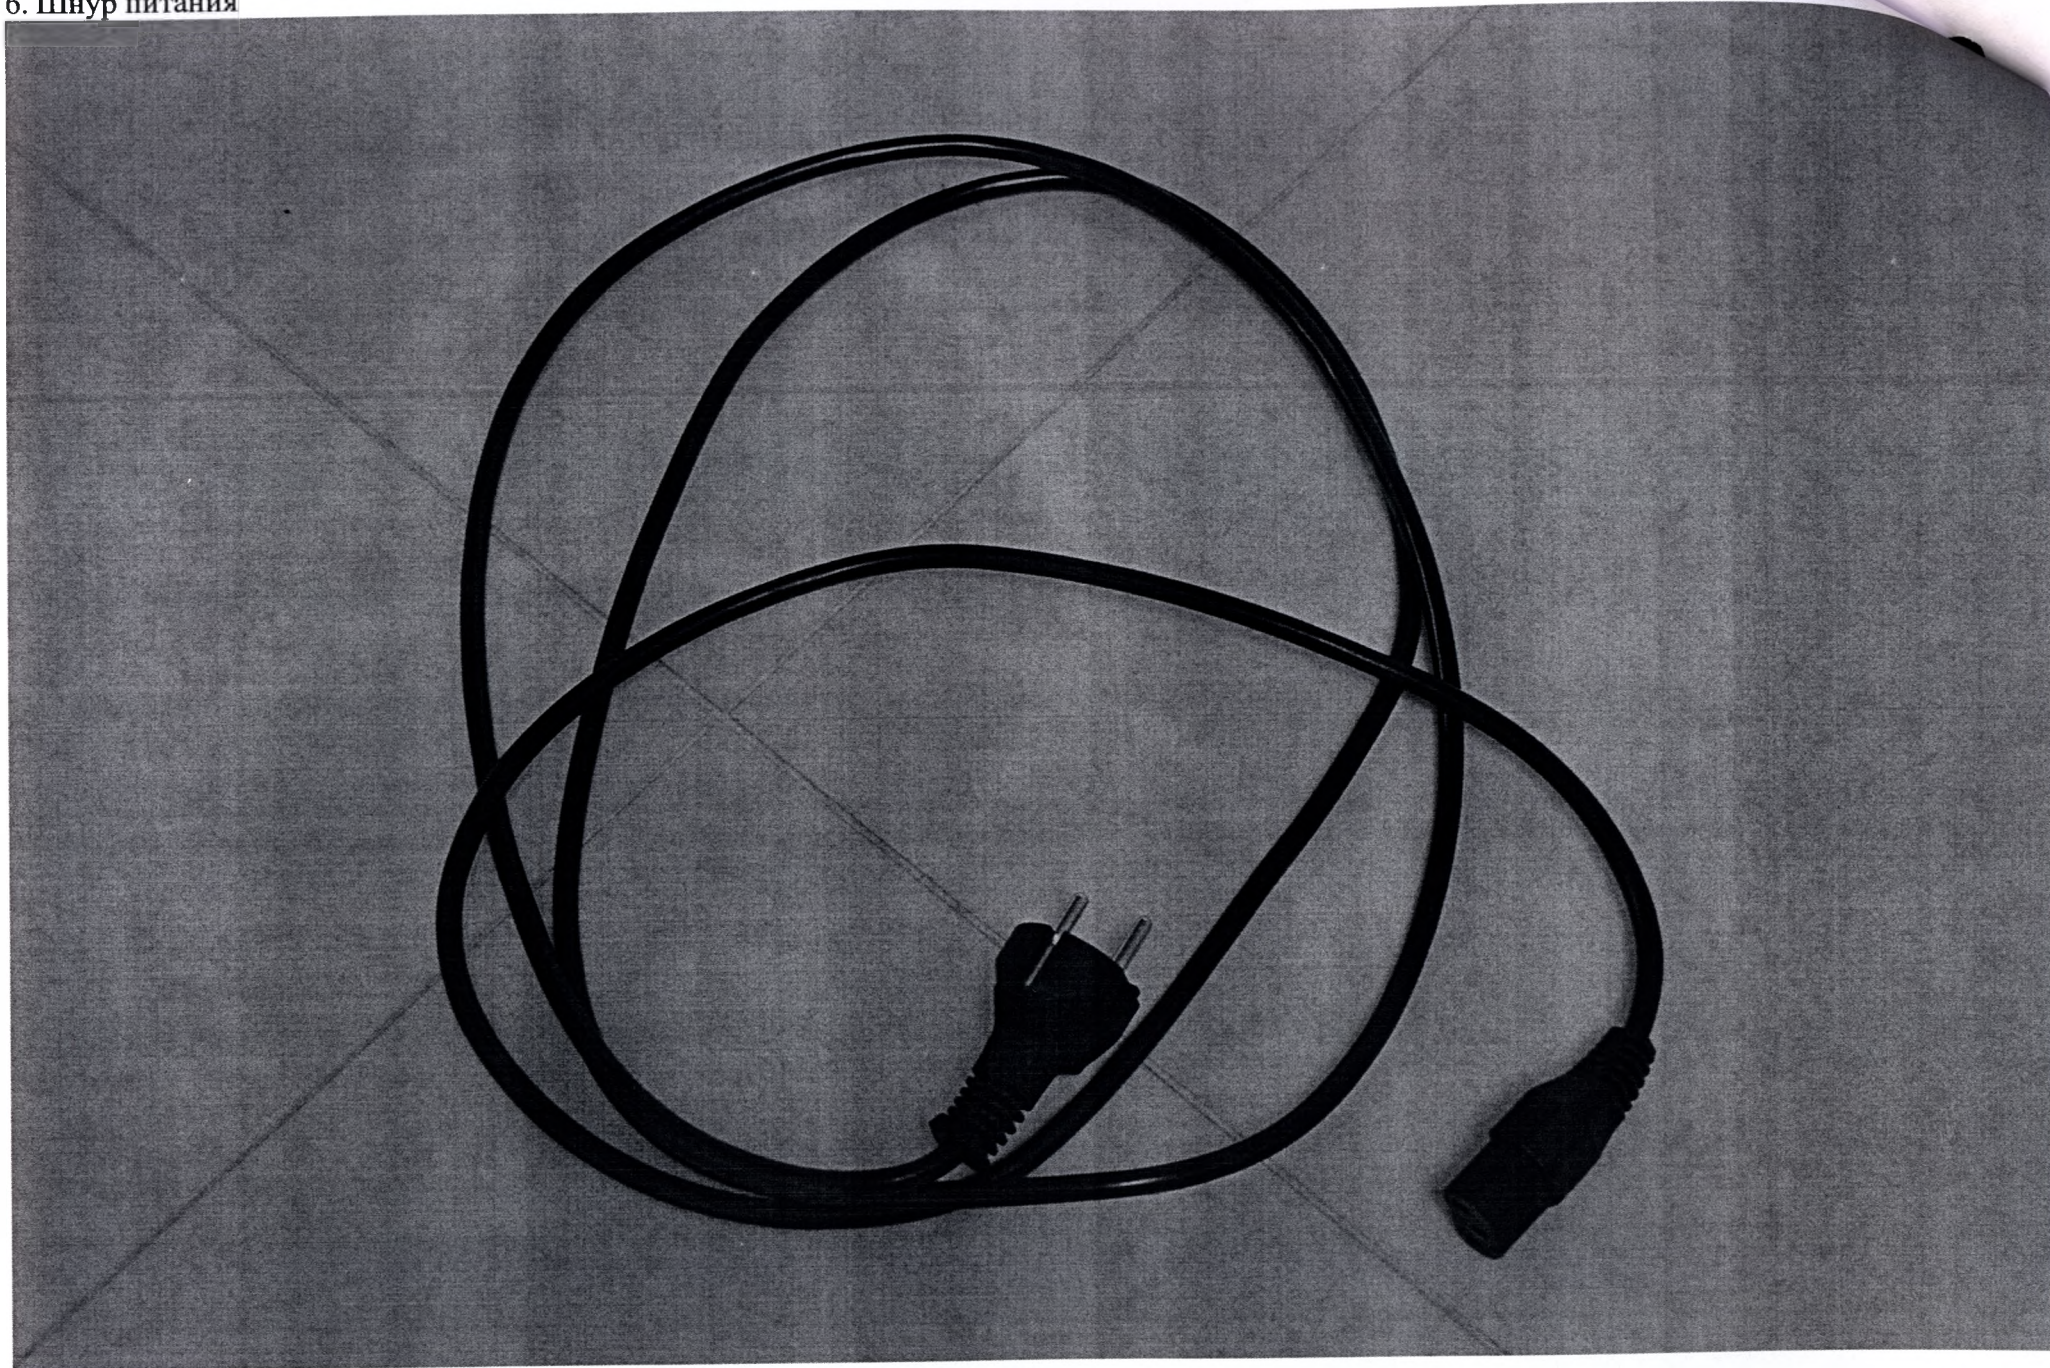

Approved by
/утверждаю/
Managing Director
/Генеральный директор /
FONA S.r.l., Italy,
/ФОНА С.р.л) Италия/

FONA S.r.l.
Via G. Galilei, 11
20090, Arcore (MI) - Italy
C.F. e P. IVA 12953700159



Derrick Andrew Colby
/Деррик Эндрю Колби/

October 20th, 2015

Руководство по эксплуатации медицинского изделия

Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC с принадлежностями,
FONA S.r.l., Italy (ФОНА С.р.л.), Италия

2015

1

FONA XDC



TYPE 9319001700

SN 2908DR0028

100-240 V 50-60 Hz Max 6 A 690 VA



0051

This product complies with DHS
performance standard 21 CFR
Subchapter J in effect at the time
of manufacture.



08-2013



FONA SRL
Via Idiommi 1/8-33
Assago Italy

WALL ADAPTOR XDC


TYPE 9319011000

SN 2906WA0033





2. Устройство ограничения луча (BLD) размер 0, прямоугольное размером 2,2 x 3,2 см

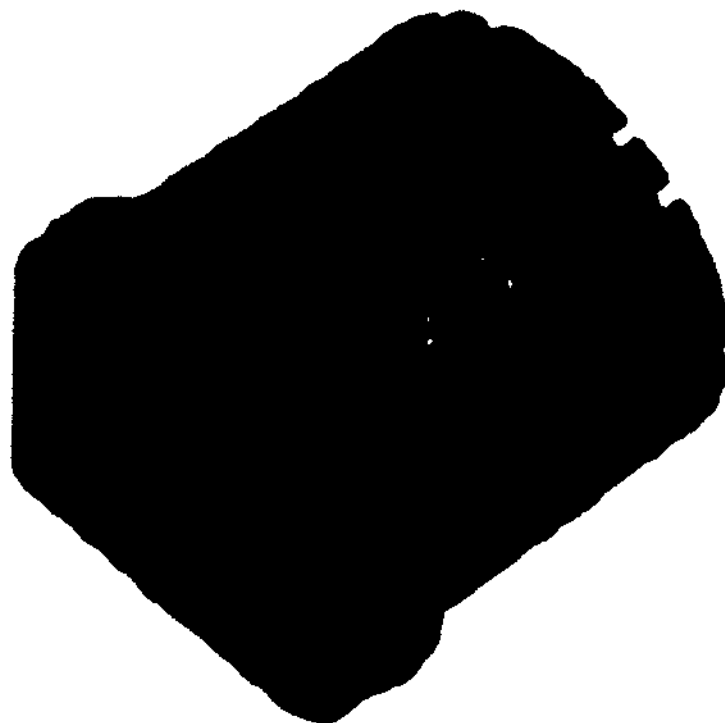

3. Расширения тубуса на 10 см.



Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC с принадлежностями

I Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC, мобильный

1. Моноблок рентгеновский дентальный
2. Блок управления
3. Пульс управления
4. Штатив мобильный
5. Устройство ограничения луча (BLD) круговое диаметром 5,8 см
6. Шнур питания
7. Руководство по эксплуатации

II Аппарат рентгеновский дентальный FONA XDC, стационарный

1. Моноблок рентгеновский дентальный
2. Блок управления
3. Пульс управления
4. Штатив настенный с длиной манипулятора размера S (короткий) 30 см или размера M (Средний) 60см или размера L (длинный) 80 см или размера XL (очень длинный) 100 см
5. Устройство ограничения луча (BLD) круговое диаметром 5,8 см
6. Шнур питания
7. Руководство по эксплуатации

III Принадлежности

1. Устройство ограничения луча (BLD) размер 2, прямоугольное 3,2 x 4,4 см
2. Устройство ограничения луча (BLD) размер 0, прямоугольное размером 2,2 x 3,2 см
3. Расширения тубуса на 10 см.

Генеральный директор
(должность)



Л.Б. Бронникова
(И.О.Фамилия)

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист (ов)

Л.Б. Бронникова

