


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для определения ДНК цитомегаловируса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 1))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
10 2019 г.



е изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения
омегаловируса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 1))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«03» 10 2019 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-1598

набор реагентов для определения
ДНК цитомегаловируса методом
полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК ЦМВ
(комплект 1)

LOT 6395

СОСТАВ:

LOT

- | | | | |
|--|--------|-----------|------|
| 1. Положительный контрольный образец универсальный | 1 пр. | 1 мл | 93 |
| 2. Готовая реакционная смесь для ПЦР | 96 пр. | | 6395 |
| Принадлежности: | | | |
| Оптическая плёнка | | 1,5 листа | |
| Вкладыш с информацией о концентрации ДНК ЦМВ в ПКО универсальном | | 1 шт. | |

ТУ 9398-538-23548172-2016
ПУ № РЗН 2017/5536 от 22.03.2017

изображение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения
мегаловируса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 1))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» _____ Хусаинов М.Д.
«01» _____ 2019 г.

BEKTOP


БЕСТ

REF

D-1598


LOT

6395



IVD

Σ 96



2019-07-01

2020-07-01

**РеалБест ДНК ЦМВ
(комплект 1)**




15980107200639500411




Для профессионального применения

...ображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения
...егаловируса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 1))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«03» 10 2019 г.

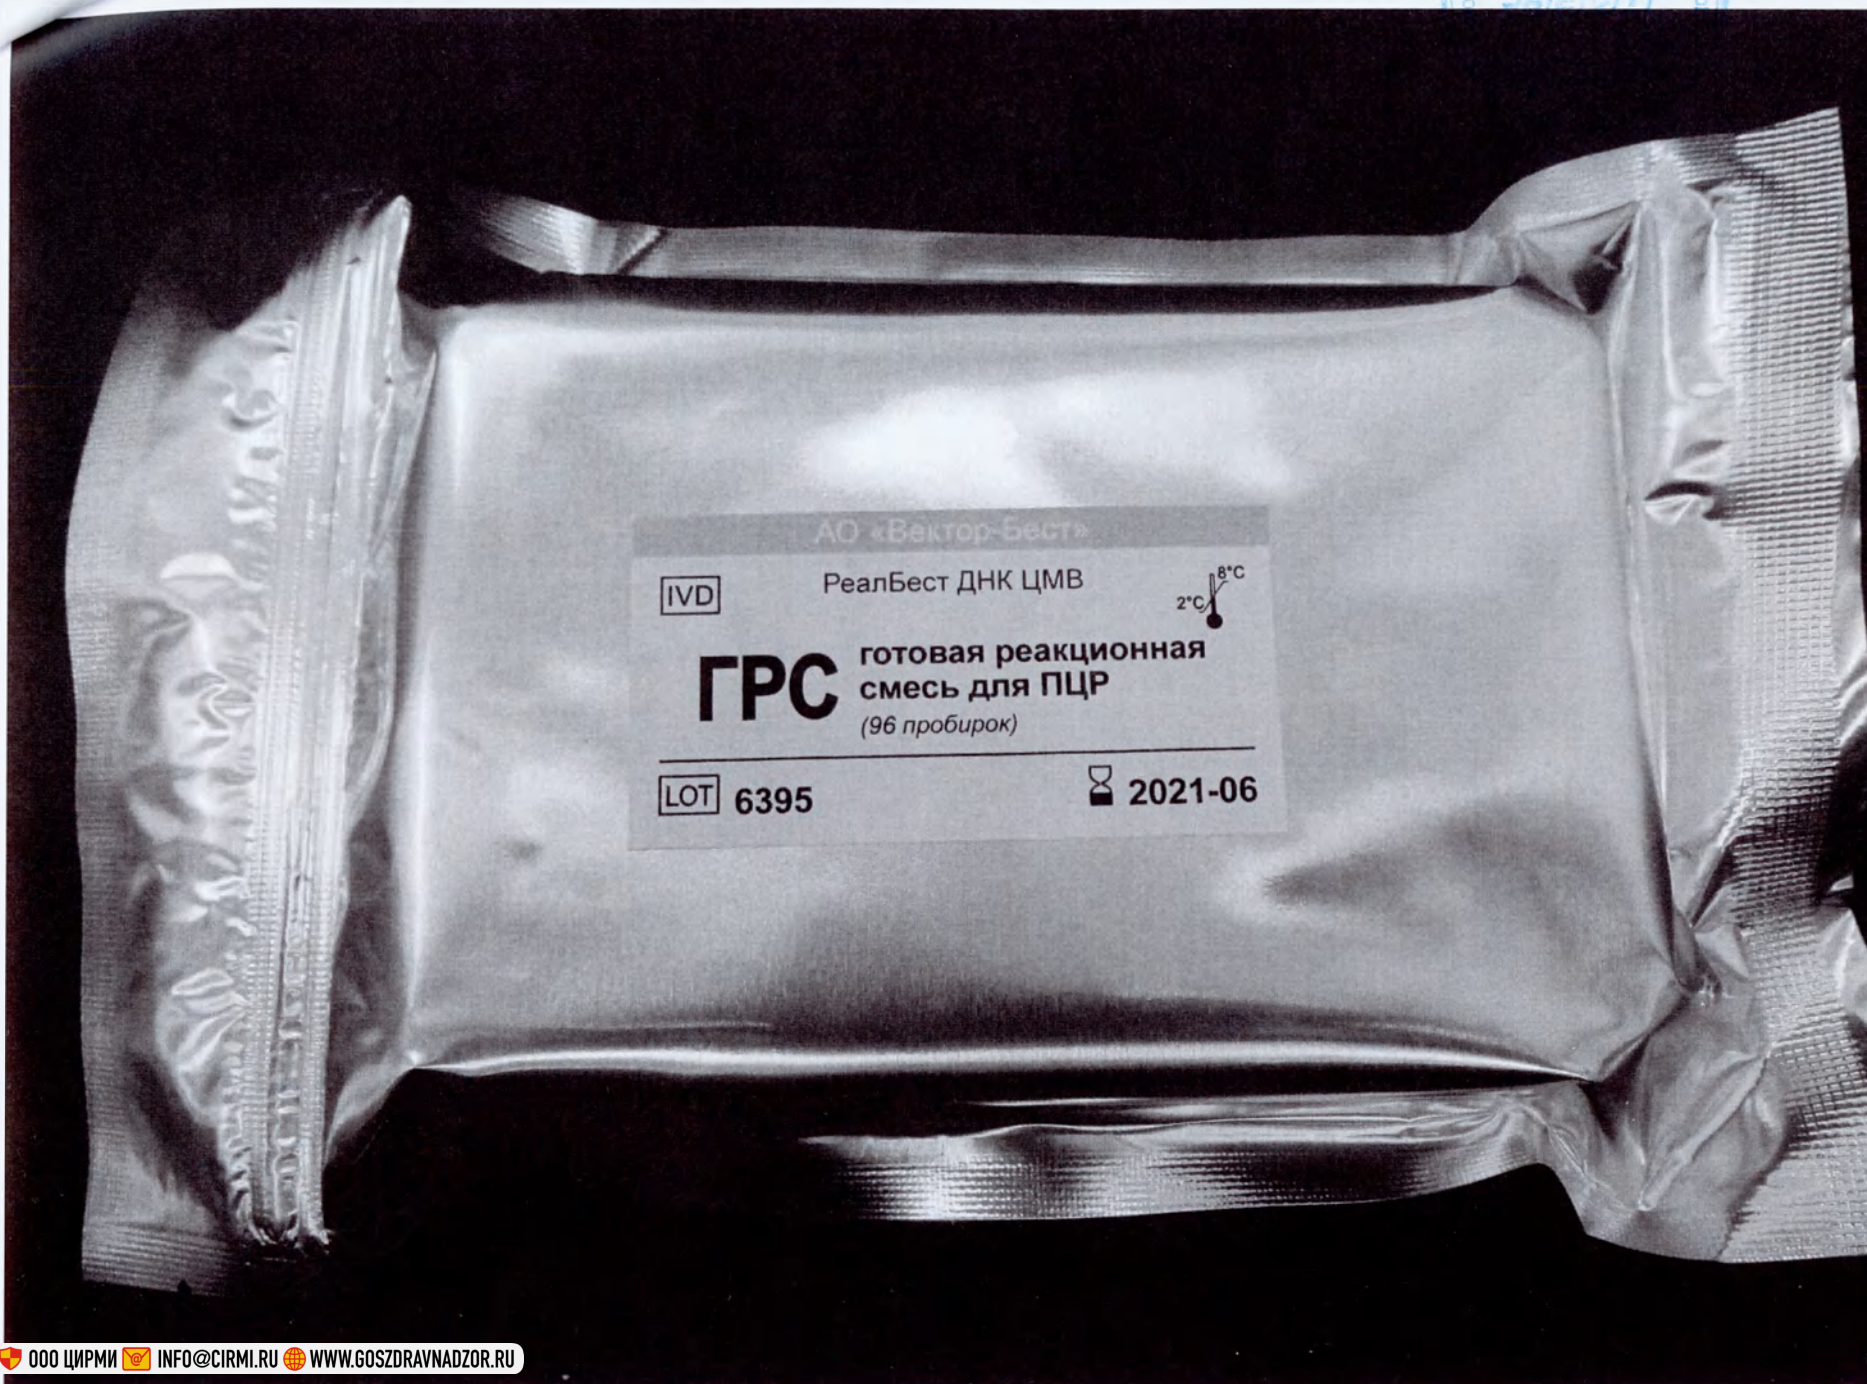






Хусаинов М.Д.
«03» 20 2019 г.





«Выявление общего вида медицинского изделия «Набор реагентов для определения
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 2))»

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



10 2019 г.

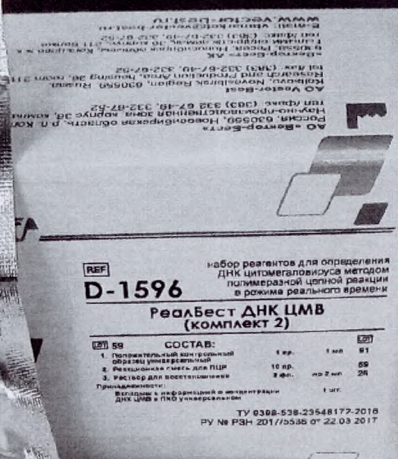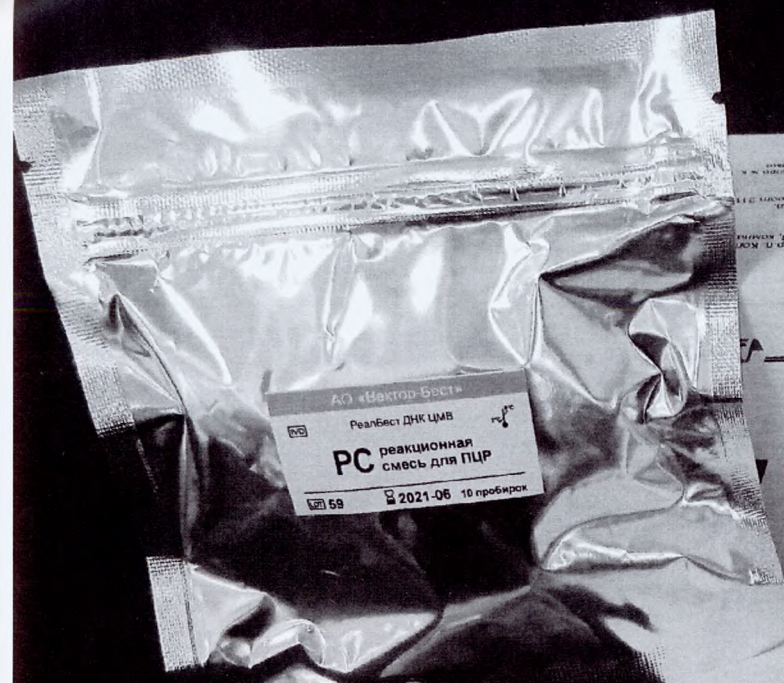

D-1596	
Штрих-код набора 1510000059	
конц-ция, МЕ/мл	штрих-код 151423
4200	
Сt контрольных образцов	
ЛТ-96	Rotor-Gene
26-30	25-29

ВЕКТОР

БЕСТ

REF

D-1596

набор реагентов для определения
ДНК цитомегаловируса методом
полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени

РеалБест ДНК ЦМВ
(комплект 2)

LOT 59

СОСТАВ:

LOT

1. Положительный контрольный образец универсальный	1 пр.	1 мл	91
2. Реакционная смесь для ПЦР	10 пр.		59
3. Раствор для восстановления	2 фл.	по 2 мл	26

Принадлежности:

Вкладыш с информацией о концентрации
ДНК ЦМВ в ПКО универсальном

1 шт.

ТУ 9398-538-23548172-2016
ПУ № РЗН 2017/5536 от 22.03.2017


...ражение упаковки медицинского изделия «Набор реагентов для определения
...методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 2))» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.
«05» 10 2019 г.

REF **D-1596** LOT **59**



IVD

Σ 100



2019-06-27

2020-06-27

РеалБест ДНК ЦМВ
(комплект 2)



15962706200005900019




Для профессионального применения

компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения
вируса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 2))» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



«03» 10 2019 г.

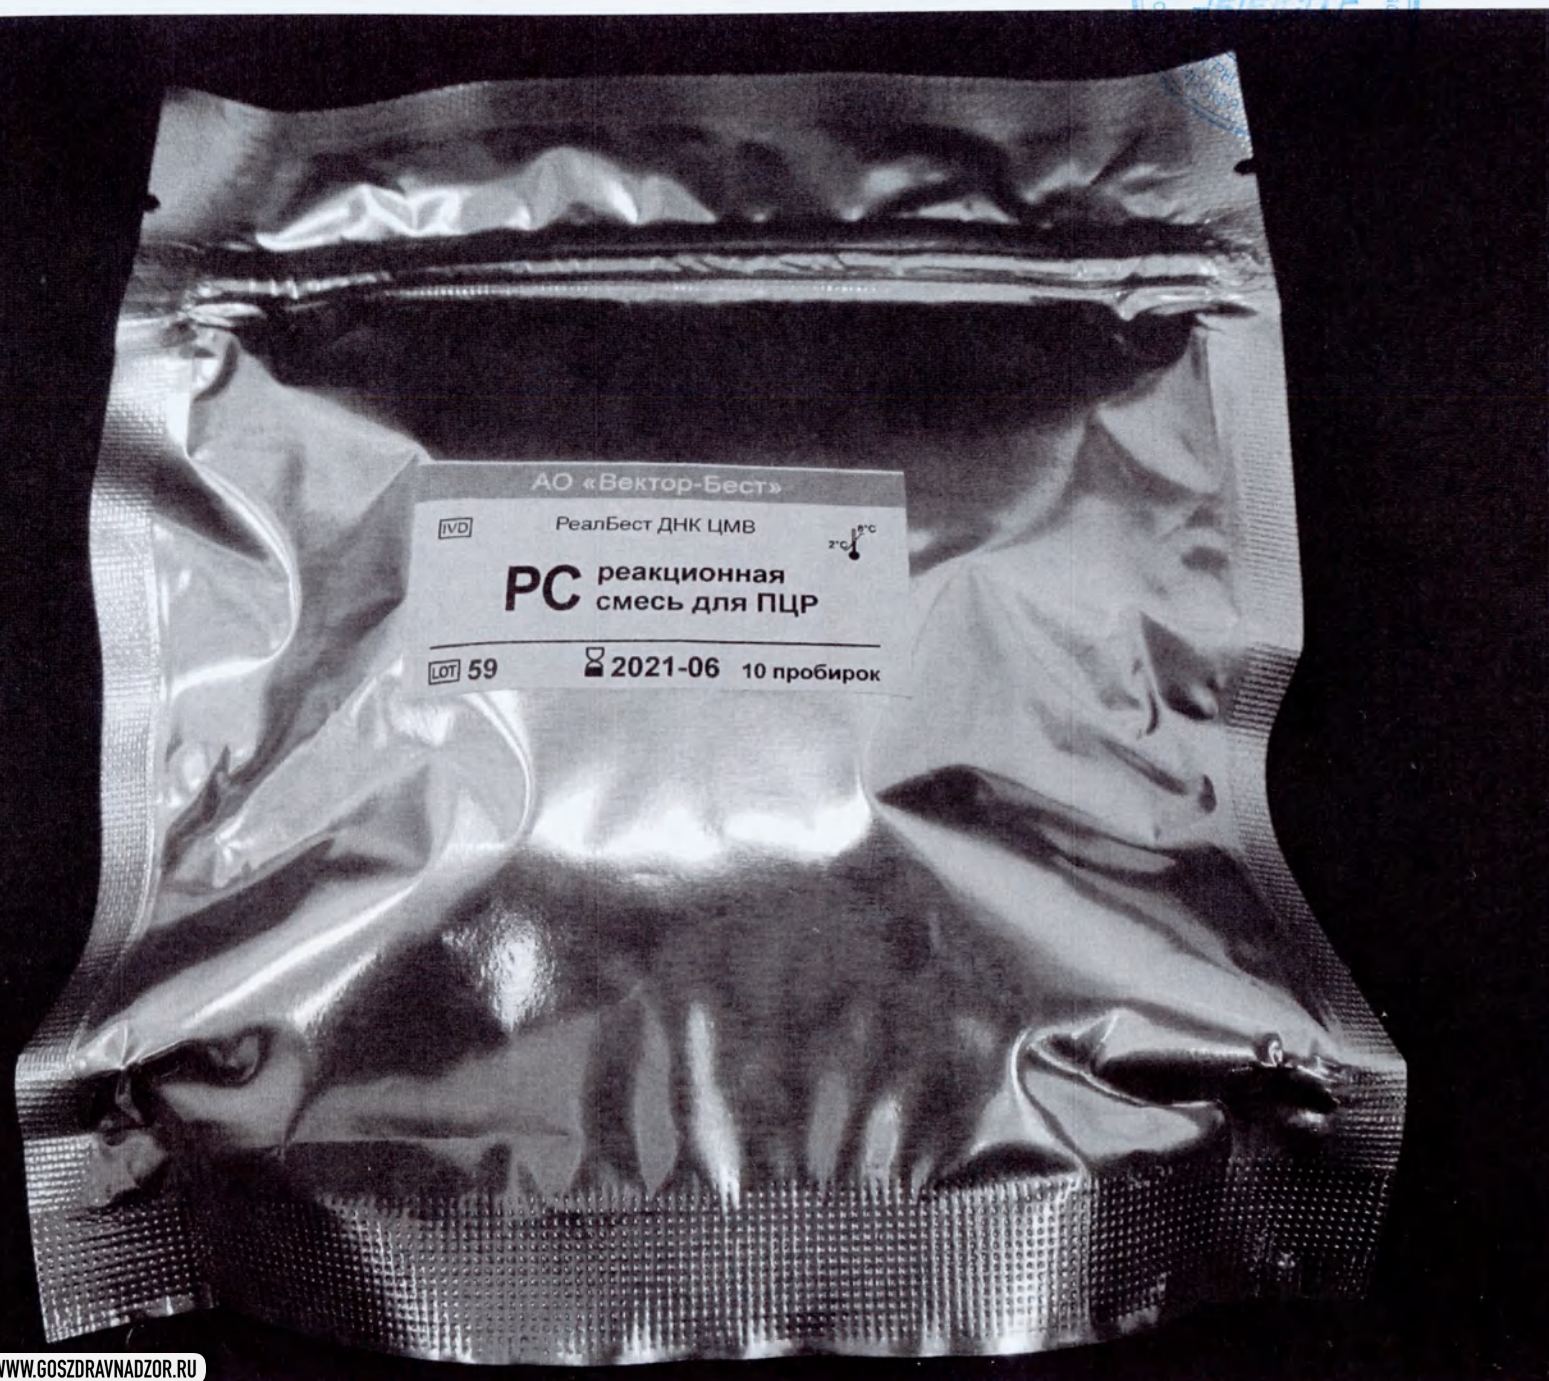



компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения
вируса методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 2))» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.


«03» 10 2019 г.



компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для определения
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
(РеалБест ДНК ЦМВ (комплект 2))» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.
«03» 10 2019 г.

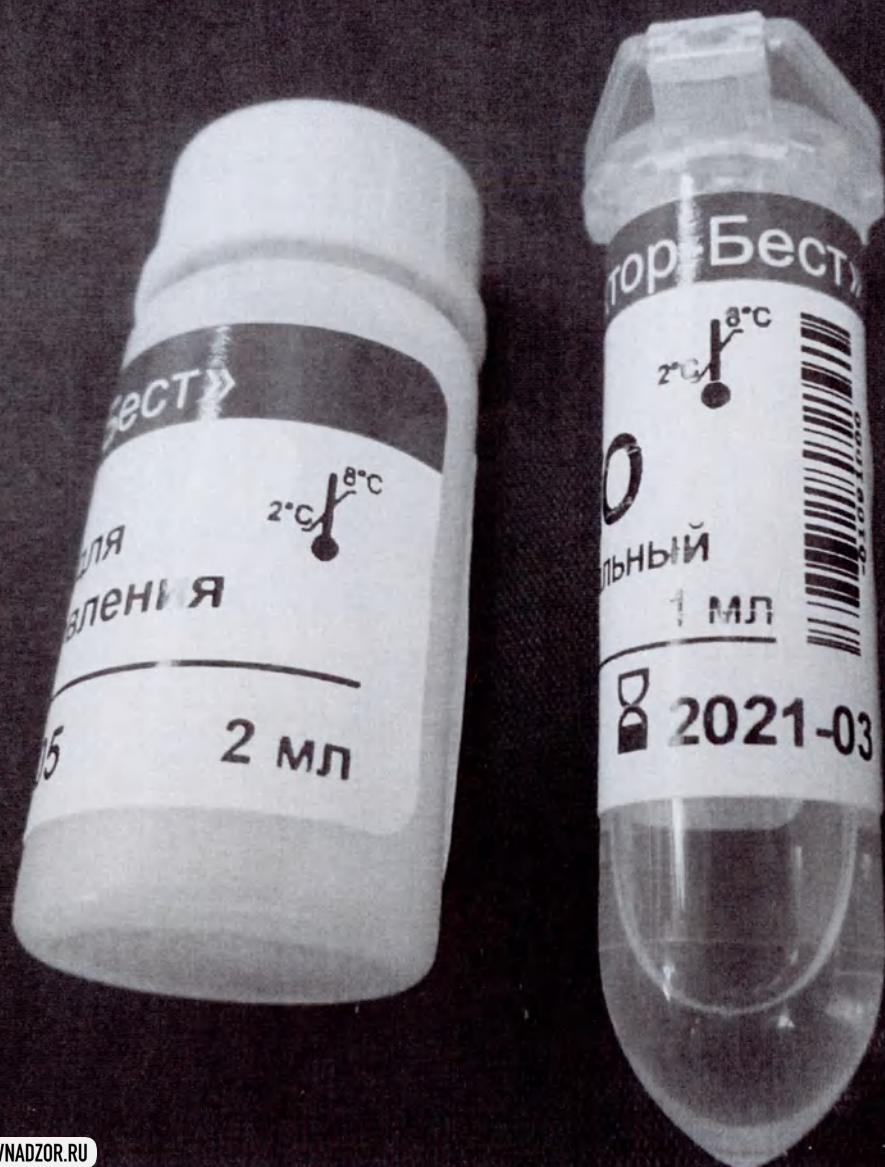

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 14 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

14 _____ Масяго А.В.
2019 г.

