



02

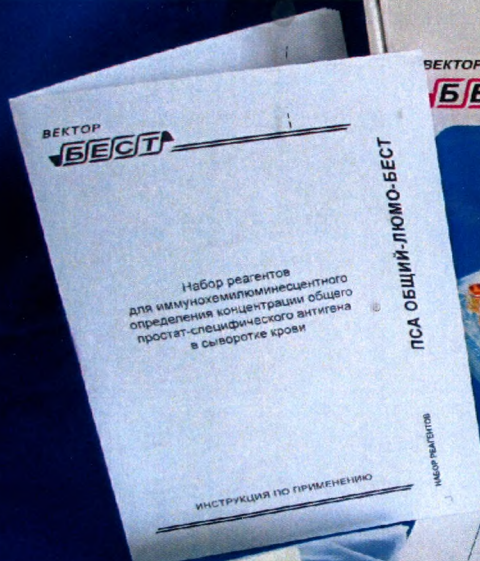

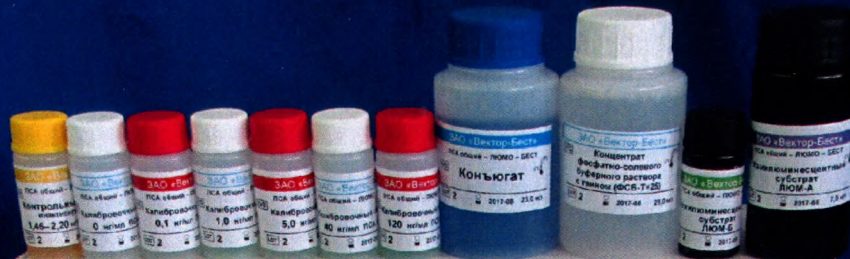

ПАСПОРТ № 239-10
ПСА общий - ЛЮМО - БЕСТ

Система контроля	Характеристики и нормы	Результаты
Калибровочный образец, серия 2	Средняя концентрация антигена в сыворотке крови, 1 мг/л. Препаративная погрешность, 6 фл. от 0,5 мг/л.	Результат: 1,0 мг/л.
Контрольный образец, серия 2	Средняя концентрация антигена в сыворотке крови, 1,000, 0,5 мг/л.	Результат: 1,0 мг/л.
Конъюгат, серия 2	Препаративная погрешность, 1 фл. от 0,5 мг/л.	Результат: 1,0 мг/л.
Концентрат фосфата-содового буферного раствора, серия 2	Препаративная погрешность, 1 фл. от 0,5 мг/л.	Результат: 1,0 мг/л.
Иммунохимолюминесцентный субстрат ЛЮМО-Б, серия 2	Препаративная погрешность, 1 фл. от 0,5 мг/л.	Результат: 1,0 мг/л.