

BEKTOP
БЕСТ

**Набор реагентов
для выявления РНК вируса
клещевого энцефалита
методом ОТ-ПЦР в режиме
реального времени**

РеалБест РНК ВКЭ (комплект 2)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

РеалБест РНК ВКЗ
(комплект 2)

СОСТАВ:
1. Полотно
2. Рванцы
3. Растер
4. Растер

TV 6326-637-2254/172-26

650529. Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
п. Колывань, д/п 121. ЗАО «Вектор-Бест»

ПАСПОРТ № 355-16
РеалБест РНК ВКЗ (комп)
Набор документов для выделения РНК вures классного зм
реального времени

Т/У 9396-537-23548192-2016

Tels. (503) 227-67-66 Tels. (503) 227-13-48
 227-25-53 227-37-28 E-mail: info@hawaii.com

DT-NUP в режиме

Номер серии 2

Дата изготовления 18.02.2016
Дата выдачи паспорта 18.02.2016

... ..

ГОРНОСТАЯ РЕЧКА АД 18.02.2017

Техника и нормы	Раз-ты контро
ная жидкость, 1	Проверка жидкости

1 пробирка, 1 0 мл (се

Аморфная масса бел.

определенный (соо

Белая жидкость, 1 флакон	Прозрачная бесцветная жидкость, 1 флакон 20 мл
--------------------------	--

SUBSTANTIAL EVIDENCE. A

4 флакона по

15001807C18

100 (cont.)

100 (662)

интов, инструкция по применению, паспорт и маркировка.

и маркировка соответствуют требованиям





ОТДЕЛ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

TECHNICAL

...

100

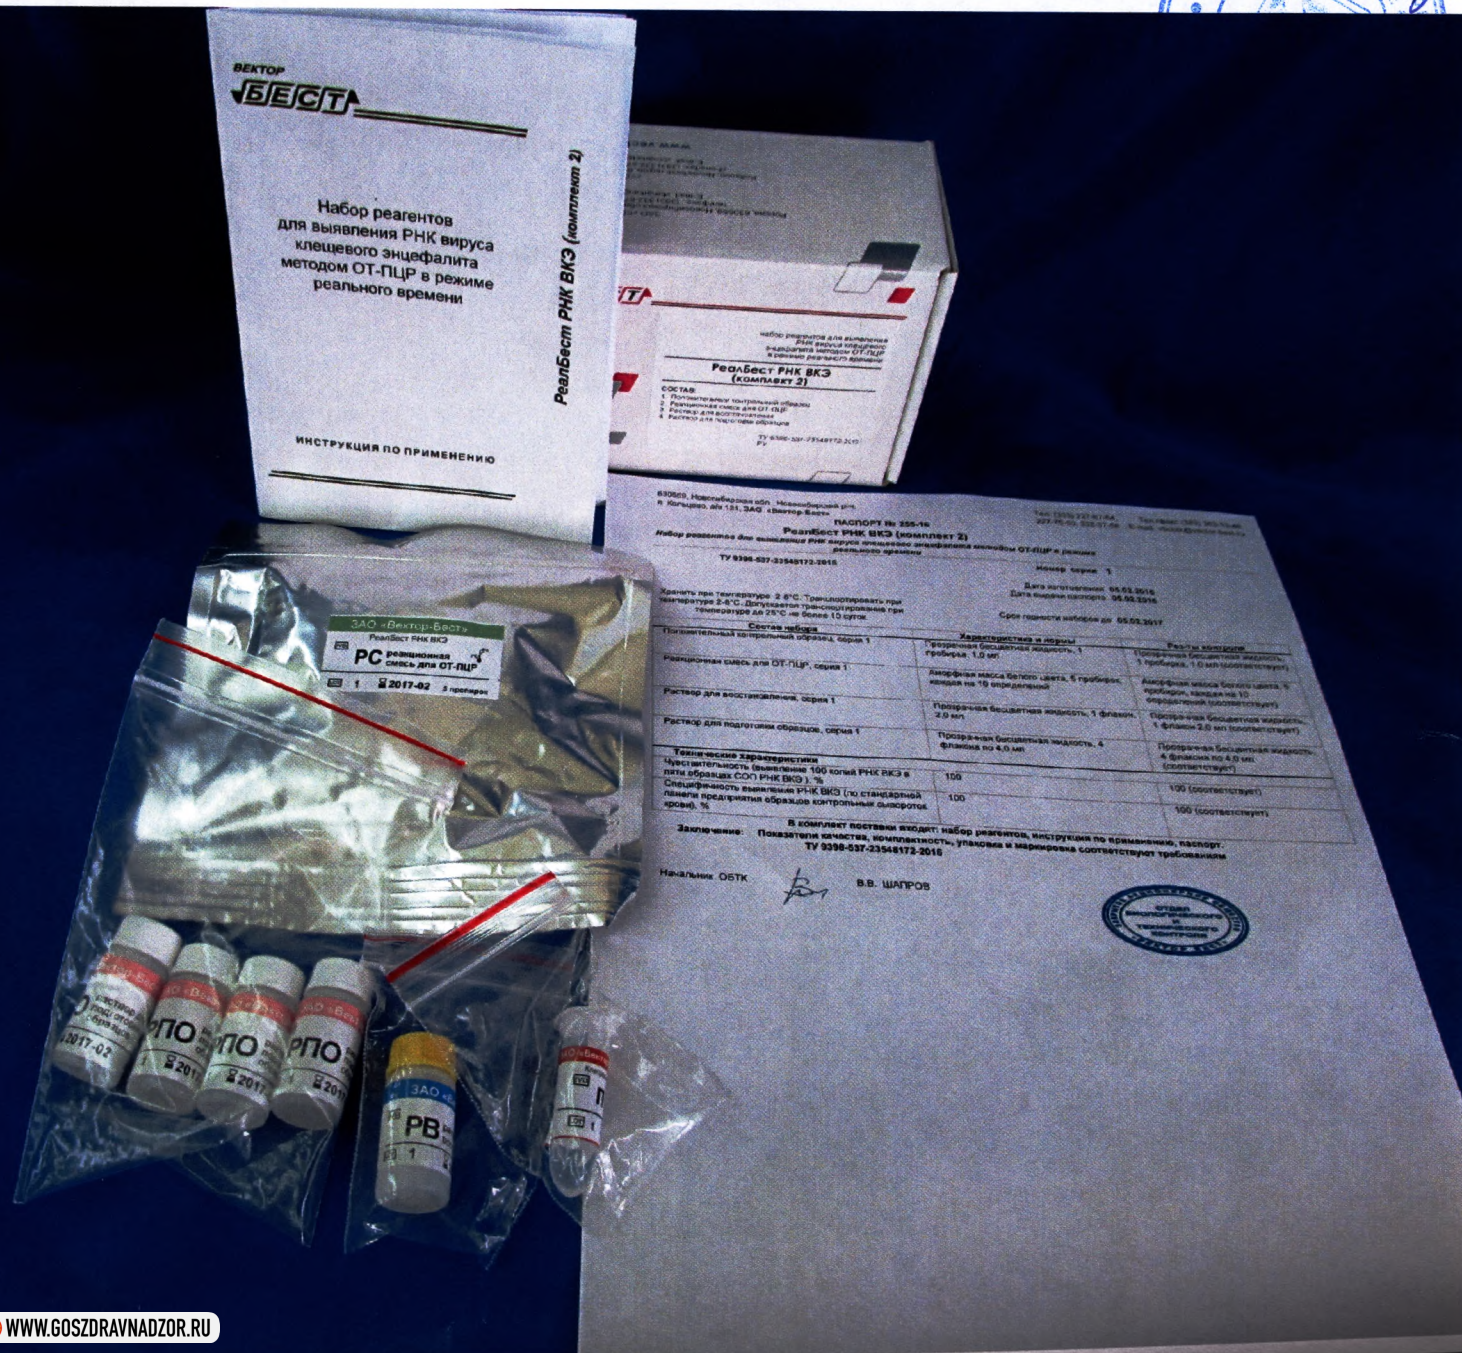

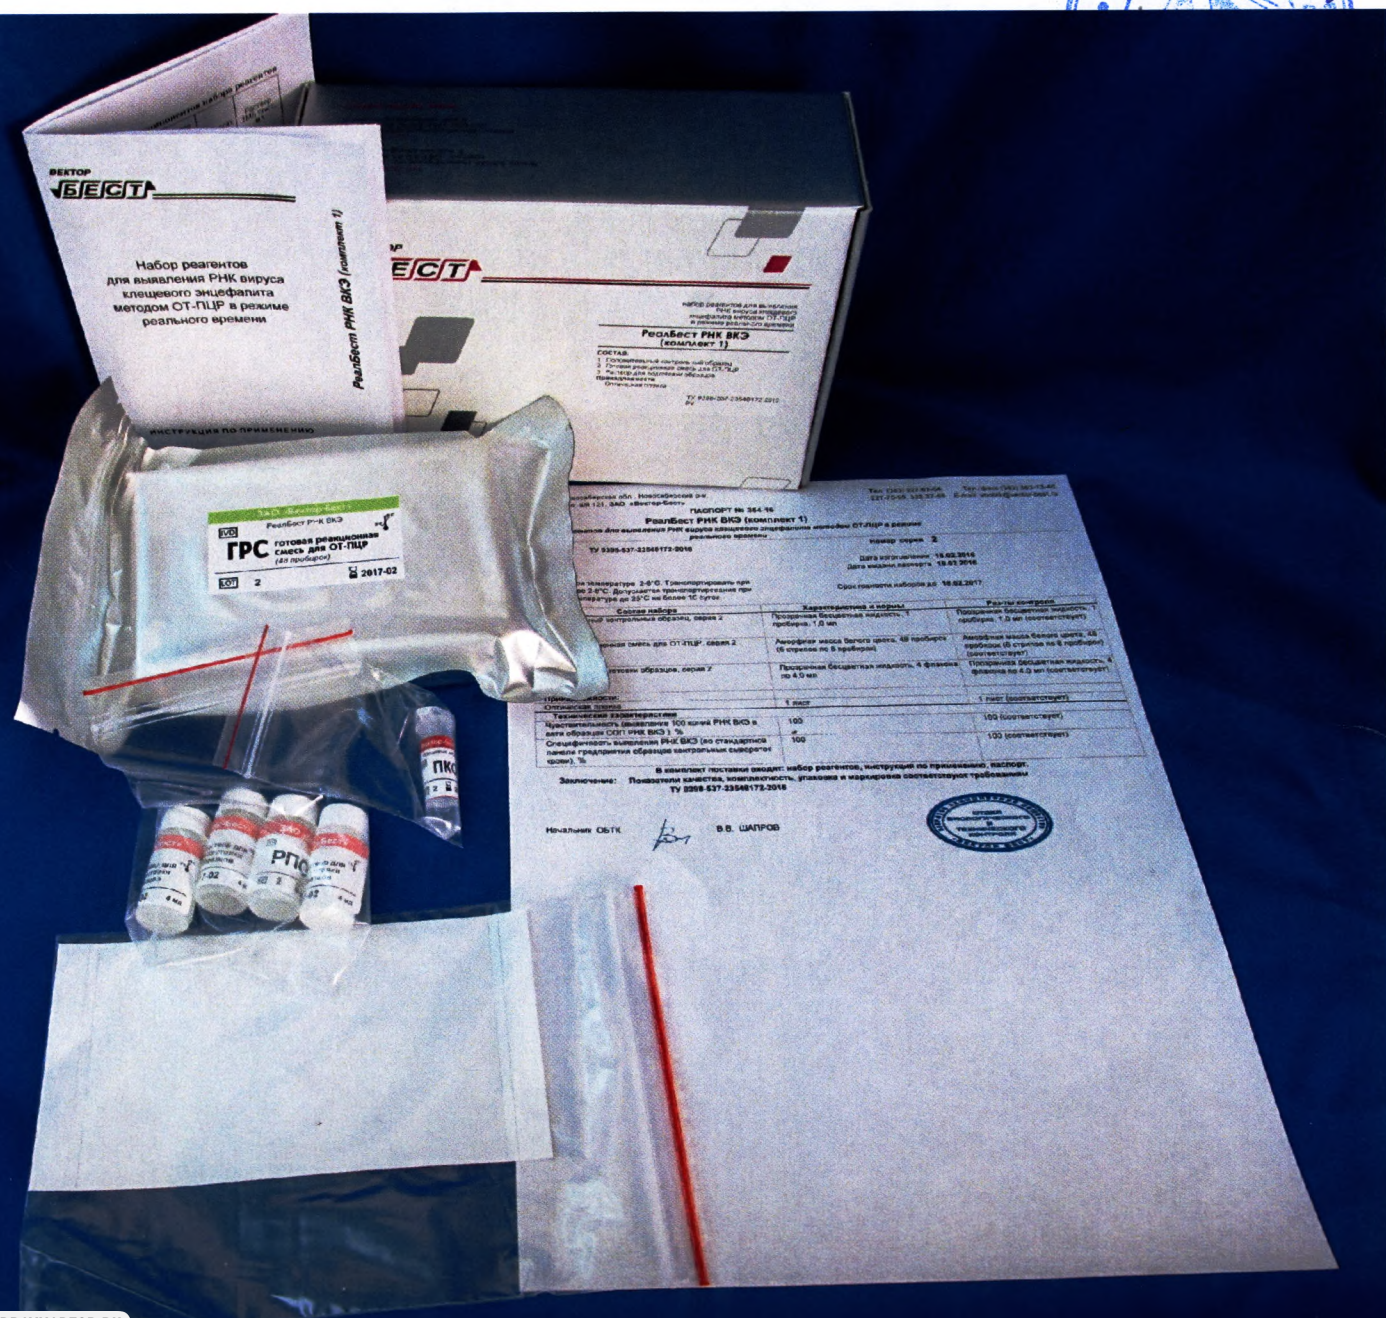

ВЕКТОР-БЕСТ

Набор реагентов
 для выявления РНК вируса
 клещевого энцефалита
 методом ОТ-ПЦР в режиме
 реального времени

Реагенты РНК ВКЭ (комплект 1)

ЗАО "Вектор-Бест"
 Реагенты РНК ВКЭ
ГРС
 готовая реакционная
 смесь для ОТ-ПЦР
 (из пробирки)
 2017-02

НАБОР реагентов для выявления
 РНК вируса клещевого энцефалита
 методом ОТ-ПЦР в режиме
 реального времени

**Реагенты РНК ВКЭ
 (комплект 1)**

СОСТАВ:
 1. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР
 2. Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР
 3. Набор для контроля качества
 реагентов

ТУ 5395-537-2016

ПАСПОРТ № 354-16

Реагенты РНК ВКЭ (комплект 1)

ТУ 5395-537-2016

Датум изготовления: 18.02.2016
 Дата ввода в эксплуатацию: 18.02.2016
 Срок годности: 18.02.2017

Наименование	Единица измерения	Количество
Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР	мл	100
Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР	мл	100
Набор для контроля качества реагентов	шт.	100

В комплект поставки входит: набор реагентов, инструкция по применению, паспорт.

Заключение: Показатели качества, надежности, упаковки и маркировки соответствуют требованиям ТУ 5395-537-2016

Исполнитель: В.В. ШАПОВ

Генеральный директор
ЗАО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2016 г.

