

Фотографии медицинского изделия:

«Тренажер Eccentron LE1 для тестирования и восстановления силы мышц в эксцентрическом режиме с биологической обратной связью с принадлежностями»,


производство: «БиТиИ Технолоджис Инк.», США / BTE Technologies Inc., USA


1. Общий вид тренажера Eccentron LE1.
2. Блок тренажера Eccentron основной: вид снаружи.
3. Блок тренажера Eccentron основной: вид изнутри.
4. Консоль передняя.
5. Панель задняя боковая: вид справа.
6. Панель задняя боковая: вид слева.
7. Блок задний боковой: вид справа.
8. Блок задний боковой: вид слева.
9. Кресло для пациента: вид с подставкой под колени.
10. Подставка под колени, 32x18 см.
11. Монитор с сенсорным дисплеем.
12. Кабель питания для монитора.
13. Кабель DVI для монитора.
14. Кабель с разъемом USB для монитора.
15. Пульт управления.
16. Кабель питания тренажера.
17. Ключ гаечный на ¾ дюйма.
18. Отвертка (№2).
19. Винт M4x10.
20. Винт ¼.
21. Ролики транспортировочные.

Генеральный директор Труханов И.А.


"04" августа 2015 г.





(Подпись)

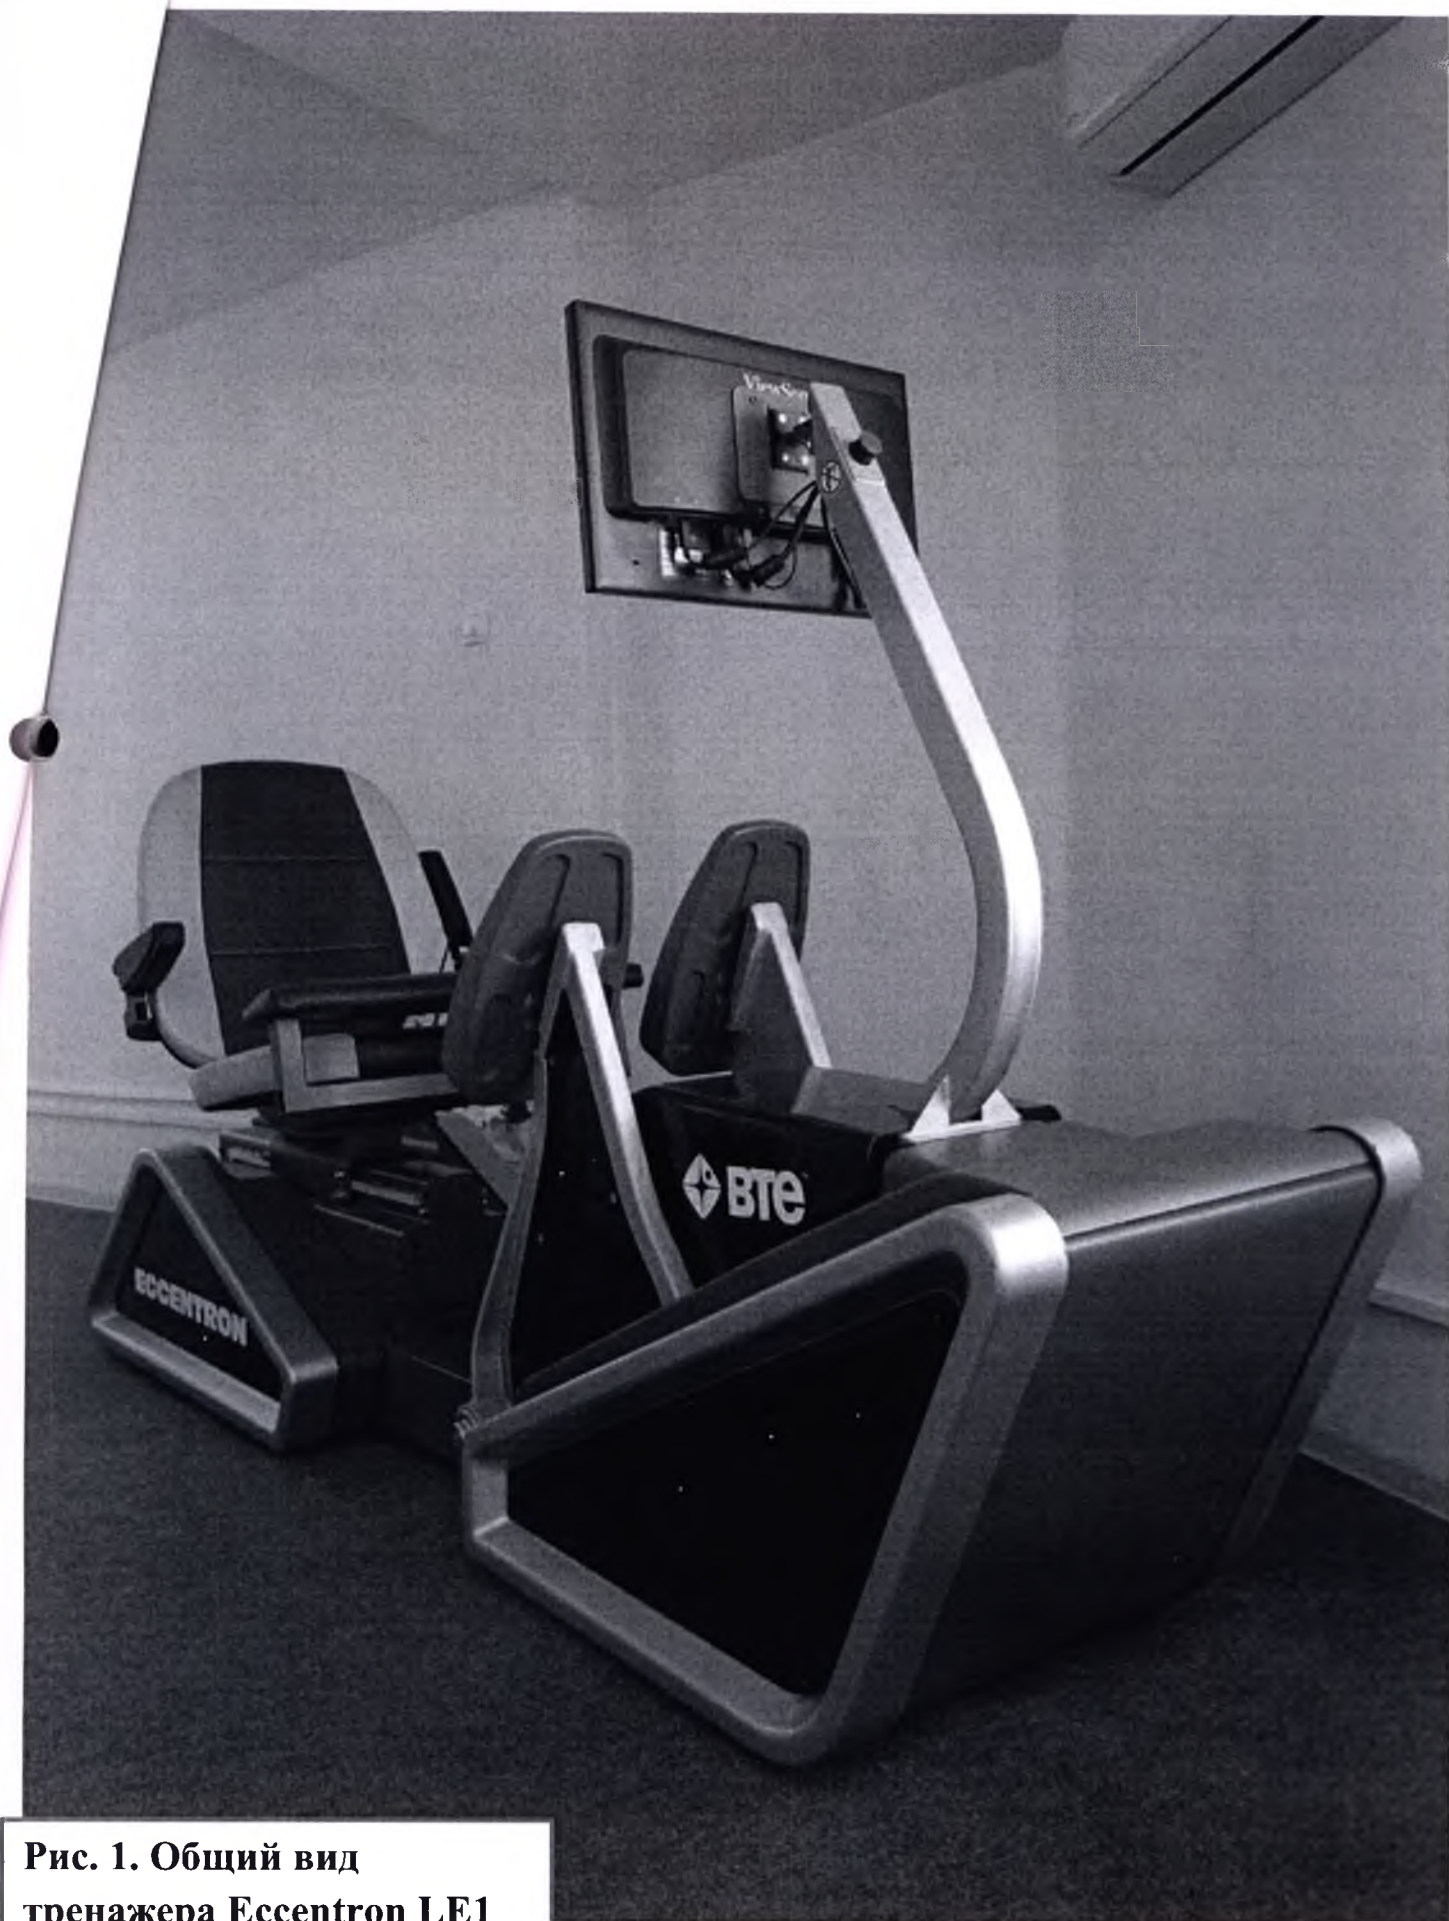

**Рис. 1. Общий вид
тренажера Eccentron LE1**

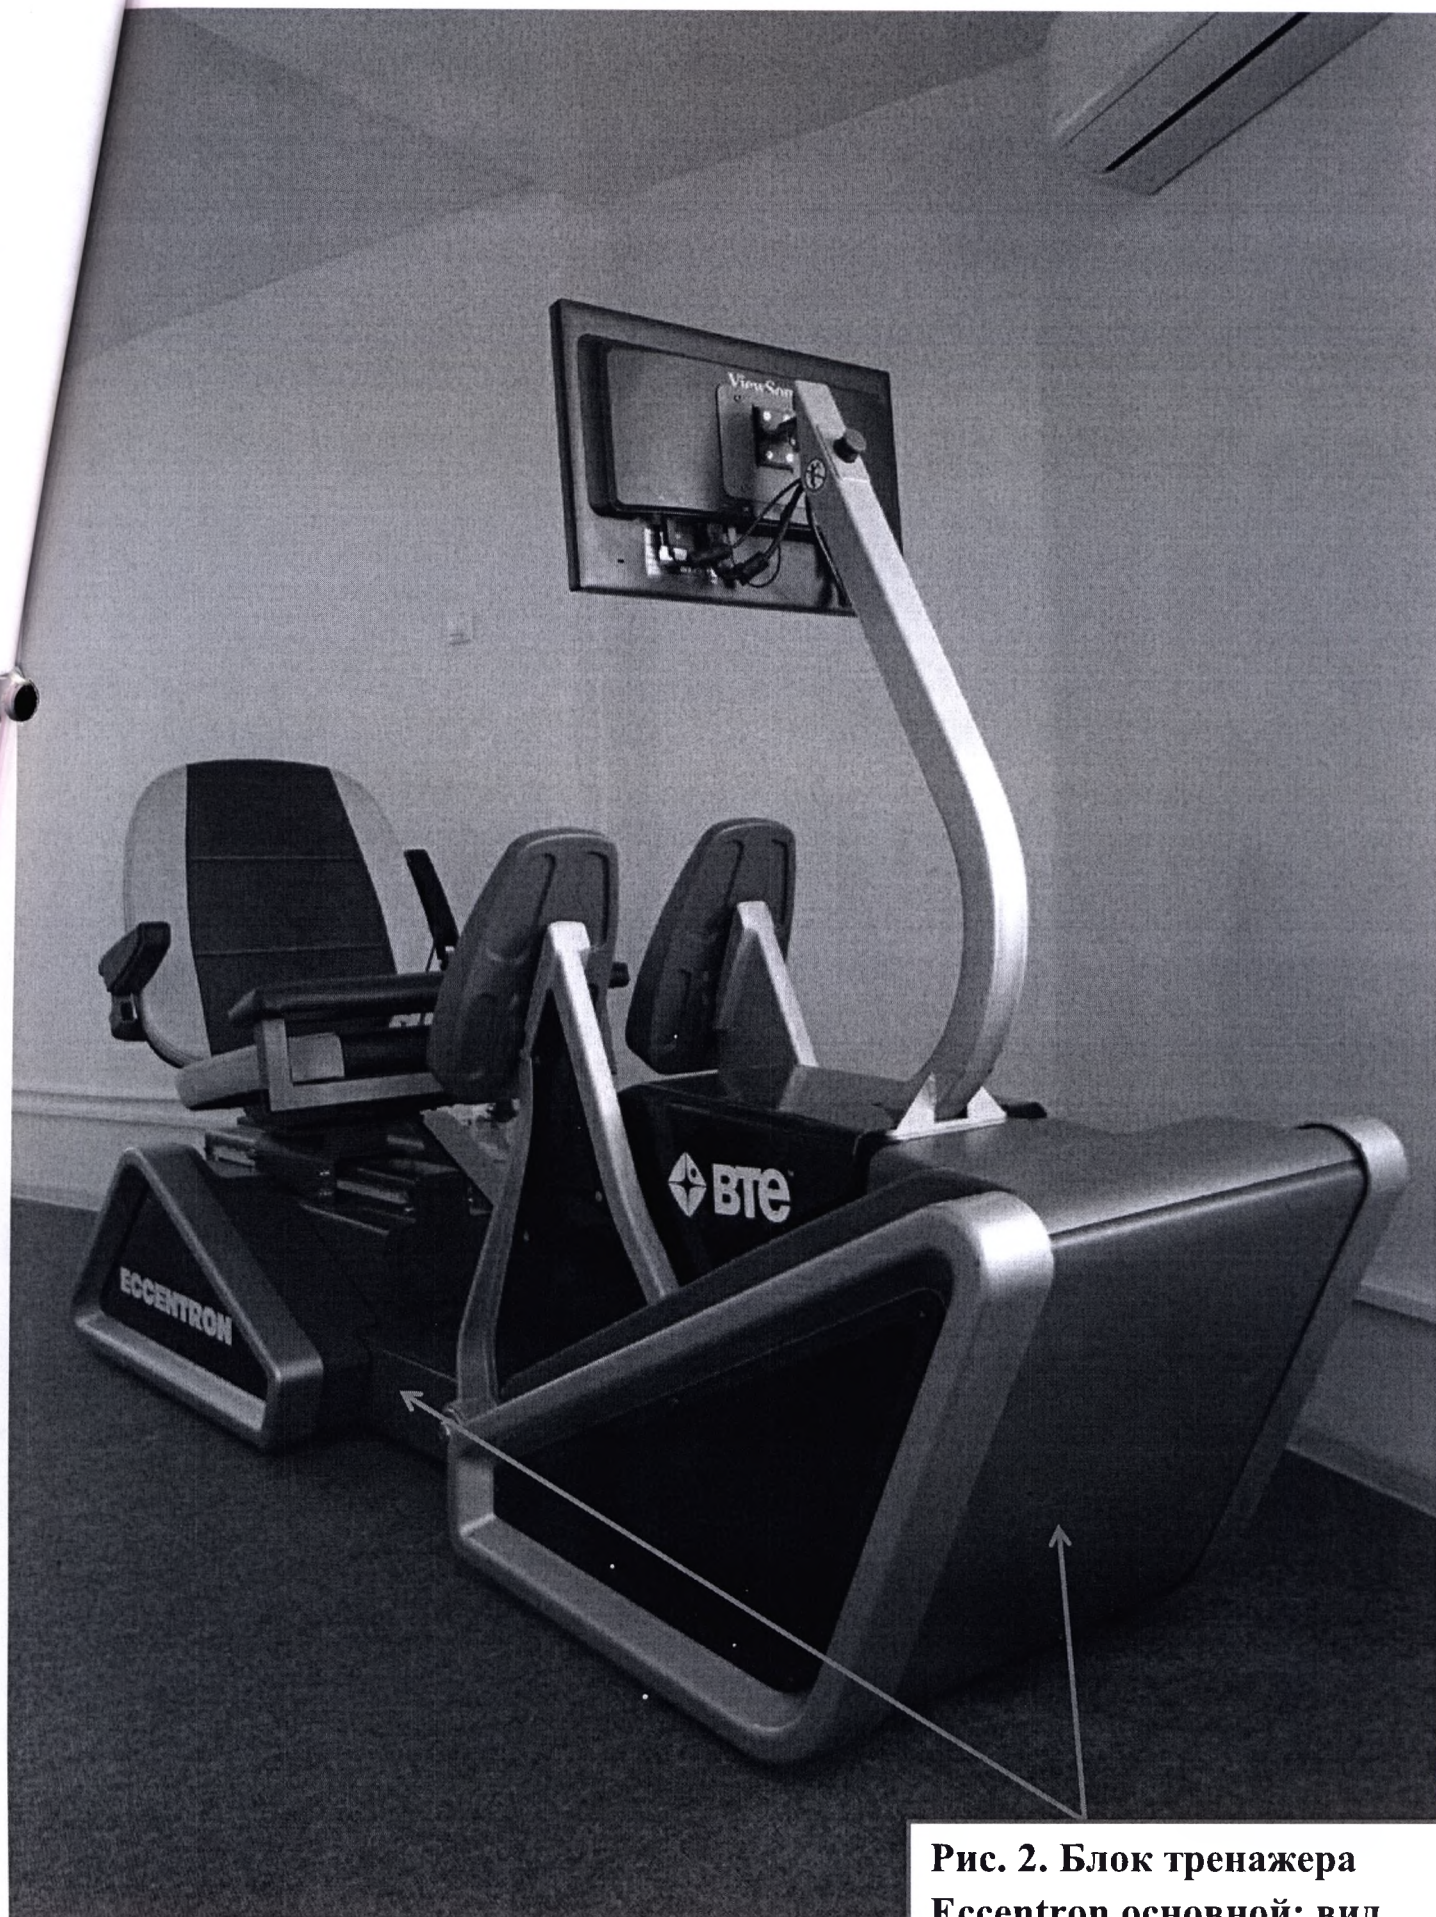

**Рис. 2. Блок тренажера
Еccentron основной: вид
снаружи**

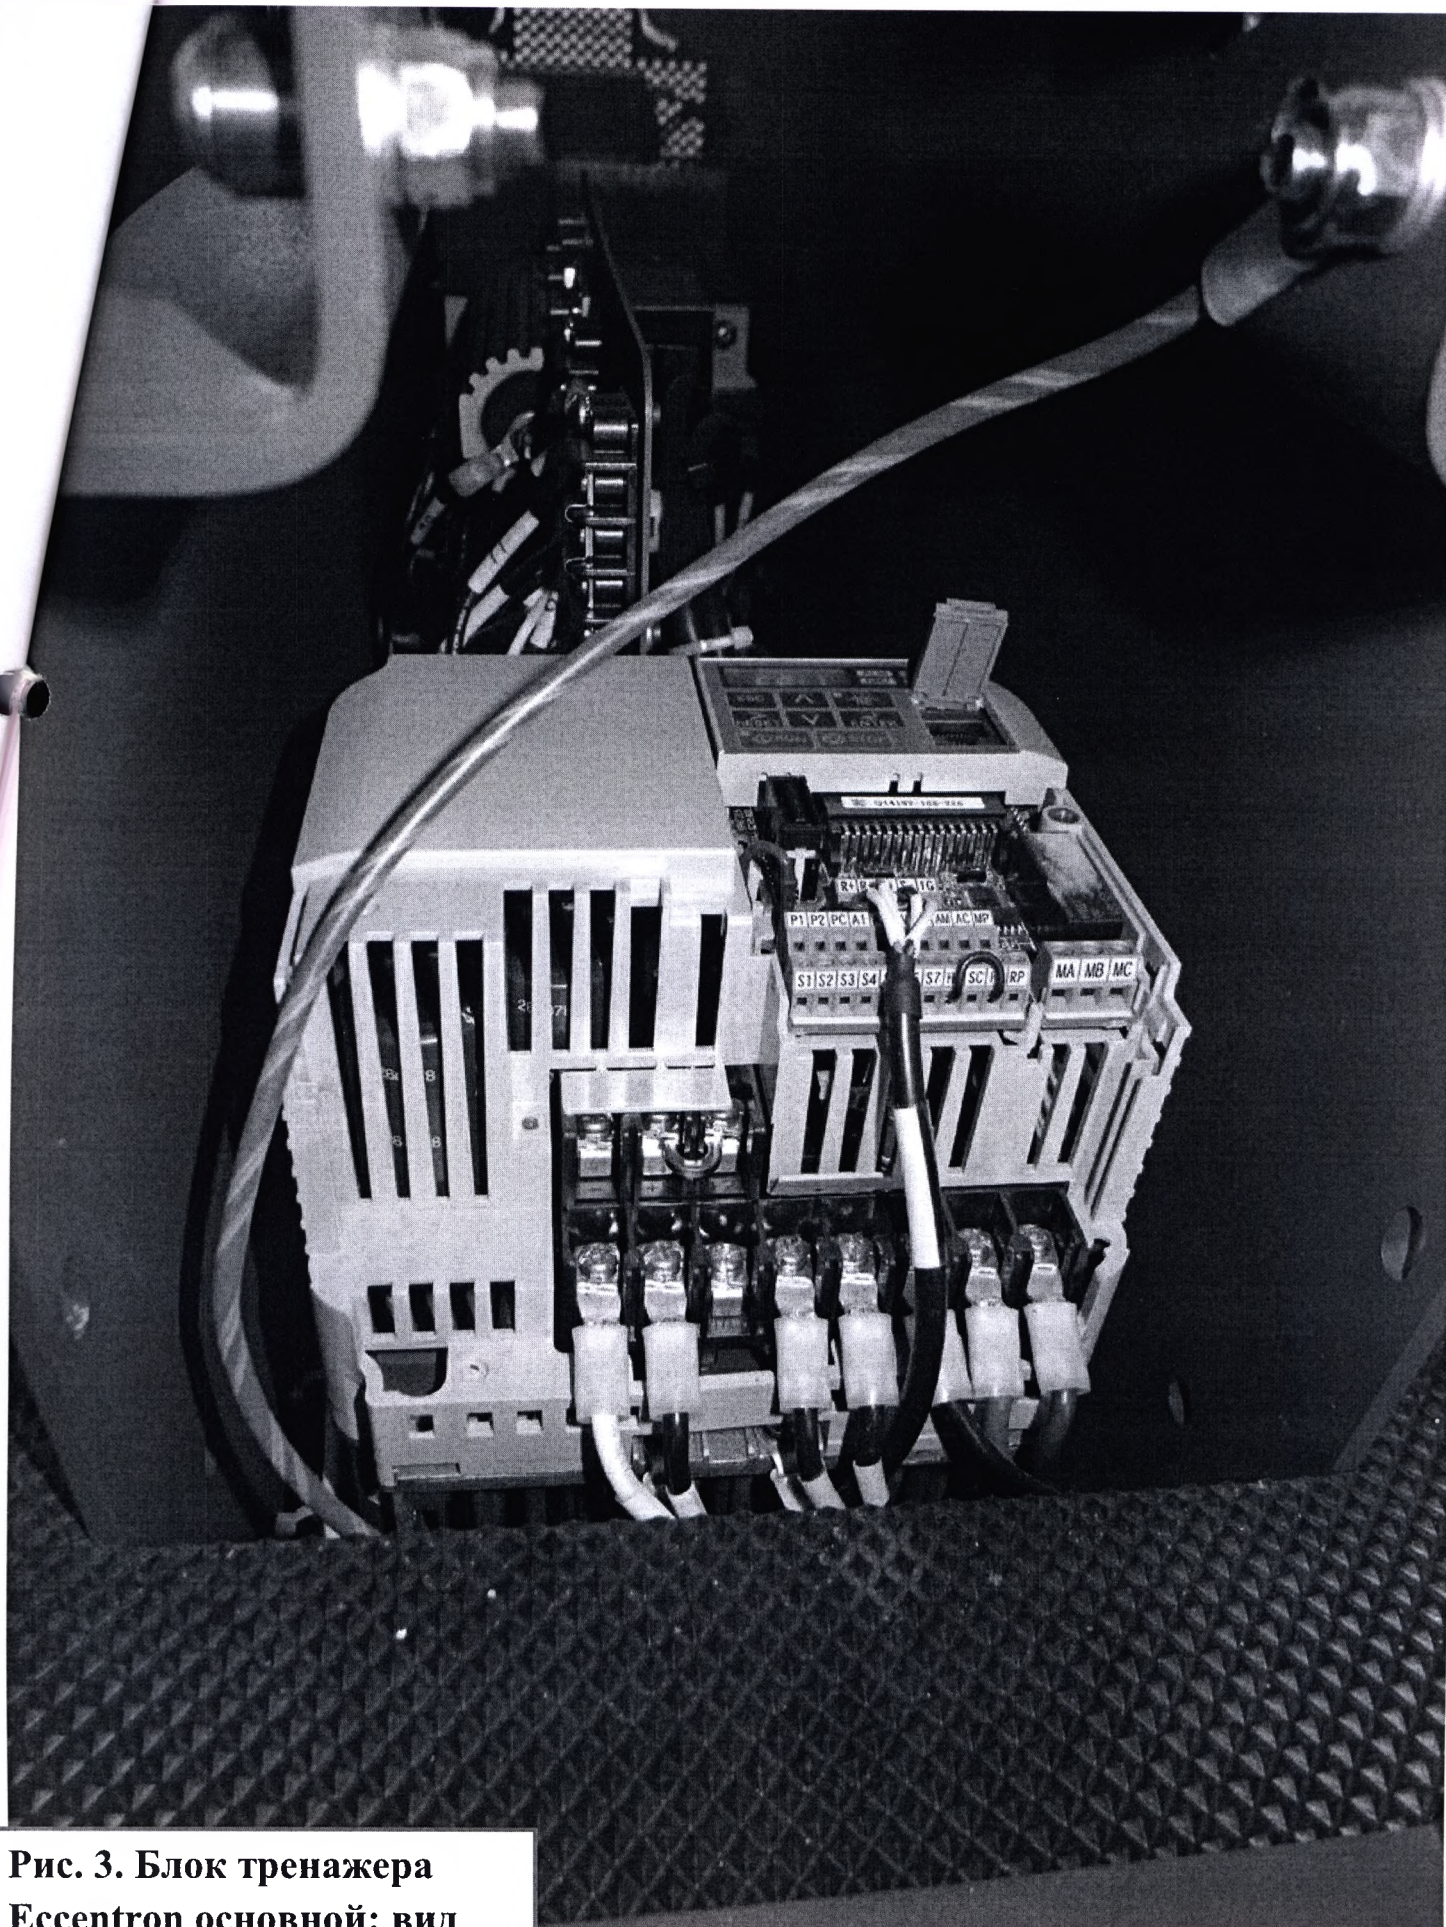

**Рис. 3. Блок тренажера
Eccentron основной: вид
изнутри**



Рис. 4. Консоль передняя



**Рис. 5. Панель задняя
боковая: вид справа**



Рис. 6. Панель задняя
боковая: вид слева



**Рис. 7. Блок задний
боковой: вид справа**



**Рис. 8. Блок задний
боковой: вид слева**



**Рис. 9. Кресло для
пациента: вид с
подставкой под колени**



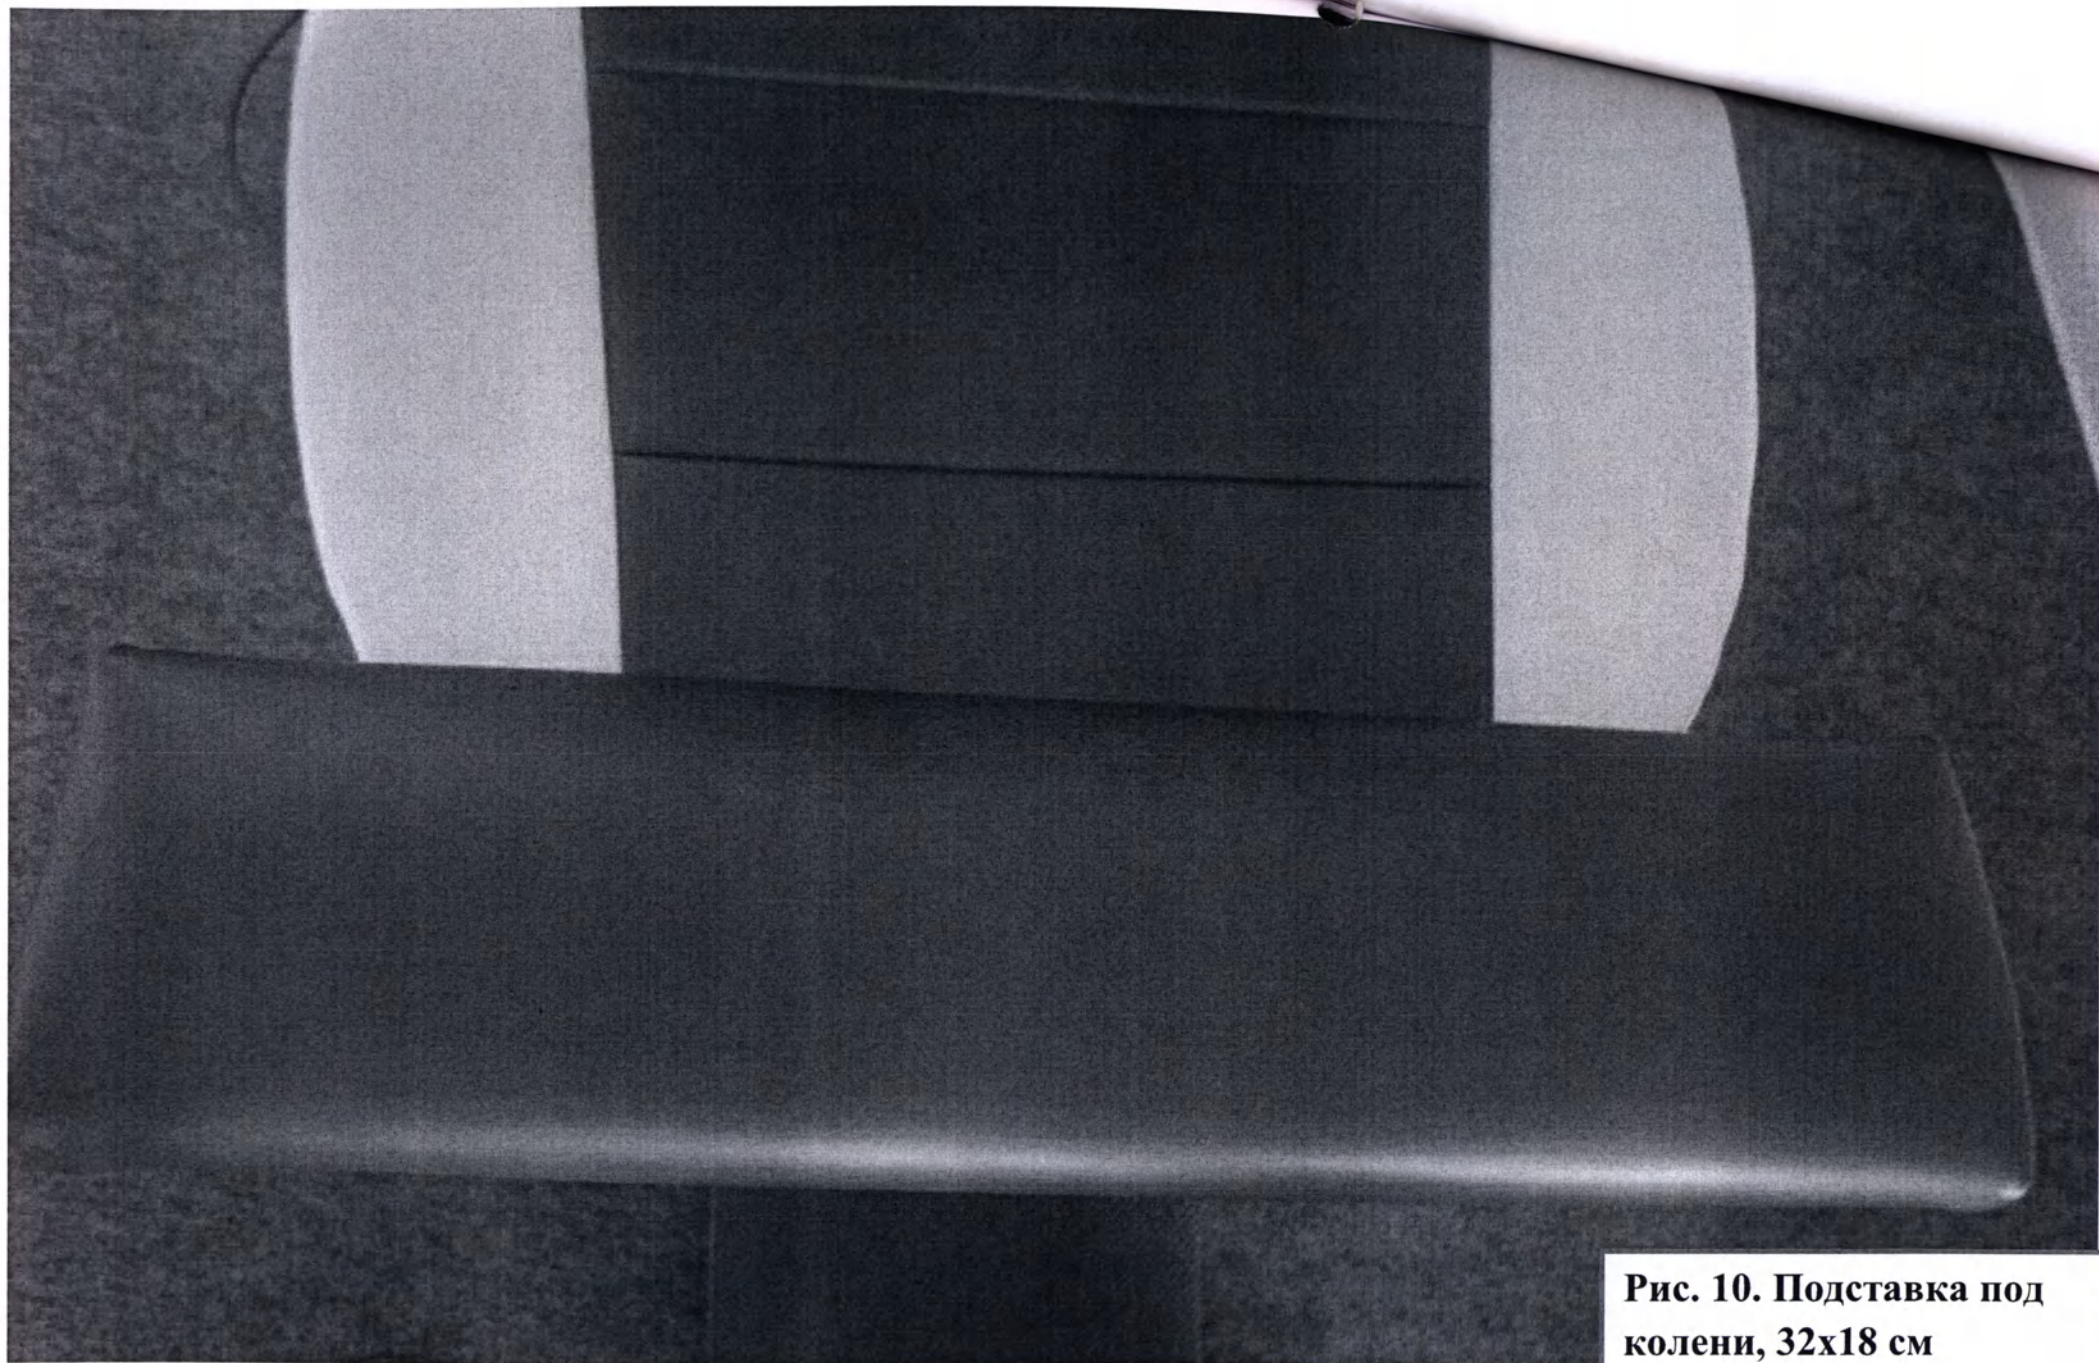


Рис. 10. Подставка под колени, 32x18 см

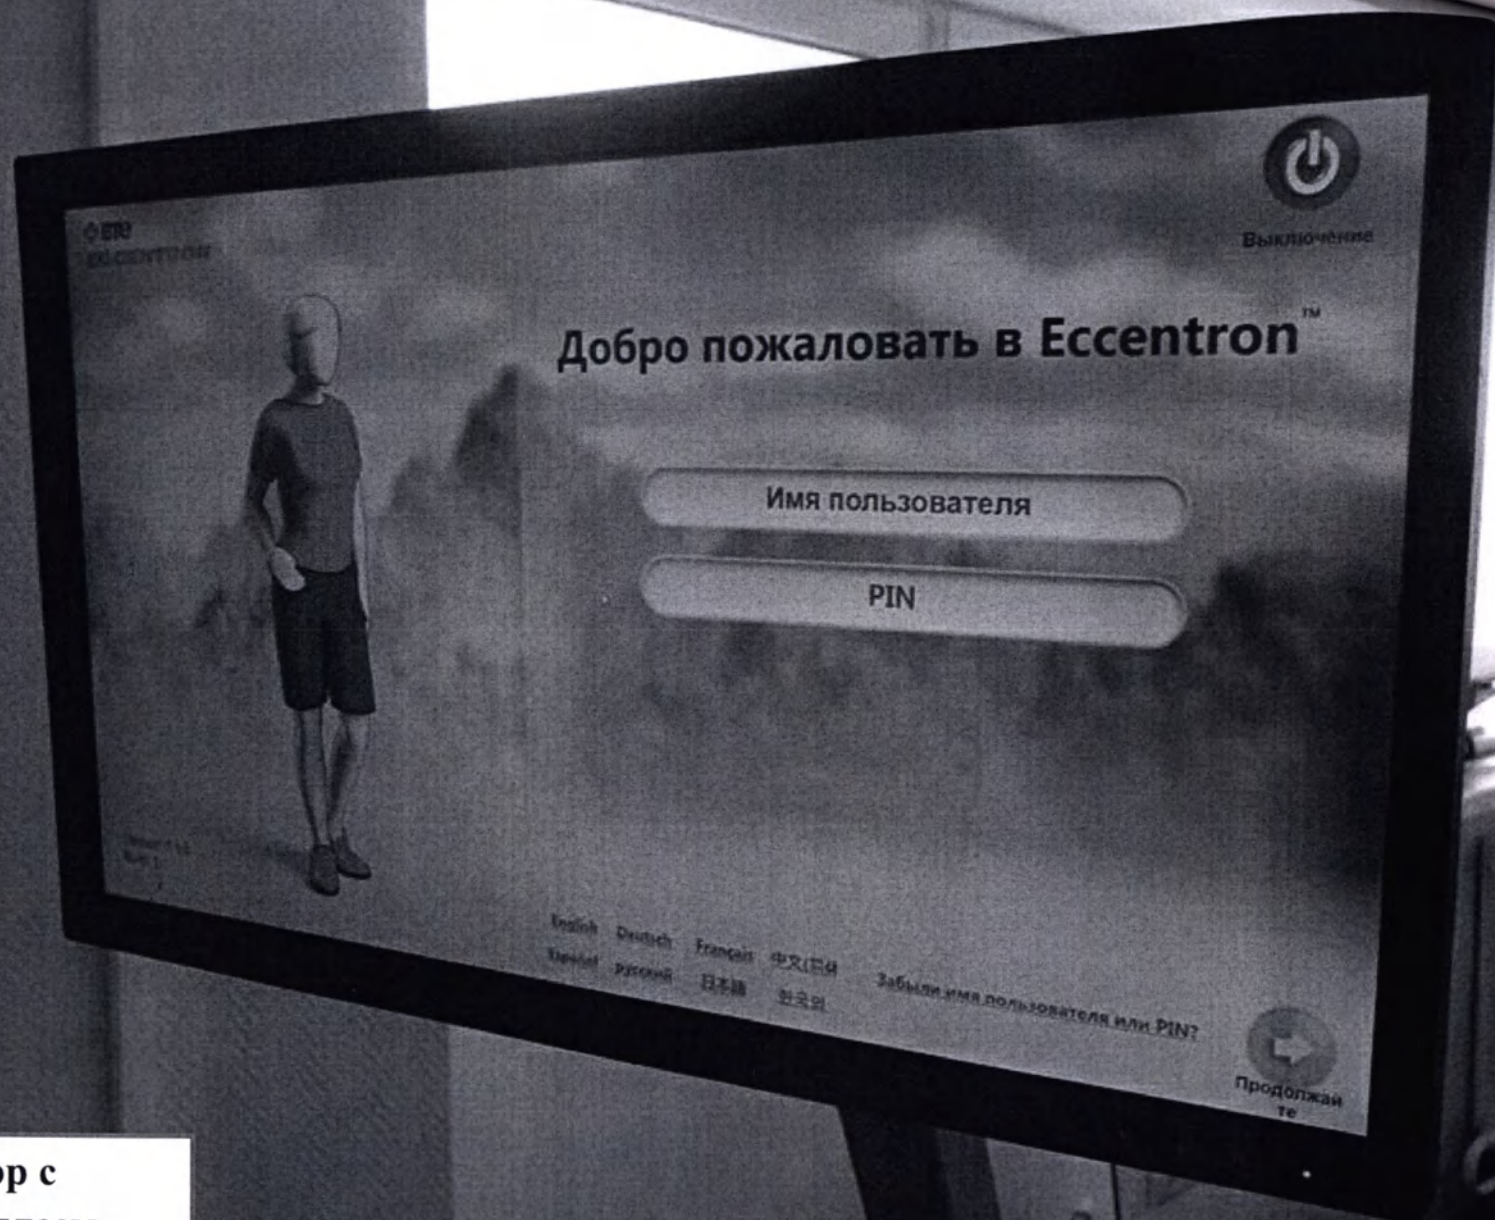

**Рис. 11. Монитор с
сенсорным дисплеем**

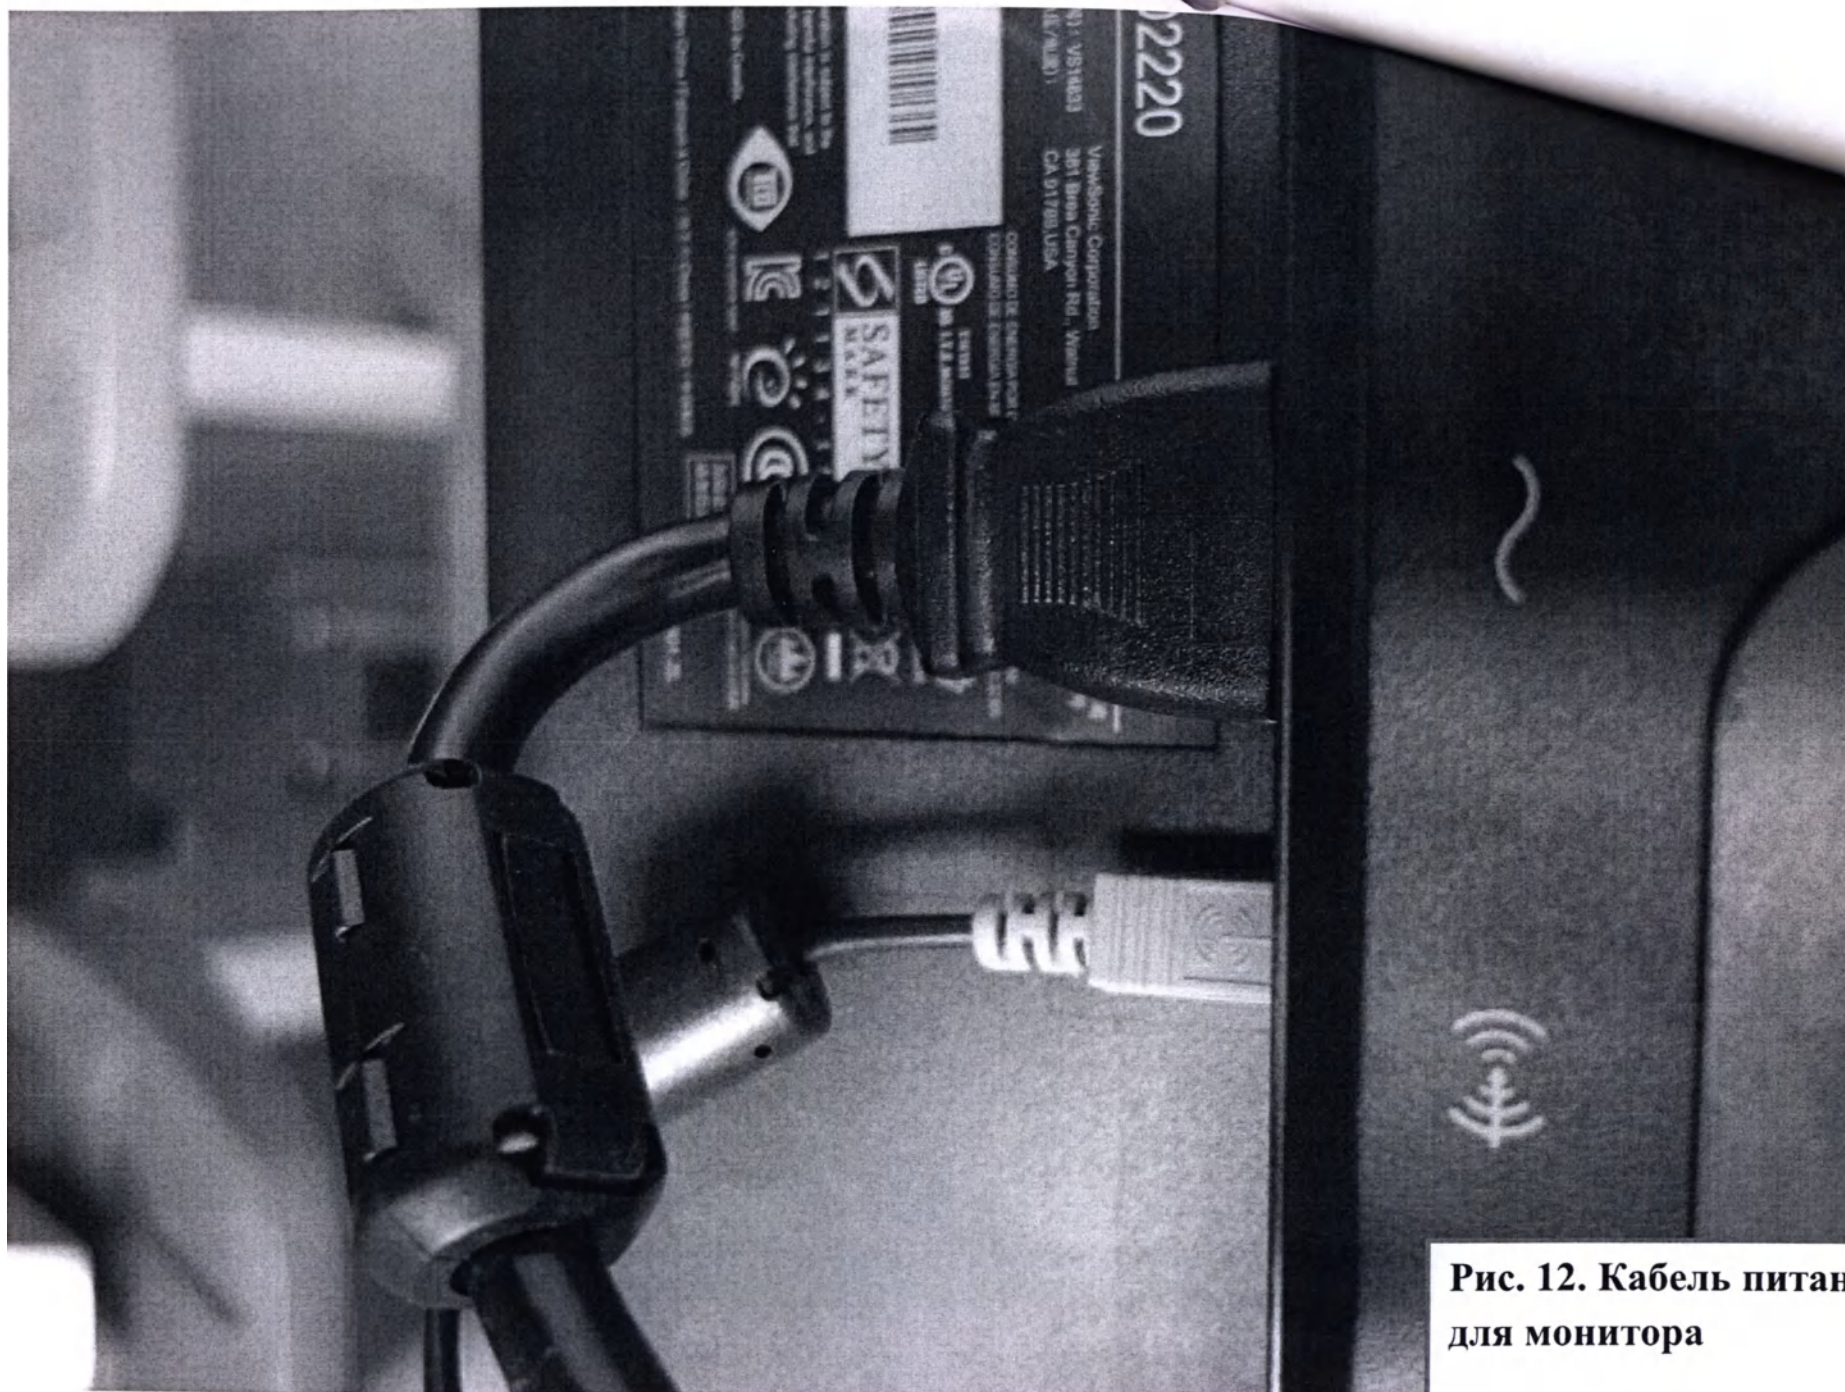

**Рис. 12. Кабель питания
для монитора**

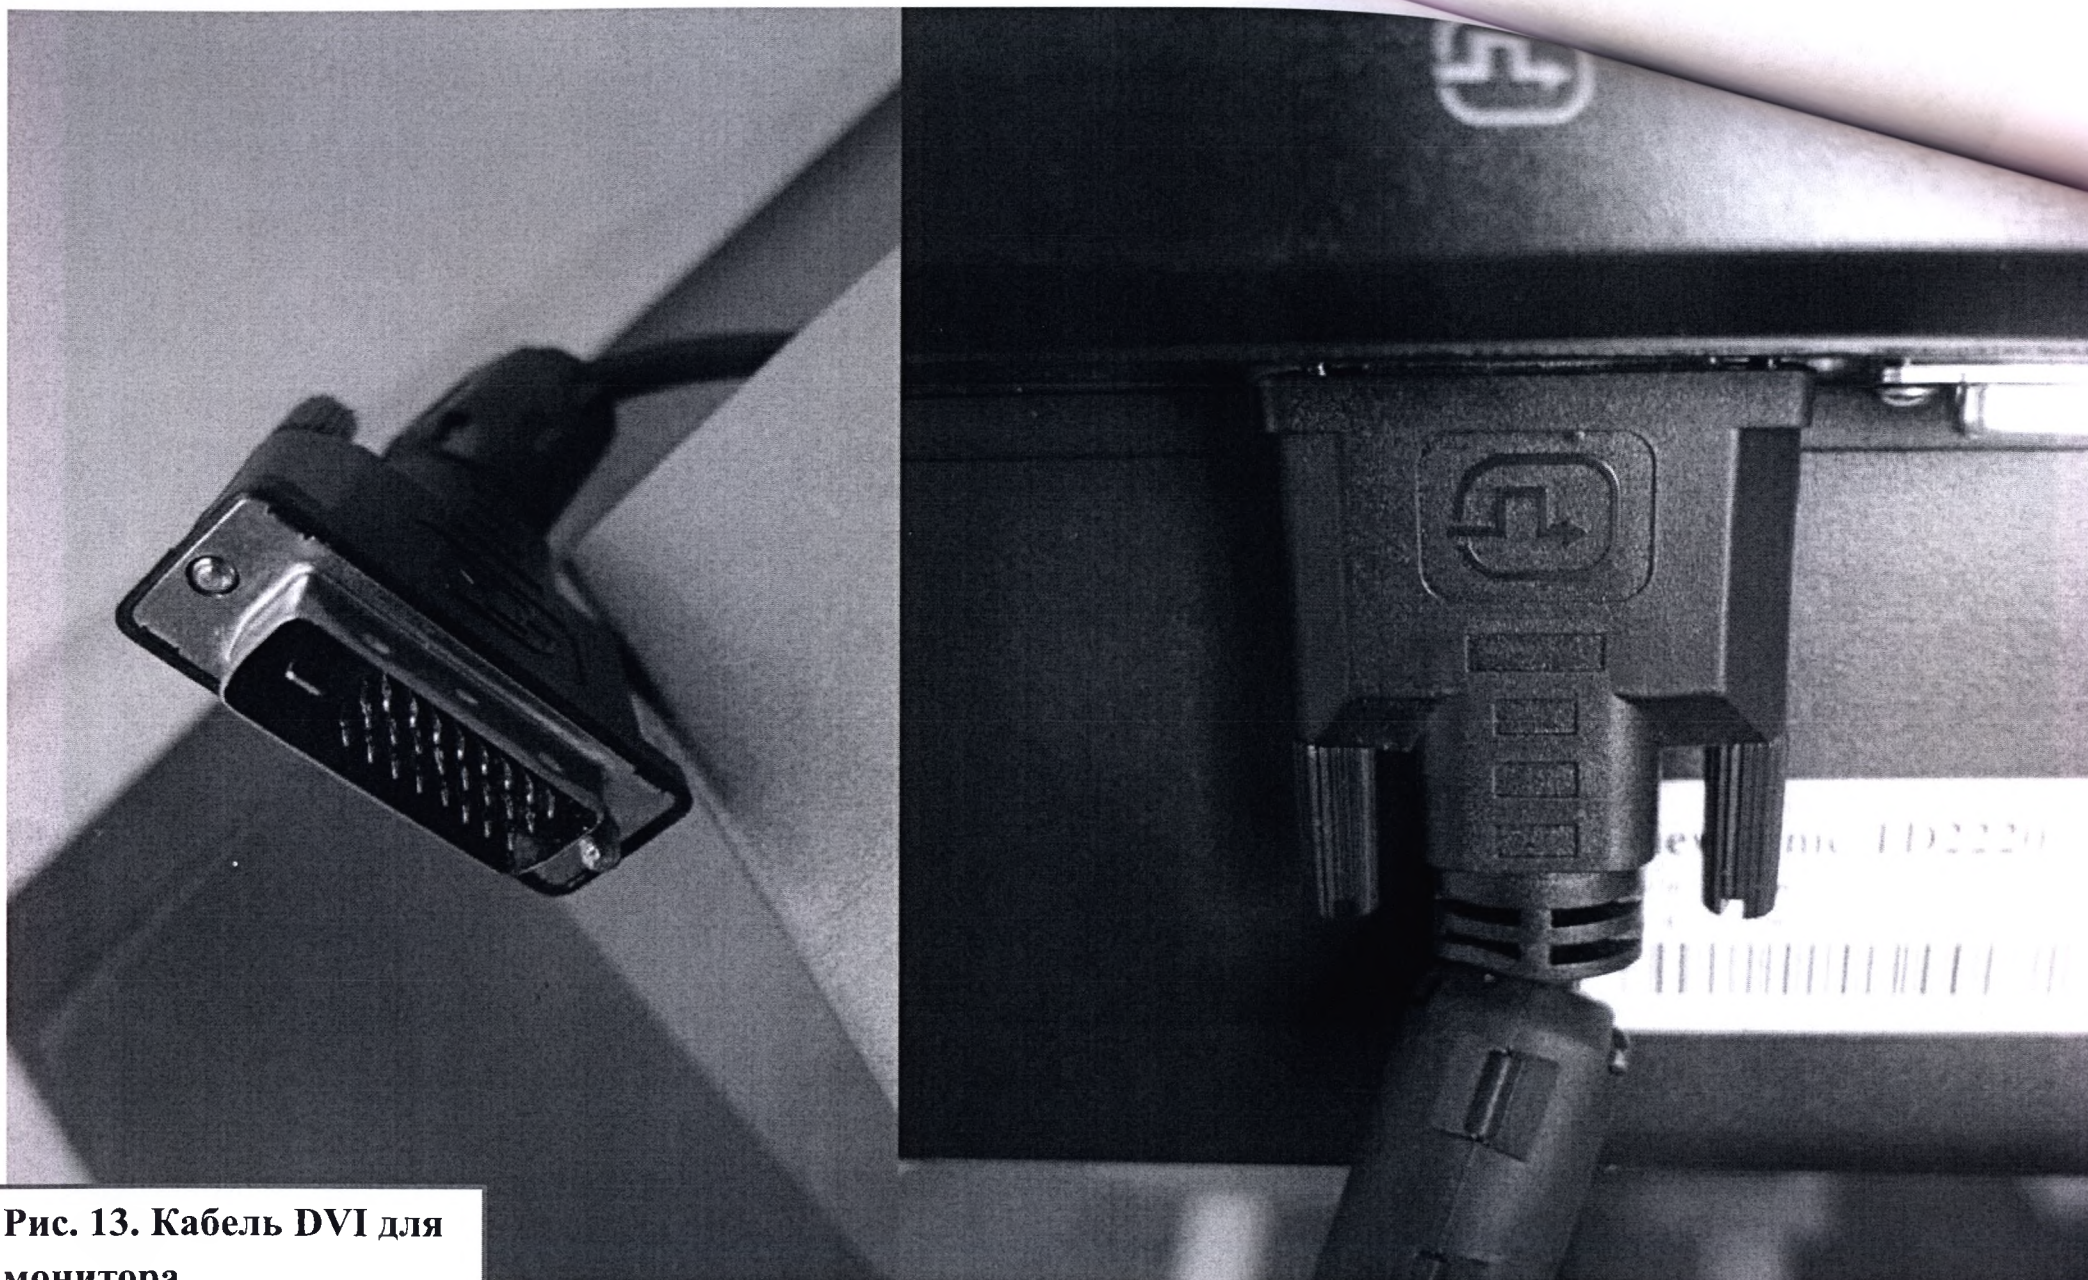


Рис. 13. Кабель DVI для монитора

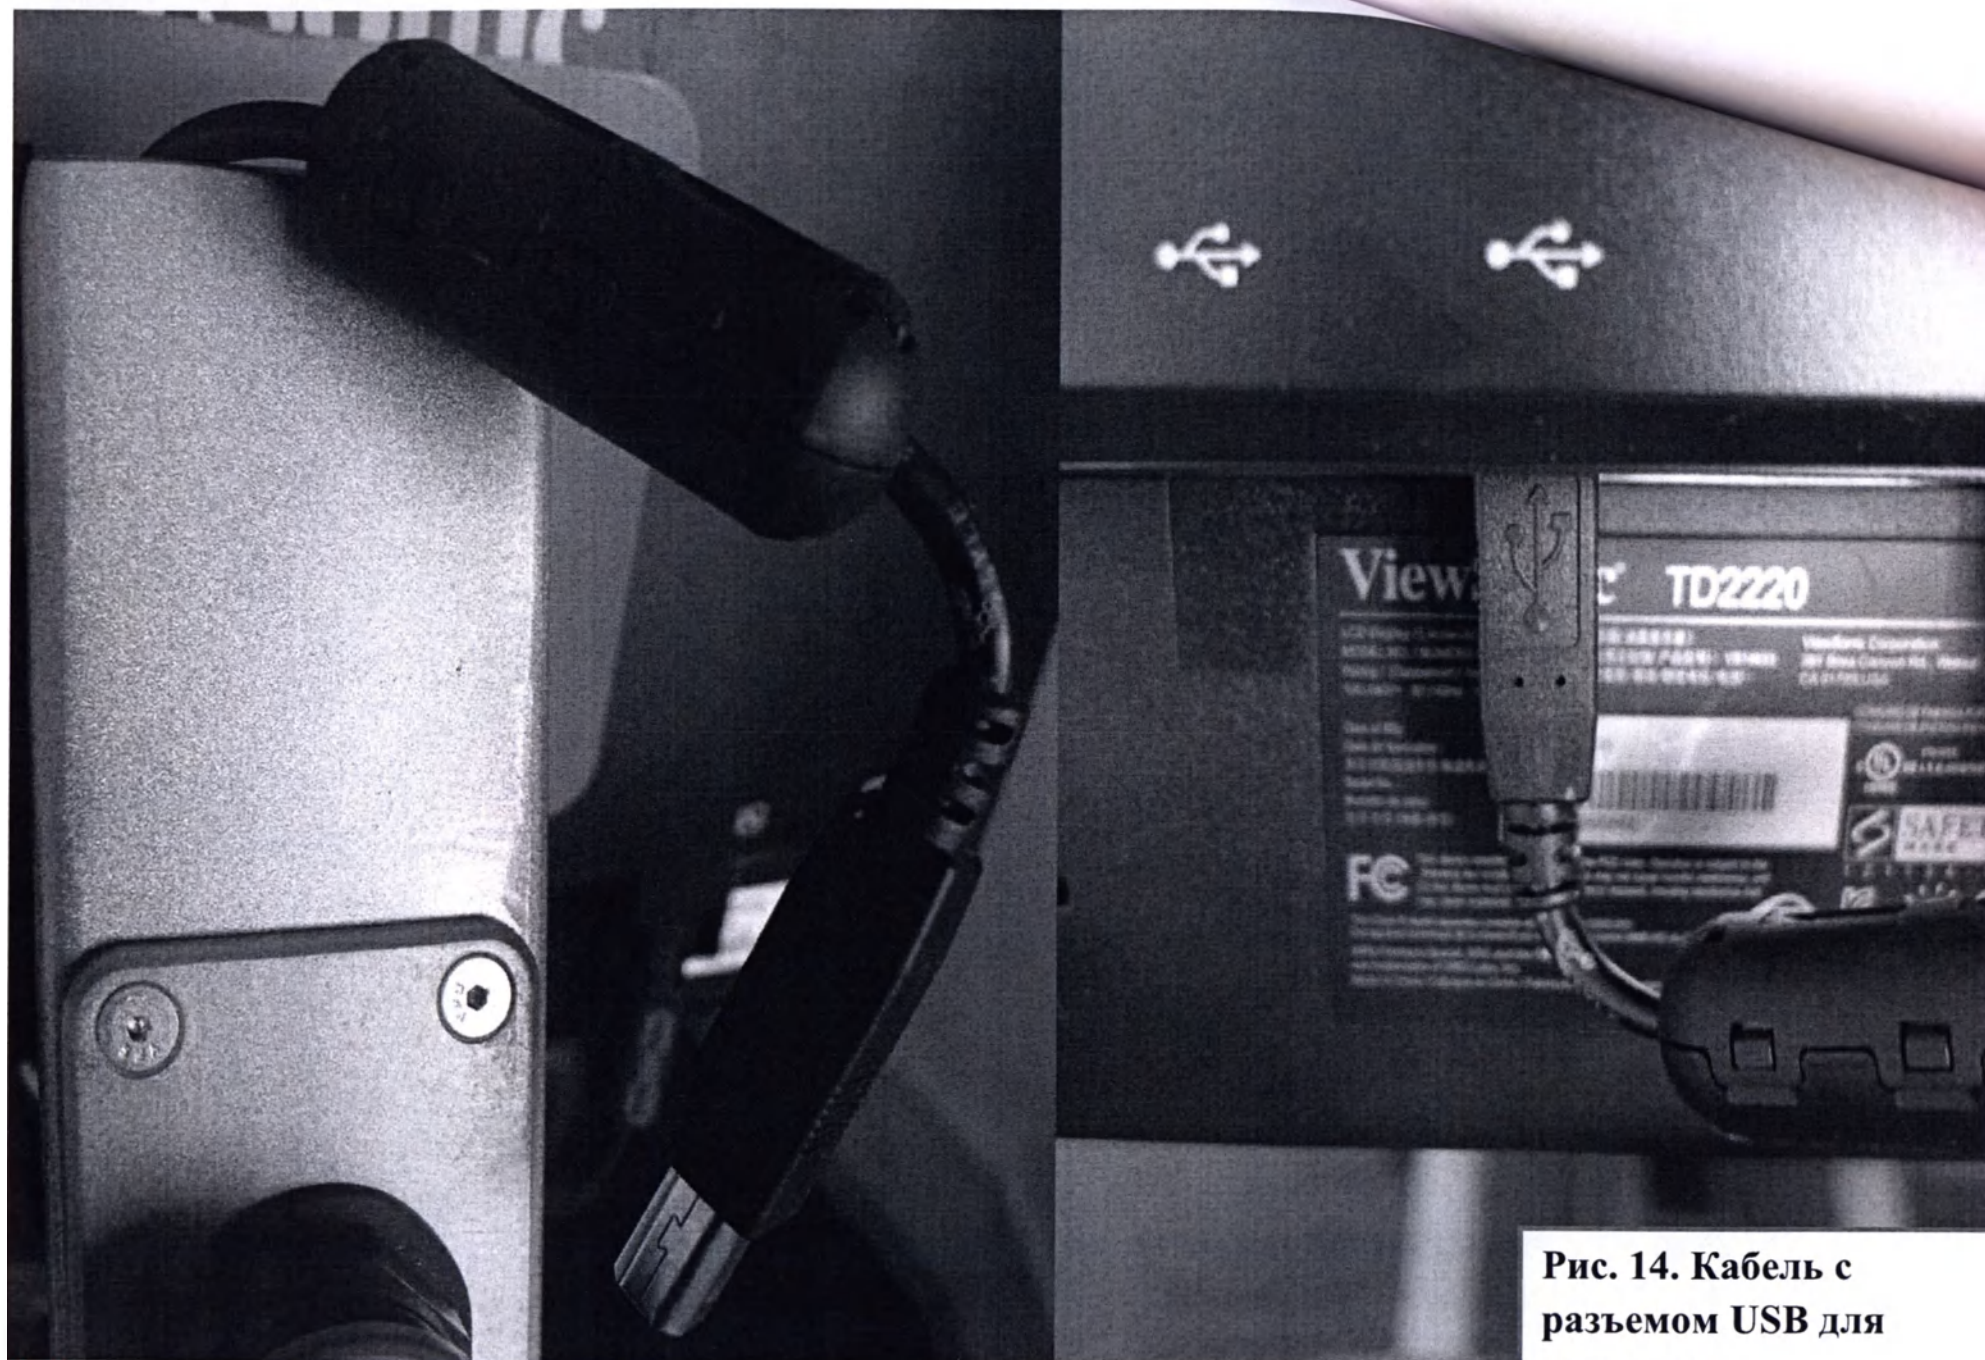


Рис. 14. Кабель с
разъемом USB для
монитора



**Рис. 15. Пульт
управления**

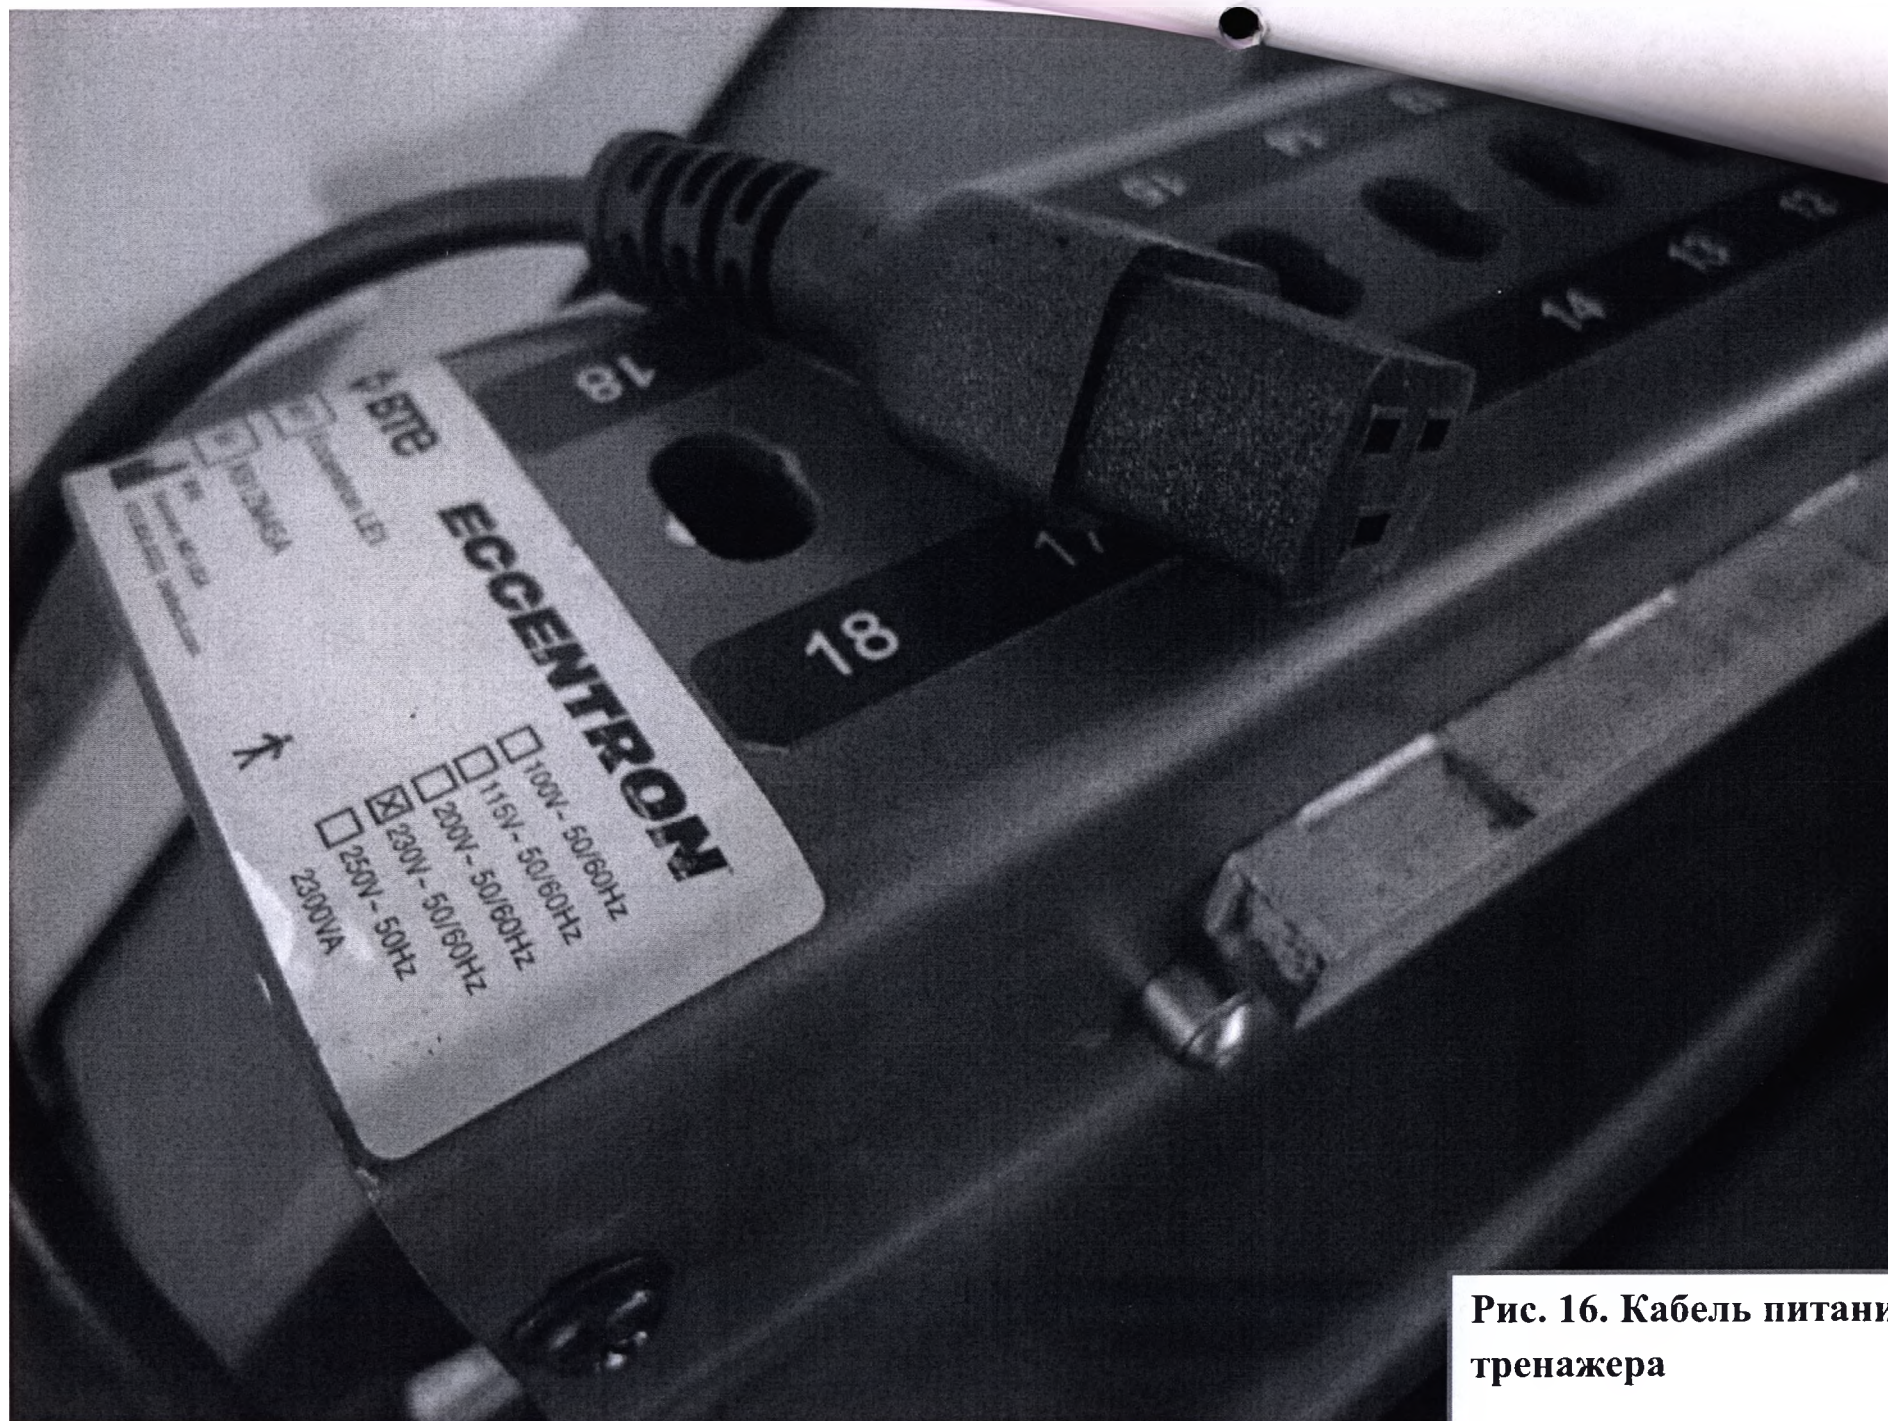


Рис. 16. Кабель питания
тренажера



**Рис. 17. Ключ гаечный
на $\frac{3}{4}$ дюйма**



Рис. 18. Отвертка (№2)

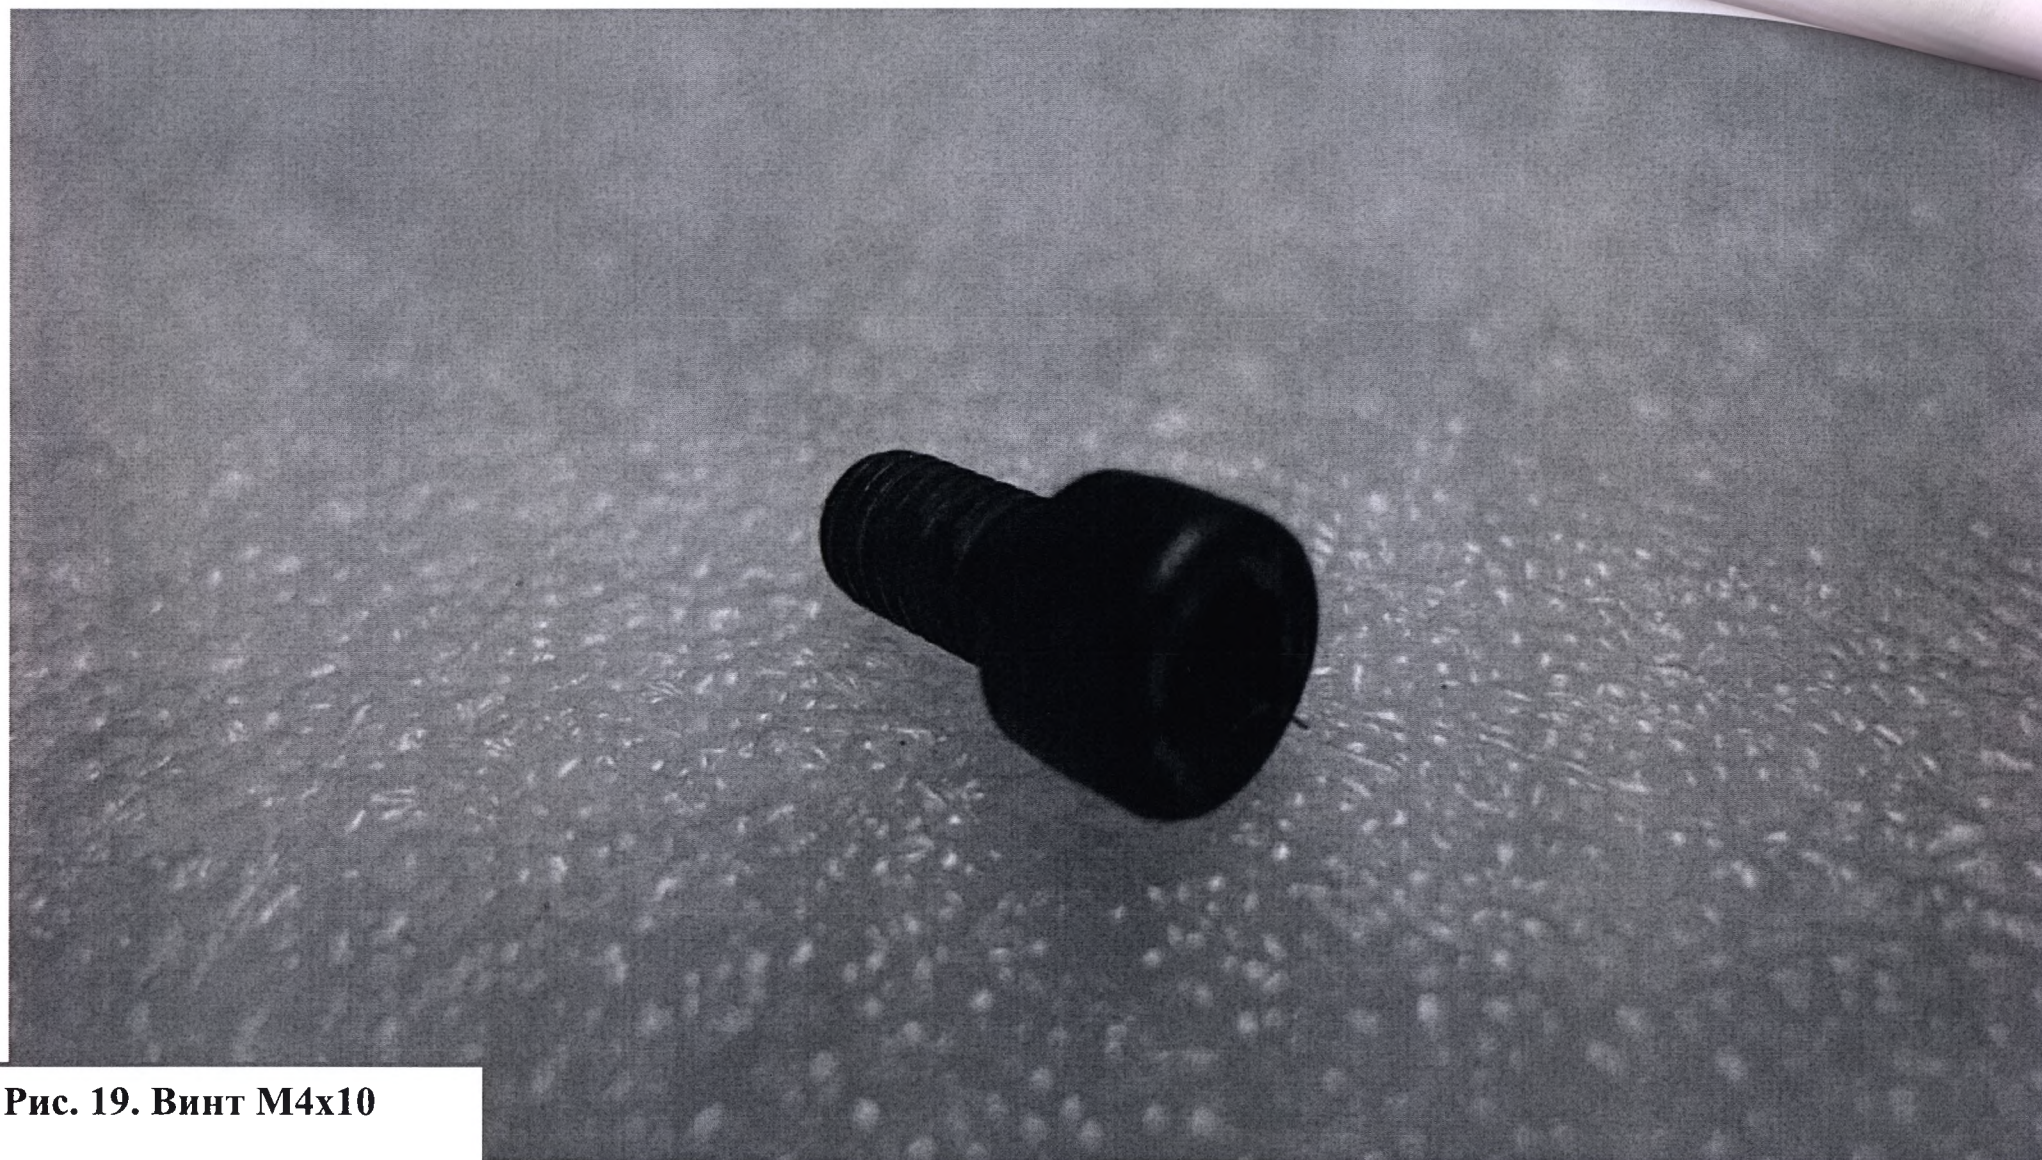


Рис. 19. Винт М4х10

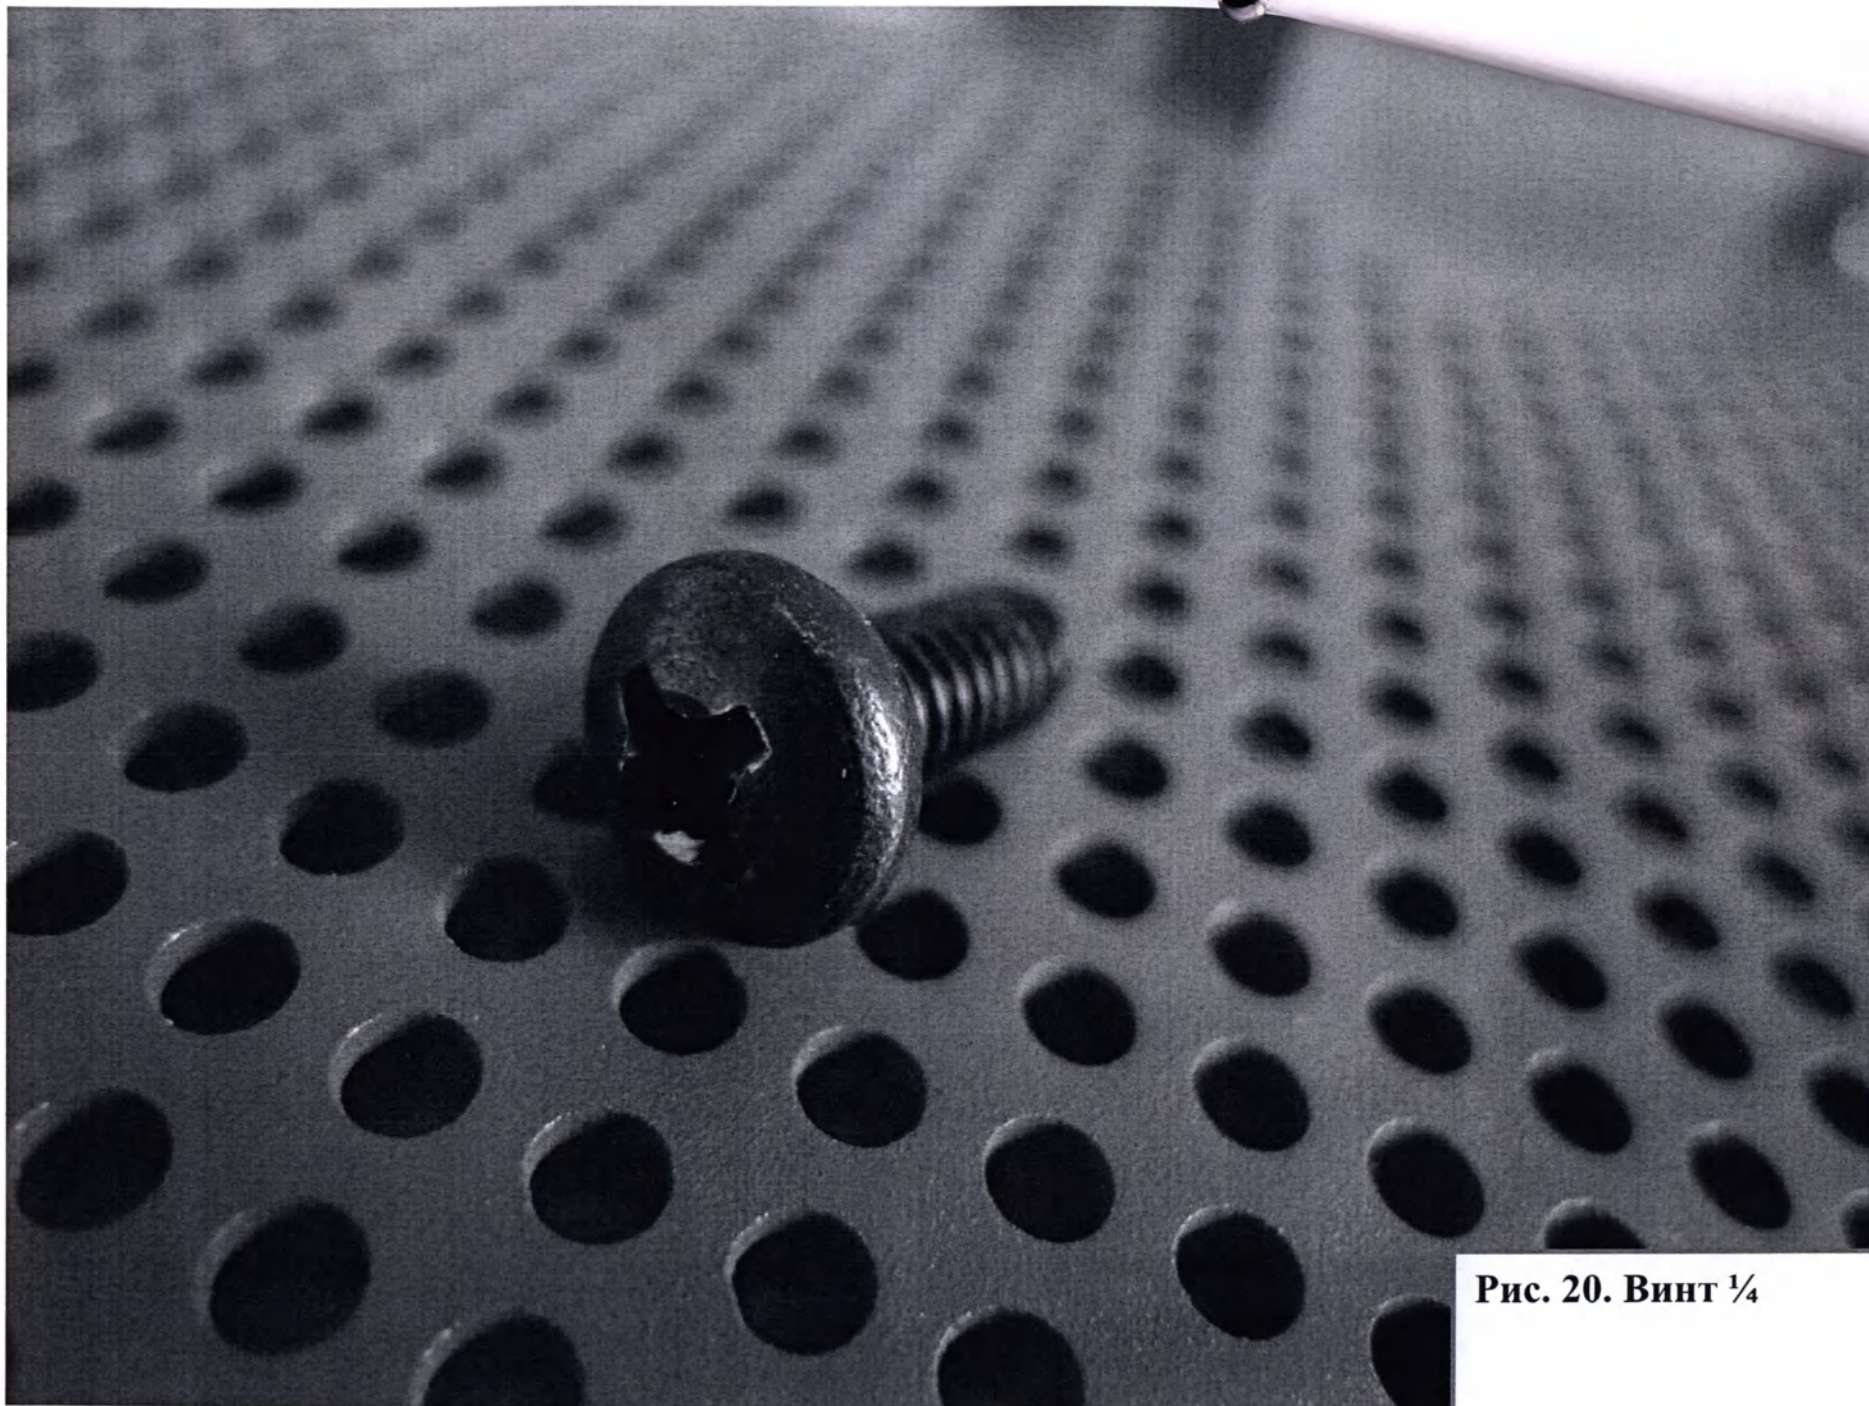


Рис. 20. Винт $\frac{1}{4}$



**Рис. 21. Ролики
транспортные**

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью

22 (двадцать
два)



Генеральный директор
ООО "СП Бека-Хоспитек"

/И.А. Труханов/

М.П.