


Система фототерапии фиброоптическая неонатальная Билифлекс 3150.00000000



Система фототерапии фиброоптическая неонатальная Билифлекс 3150.00000000

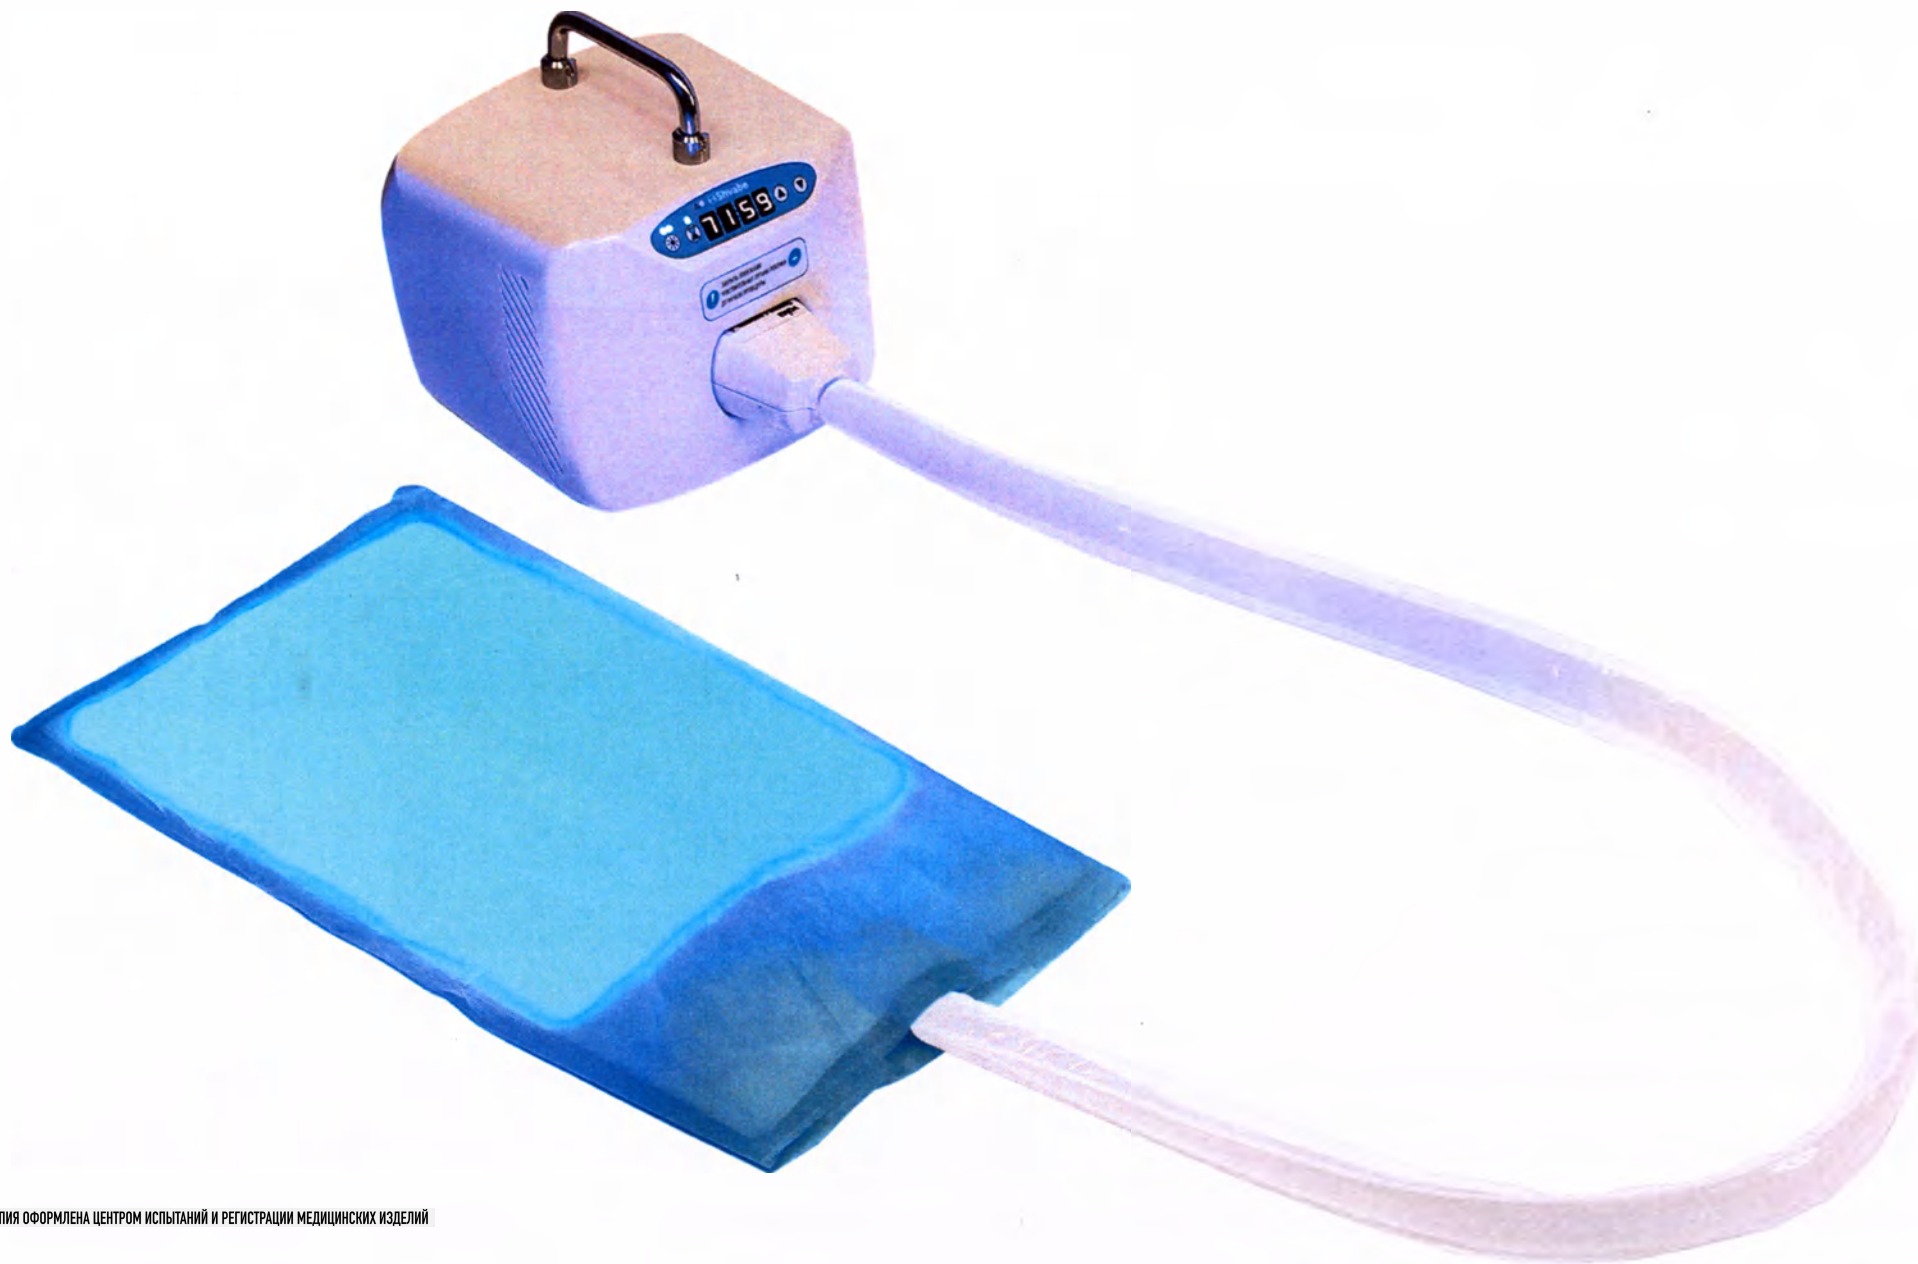

Блок управления 3150.10000000



Блок управления 3150.10000000



ПИТАНИЕ
98-242 В 50 Гц
100 В · А
FU1 Т 2 А 250 В FU2 Т 2 А 250 В

УОМЗ
Система фототерапии
фиброоптическая неонатальная
Биофлекс

3150.00000000
ТУ 9444-ТЭС-07539541-2015


IP23

SN 00001

2015

ВОСТОЧНАЯ УЛ., 336, ЕКАТЕРИНБУРГ,
РОССИЯ, 620108

Полотно с разъемом 3150.15000000

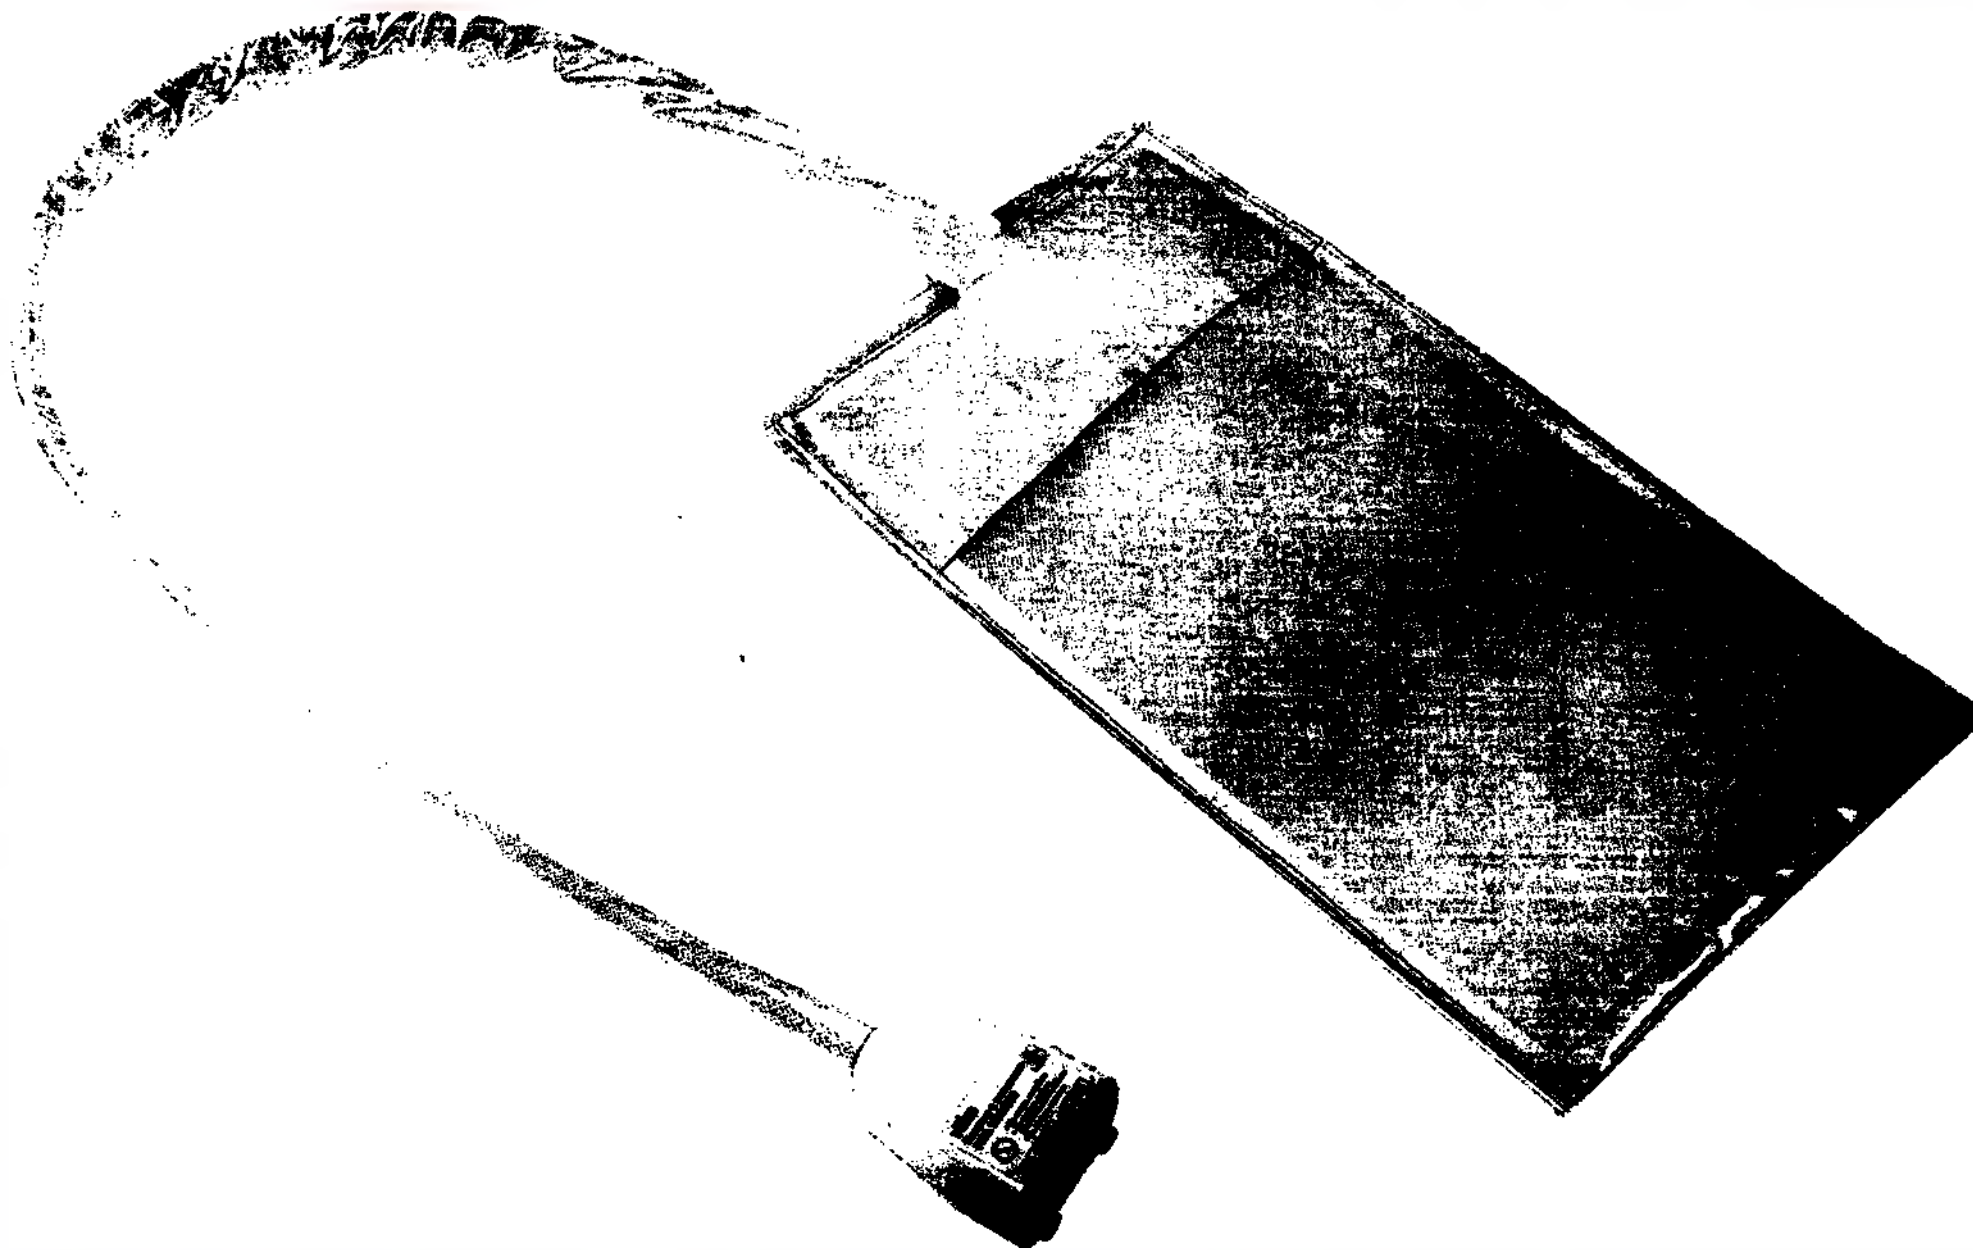

Кабель питания 3150.00001000



Кронштейн 3150.17000000



Чехол, ТУ 9398-003-38957094-2005, «Здравмедтех-Е» РУ от 24.05.2011 №ФСР 2010/08321



Защита для глаз при фототерапии, «Ковидиен Ллс» (США), рег.удостоверение от 02.10.2013г. №ФСЗ 2012/11846



Предохранитель, 0215002.P, Littelfuse (5x20; 2 A Time-Lag, 1500 A @ 250 VAC)

