

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель Департамента
Регистрации и Сертификации
России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

С.Б. Парахина

2016г




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**"Система для транскраниального хирургического лечения
фокусированным ультразвуком под контролем МРТ
ExAblate 4000 с принадлежностями"**


Система для транскраниального хирургического лечения фокусированным ультразвуком под контролем МРТ ExAblate 4000 с принадлежностями.

I. Базовый состав:

1. Стол пациента.

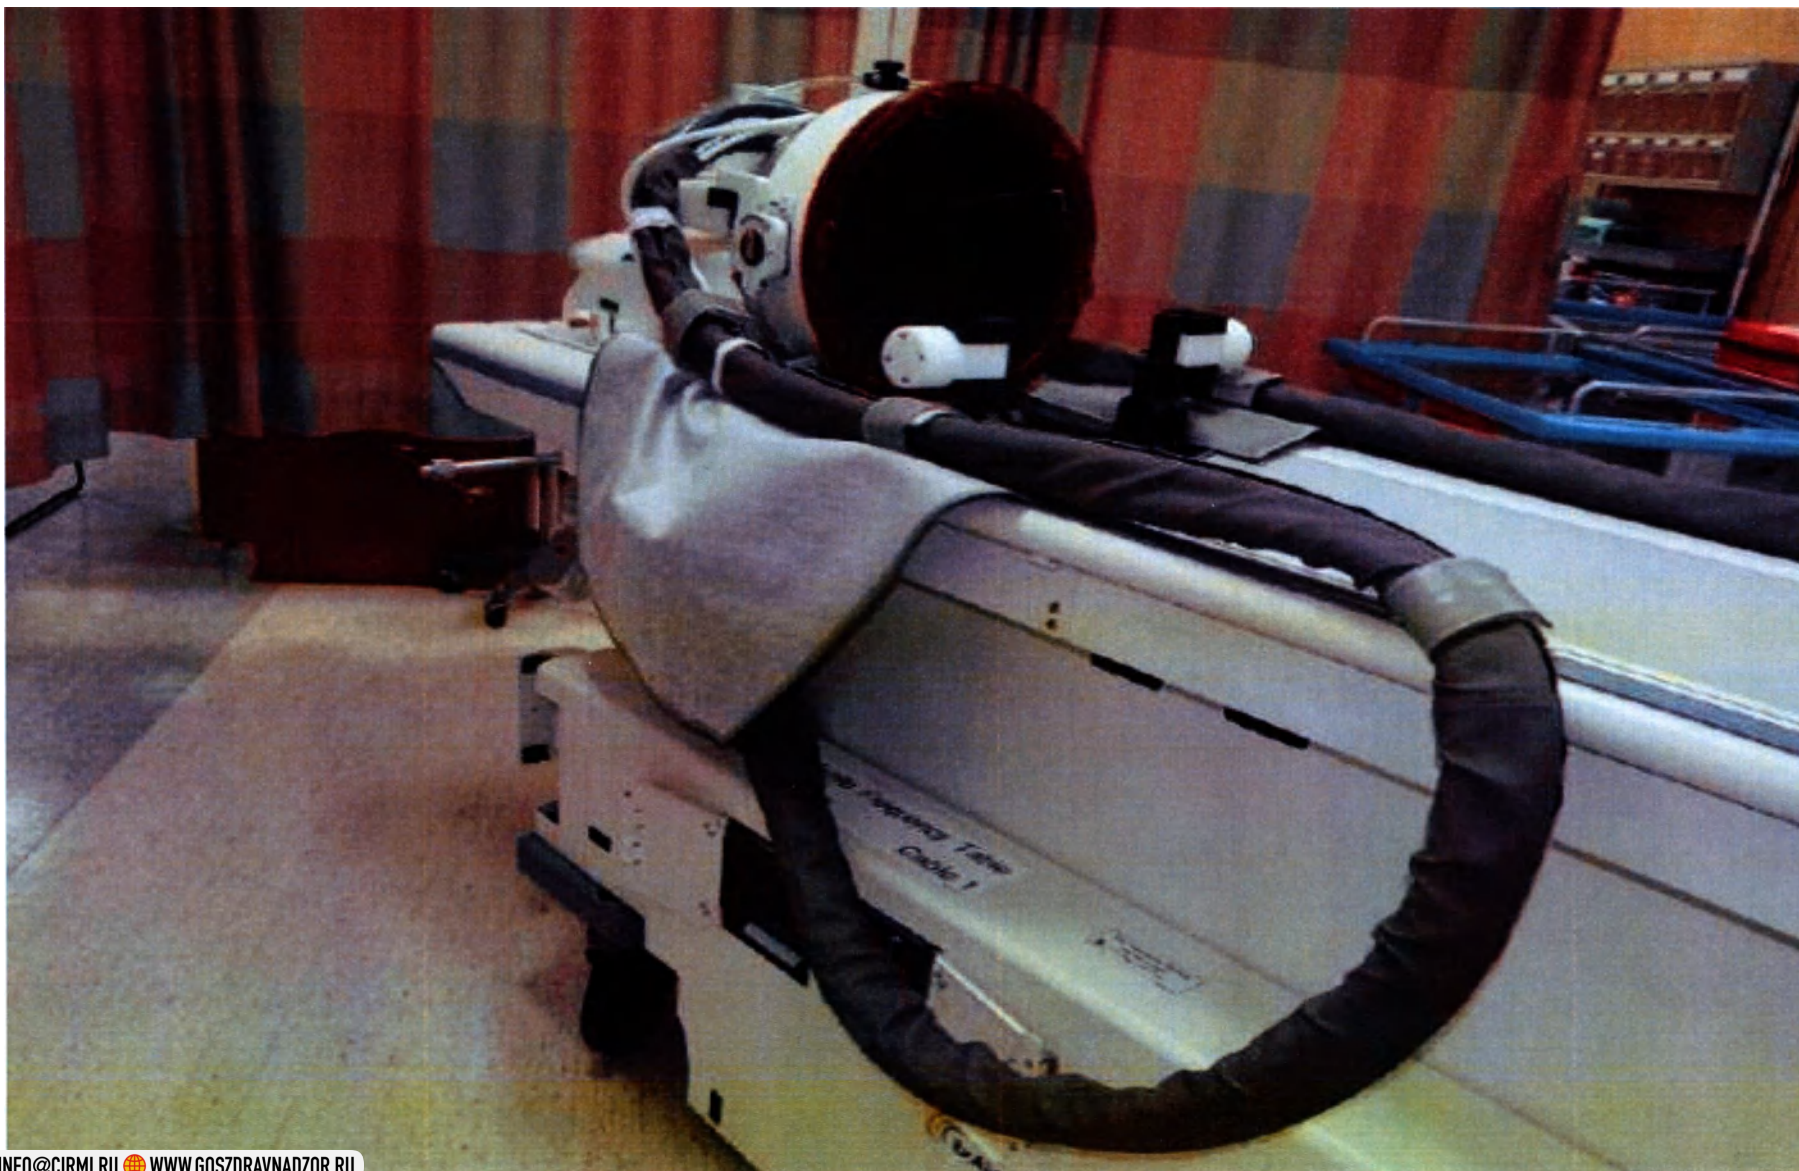


2. Рабочая станция.

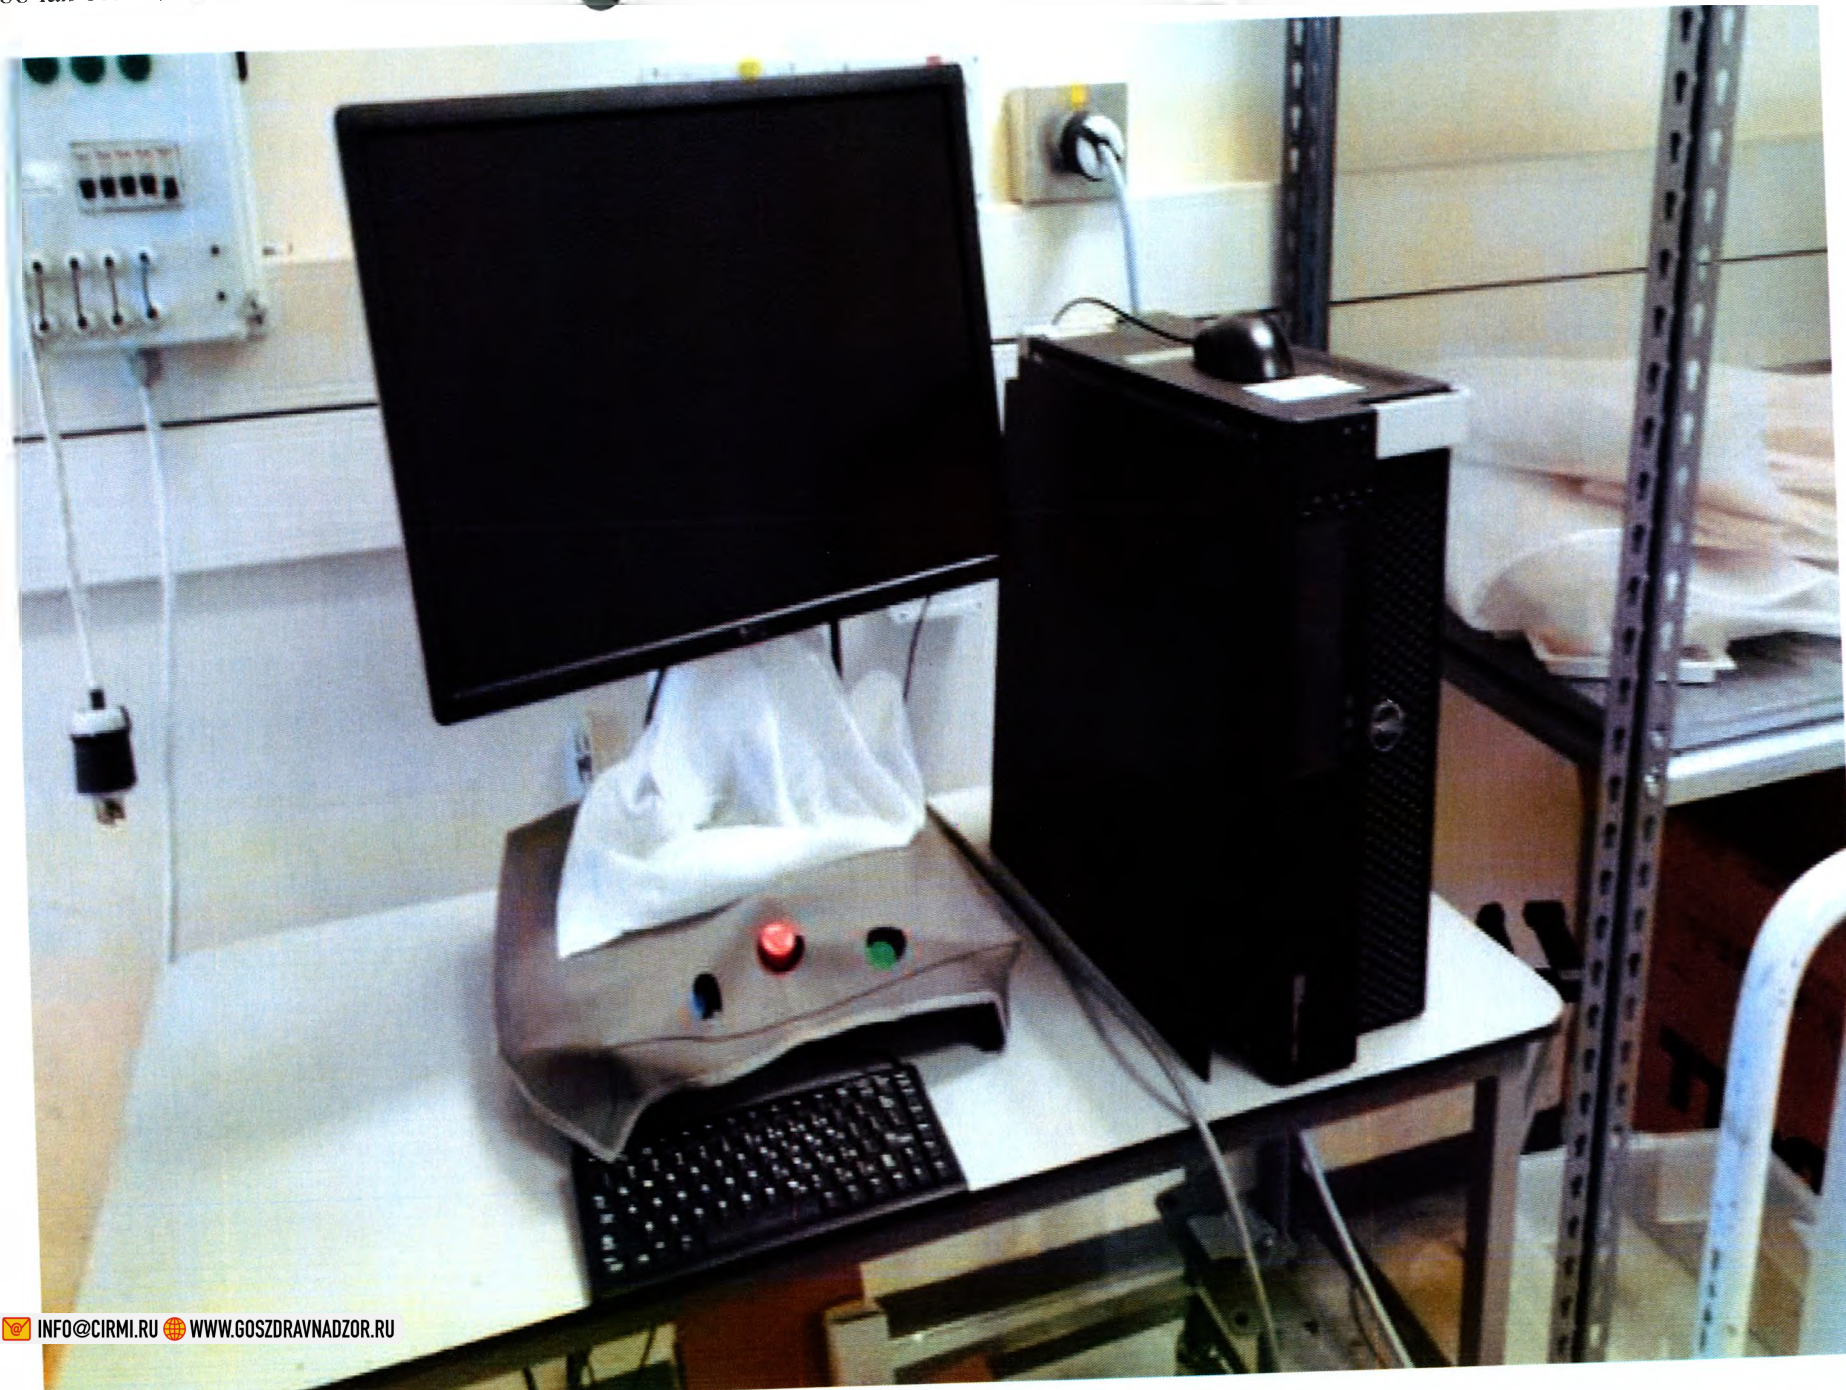

3. Шкаф с оборудованием.




4. Блок Front End.

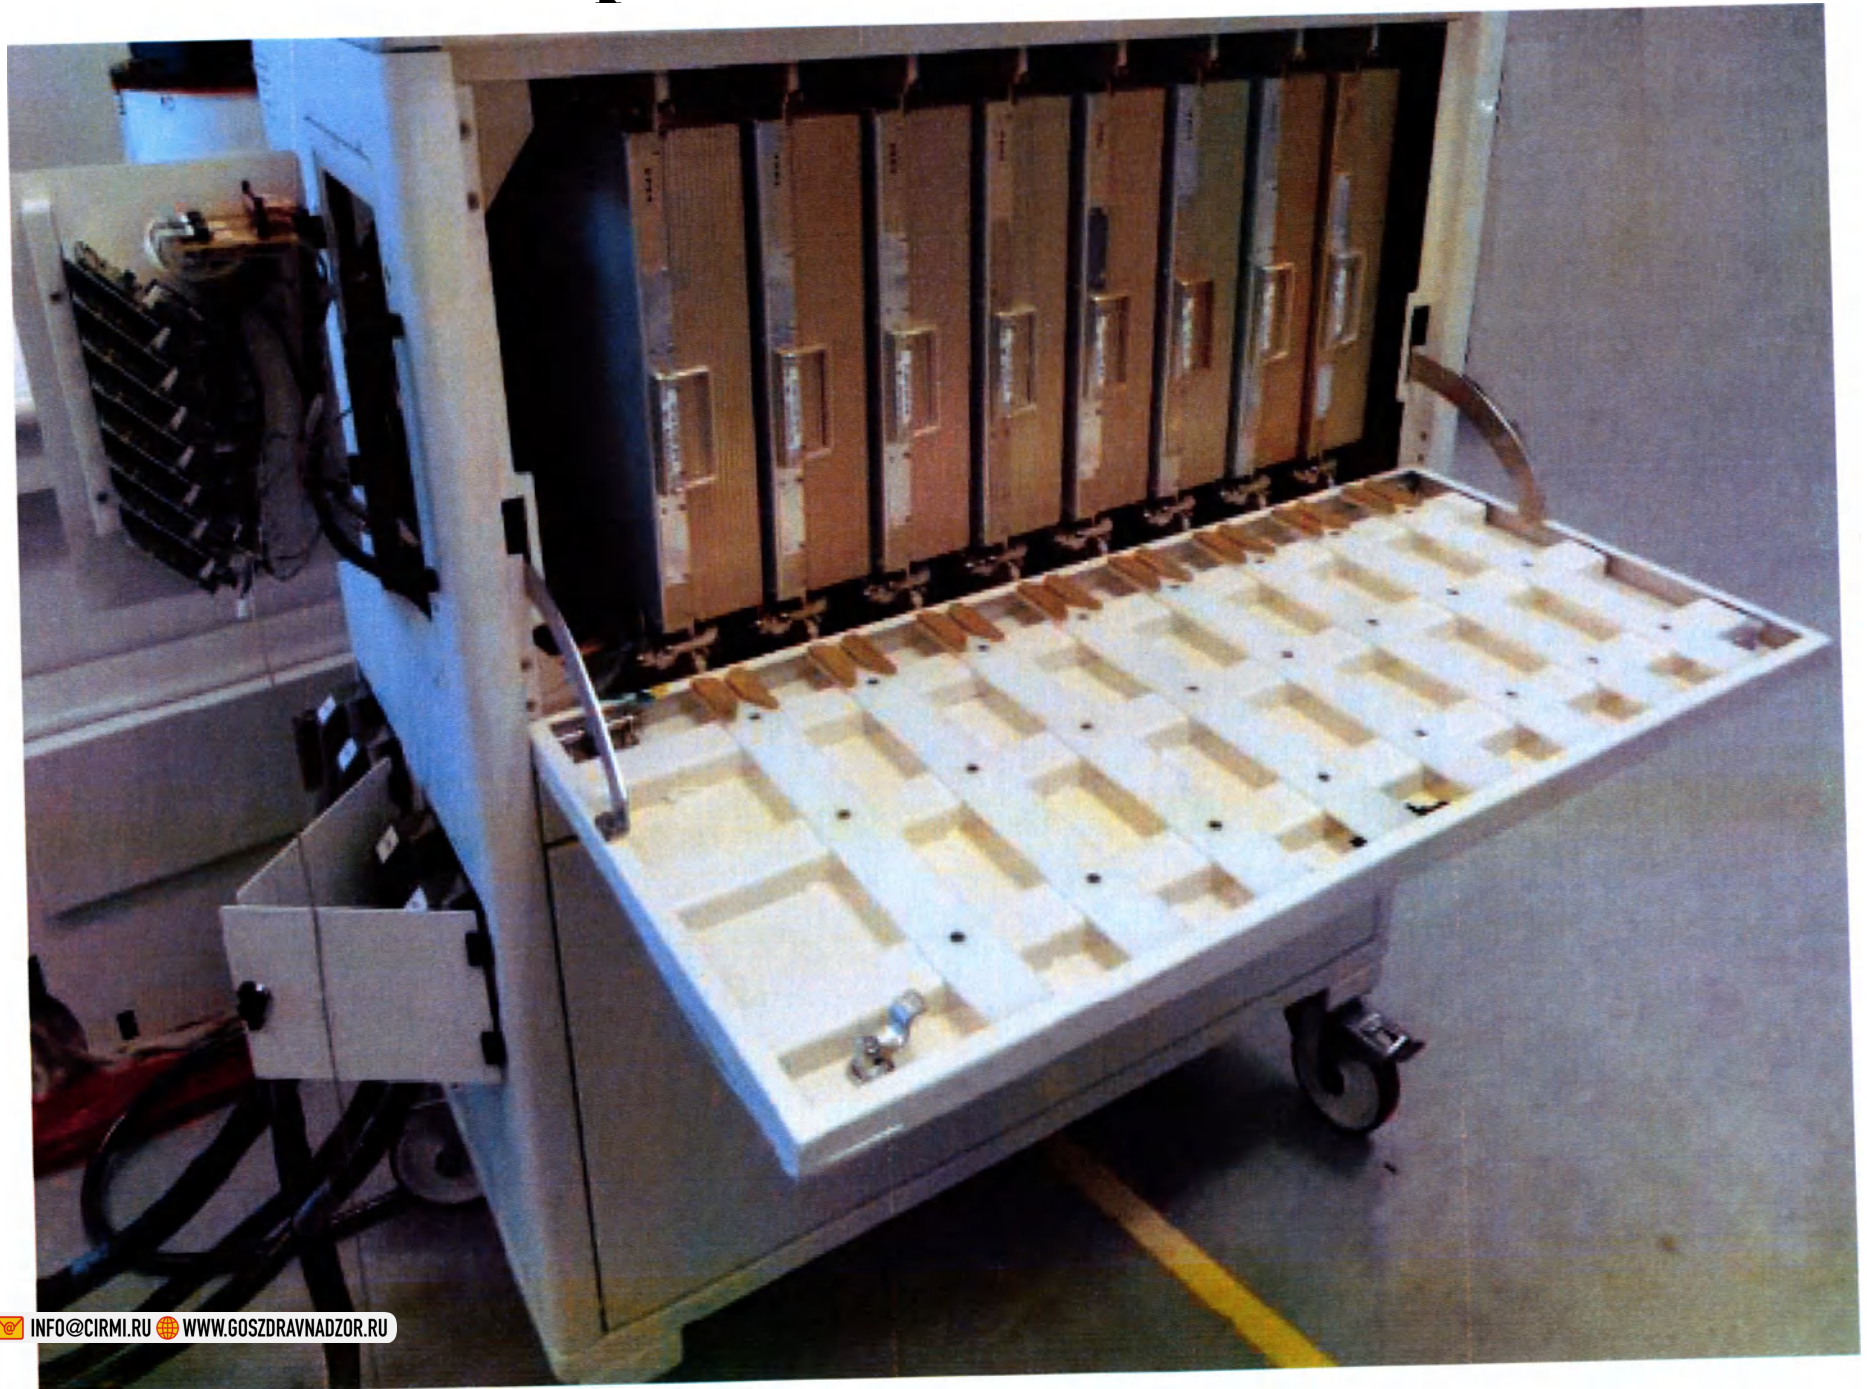

5. Система циркуляции воды.




6. Программное обеспечение Brain с актуальной конфигурацией системы.

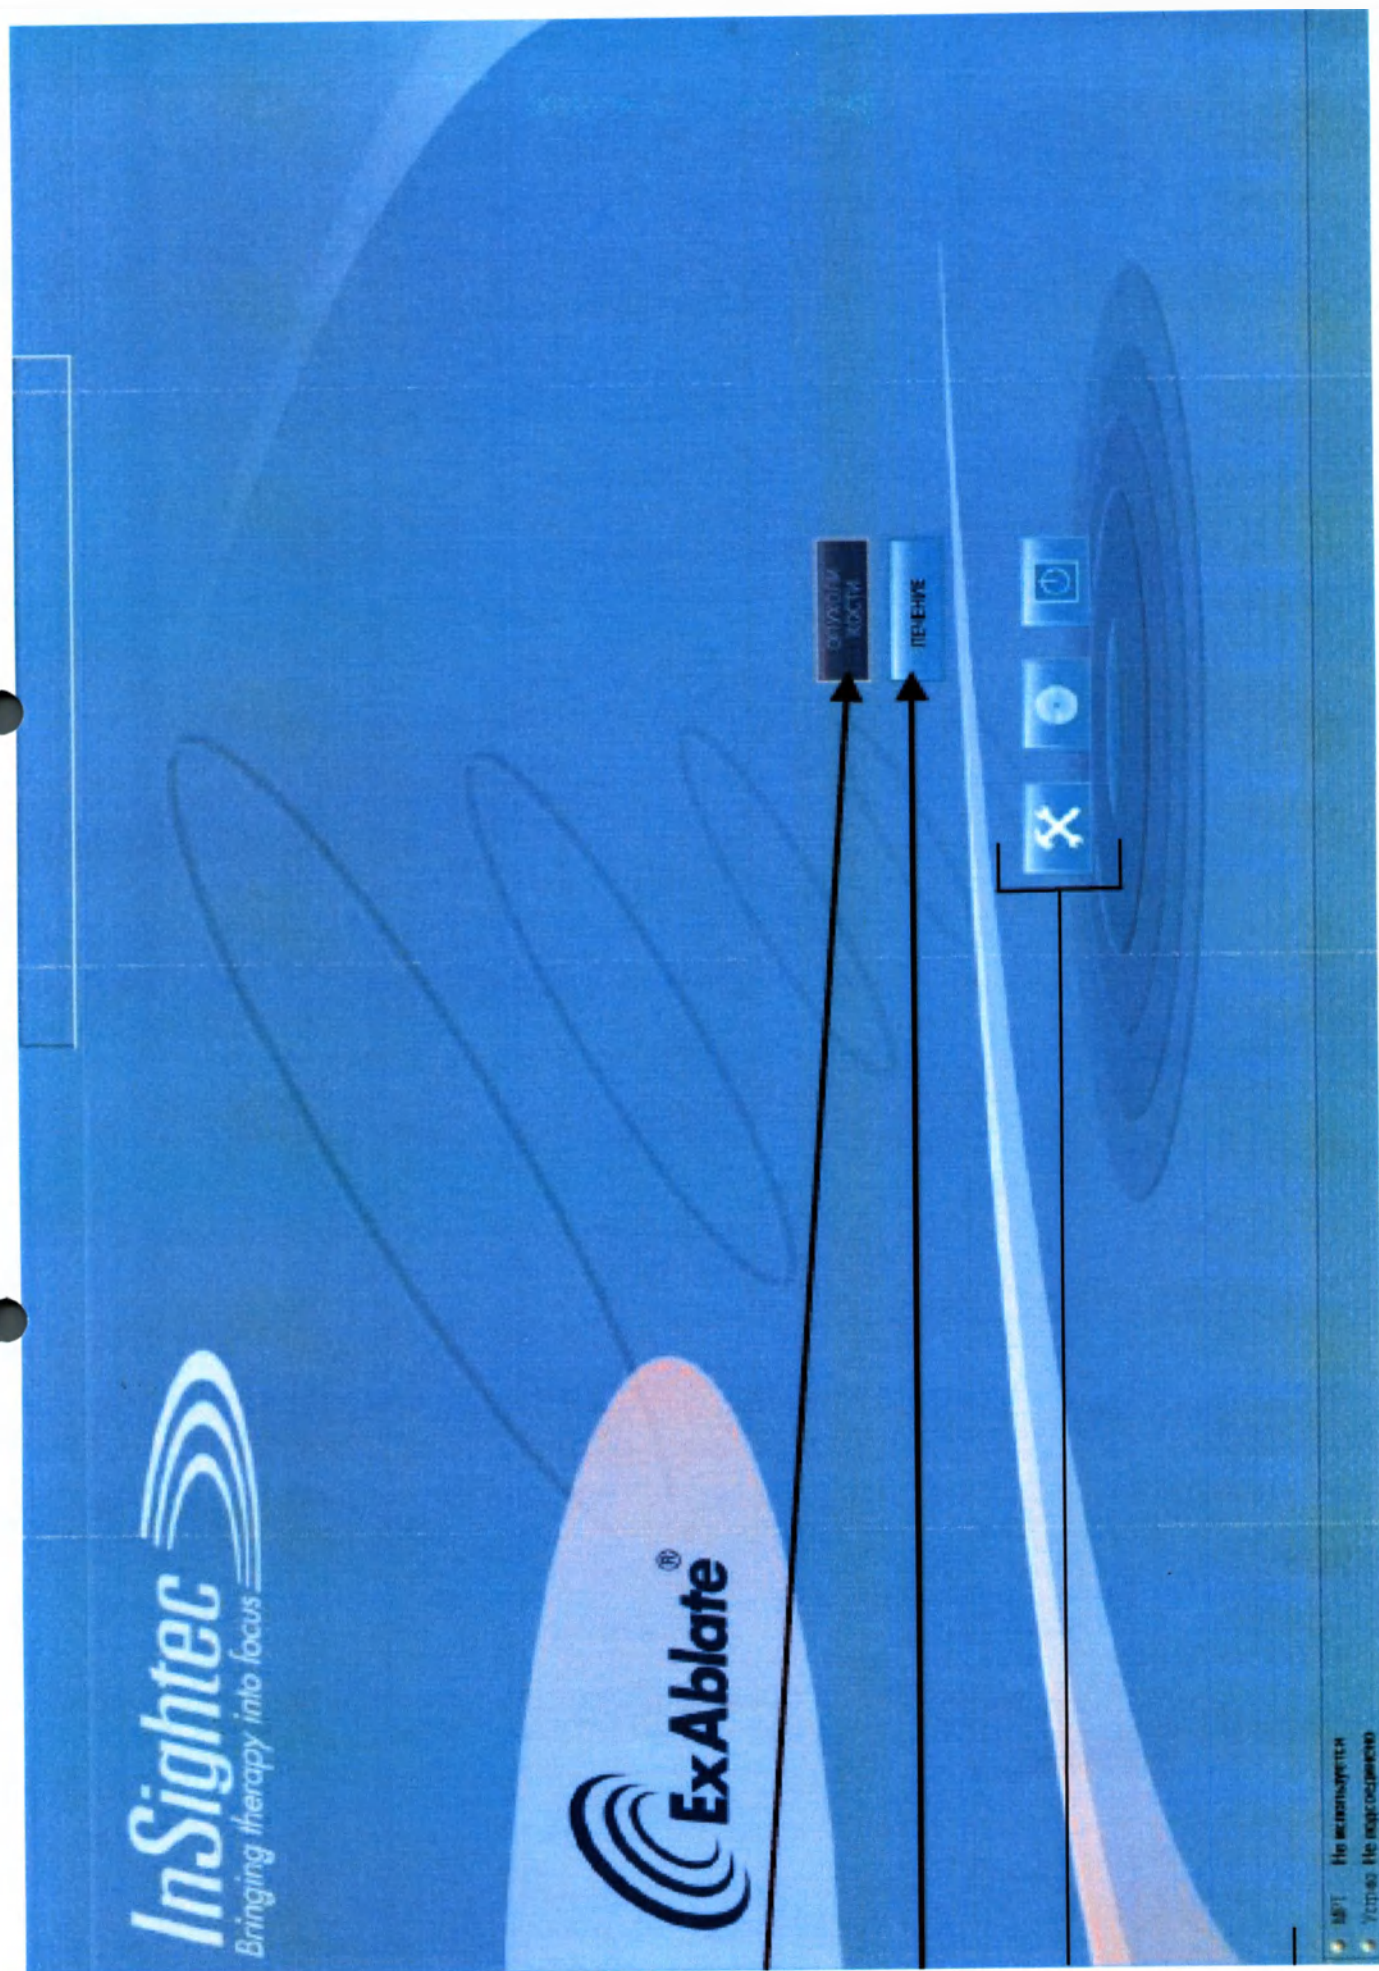


II. Принадлежности:

1. Лоток для стола для лечения головного мозга.

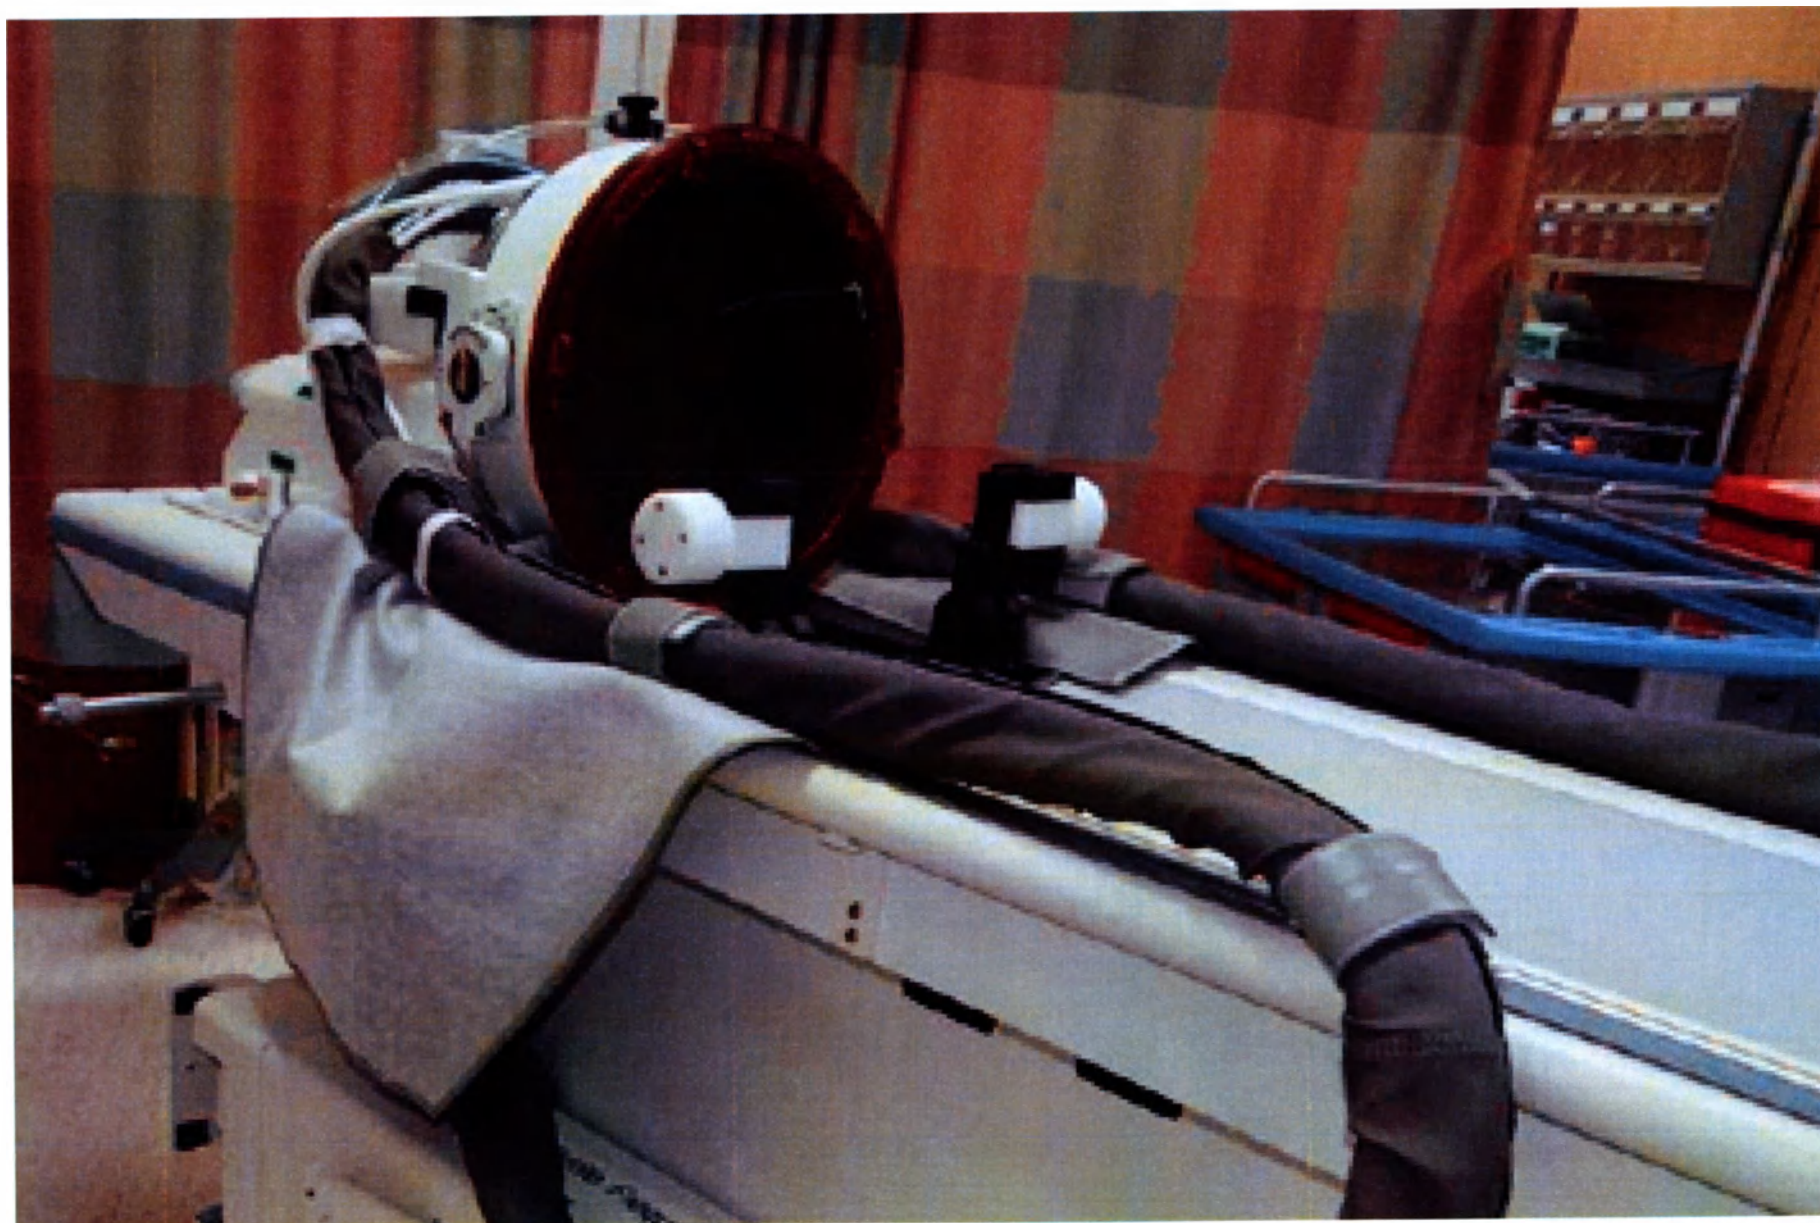


2. Контейнер для хранения лотков малый.

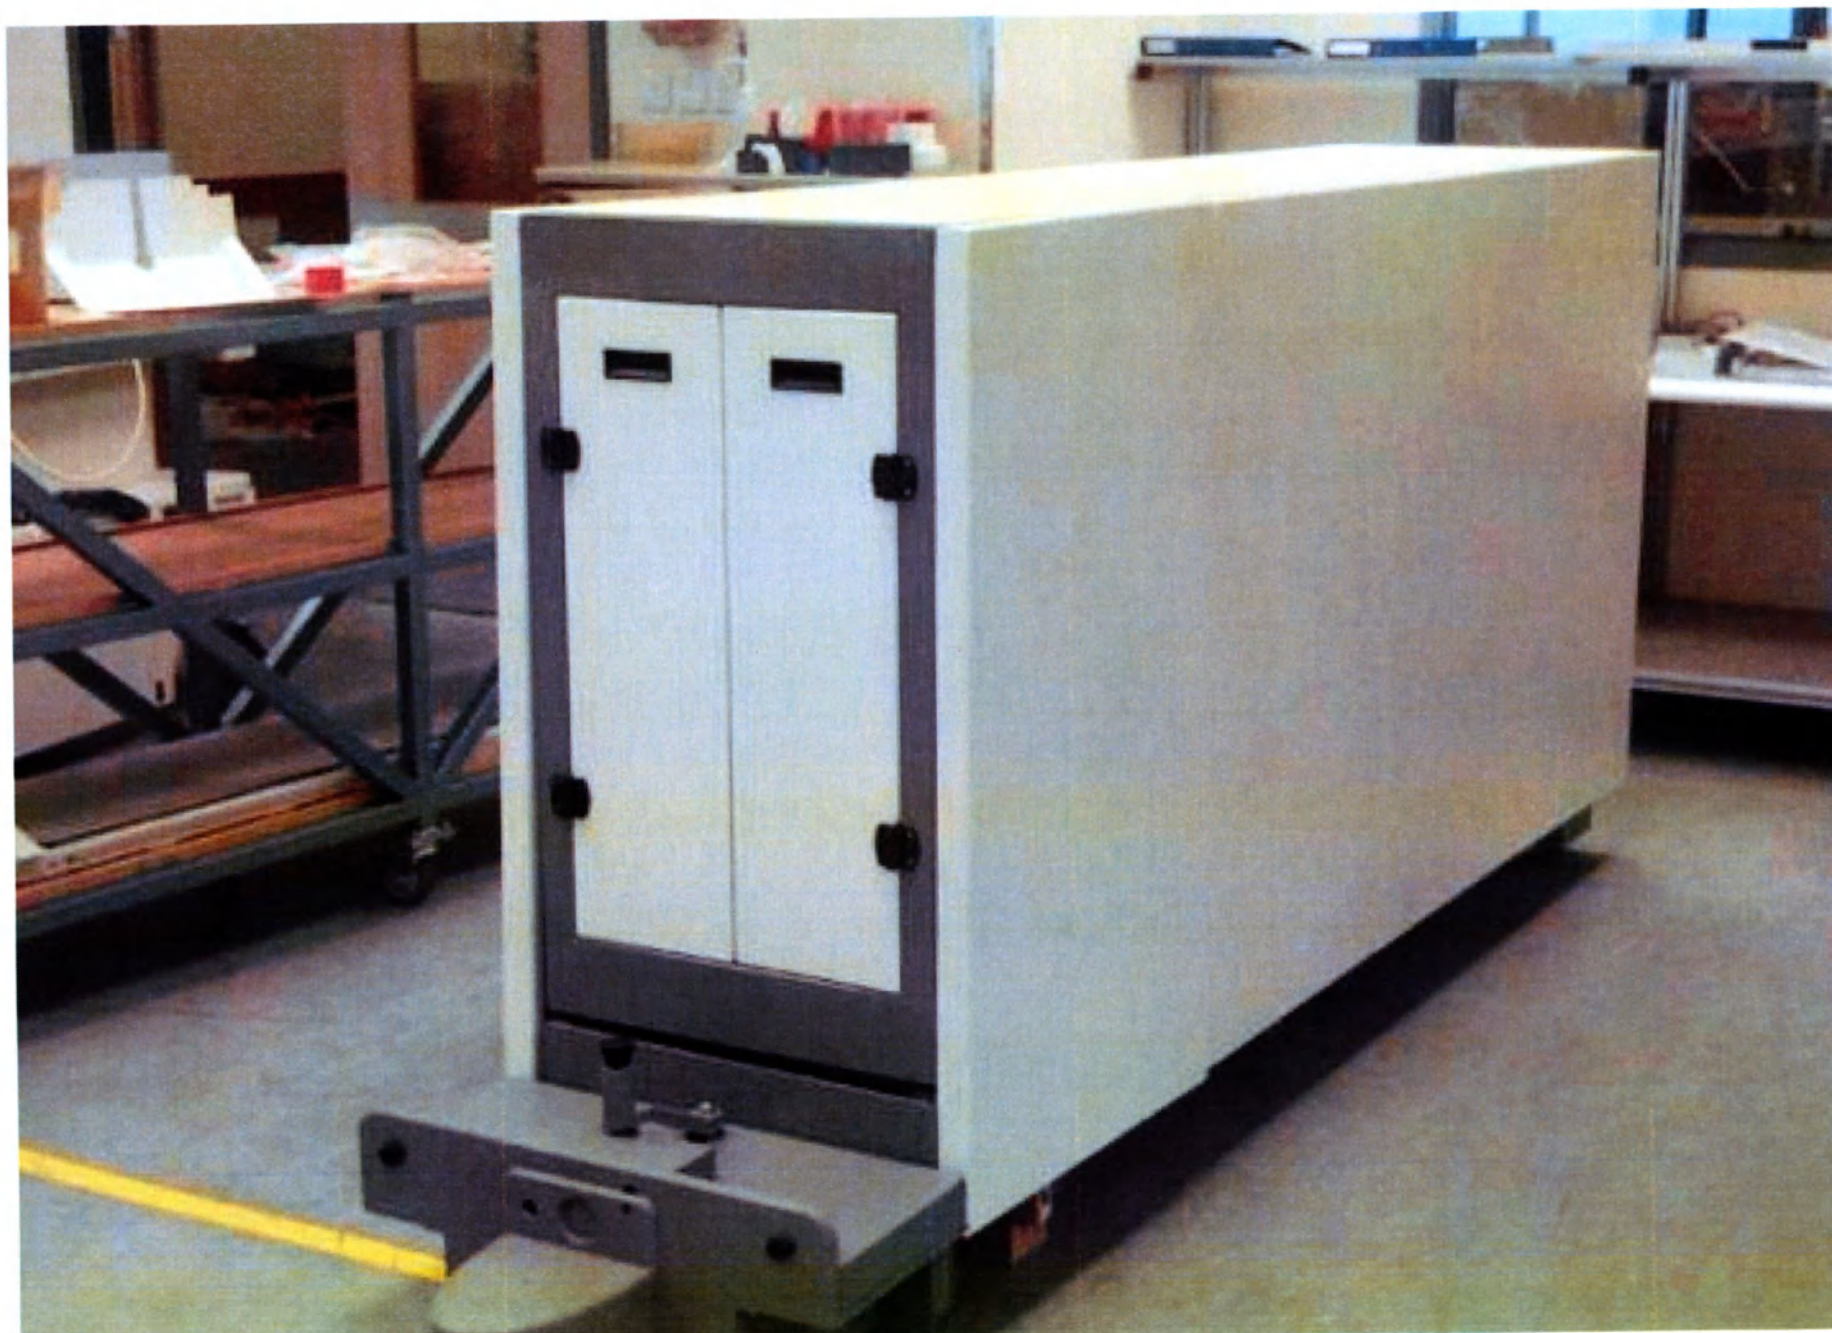


3. Контейнер для хранения лотков большой.




4. Стол базовый.

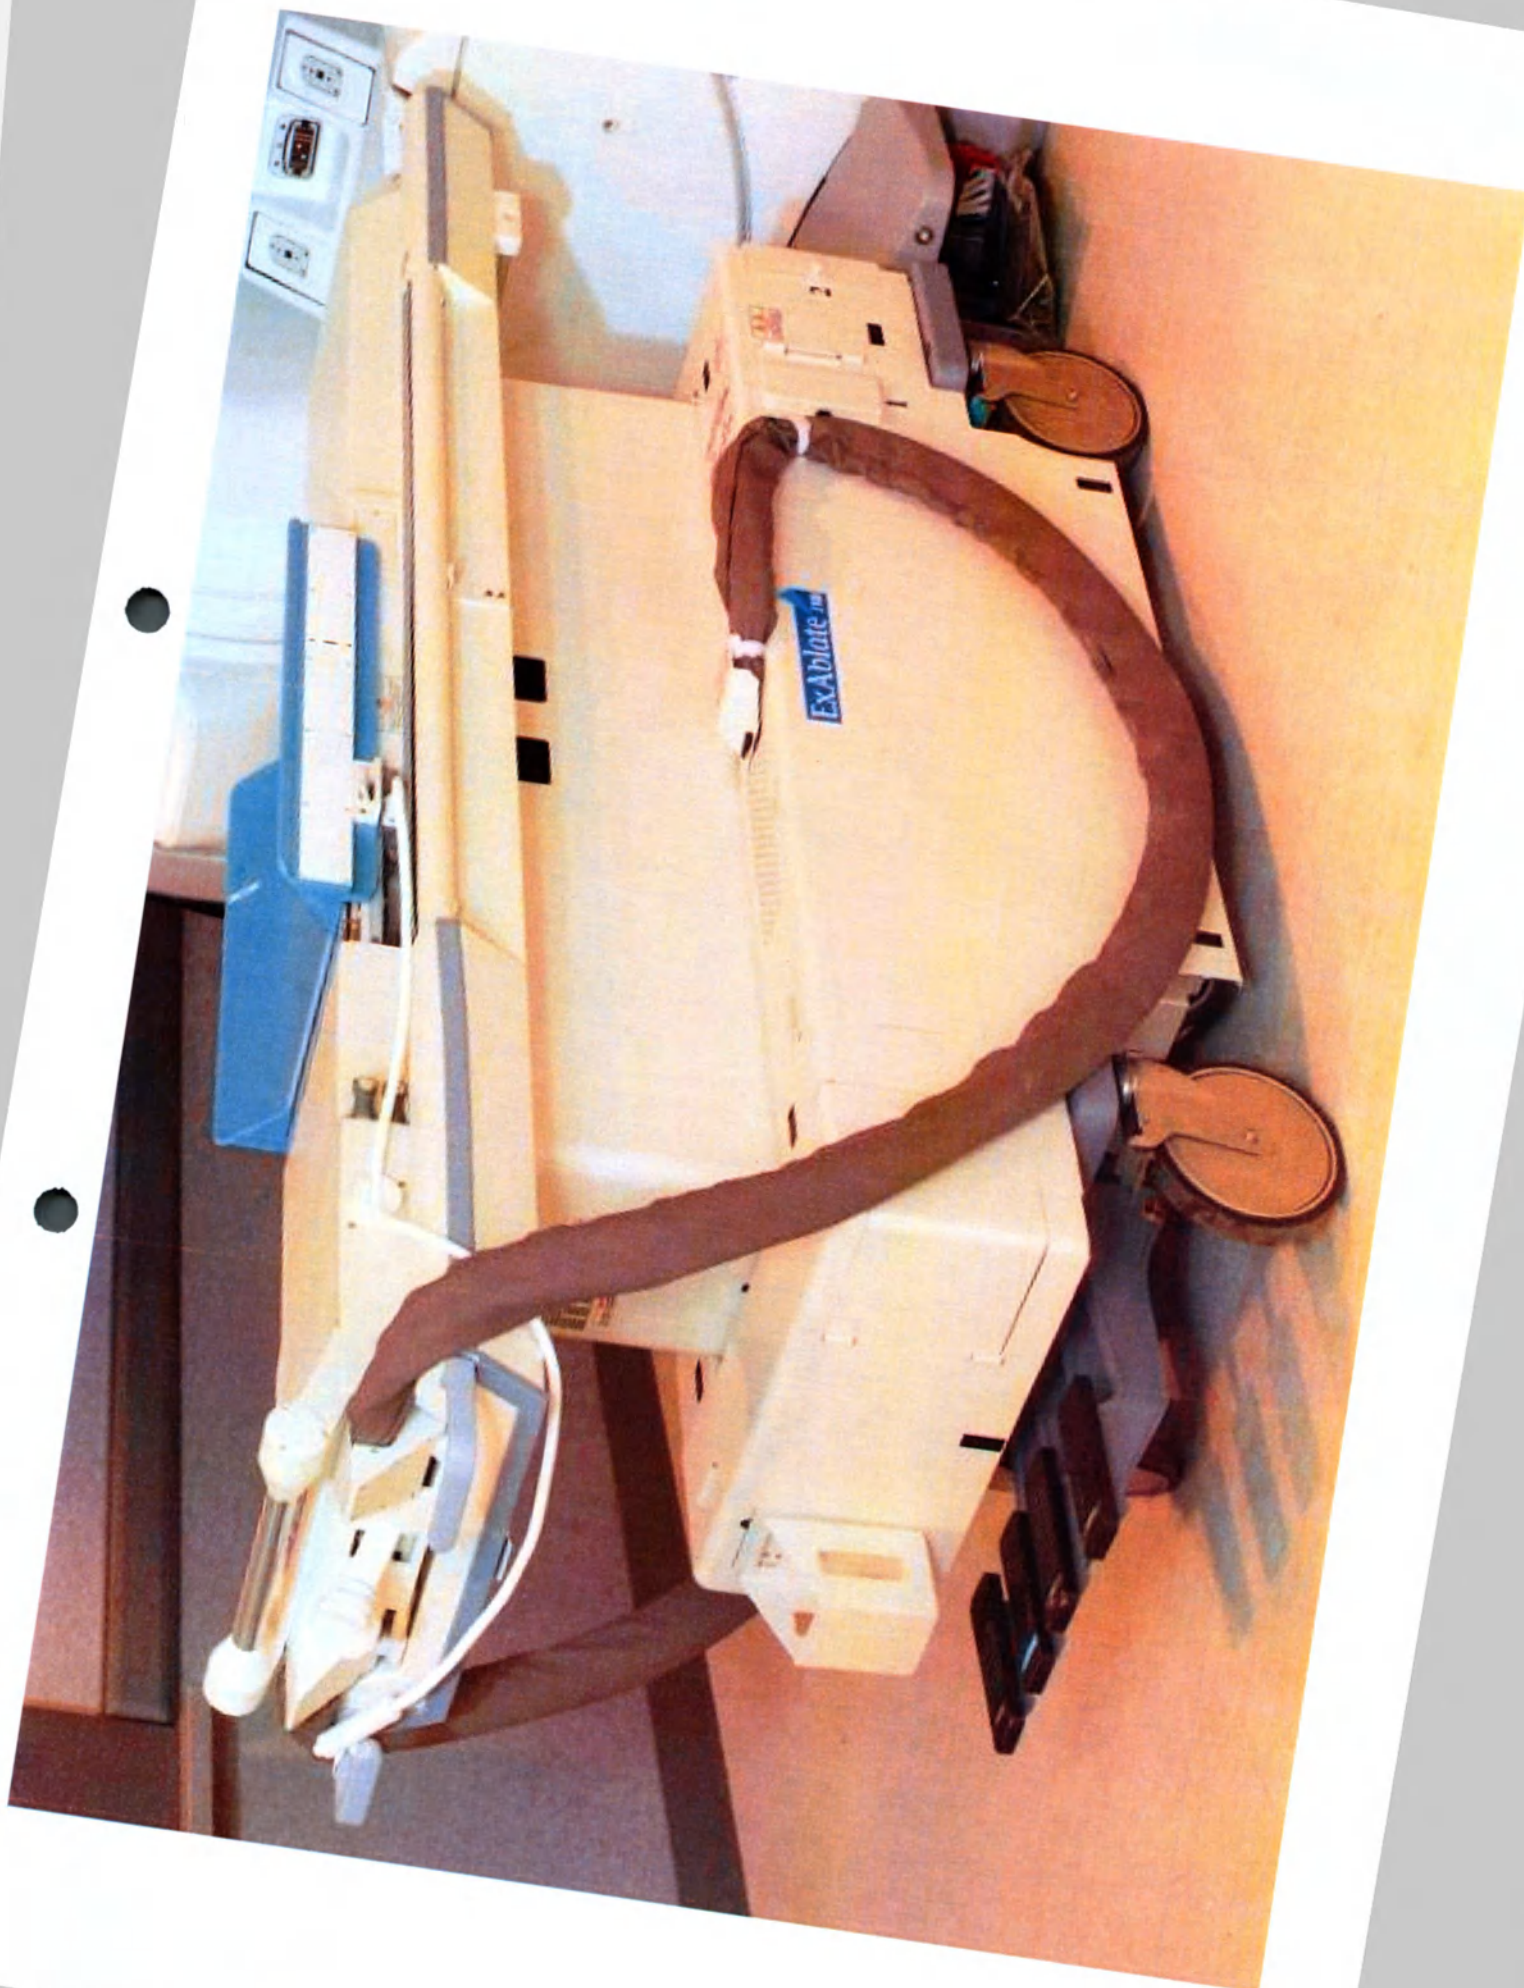

5. Дополнительные рабочие станции.

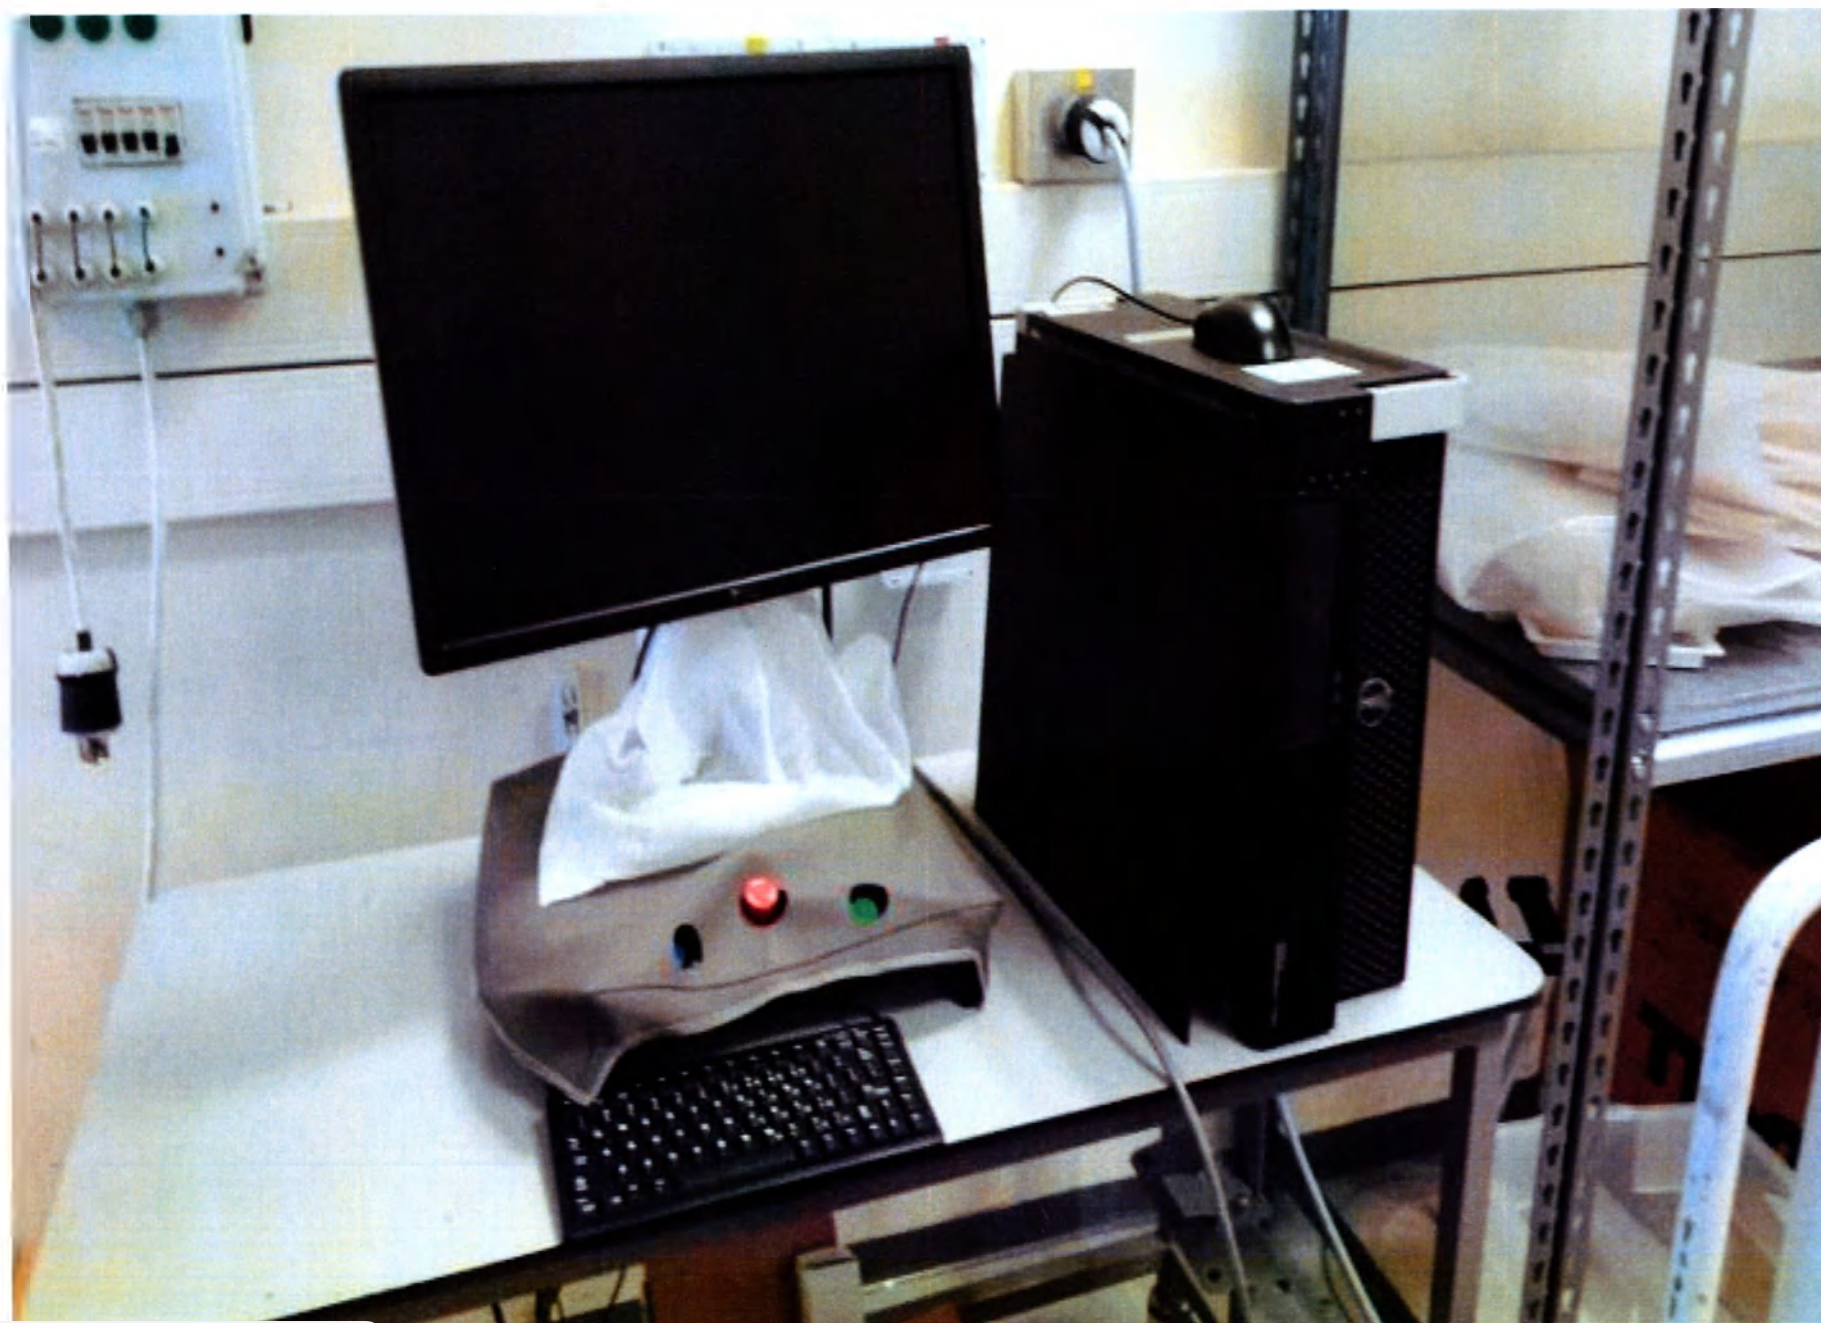


6. Ультразвуковой излучатель для лечения головного мозга.

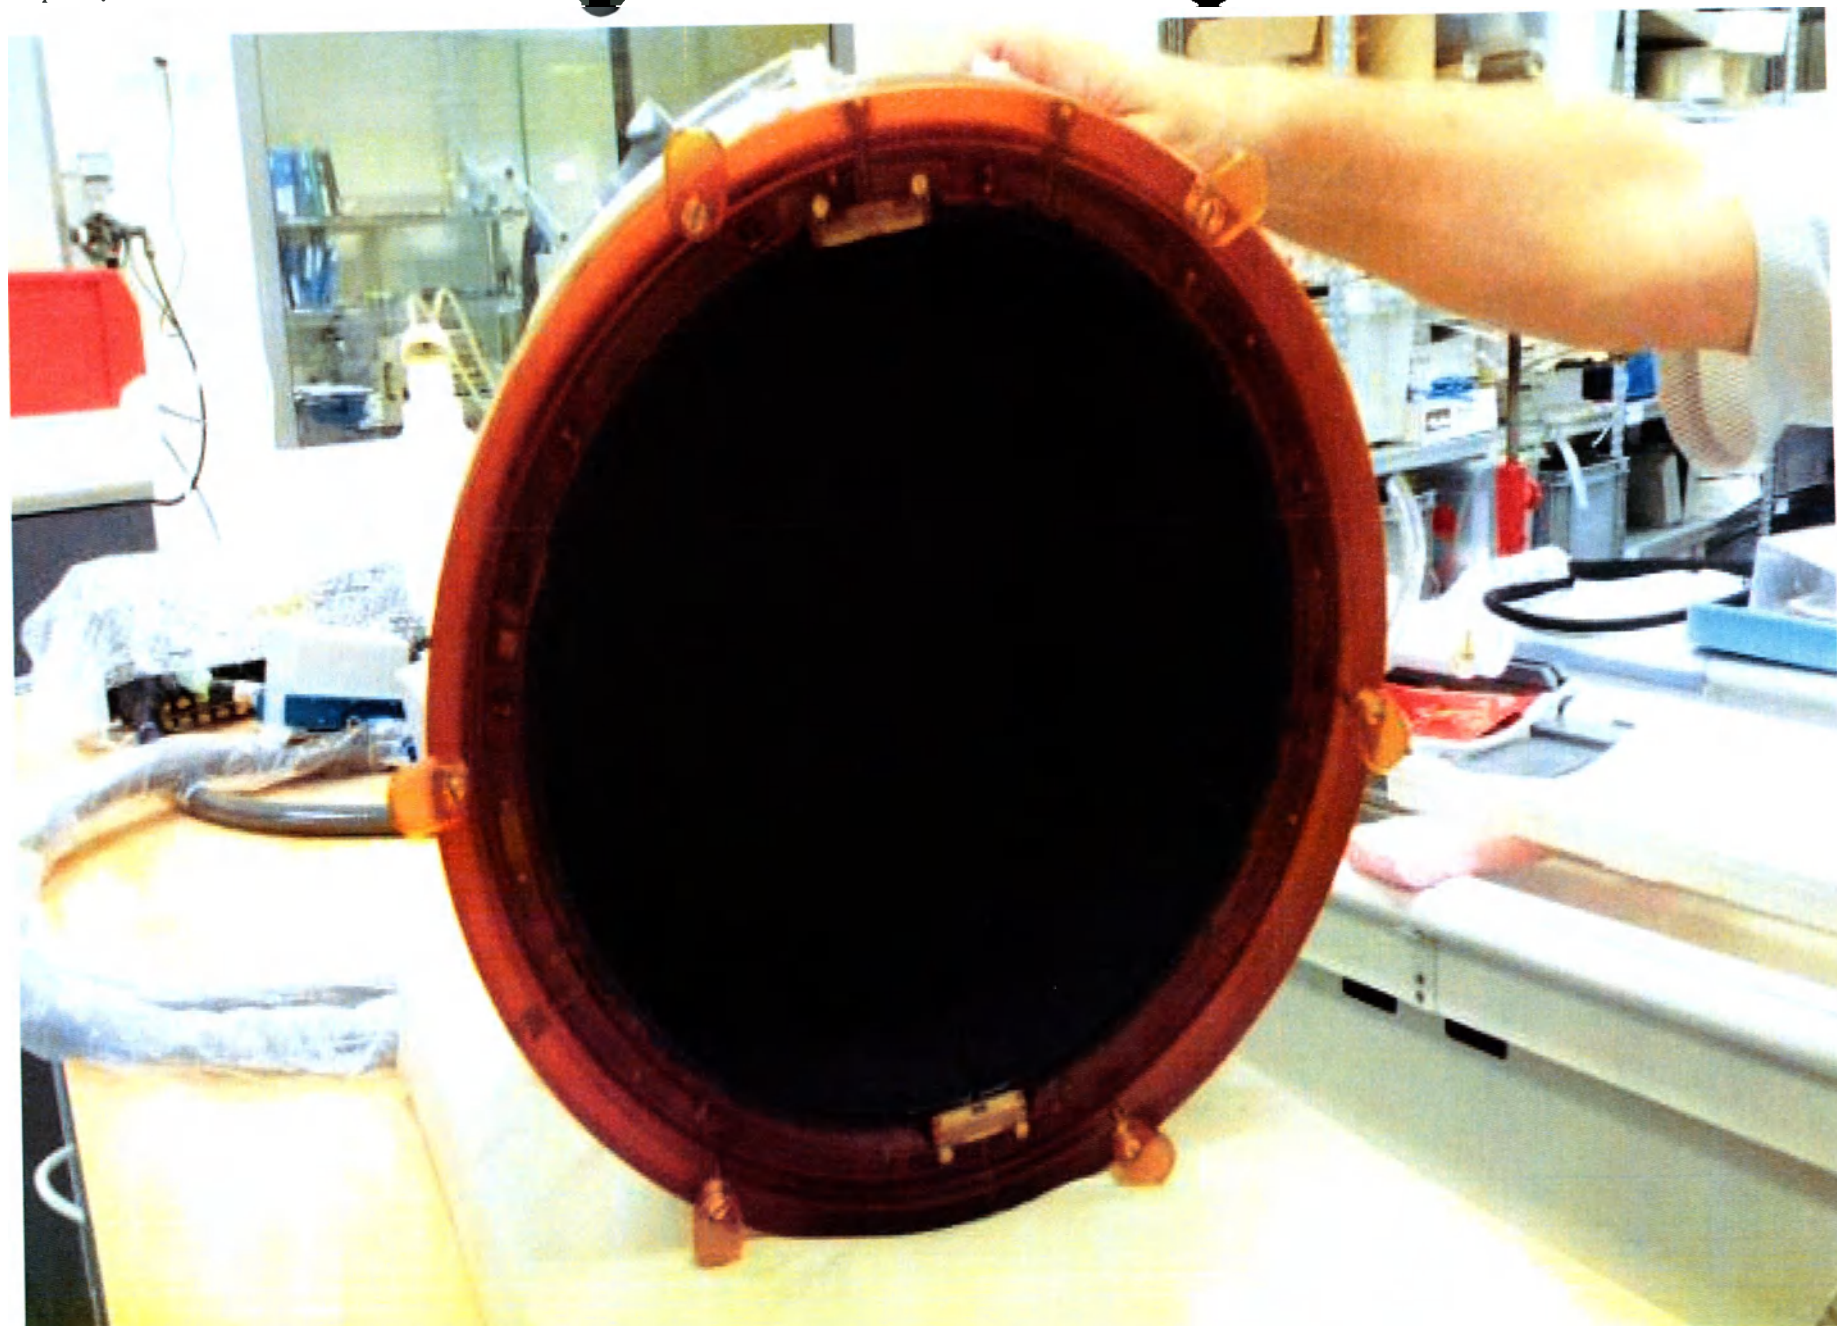

7. Устройство для нагрева воды.



8. Кабели для подключения стола.

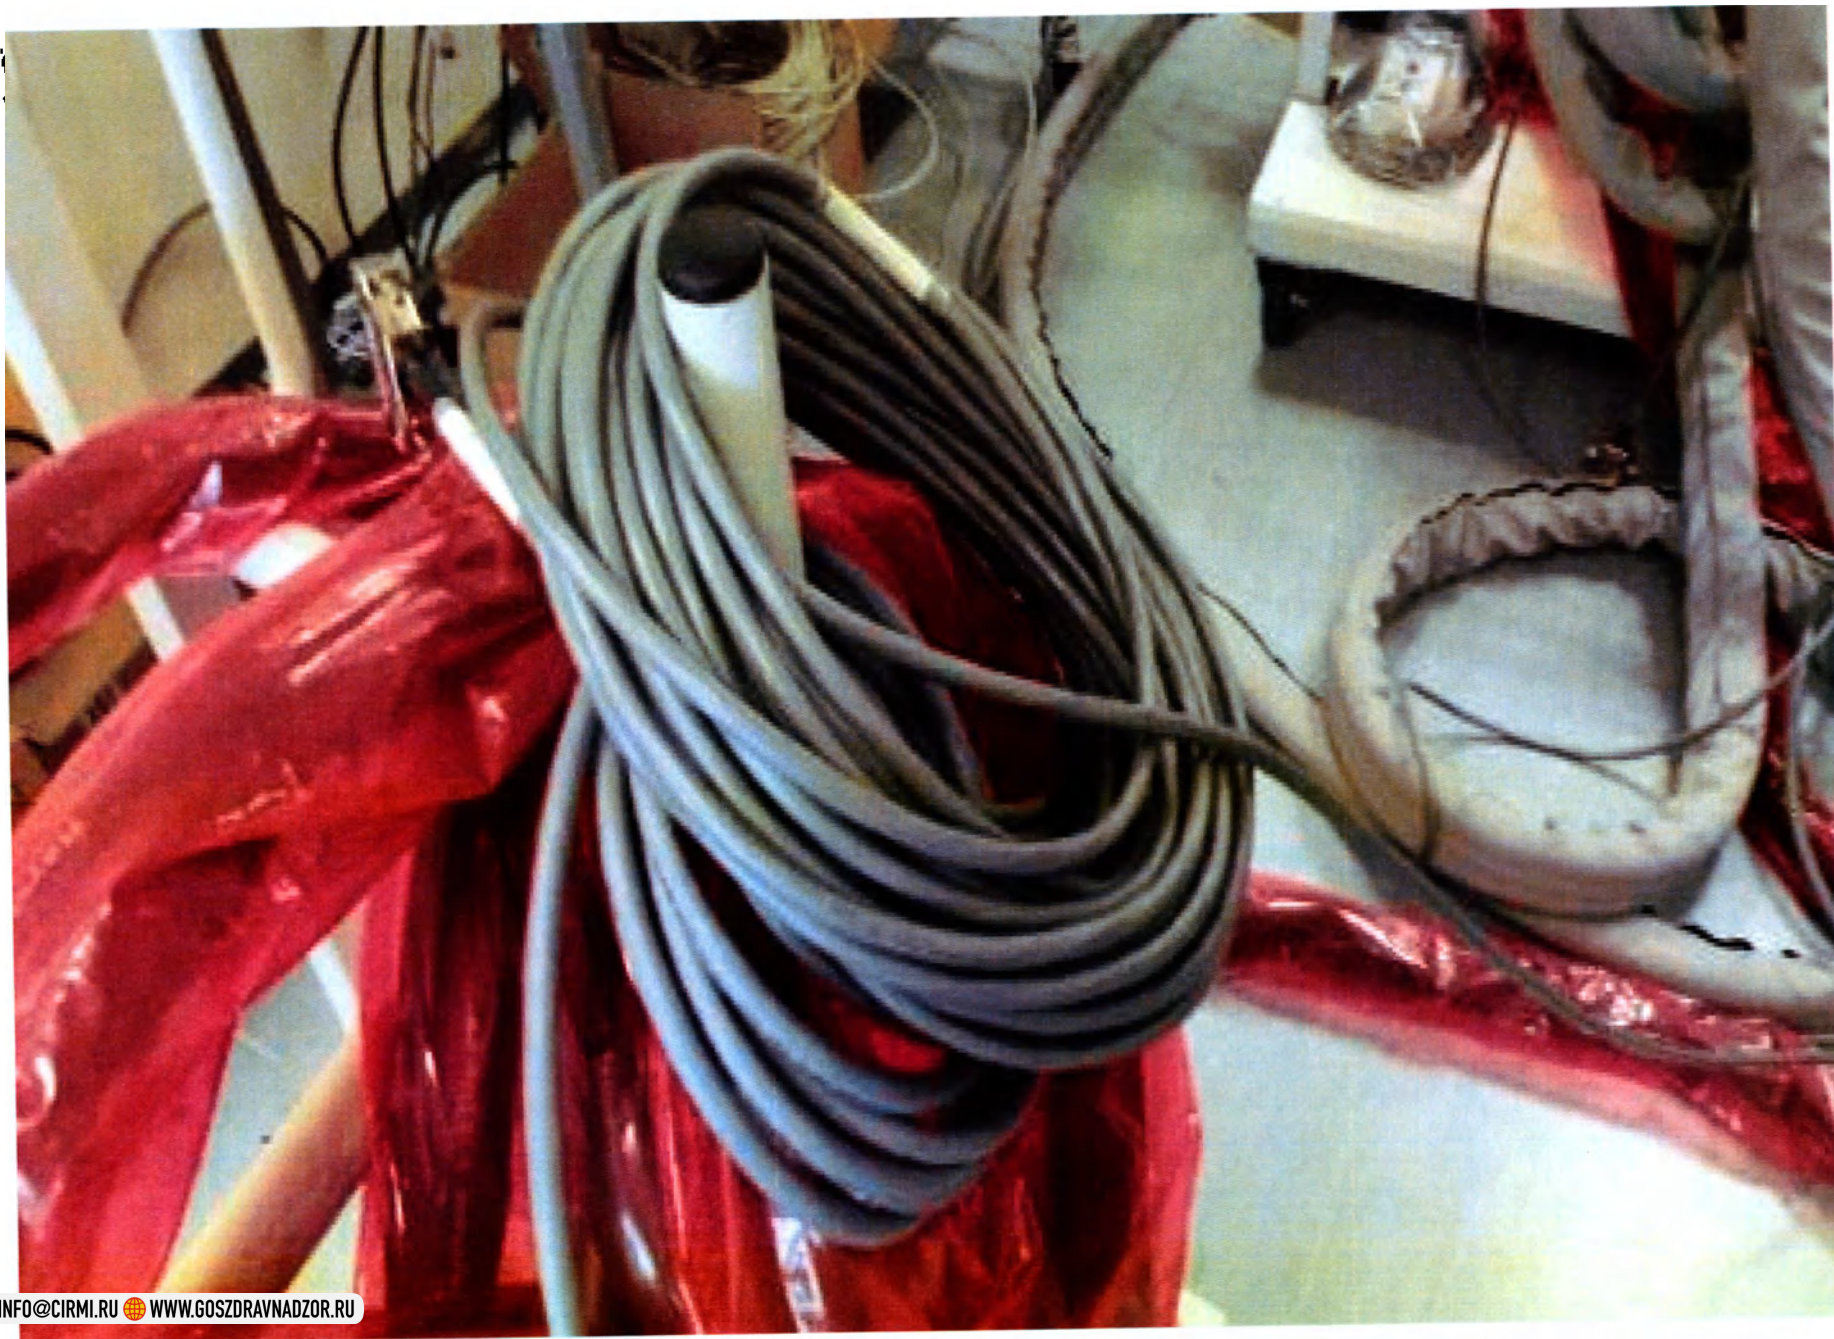

9. Матрасы для стола и для накрывания частей тела.




10. Катушки МРТ для получения изображения головы.



II. Фантомы для калибровки.




12. Держатели фантома для калибровки.

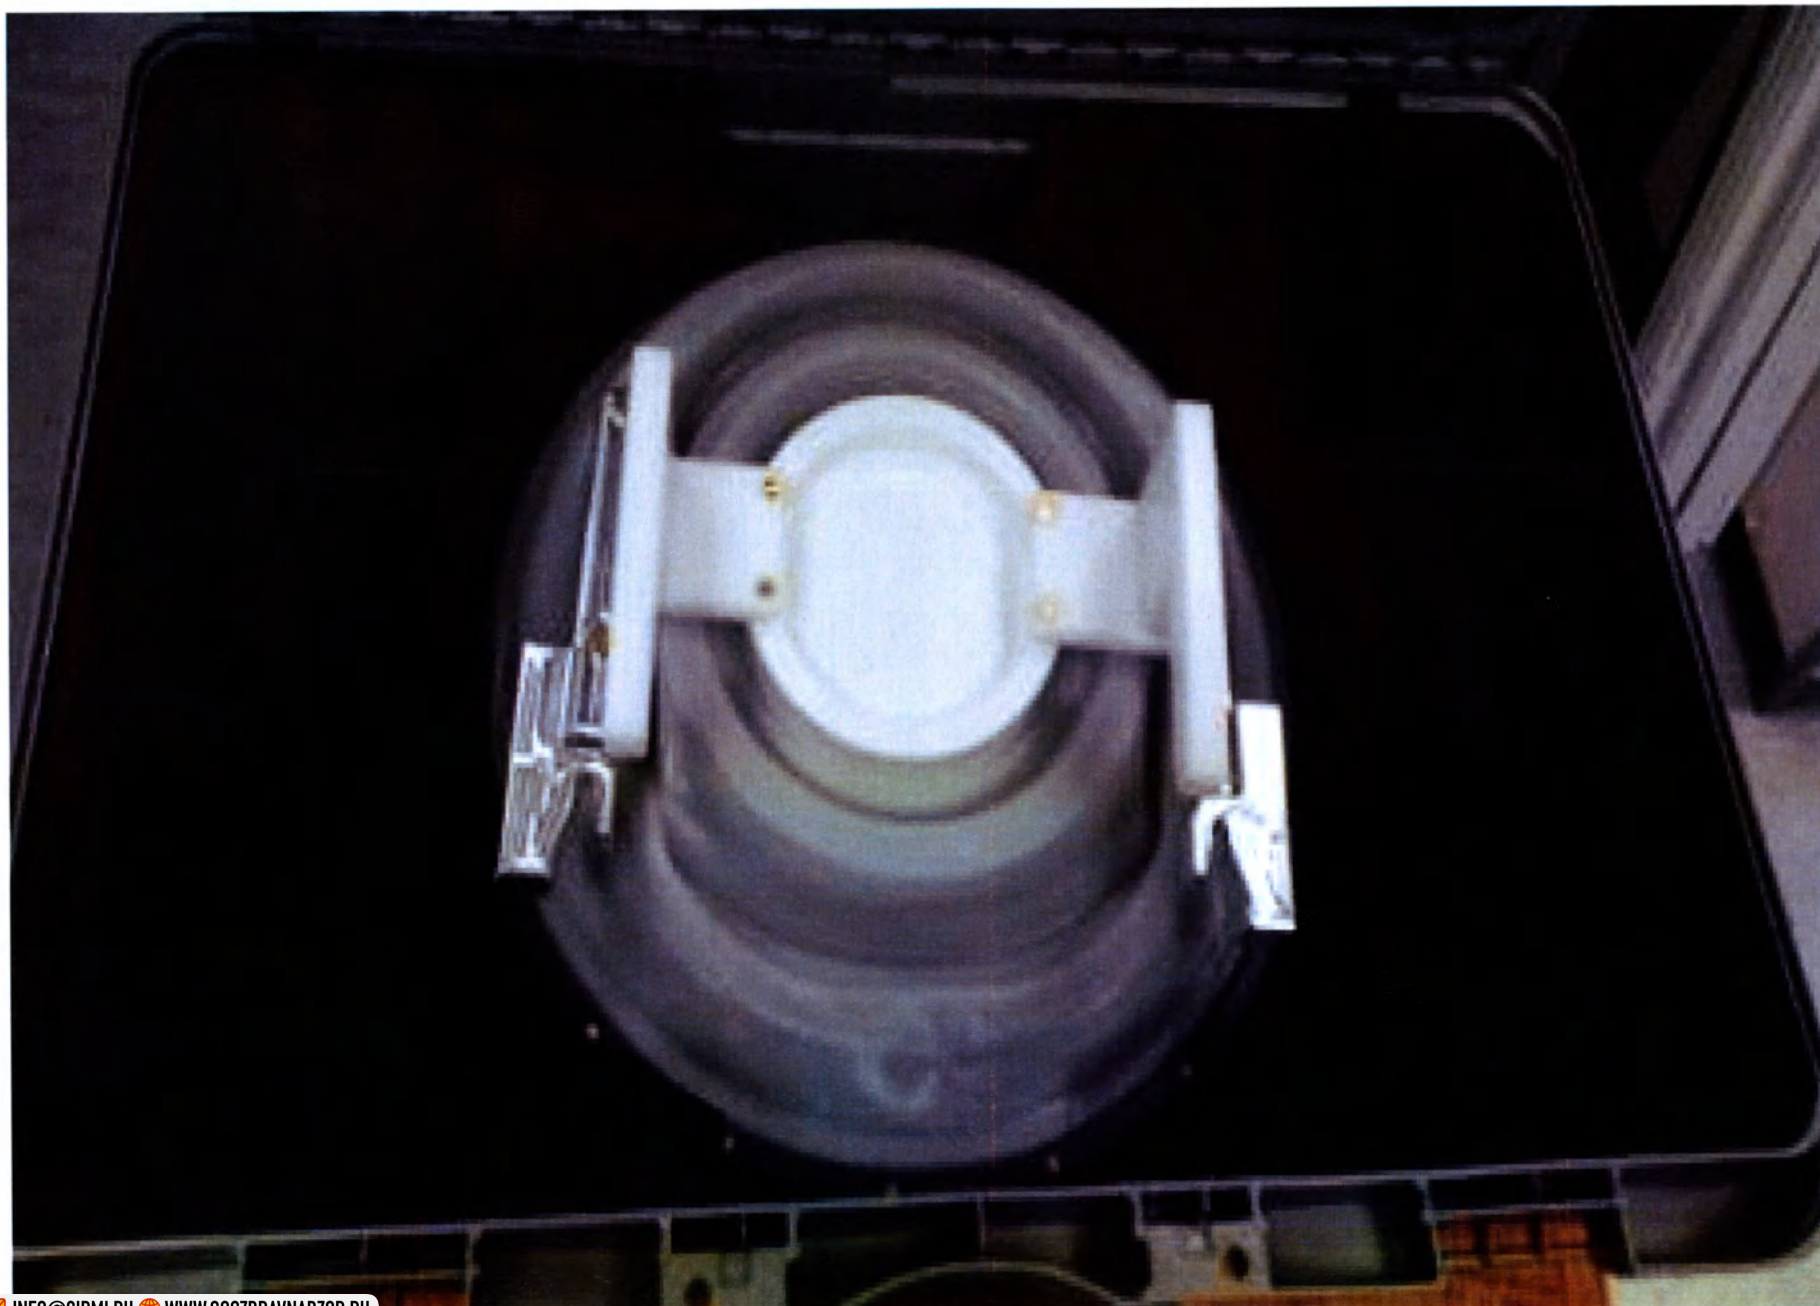



13. Кабели для рабочей станции.

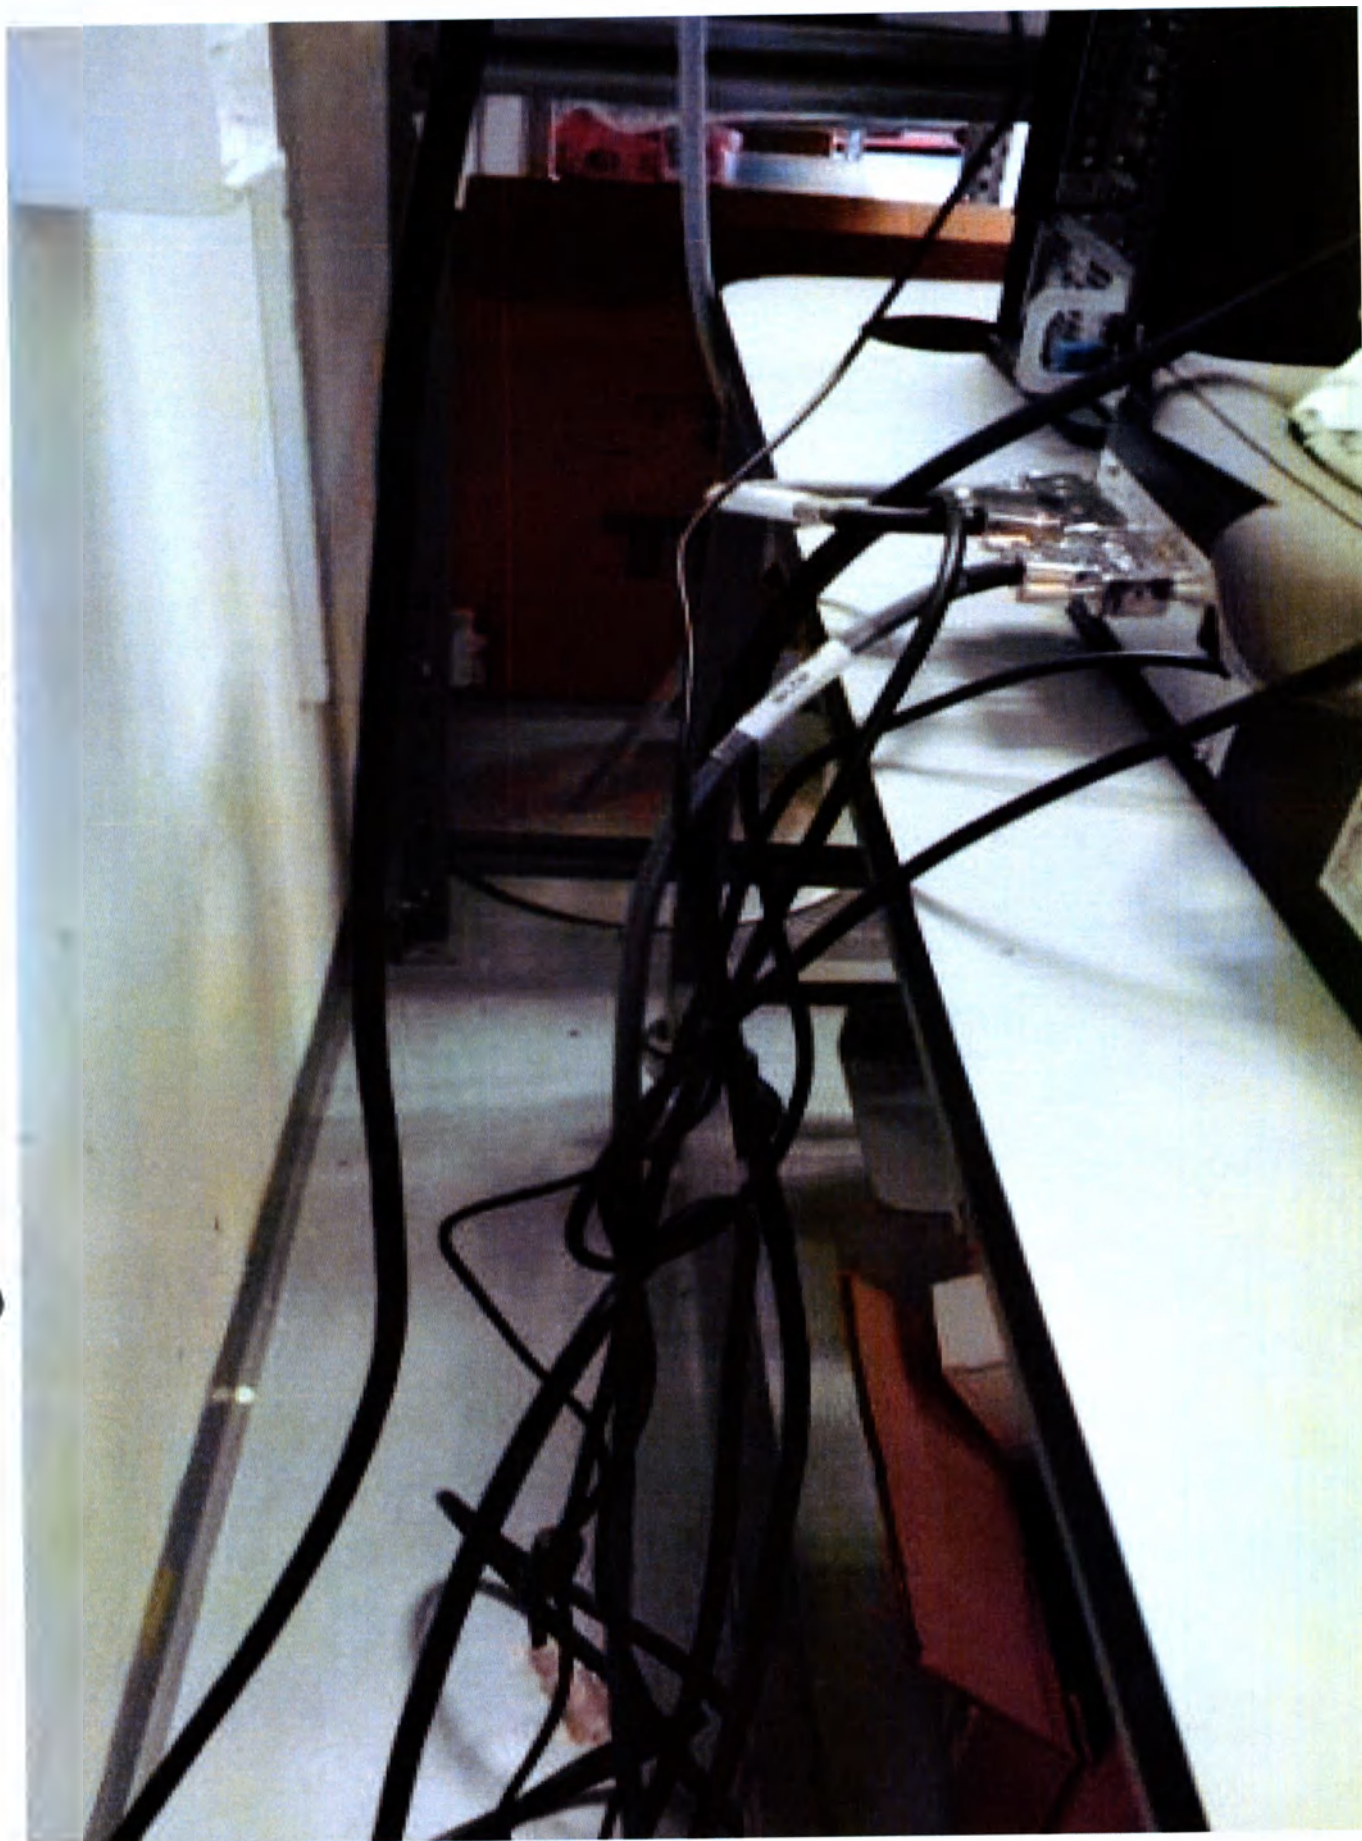

14. Соединительные кабели.



15. Кабели питания.







17. Наборы расходных материалов для проведения ФУЗ – процедуры: CD-диск, кожный маркер с линейкой, гель ультразвуковой, пленка для накрывания пациента, пластинка для удаления пузырьков, скотч хирургический, универсальные салфетки, емкость с дегазированной водой.




18. Наборы расходных материалов для проведения ФУЗ – процедуры для лечения головного мозга 1: фантом для калибровки, герметизирующий гель, дезинфицирующий раствор, очищающие салфетки, силиконовые колпачки.

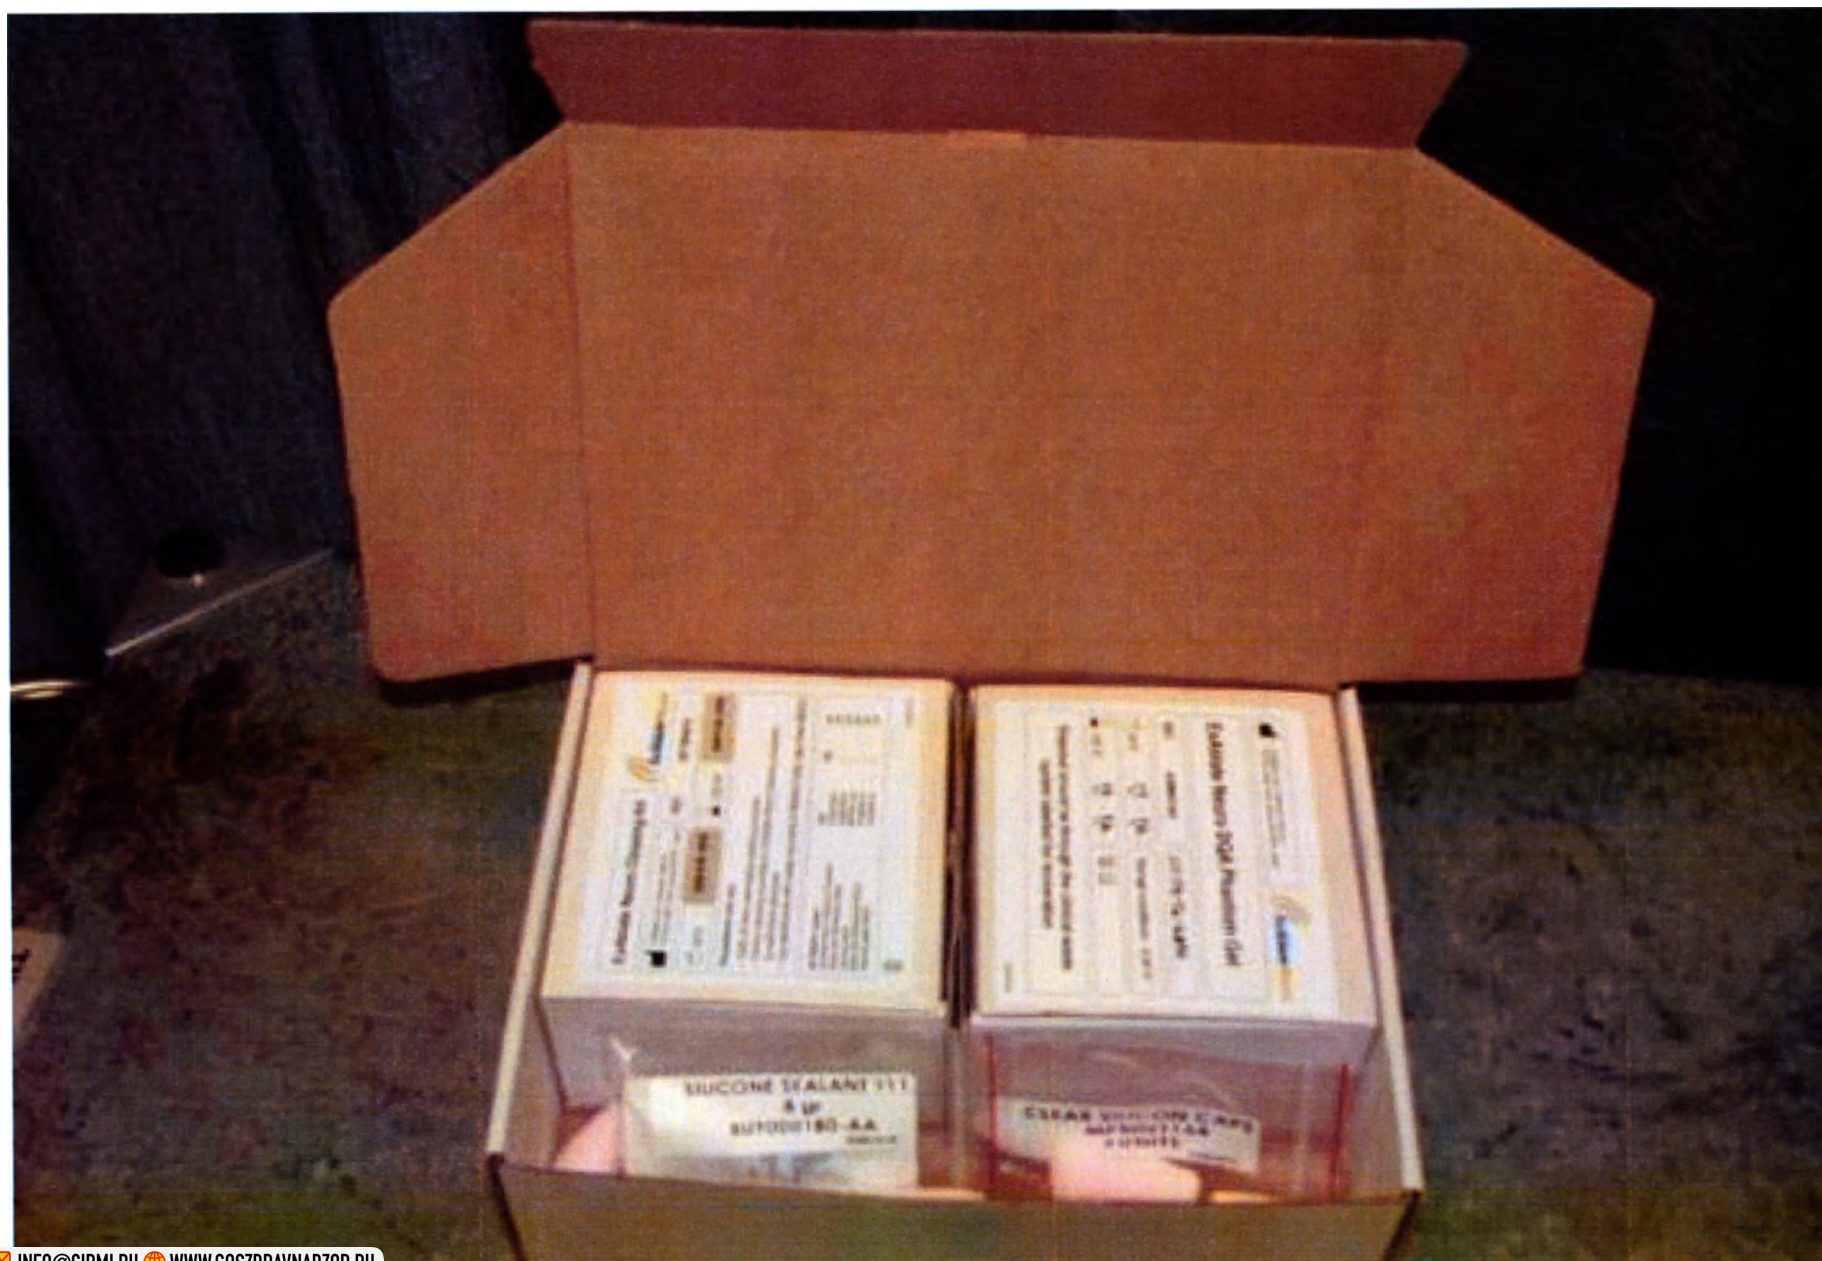


19. Наборы аксессуаров для проведения ФУЗ процедуры для лечения головного мозга 2: стереотаксическая рамка, шурупы для стереотаксической рамки, держатели, ремень.

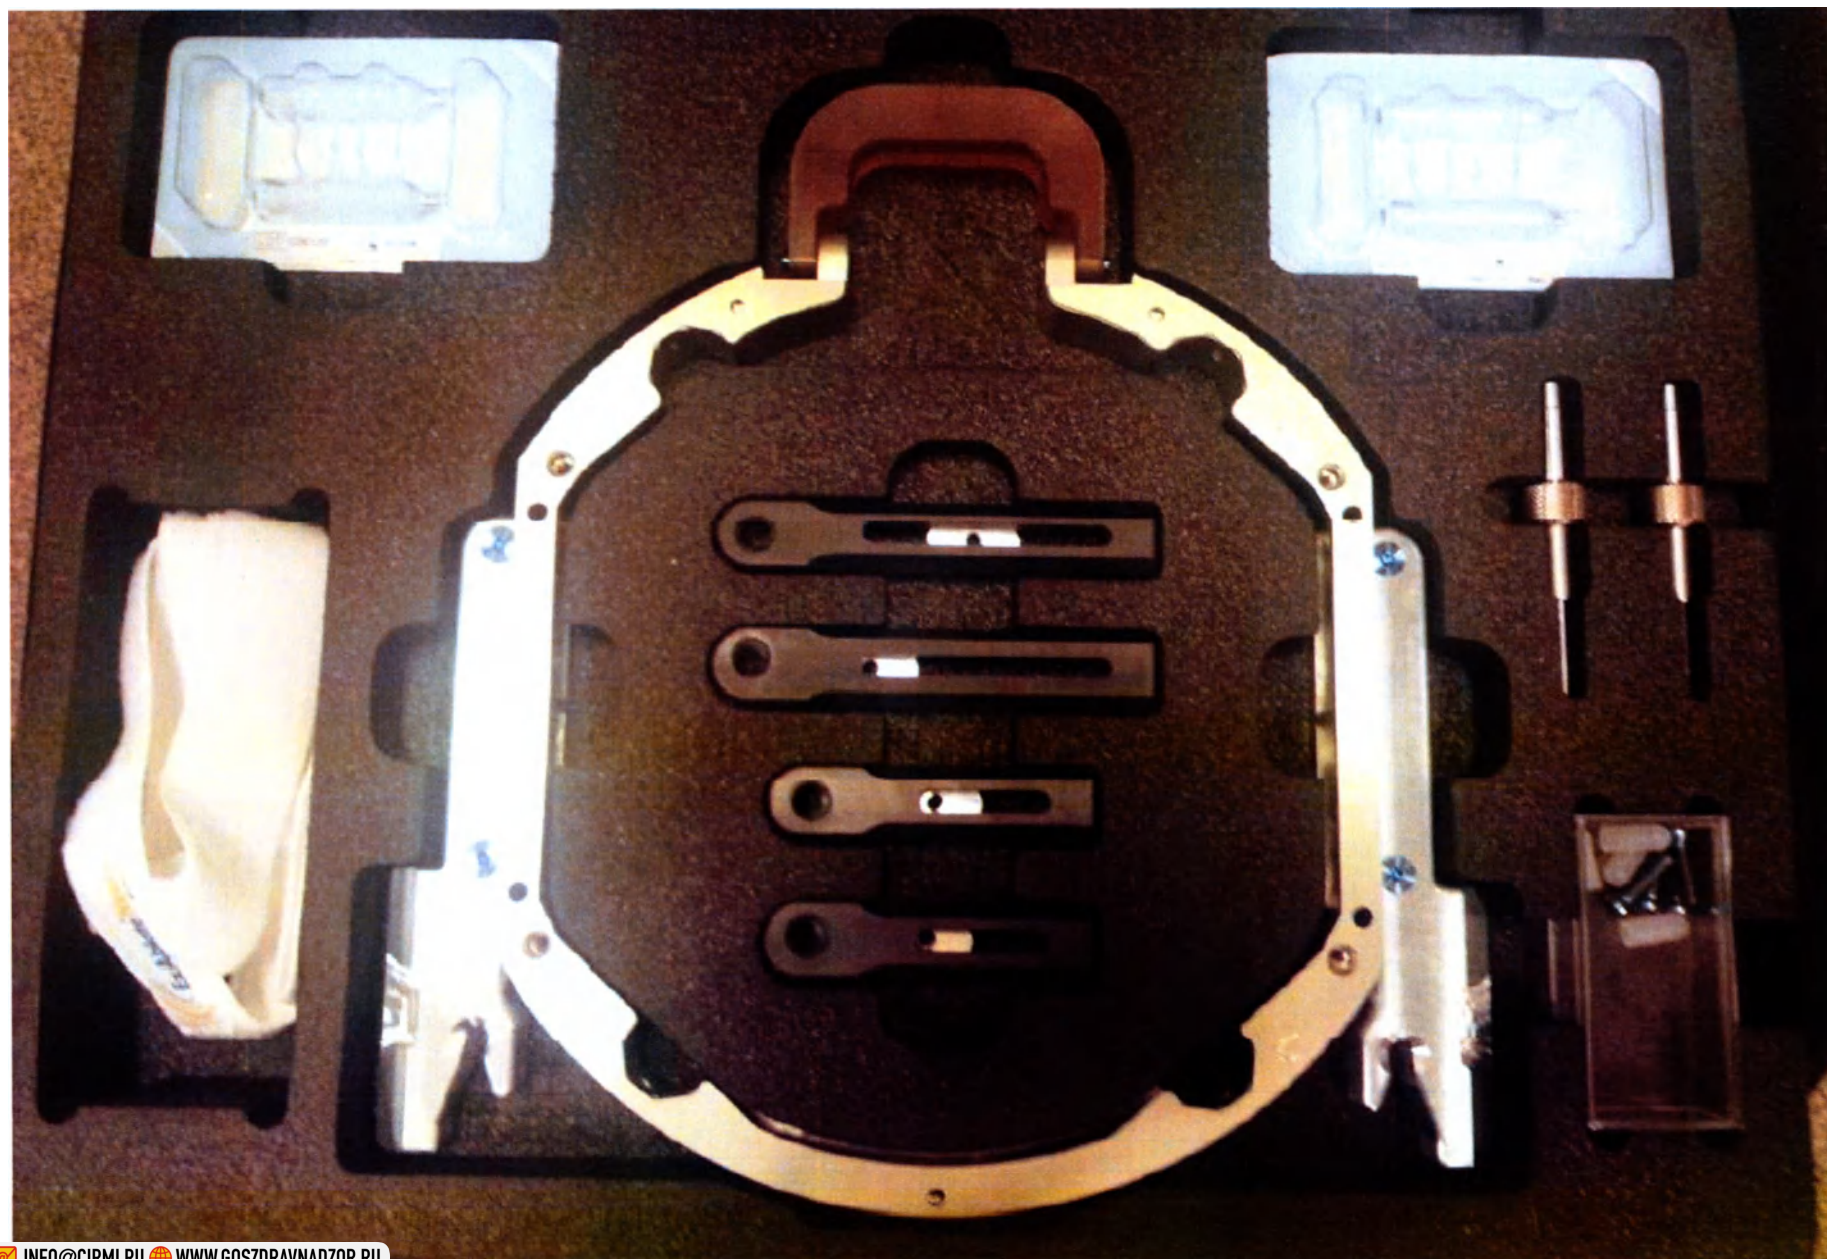

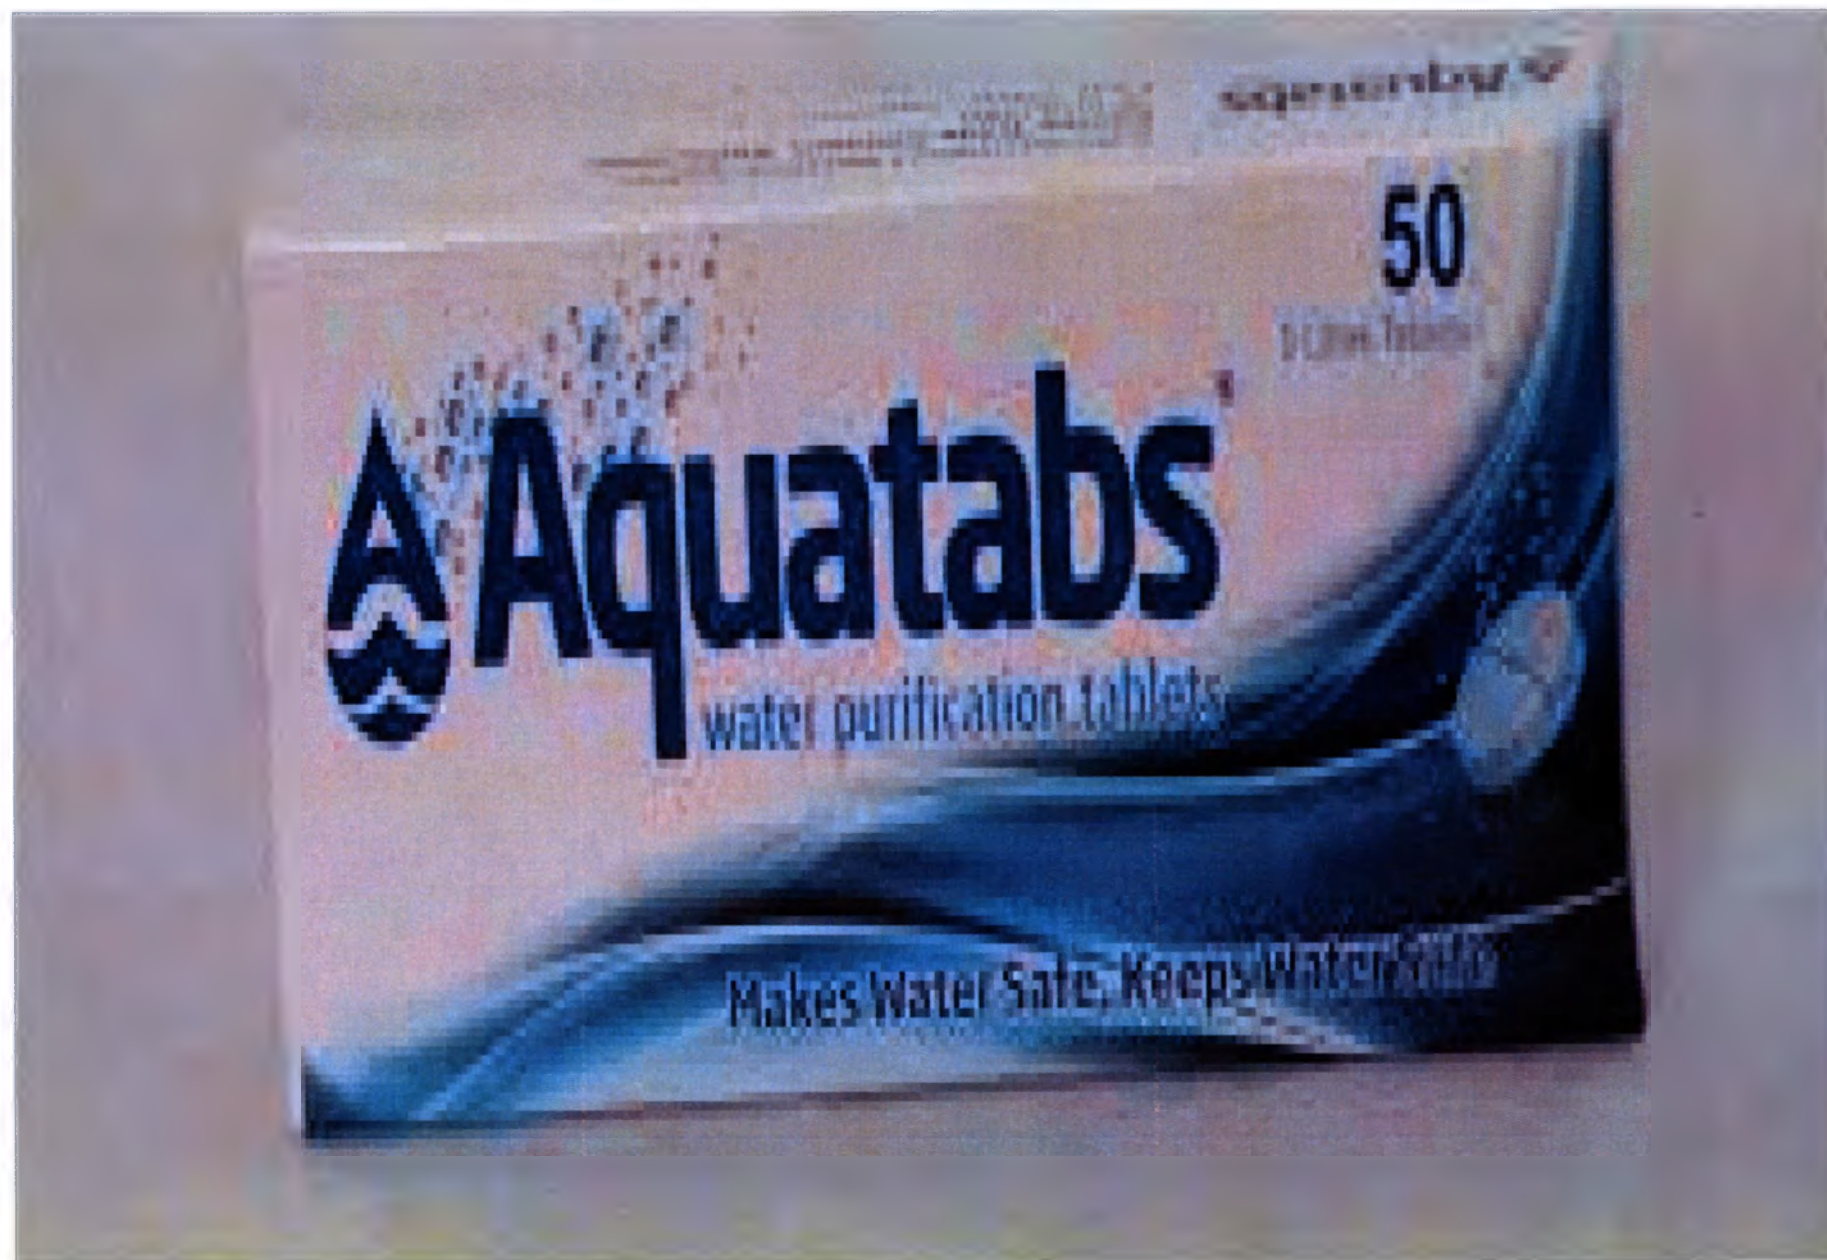


21. Шурупы для стереотаксической рамки.



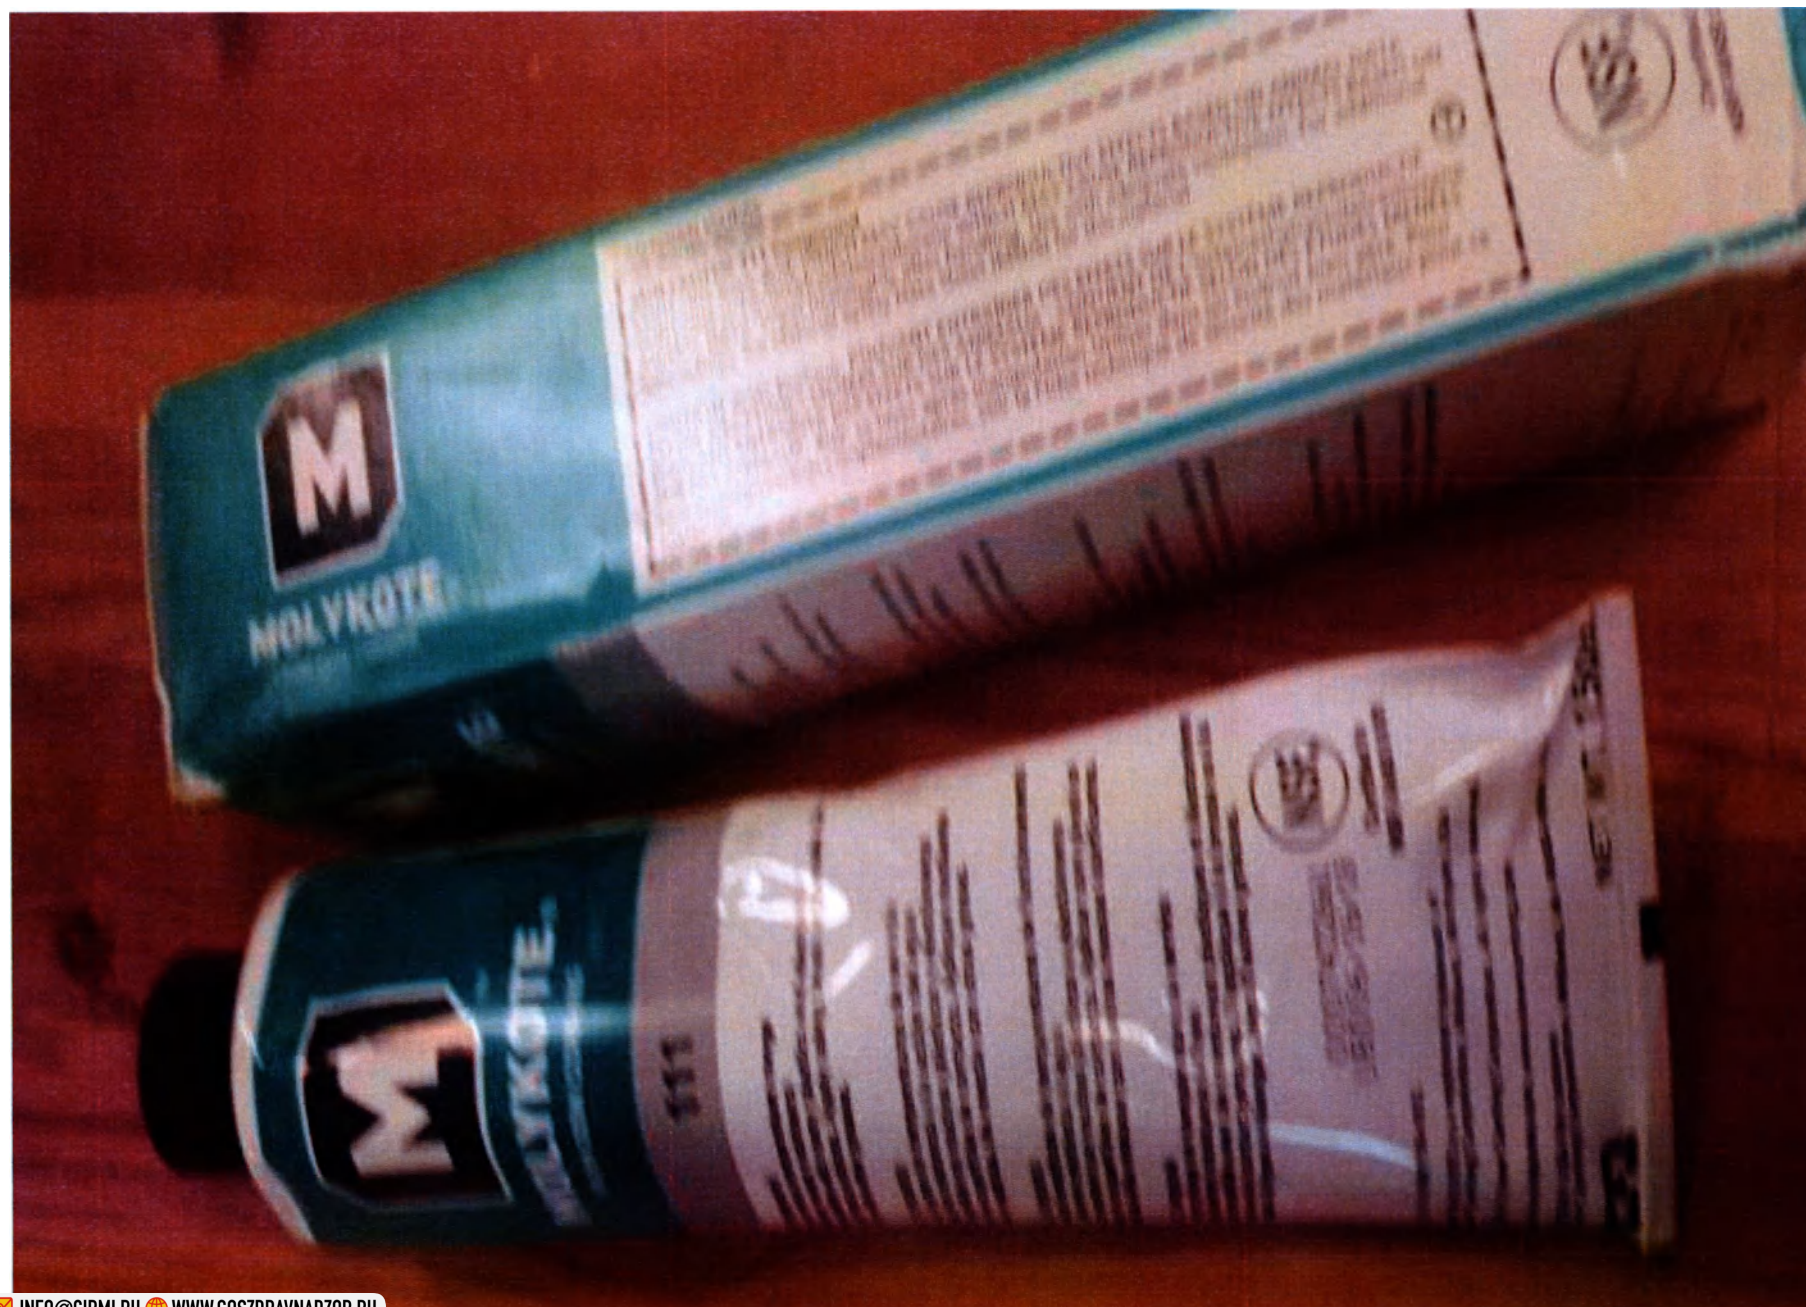

23. Очищающие наборы для проведения ФУЗ – процедуры для лечения головного мозга: дезинфицирующий раствор, очищающие салфетки.

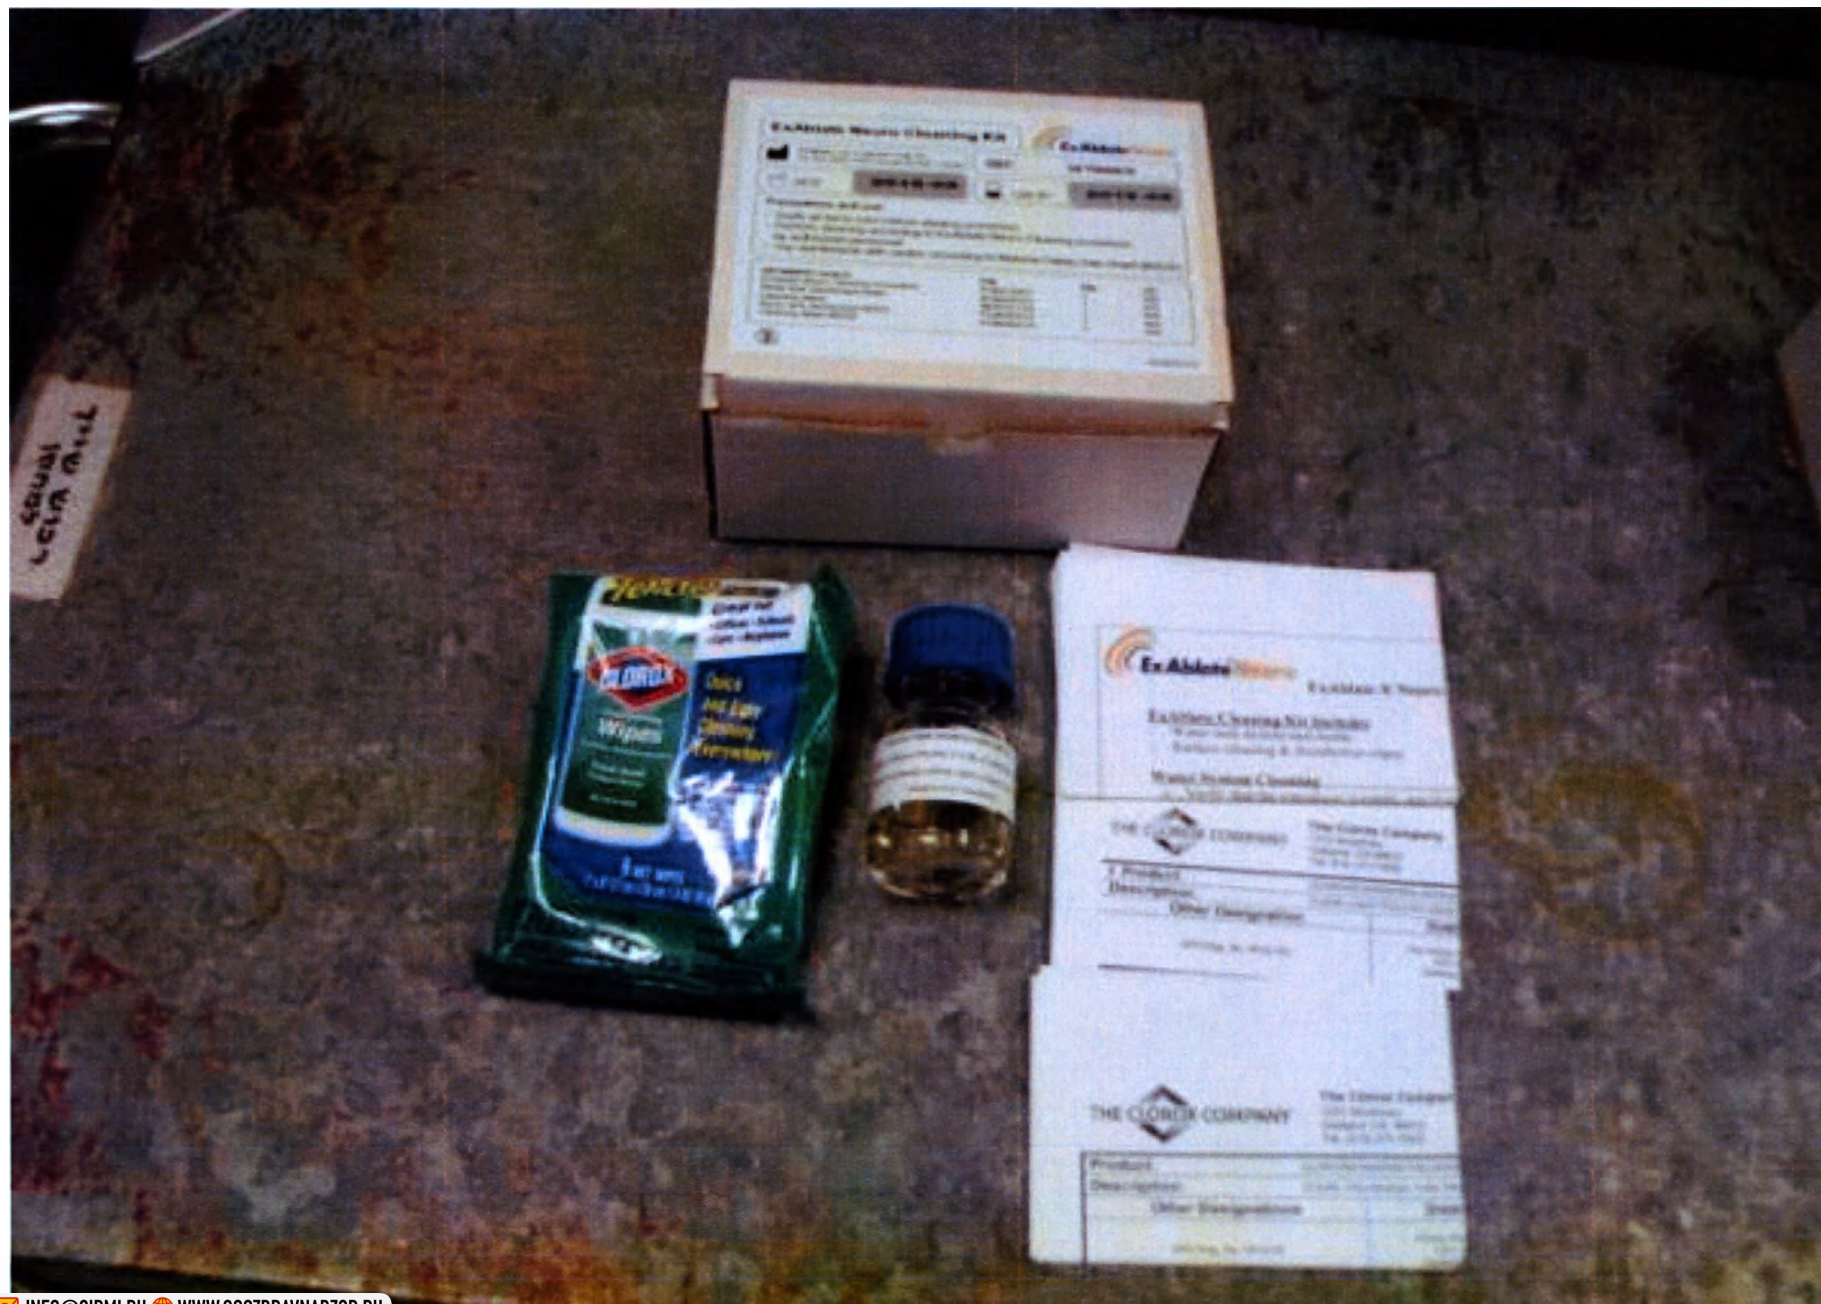

24. Наборы водных прокладок: емкости с дегазированной водой, формы для заполнения водой.



25. Прокладки из плотного геля для фиксации зоны лечения.




26. Прокладки для коррекции зоны шрамов.






28. Трубки для заполнения емкости водой.

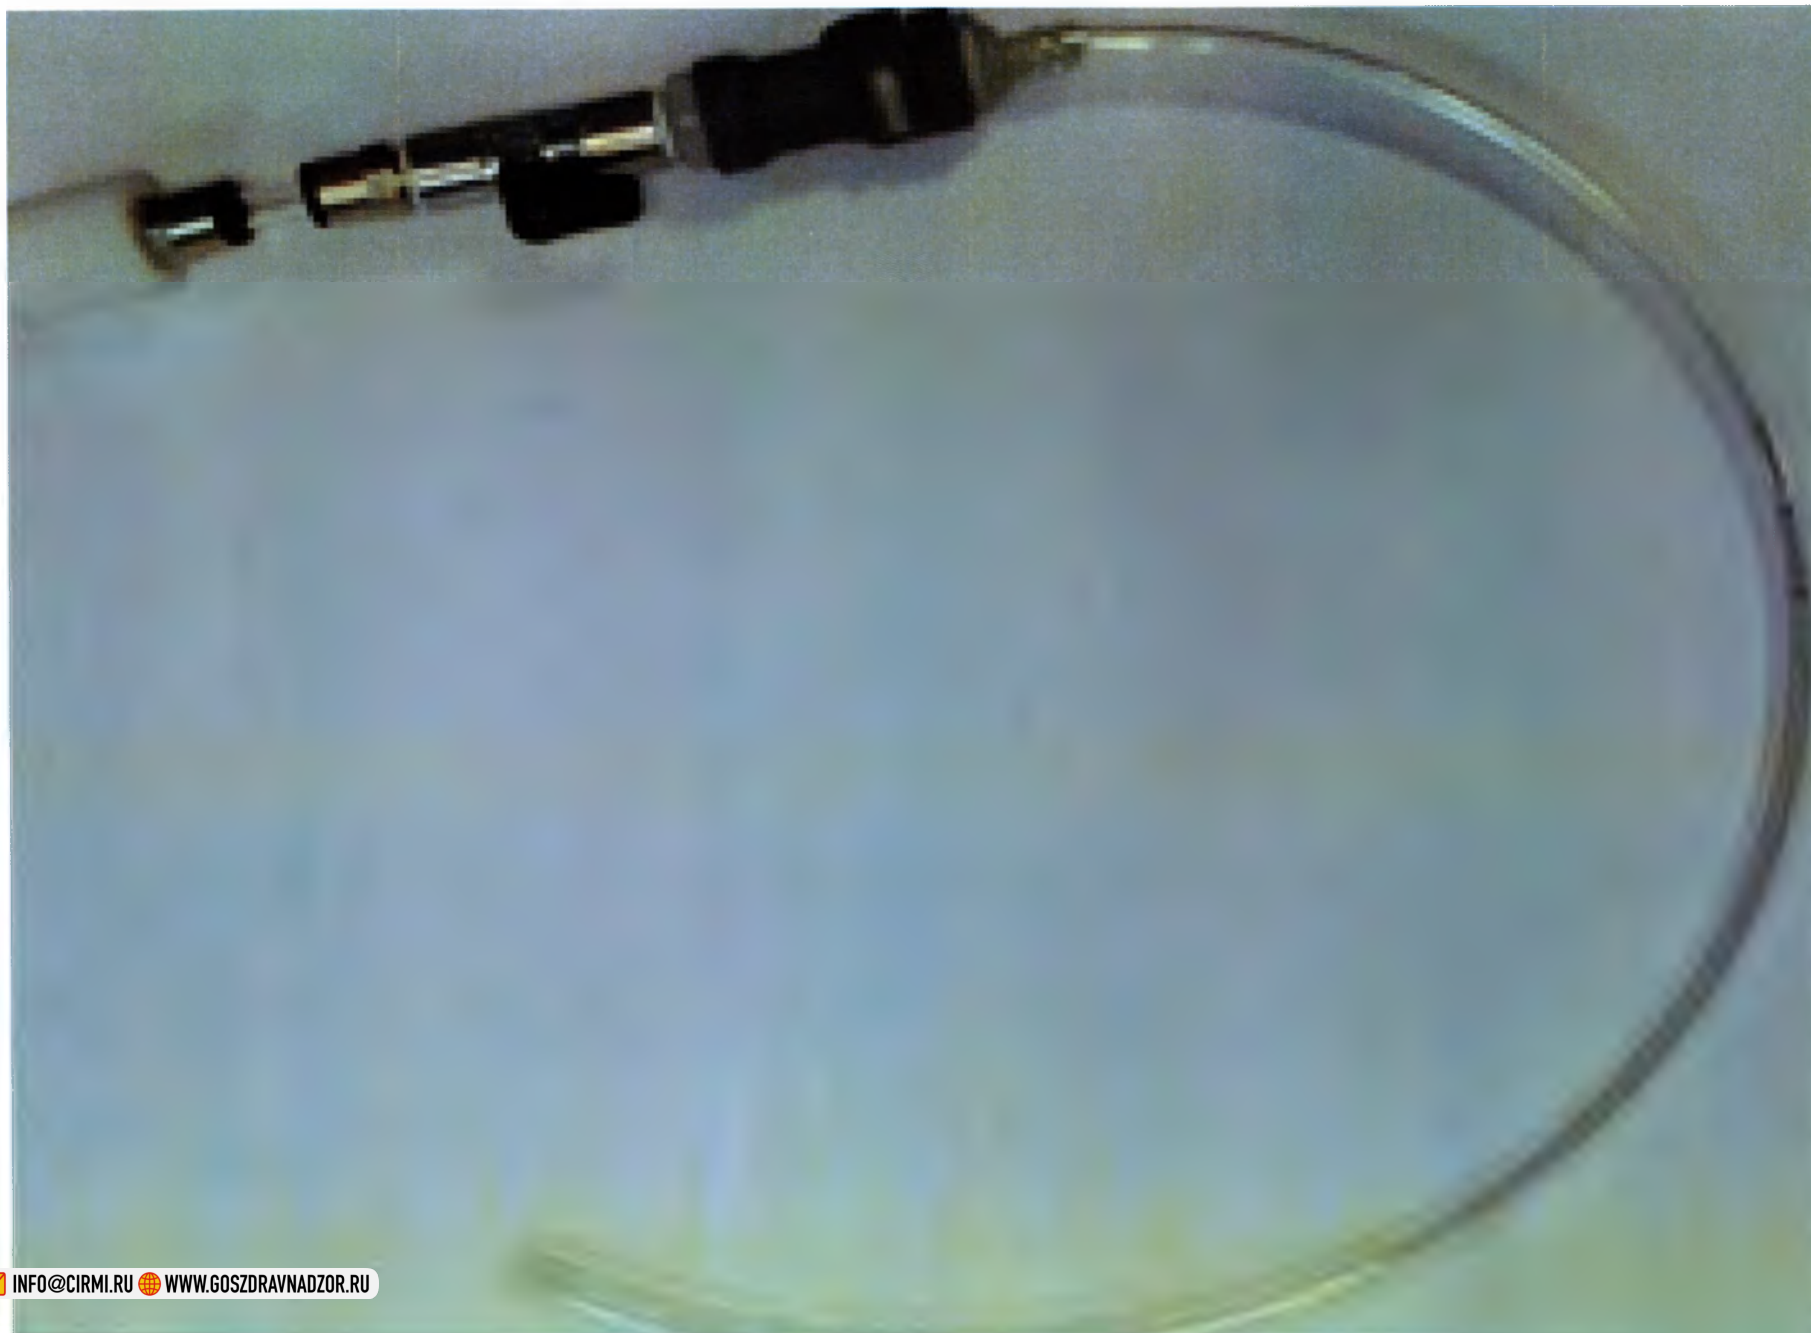

29. Держатели для пленки для накрывания пациента.

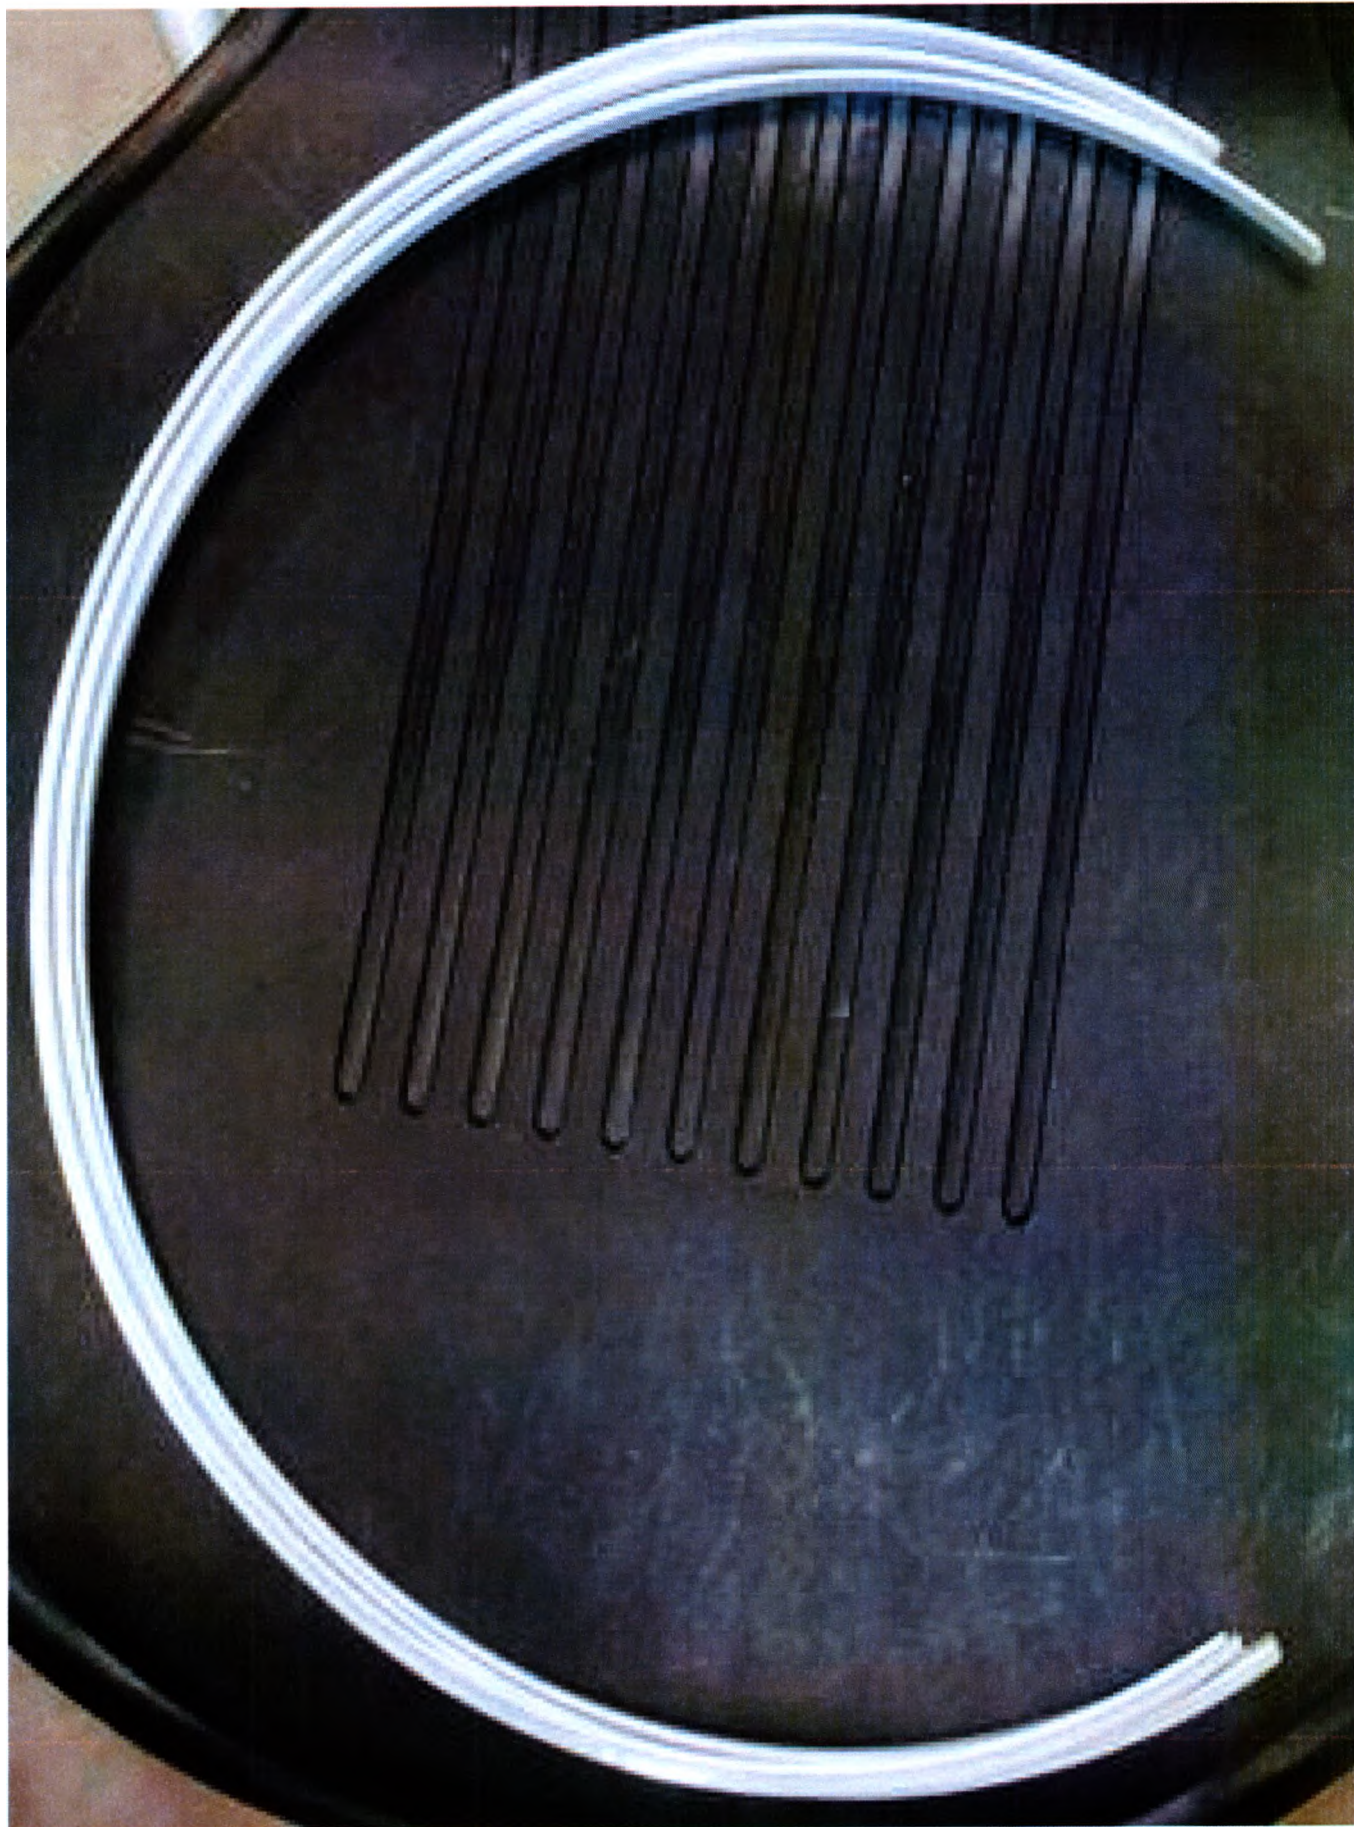

30. Гель ультразвуковой.



31. Мембраны для ультразвукового излучателя для лечения головного мозга.








Система ExAblate® 4000 для транскраниального
хирургического лечения фокусированным
ультразвуком под контролем МРТ

Руководство пользователя

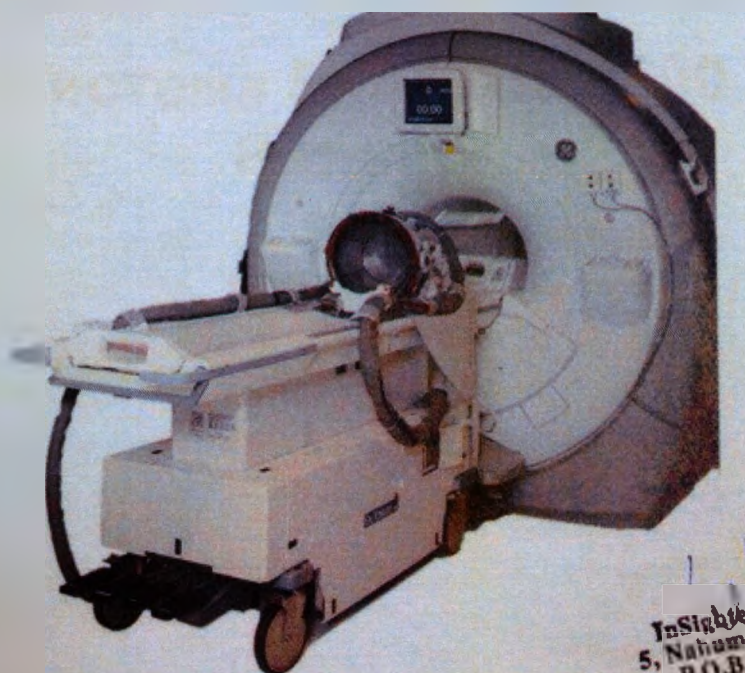

InSightec Ltd.
5, Nahum Heth st.
P.O.B. 2059
Tirat Carmel 39120

InSightec
Bringing therapy into focus



43