

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

STERIS SYSTEM 1 Express




Принадлежности:


1. Мобильная тележка для стерилизатора (A1900).




2. Основной лоток и контейнер (C1200).

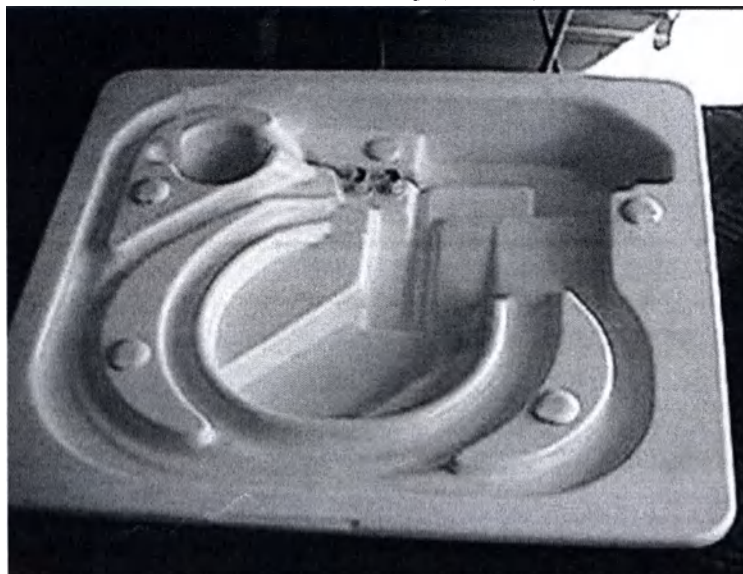

3. Контейнер и лоток для стерилизации гибких эндоскопов (С1140).

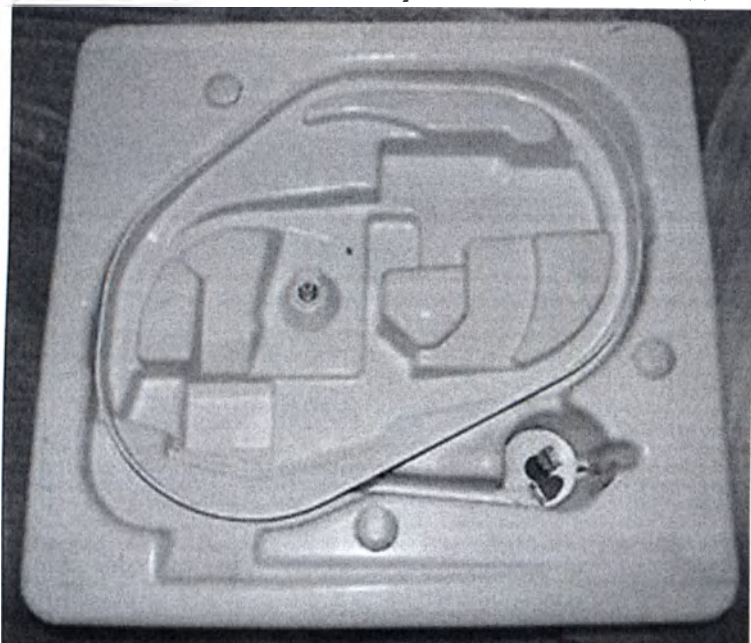


4. Контейнер для стерилизации гибких эндоскопов (С1141).

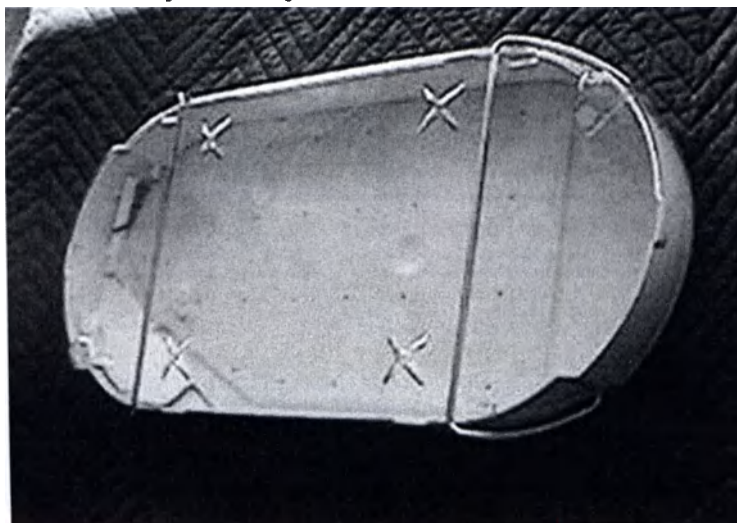


5. Универсальный лоток (С1160).



6. Контейнер и лоток для прямого потока (С1220).

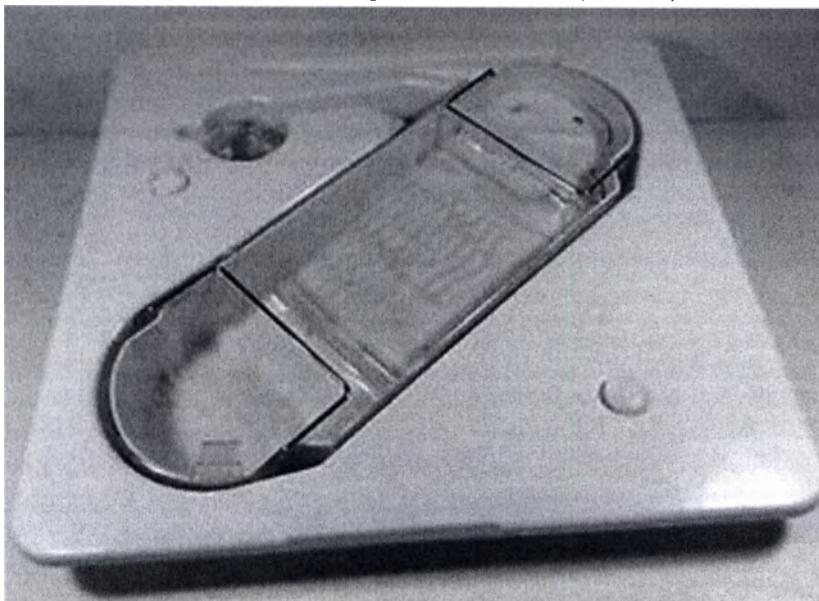

7. Контейнер для прямого потока (С1221).

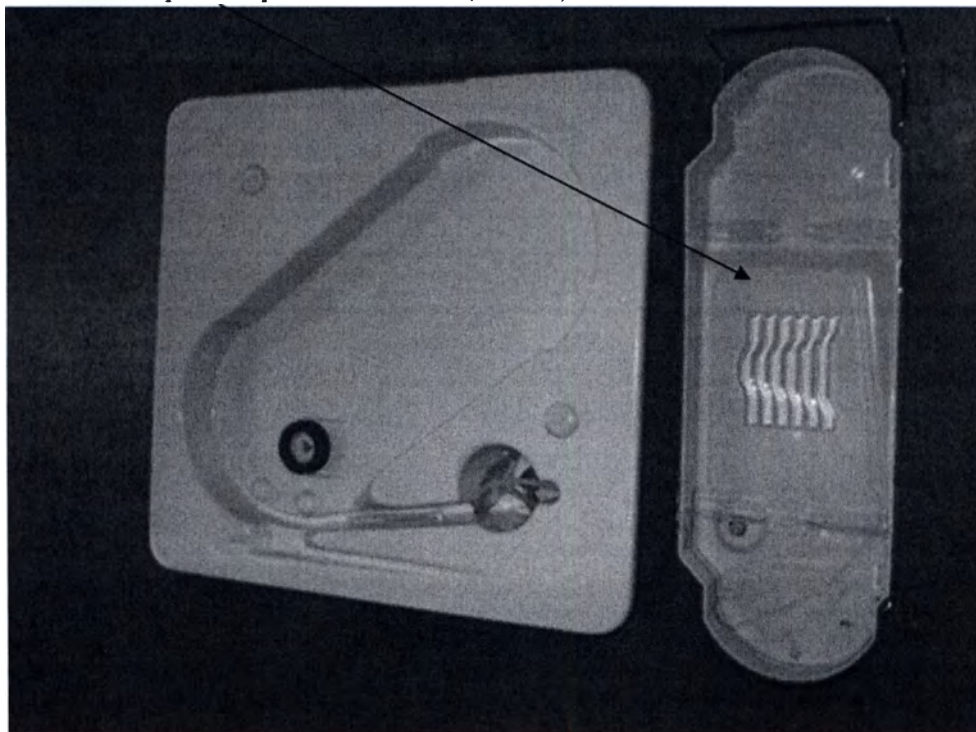


8. Основной лоток (С1201).




9. Вставка для микрохирургических инструментов (С1330).




10. Переходник для внутренних каналов эндоскопов Olympus .

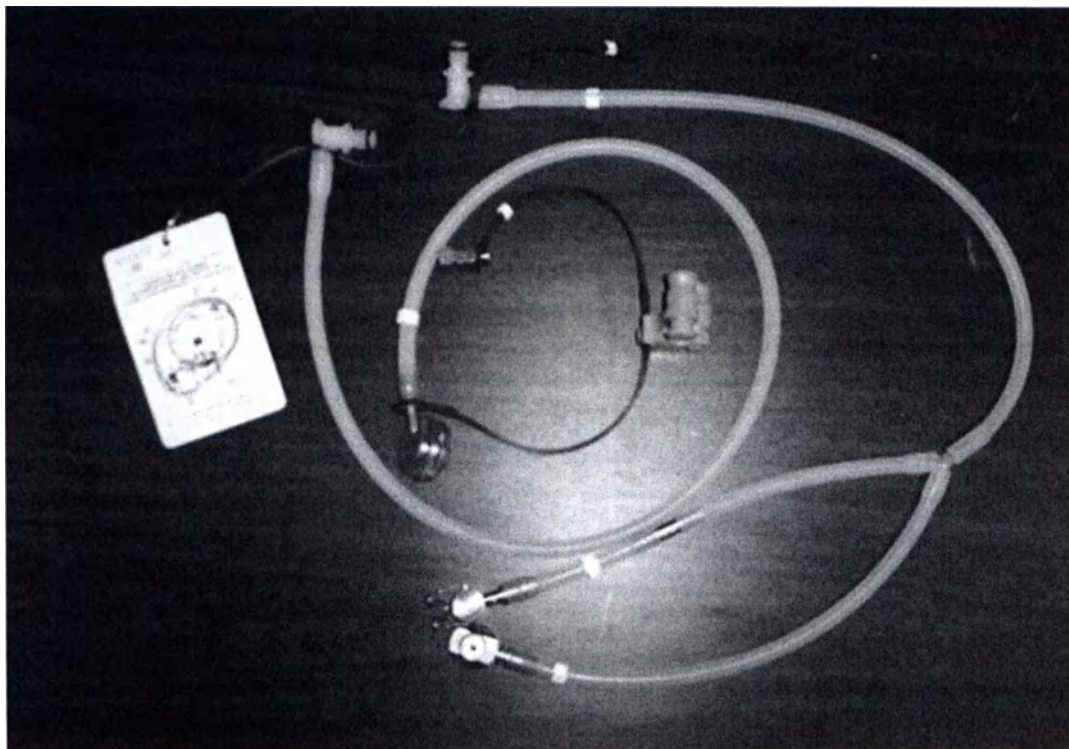


11. Переходник для внутренних каналов эндоскопов Fujinon .

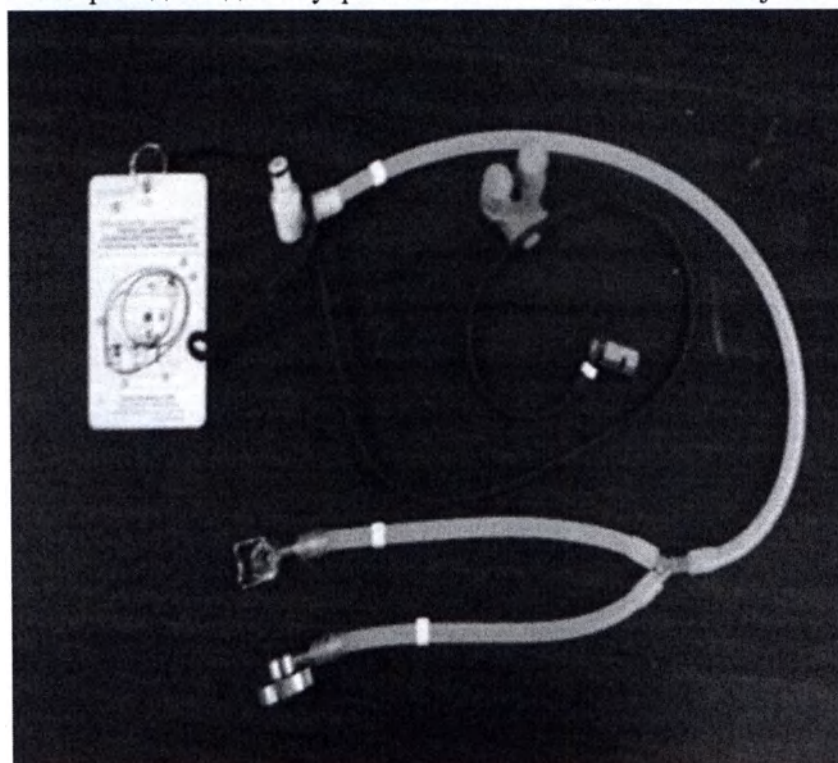


12. Переходник для внутренних каналов эндоскопов Pentax.

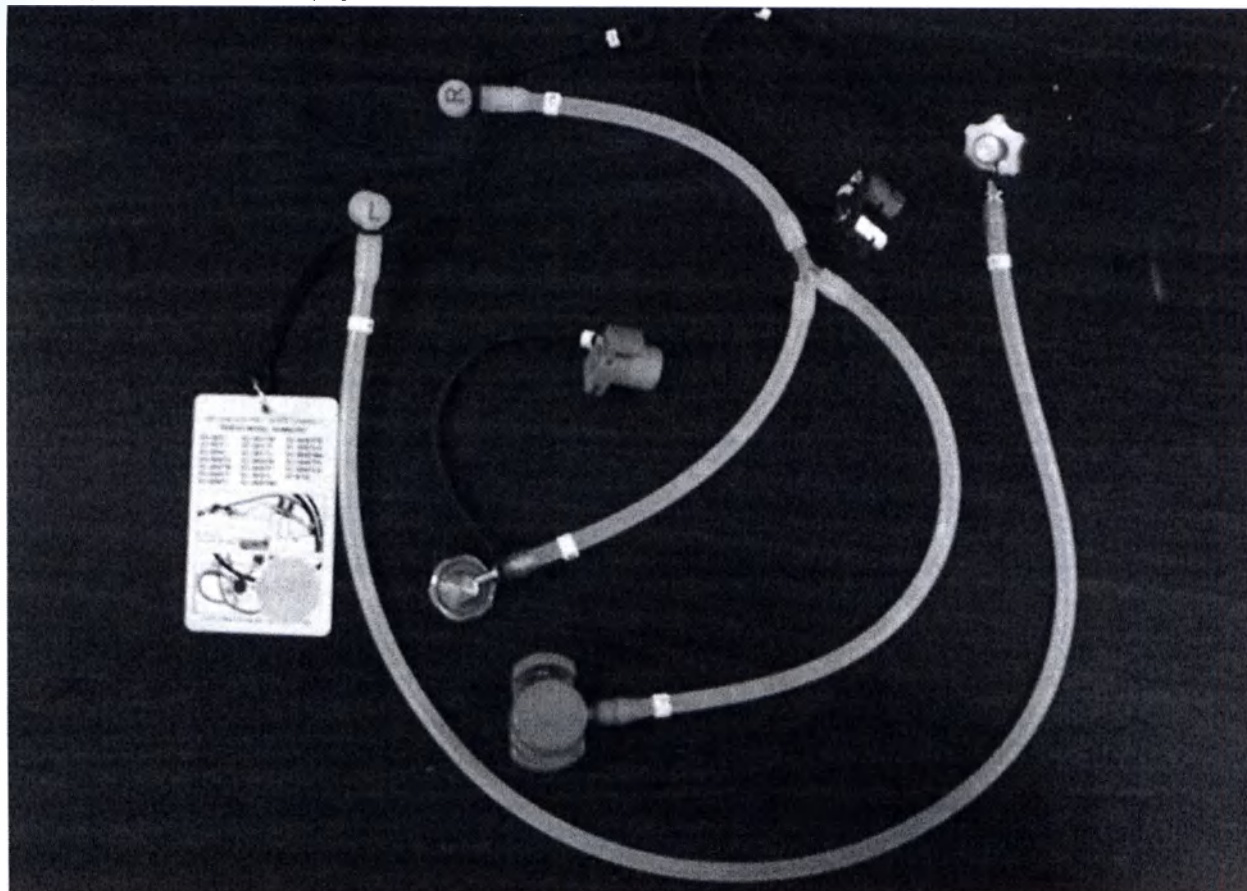


13. Переходник для внутренних каналов эндоскопов Storz .

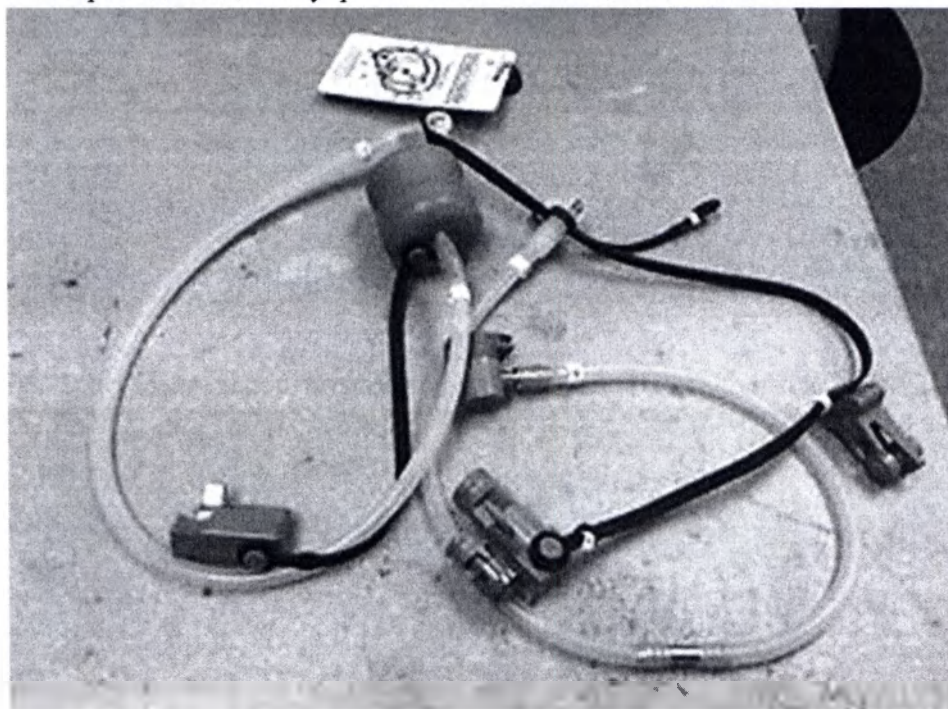

14. Корзина сетчатая (С1311).

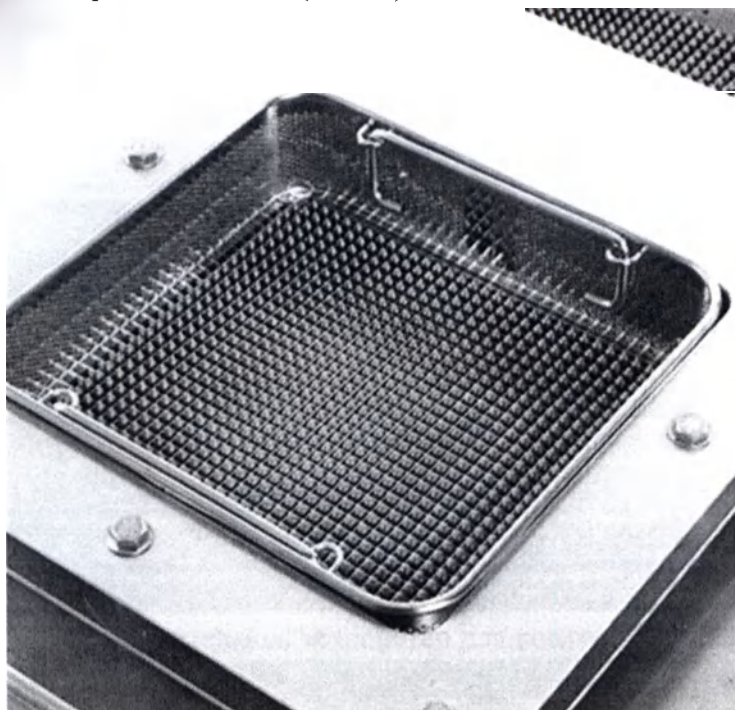

15. Термометр (А1005)

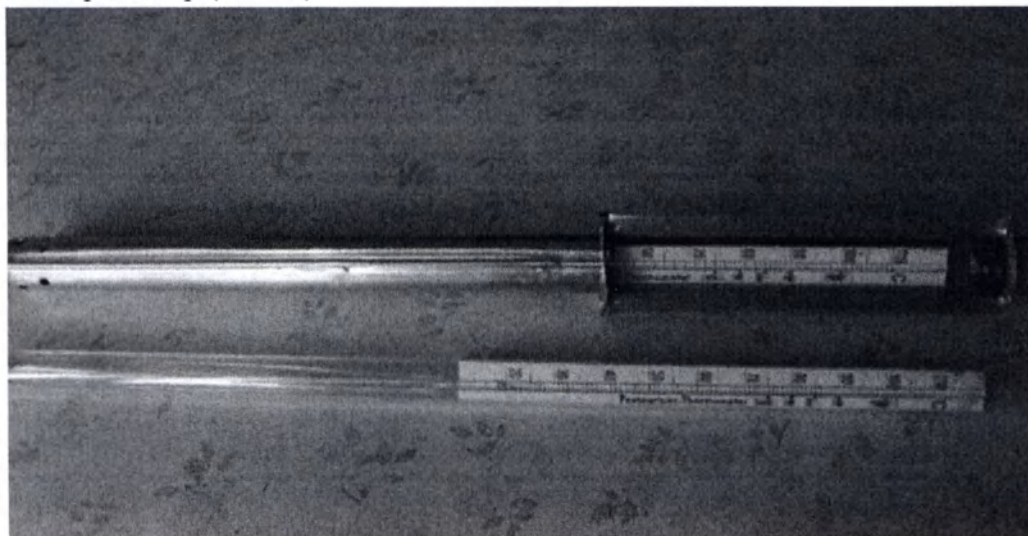

16. Вспомогательное устройство для контроля температуры (А1003).



17. Вспомогательное устройство для контроля температуры (A1004).



18. Вспомогательное устройство для контроля температуры (A1017).




19. Бумага для принтера (A1700).




20. Картридж для принтера (150828-440).



21. Водяной фильтр грубой очистки (A1501).

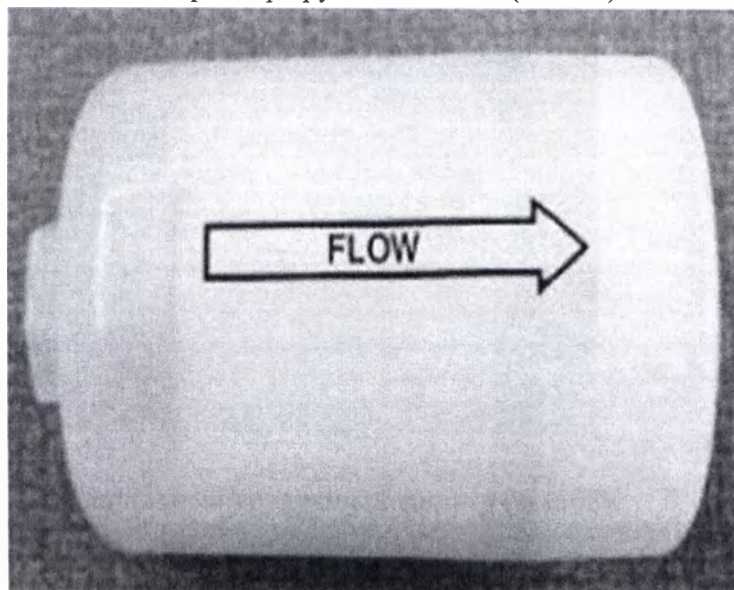


22. Водяной фильтр тонкой очистки (A1504).

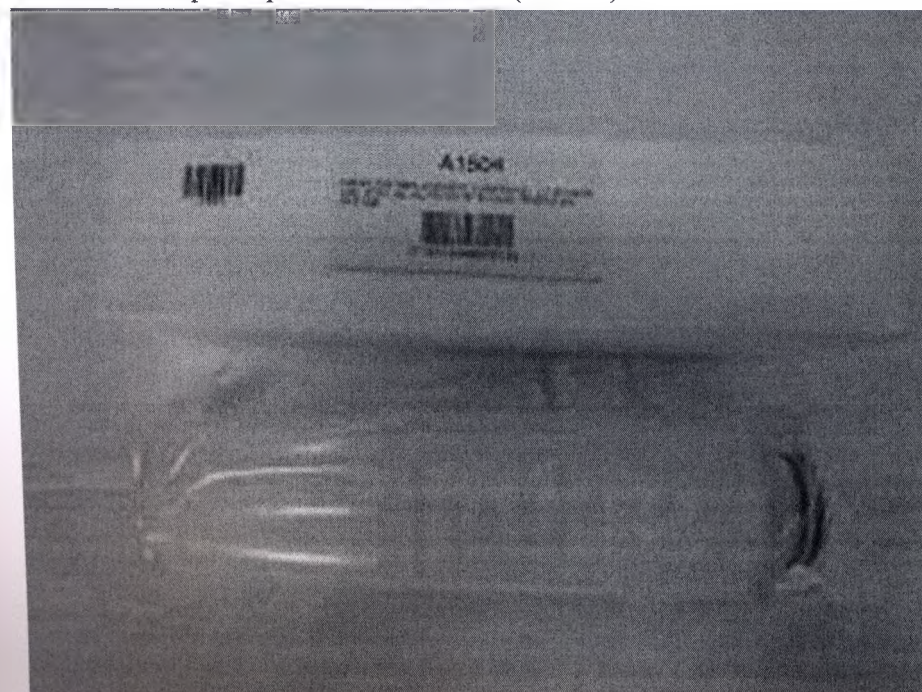


23. Двойной водяной фильтр (A1551).



24. Фильтр для производства стерильной воды, с удлиненным сроком службы (A1525).

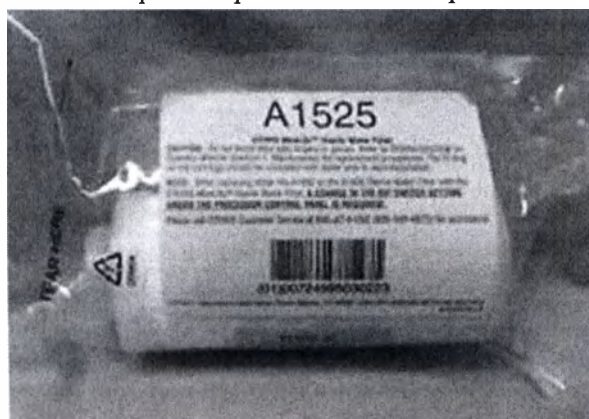


25. Стерильный воздушный фильтр (A1503).

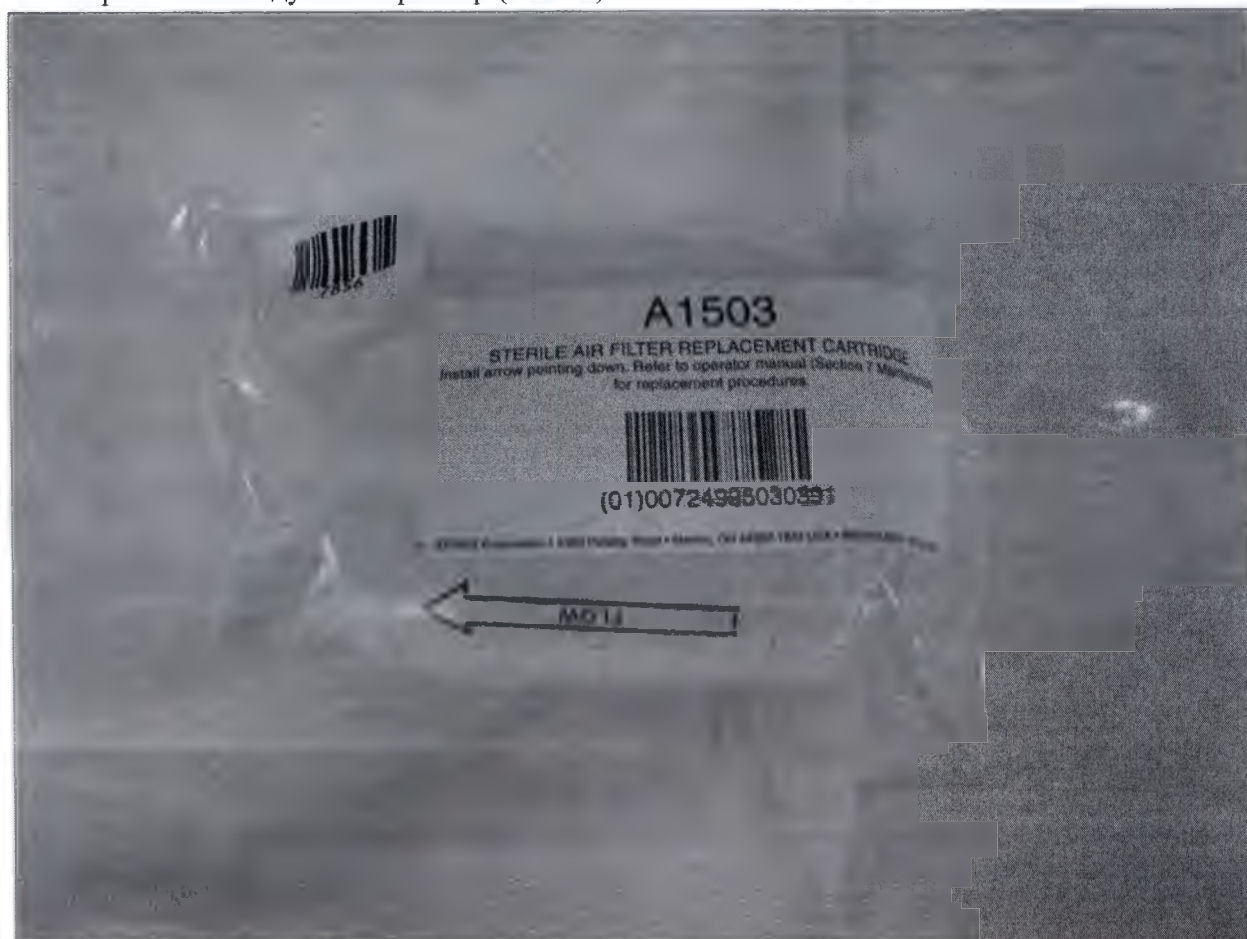


26. Клапан температурного контроля (A1002).



27. Биологический индикаторный набор (LCB002).

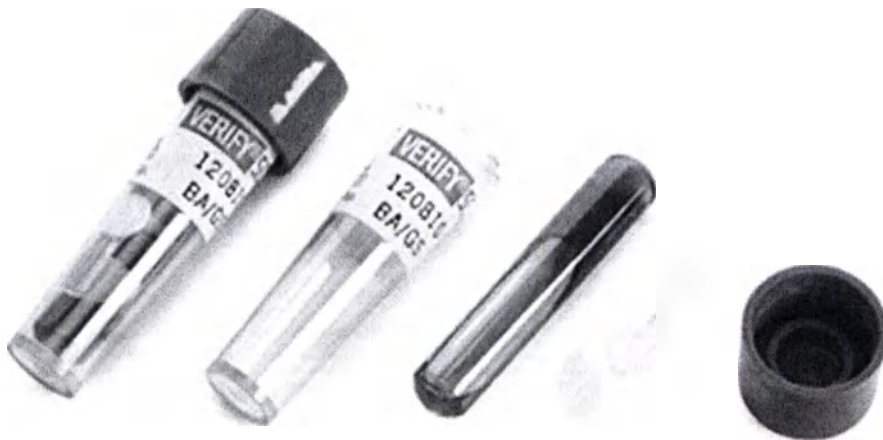

28. Индикаторная полоска для тестирования (LCC009).

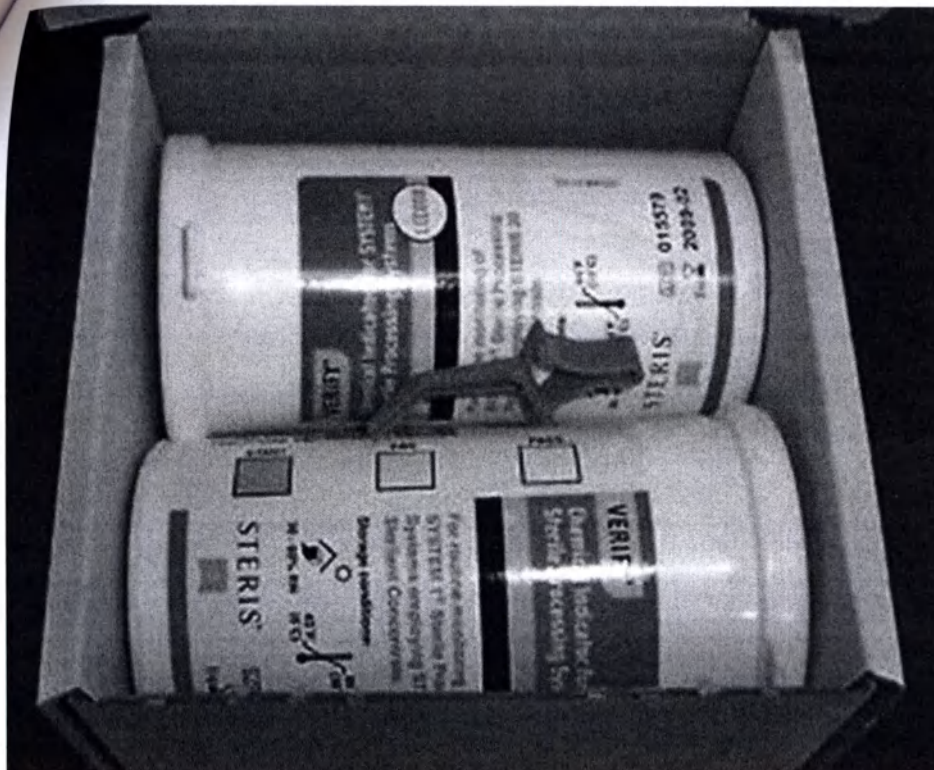


29. Приемная катушка бумаги для принтера (A1730).




30. Стабилизатор напряжения.



31. Устройство отбора стерильнта (A1600).

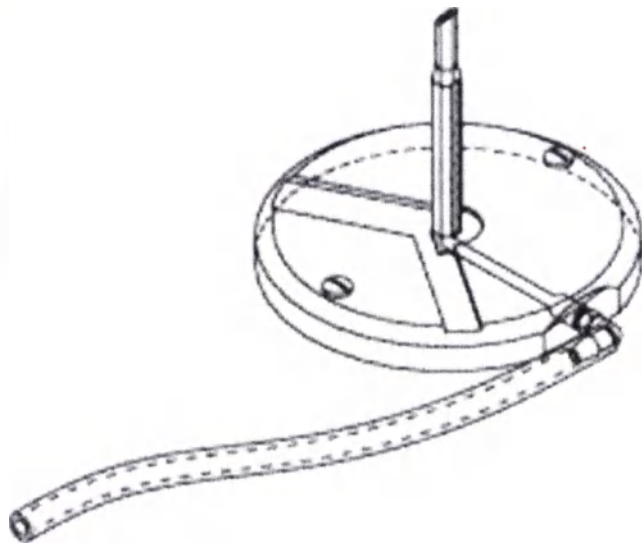

32. Устройство защитного отключения (A1001).

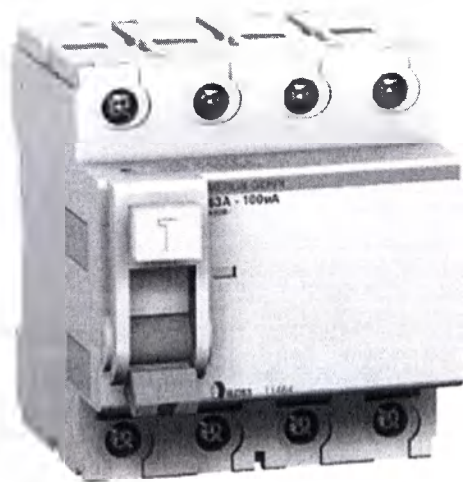


33. Сканер штрих-кода (129376-384).



34. Стерилант Steris 20 (S2009).



35. Прокладка.

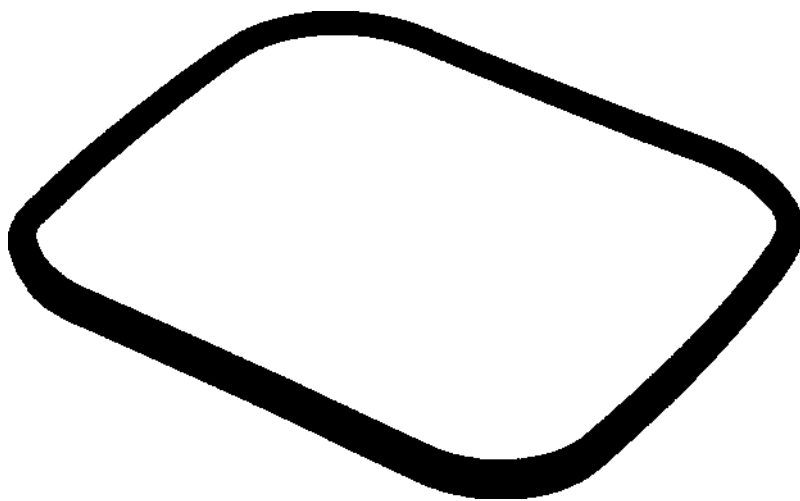


36. Клапан.



37. Фильтр.




38. Циркуляционный насос.

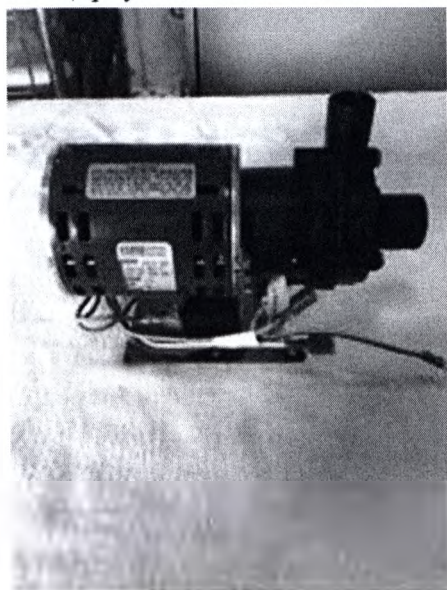

39. Регулятор давления.



40. Высокоэффективный насос.

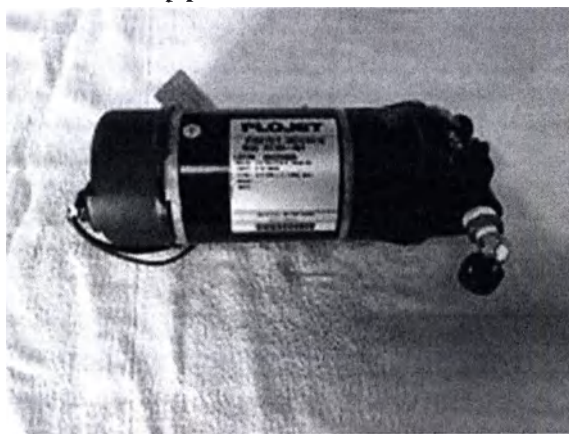


41. Панель для принтера.



42. Панель для дисплея.



43. Затвор.

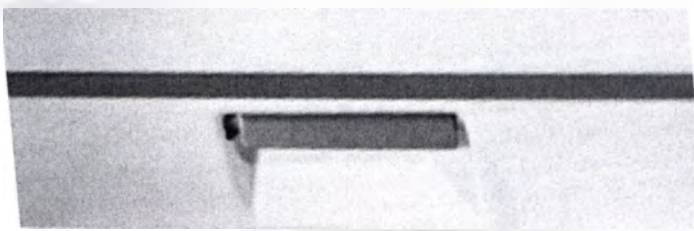


44. Контрольная панель.



45. Уплотнительное кольцо.



46. Нагревательный элемент.

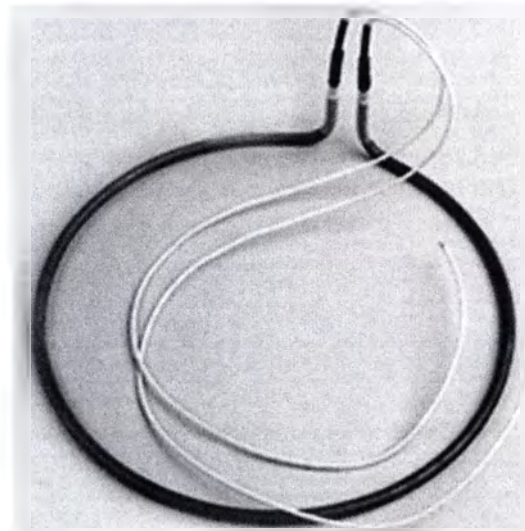

Генеральный директор
ООО «МК ЮНИКС»



В.В. Троценко

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

