



Рис. 1.1. Фотографические изображения носителя медицинского изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM Архив Локальный»: А – компакт диск с дистрибутивом программного обеспечения, масштаб 1:1, Б – лицензионный USB ключ с нанесенным на него серийным номером (классический и микро форм-фактор), масштаб 2:1



А



Б



В

Рис. 1.2. Фотографические изображения потребительской упаковки медицинского изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM Архив Локальный», масштаб 1:2: А – вид спереди, Б – вид сбоку, В – вид сзади.

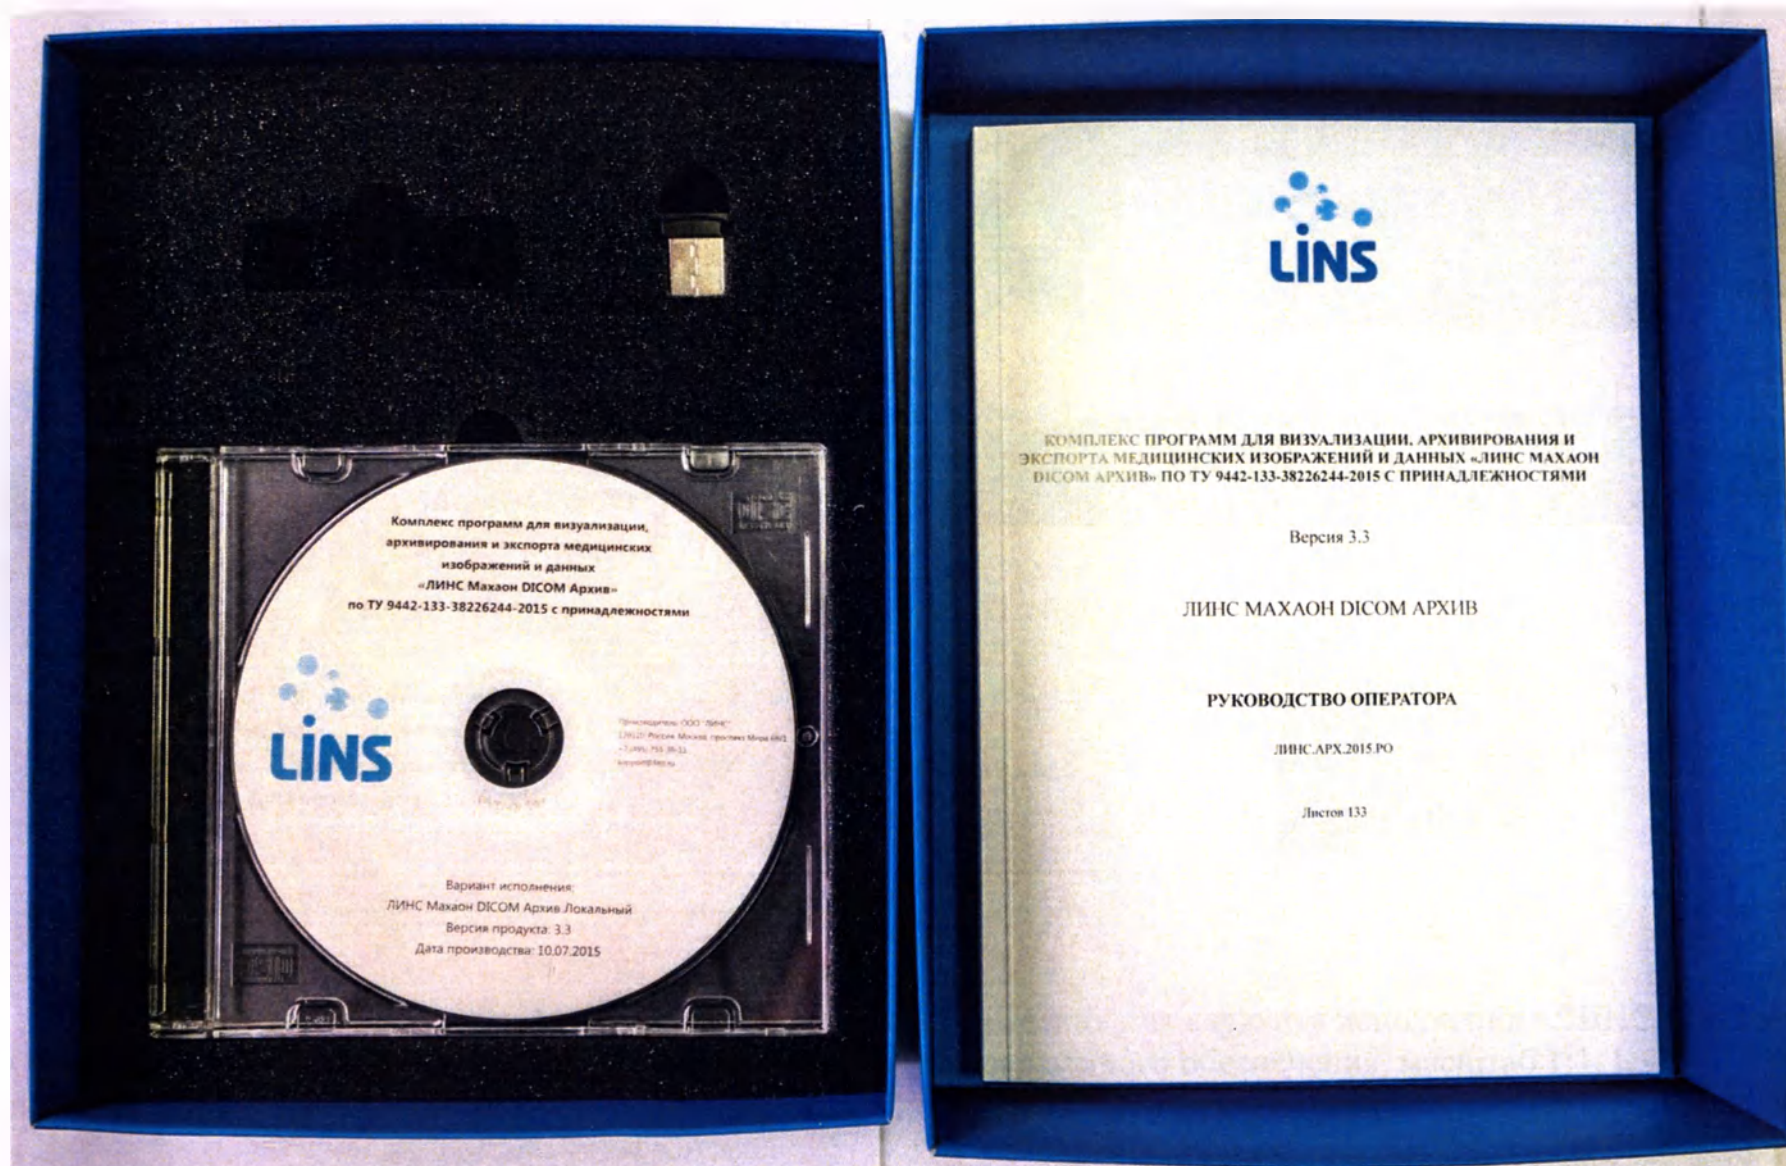


Рис. 1.3. Фотографическое изображение комплектности изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM

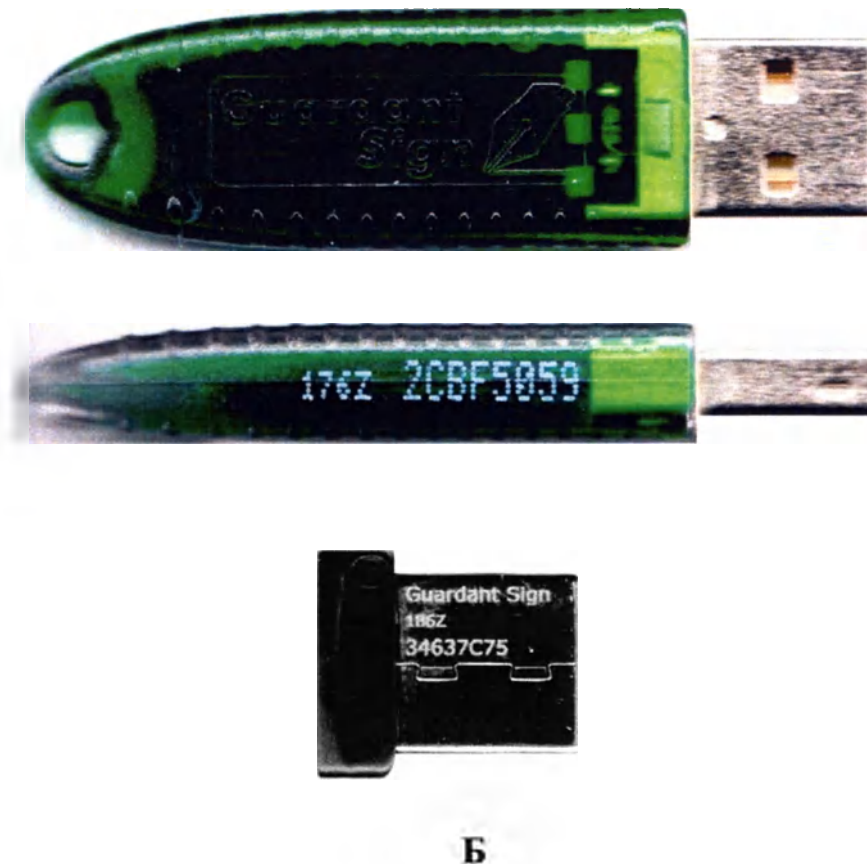


Рис. 2.1. Фотографические изображения носителя медицинского изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM Архив Стандарт»: А – компакт диск с дистрибутивом программного обеспечения, масштаб 1:1, Б – лицензионный USB ключ с нанесенным на него серийным номером (классический и микро форм-фактор), масштаб 2:1.



А



Б



В

Рис. 2.2. Фотографические изображения потребительской упаковки медицинского изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM Архив Стандарт», масштаб 1:2: А – вид спереди, Б – вид сбоку, В – вид сзади.



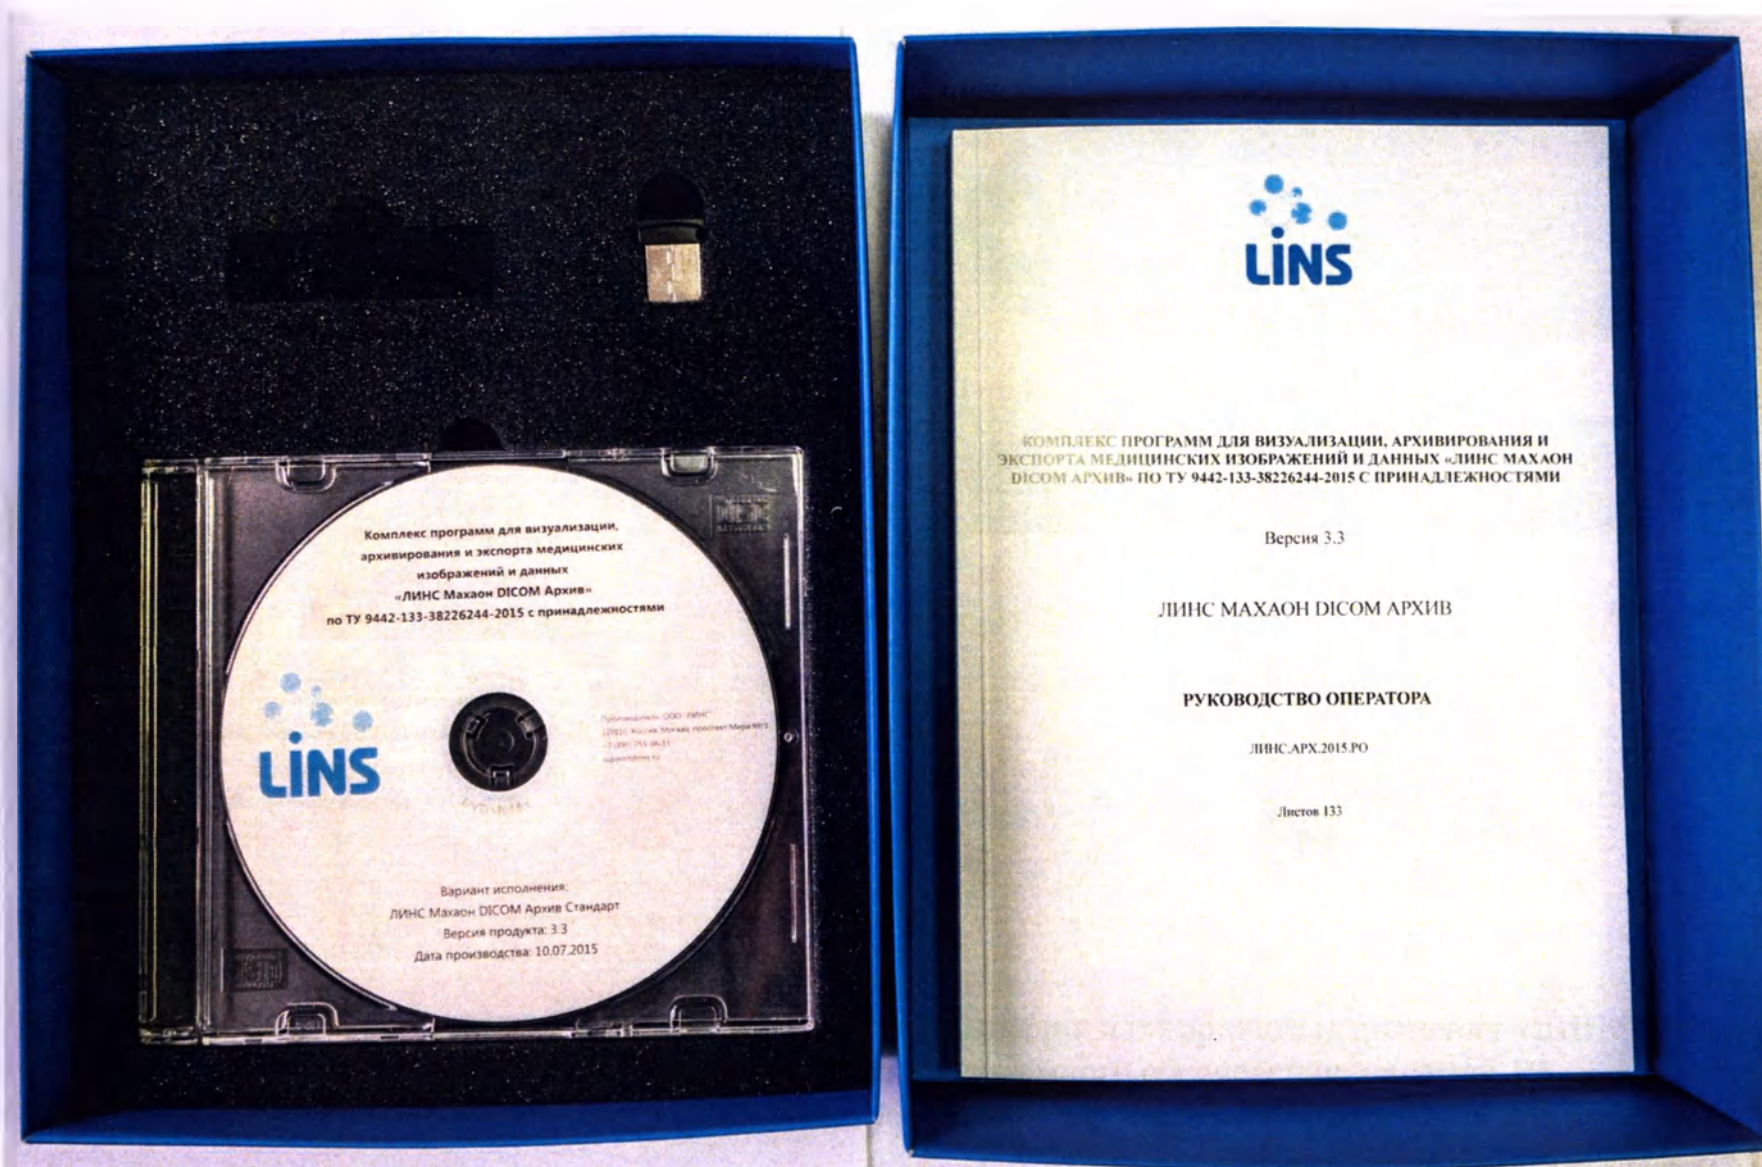


Рис. 2.3. Фотографическое изображение комплектности изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM

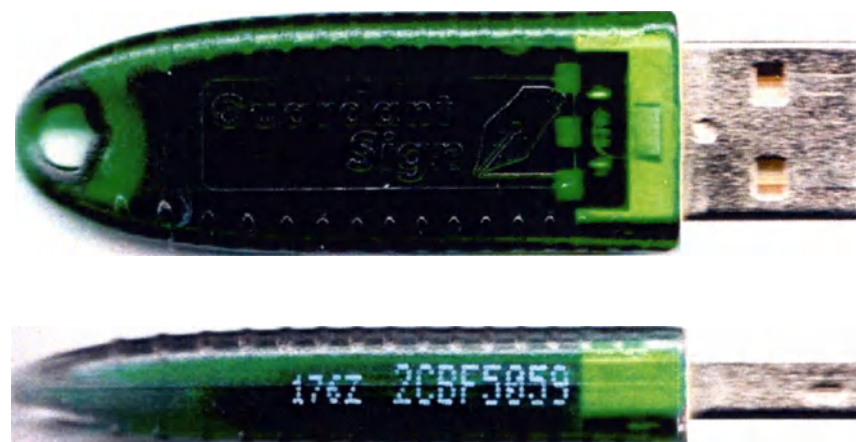

ис. 3.1. Фотографические изображения носителя медицинского изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM Архив Эксперт»: А – компакт диск с дистрибутивом программного обеспечения, масштаб 1:1, Б – лицензионный USB ключ с нанесенным на него серийным номером (классический и микро форм-фактор), масштаб 2:1.

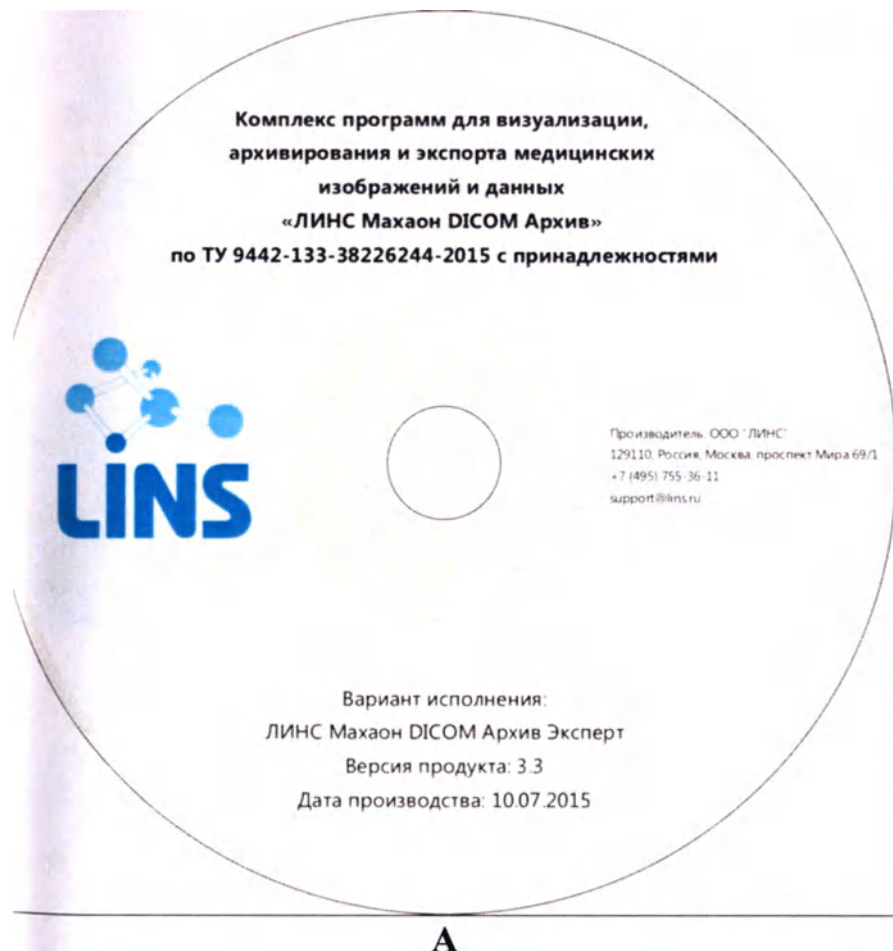

А




Б



В

ис. 3.2. Фотографические изображения потребительской упаковки медицинского изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM Архив Эксперт», масштаб 1:2: А – вид спереди, Б – вид сбоку, В – вид сзади.

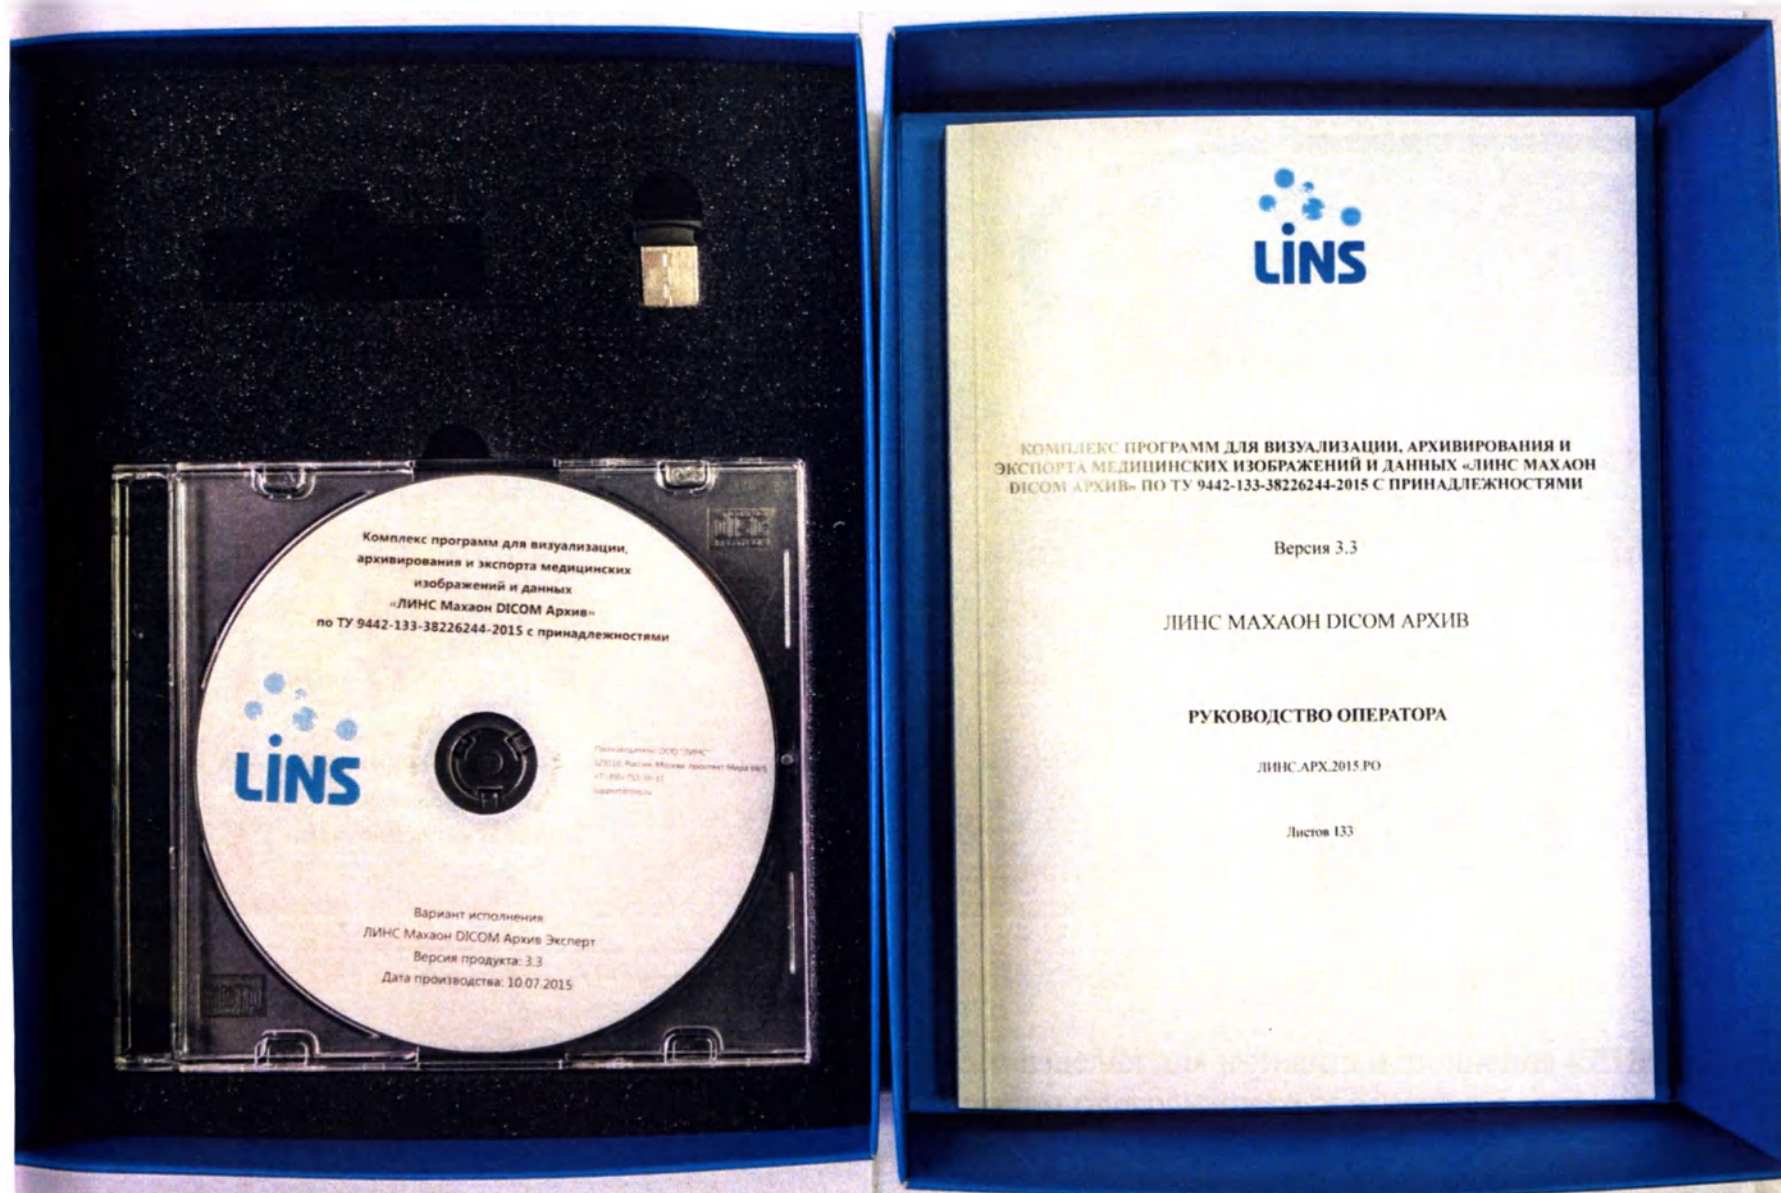

с. 3.3. Фотографическое изображение комплектности изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM Архив Эксперт», масштаб 1:1.5.



А



Б

Рис. 4.1. Фотографические изображения носителя медицинского изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM Архив Максимальный»: А – компакт диск с дистрибутивом программного обеспечения, масштаб 1:1, Б – лицензионный USB ключ с нанесенным на него серийным номером (классический и микро форм-фактор), масштаб 2:1.



А




Б



В

Рис. 4.2. Фотографические изображения потребительской упаковки медицинского изделия для варианта исполнения «ЛИНС Махаон DICOM Архив Максимальный», масштаб 1:2: А – вид спереди, Б – вид сбоку, В – вид сзади.

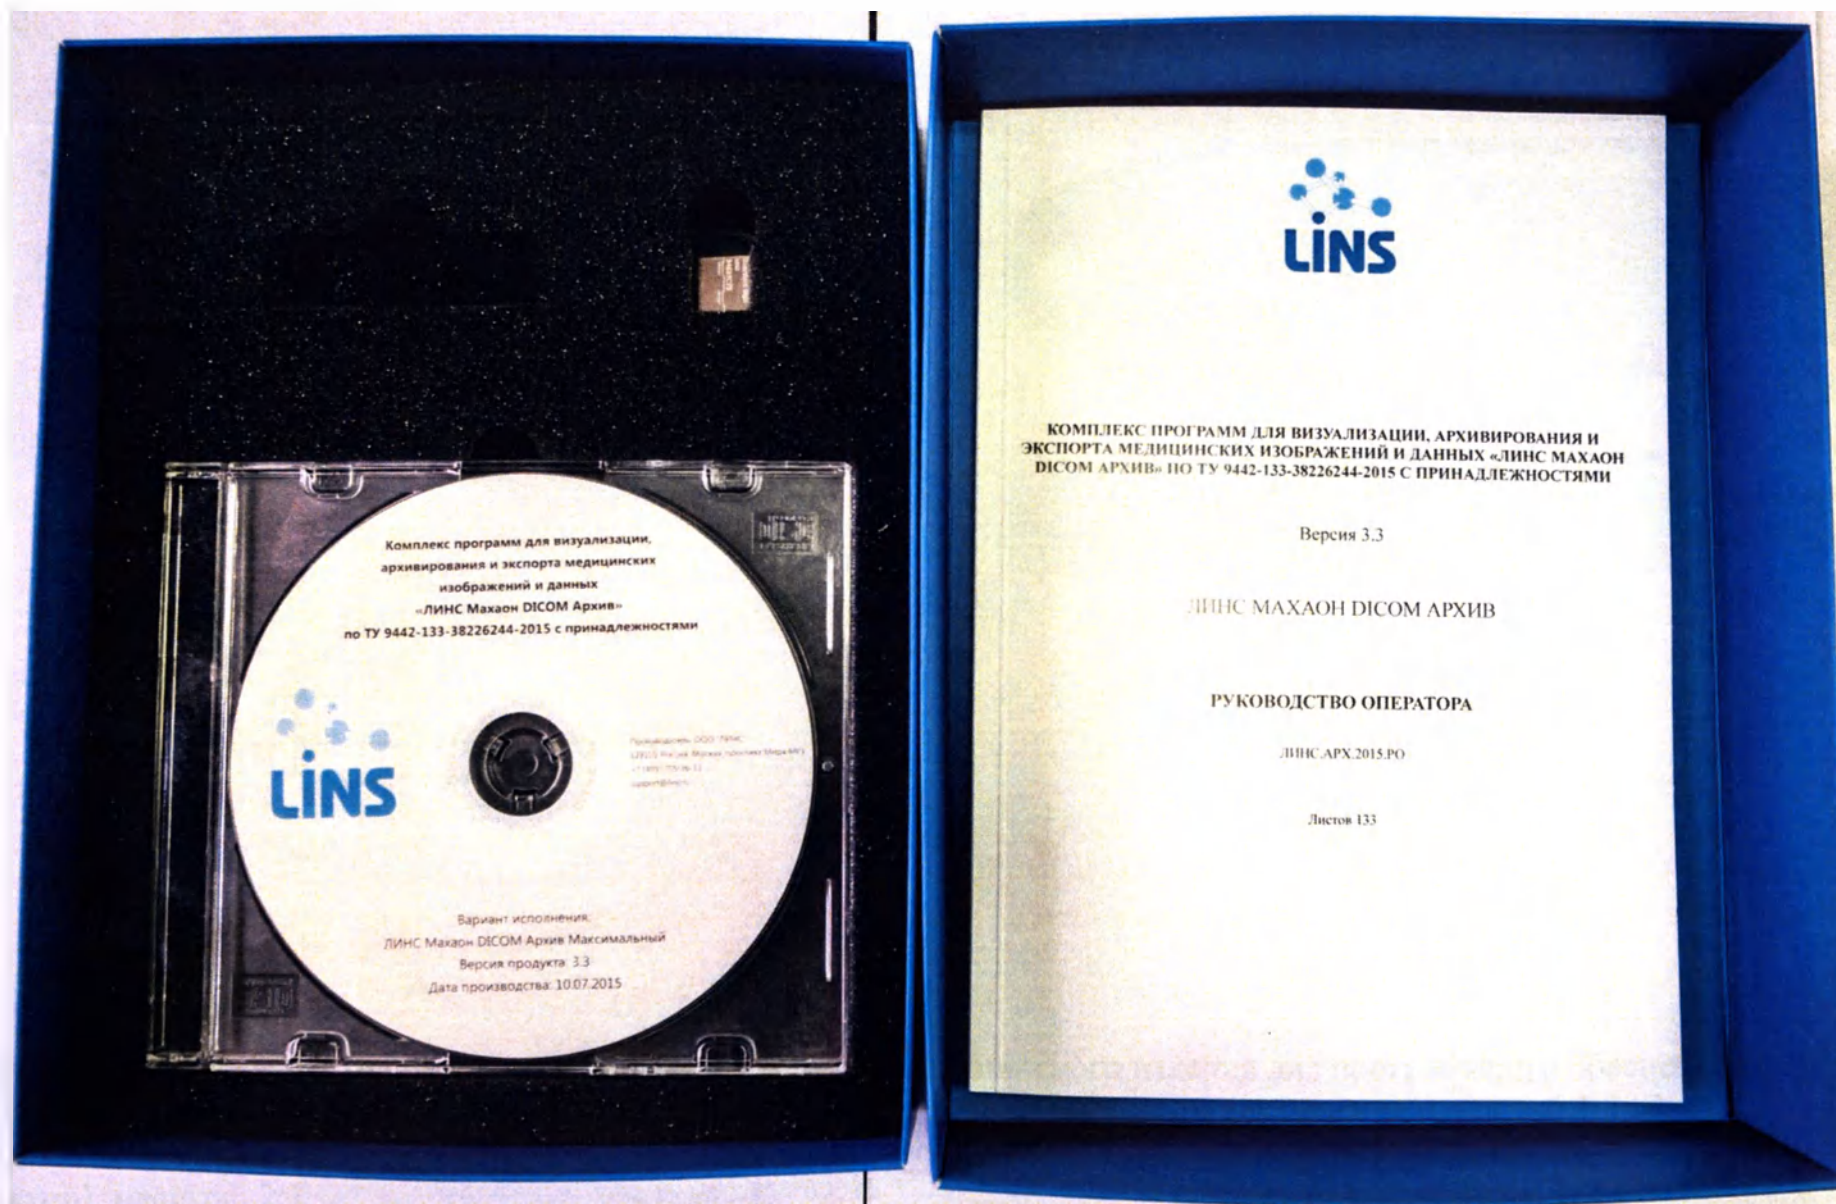

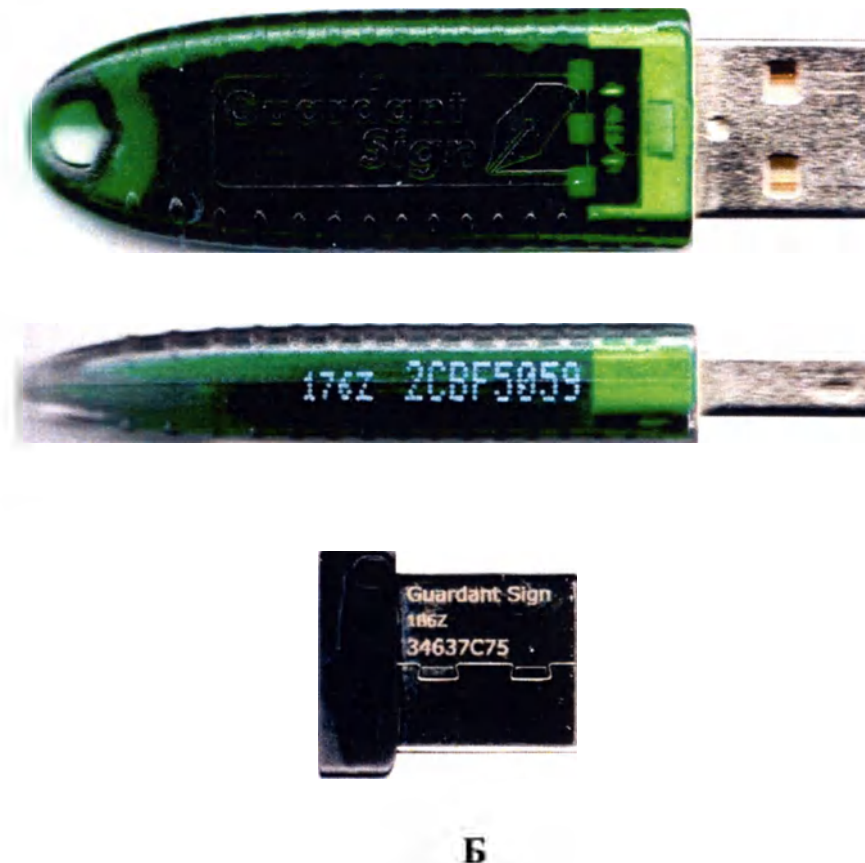



Рис. 5.1. Фотографические изображения принадлежности медицинского изделия для программного обеспечения «ЛИНС Махаон DICOM Worklist»: А – компакт диск с дистрибутивом программного обеспечения, масштаб 1:1, Б – лицензионный USB ключ для активации ПО с нанесенным на него серийным номером (классический и микро форм-фактор), масштаб 2:1.



А




Б

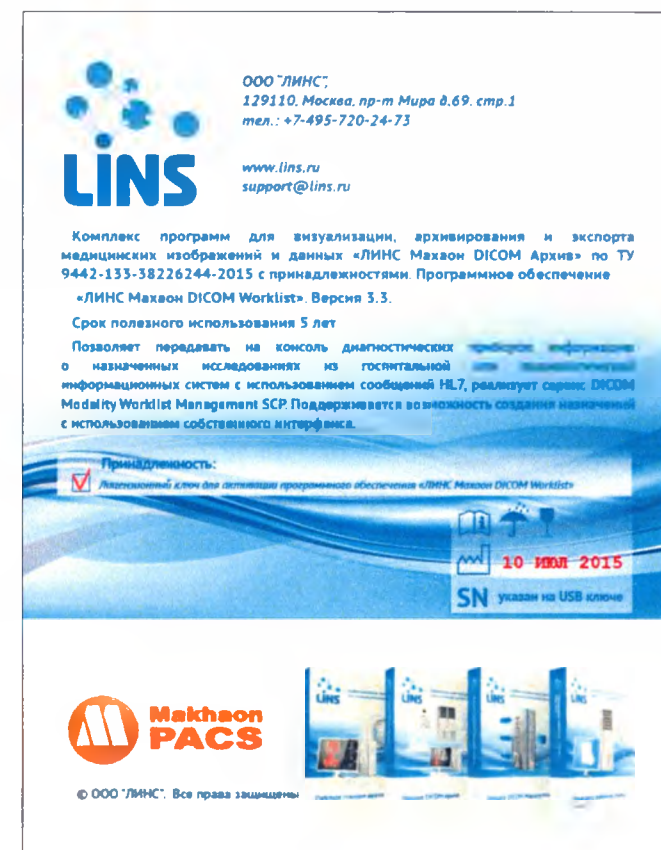

В

Рис. 5.2. Фотографические изображения потребительской упаковки медицинского изделия для программного обеспечения «ЛИНС Махаон DICOM Worklist» масштаб 1:2: А – вид спереди, Б – вид сбоку, В – вид сзади.

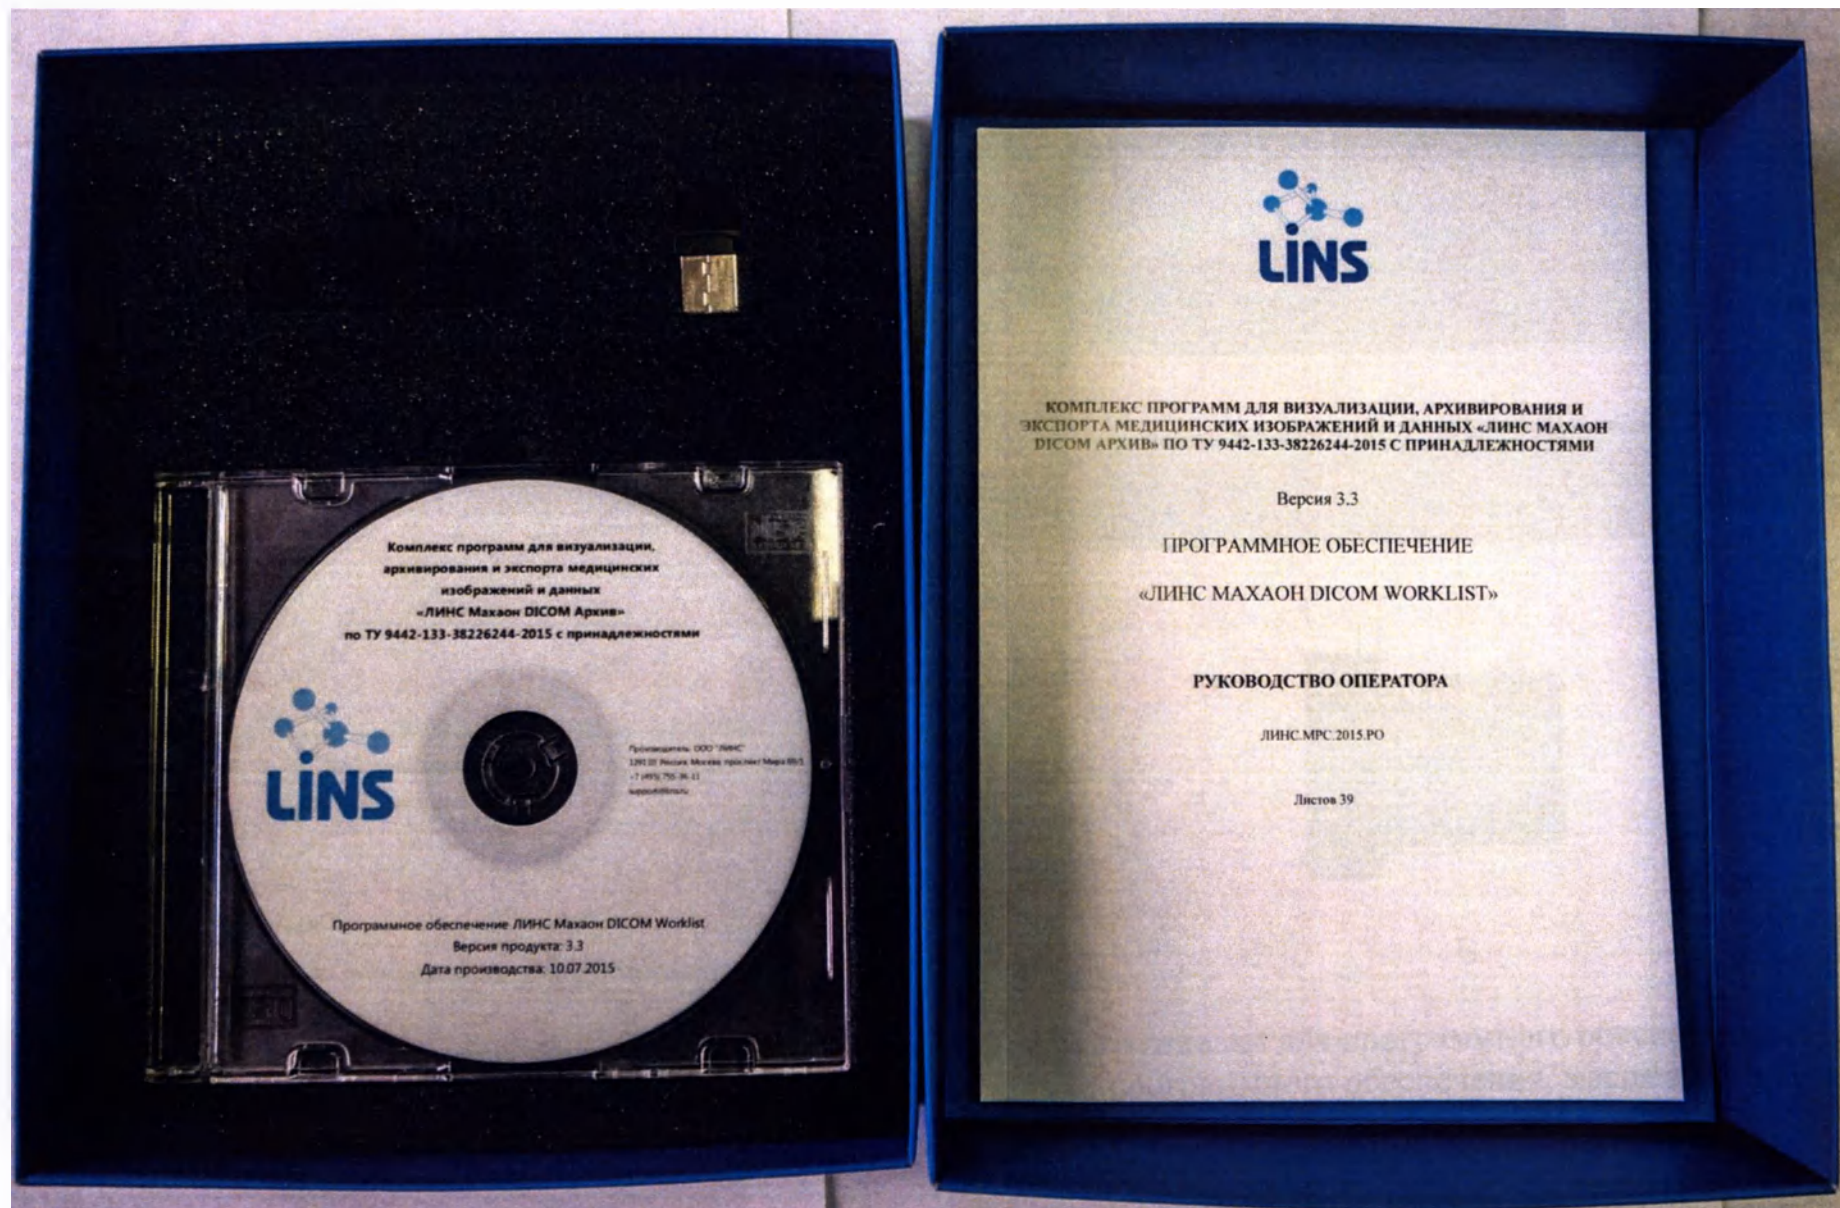

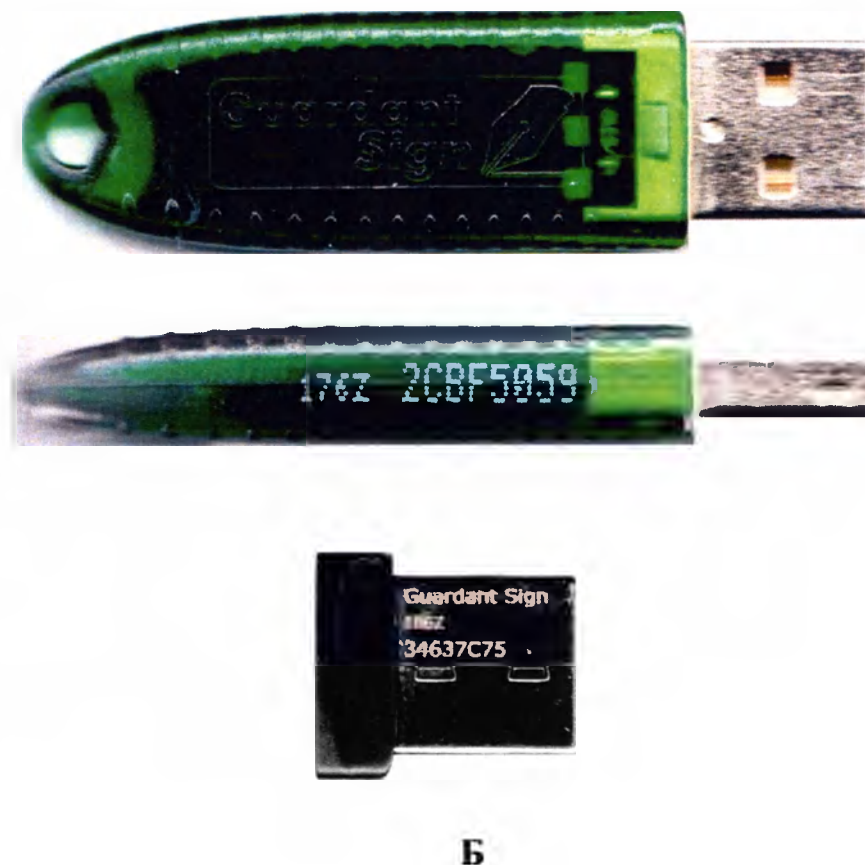


Рис. 6.1. Фотографические изображения принадлежности медицинского изделия для программного обеспечения «ЛИНС Махаон DICOM Маршрутизатор»: А – компакт диск с дистрибутивом программного обеспечения, масштаб 1:1, Б – лицензионный USB ключ для активации ПО с нанесенным на него серийным номером (классический и микро форм-фактор), масштаб 2:1.



А




Б



В

Рис. 6.2. Фотографические изображения потребительской упаковки медицинского изделия для программного обеспечения «ЛИНС Махаон DICOM Маршрутизатор», масштаб 1:2: А – вид спереди, Б – вид сбоку, В – вид сзади.

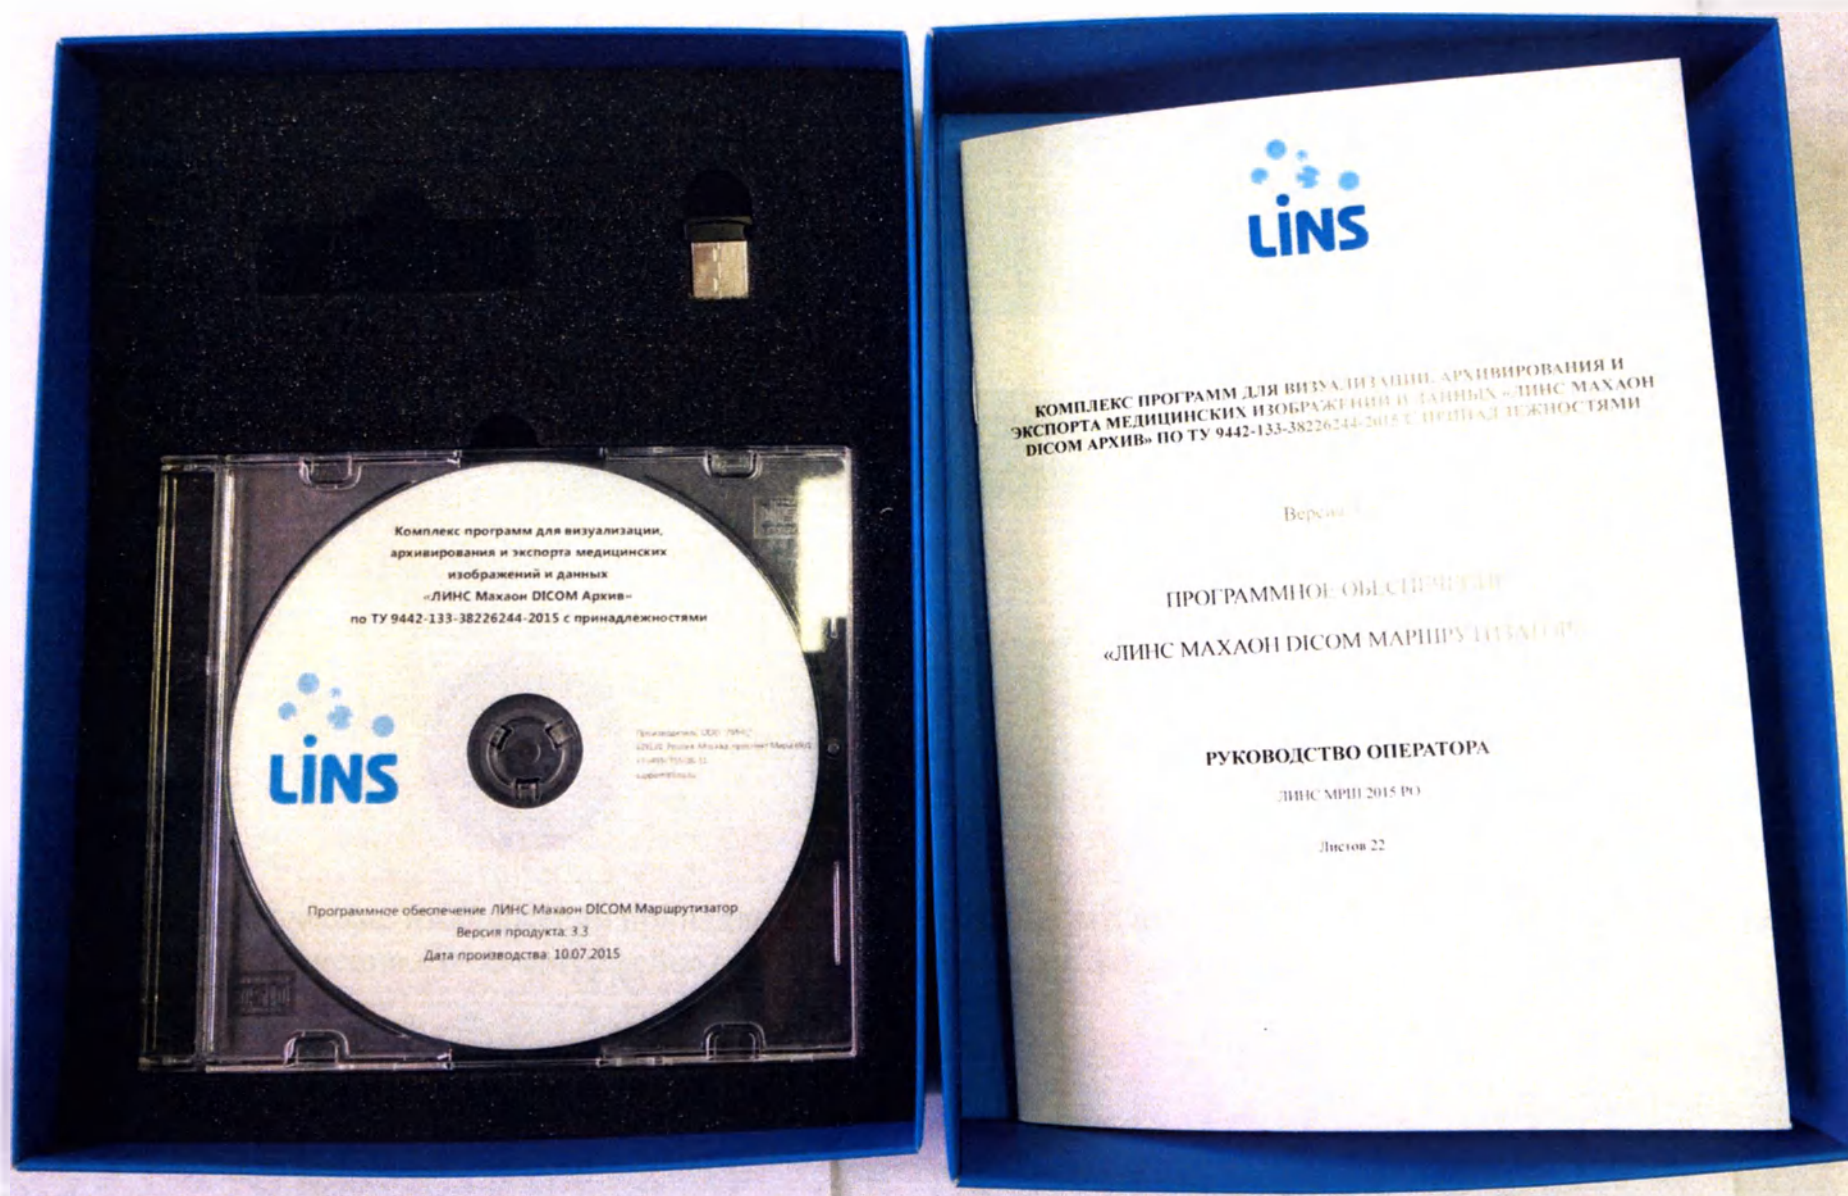

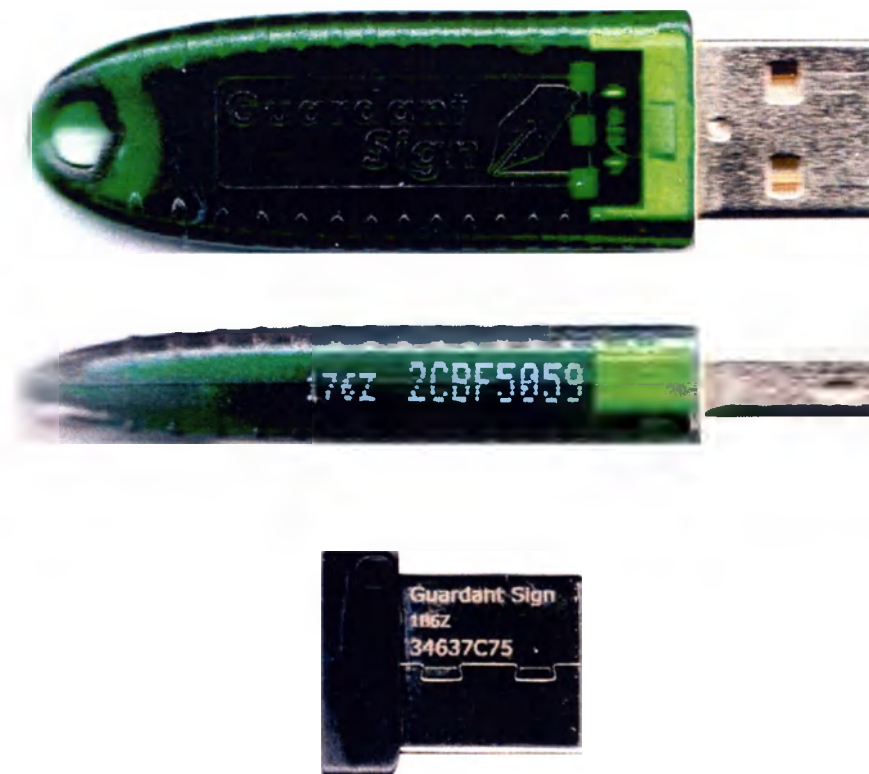


Рис. 7.1. Фотографические изображения принадлежности медицинского изделия Лицензионный ключ для активации программного обеспечения «Web-интерфейс» (классический и микро форм-фактор), масштаб 2:1.



А



Б

Рис. 7.2. Фотографические изображения принадлежности медицинского изделия Лицензионный ключ для активации программного обеспечения «Просмотровая станция NetLite»: А – компакт диск с дистрибутивом программного обеспечения, масштаб 1:1, Б – лицензионный USB ключ для активации ПО с нанесенным на него серийным номером (классический и микро форм-фактор), масштаб 2:1.

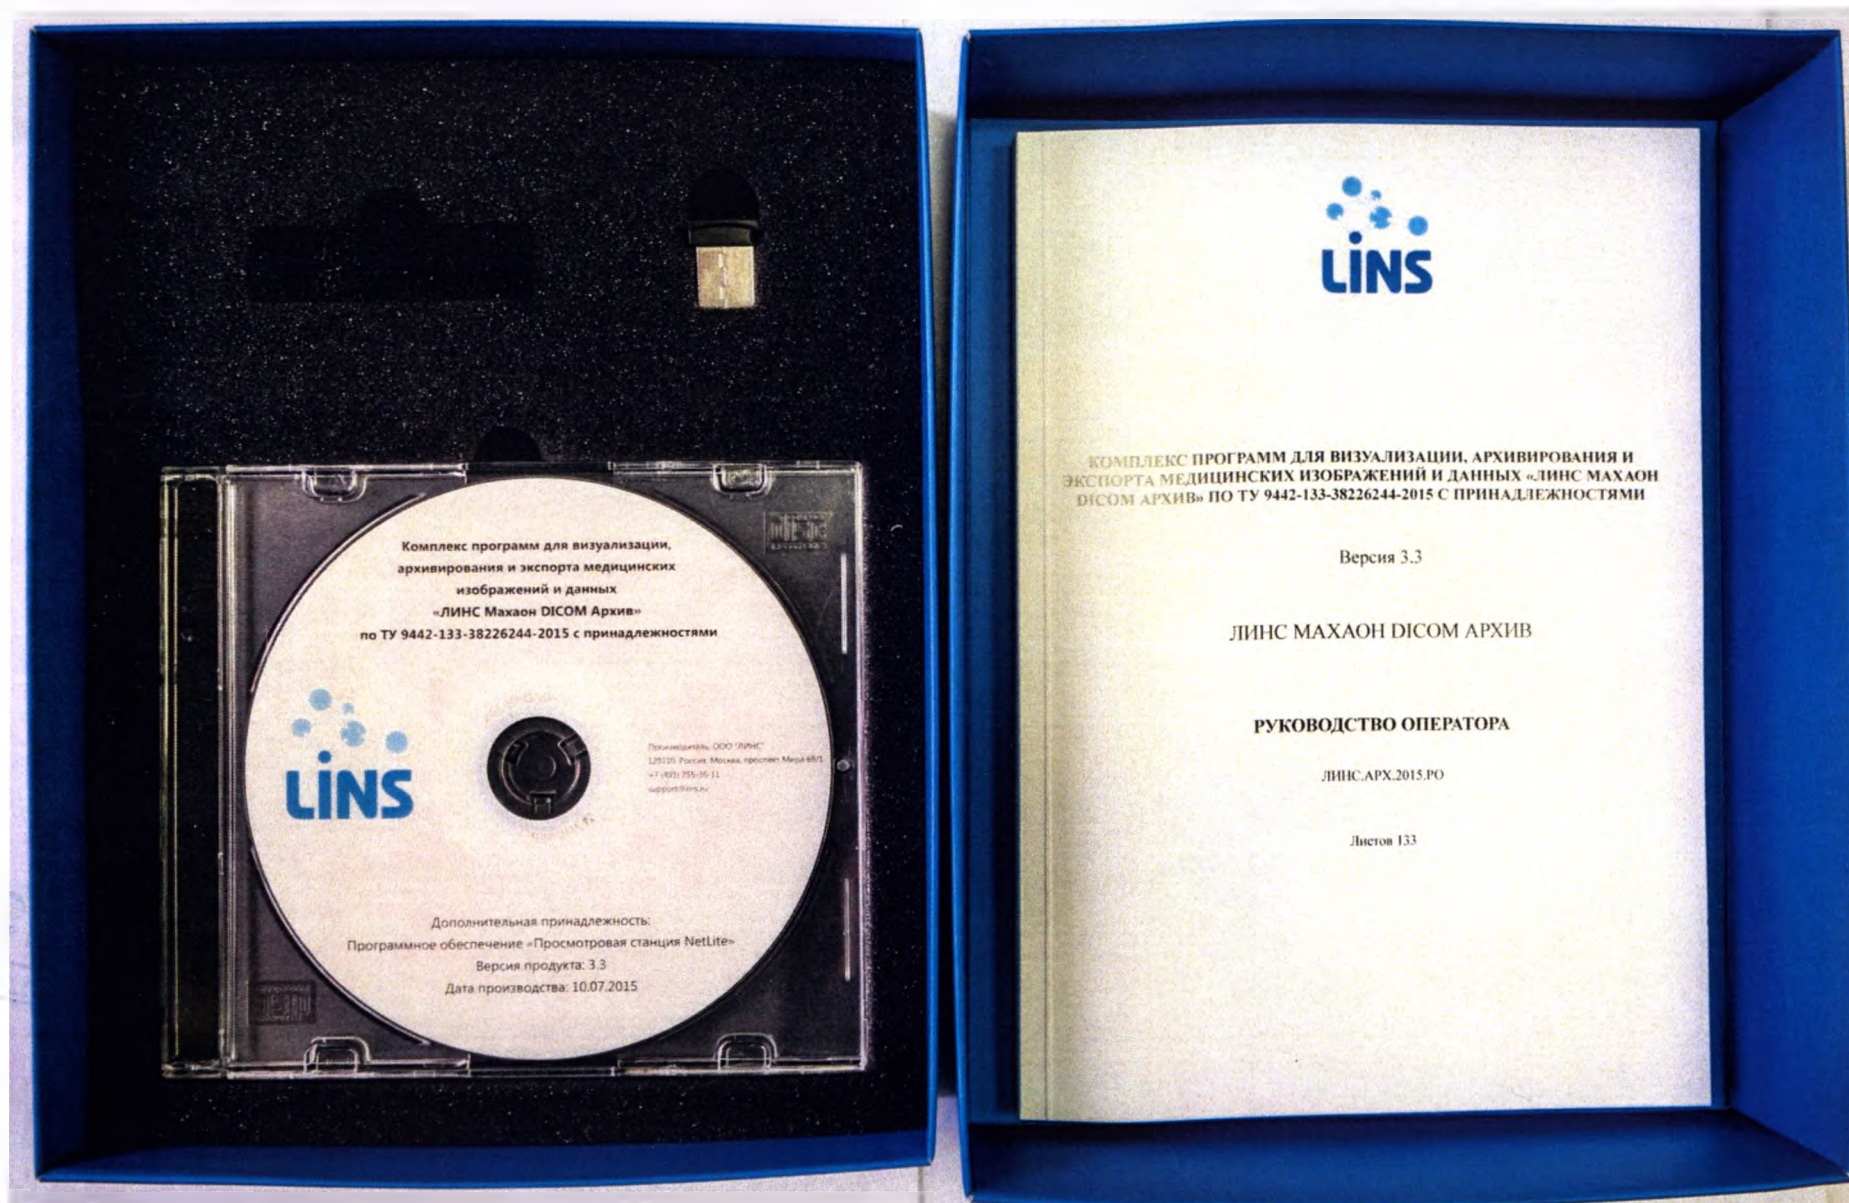


Рис. 7.3. Фотографическое изображение комплектности изделия для программного обеспечения «Просмотровая станция

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

81 (двадцать один)

Листов (а)

Генеральный директор

*[Handwritten signature]*

Умещкий И.Н.

