


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ.**



α-АМИЛАЗА-ВИТАЛ

REF B 11.01

Набор реагентов для определения активности α-амилазы
в сыворотке (плазме) крови и моче
амилокластическим методом



Реагент №1: 1 x 105 мл
Реагент №2: 1 x 5 мл
Реагент №3: 1 x 7 мл
Реагент №4: 1 x 13 мл
Реагент №5: 1 x 50 мл

ТУ 9398-052-94568735-2016
РЗН 2017/5646 от 18.04.2017

LOT

Серия:
XXXX



Дата выпуска:
ГГГГ.ММ




Годен до:
ГГГГ.ММ

только для in vitro диагностики

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург, Дорога в Каменку
дом 56, литера А



3

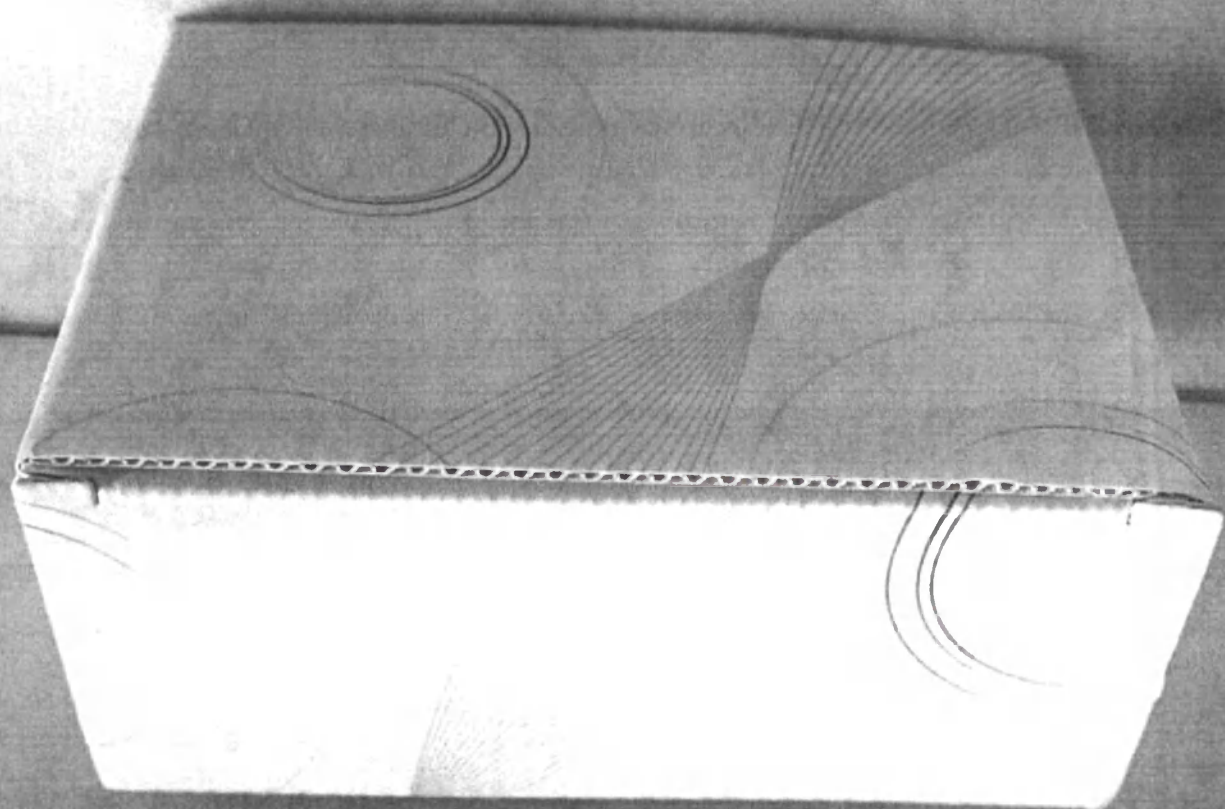

**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор Плехов А.Г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г. Плехов

2019 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

α -АМИЛАЗА-ВИТАЛ

Набор реагентов для определения активности α -амилазы в сыворотке (плазме)
крови и моче амилокластическим методом

Набор реагентов для определения активности α-амилазы
в сыворотке (плазме) крови и моче
амилокластическим методом.

LOT Серия: xxxx



Дата выпуска: гггг.мм



Годен до: гггг.мм

Реагент №1: 1х105 мл

Реагент №2: 1х5 мл

Реагент №3: 1х7 мл

Реагент №4: 1х13 мл

Реагент №5: 1х50 мл

ТУ 9398-052-94568735-2016

РЗН 2017/5646 от 18.04.2017



АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»,
194356, Санкт-Петербург, Дорога в Каменку, дом 56, литера А



+2-8°C



4 606453 1849072



5010232954236



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 1

α-АМИЛАЗА-ВИТАЛ

REF В 11.01

Буфер

105 мл



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 2

α-АМИЛАЗА-ВИТАЛ

REF В 11.01

Концентрированный субстрат

5 мл



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 3

α-АМИЛАЗА-ВИТАЛ

REF В 11.01

Концентрированный раствор йода

7 мл



+2-8°C

LOT xxxx



годен до: гггг.мм



Только для in vitro диагностики

РЕАГЕНТ 4

α-АМИЛАЗА-ВИТАЛ

REF В 11.01

Фторид калия

13 мл

 +2-8°C

LOT xxxx

 годен до: гггг.мм

 Только для in vitro диагностики



РЕАГЕНТ 5

α-АМИЛАЗА-ВИТАЛ

REF В 11.01

Соляная кислота

50 мл

 +2-8°C

LOT xxxx

 годен до: гггг.мм

 Только для in vitro диагностики



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего 3 листа(ов)

Ген. директор Департамента Согражданства Тилехов А.Г.

