





ВЕКТОР

БЕСТ

REF

C-8879

набор реактивов для выделения ДНК
из клинических образцов

Лизирующий раствор (А)

LOT 94

СОСТАВ:

1. Лизирующий раствор с ВКО
2. Отрицательный контрольный образец

1 фл. 140 мл 93
1 фл. 1 мл 73

Принадлежности:

Глубоколуночный планшет с крышкой
Фильтровальная бумага

2 шт.
2 листа



BEKTOP

БЕСТ

REF **C-8879**

Σ 192

LOT **94**

ТУ 9398-551-23548172-2016

ПУ № РЗН 2017/5872 от 26.06.2017

 **2019-07-16**

 **2020-07-16**


Лизирующий раствор (А)

IVD




88791607200009400550

Для профессионального применения

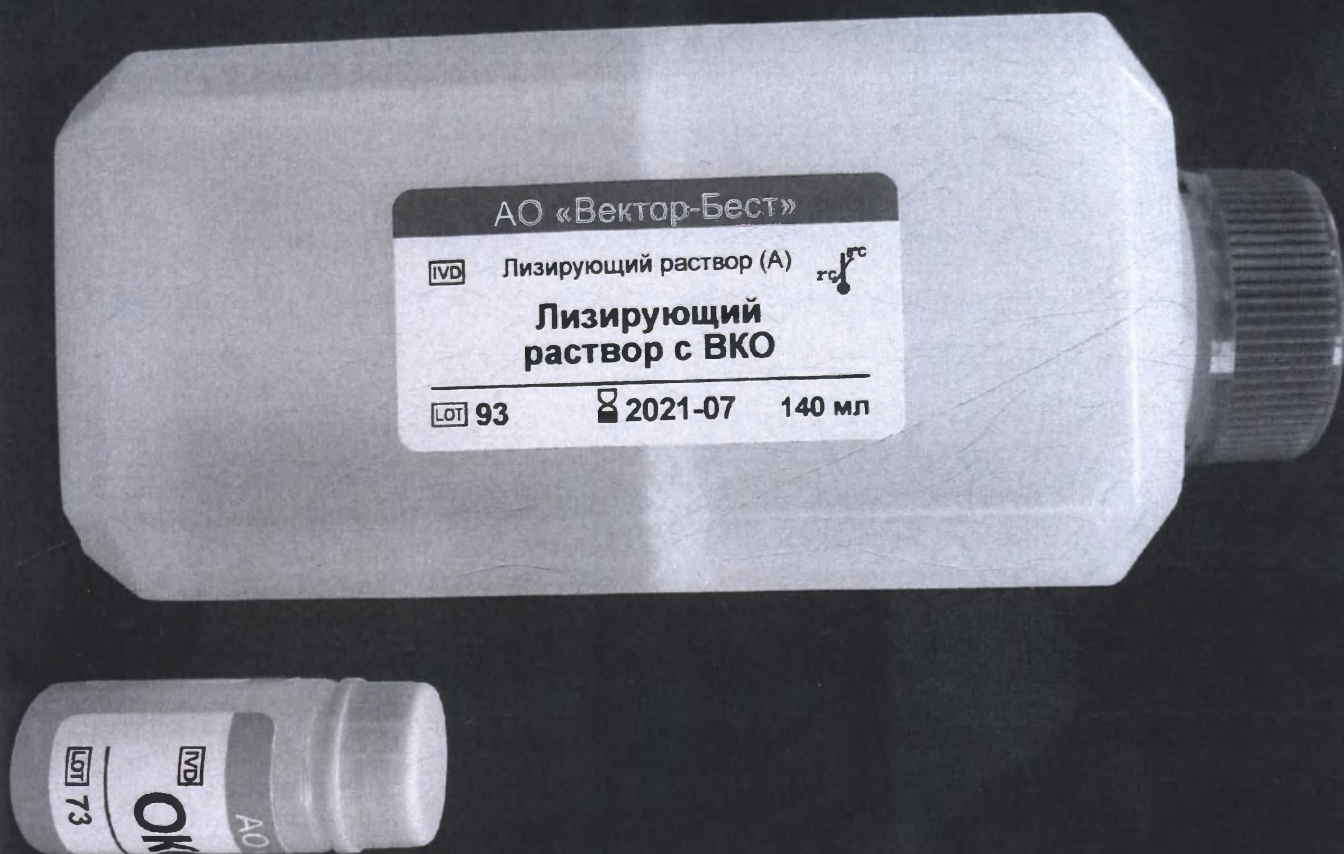



ВЕКТОР
БЕСТ

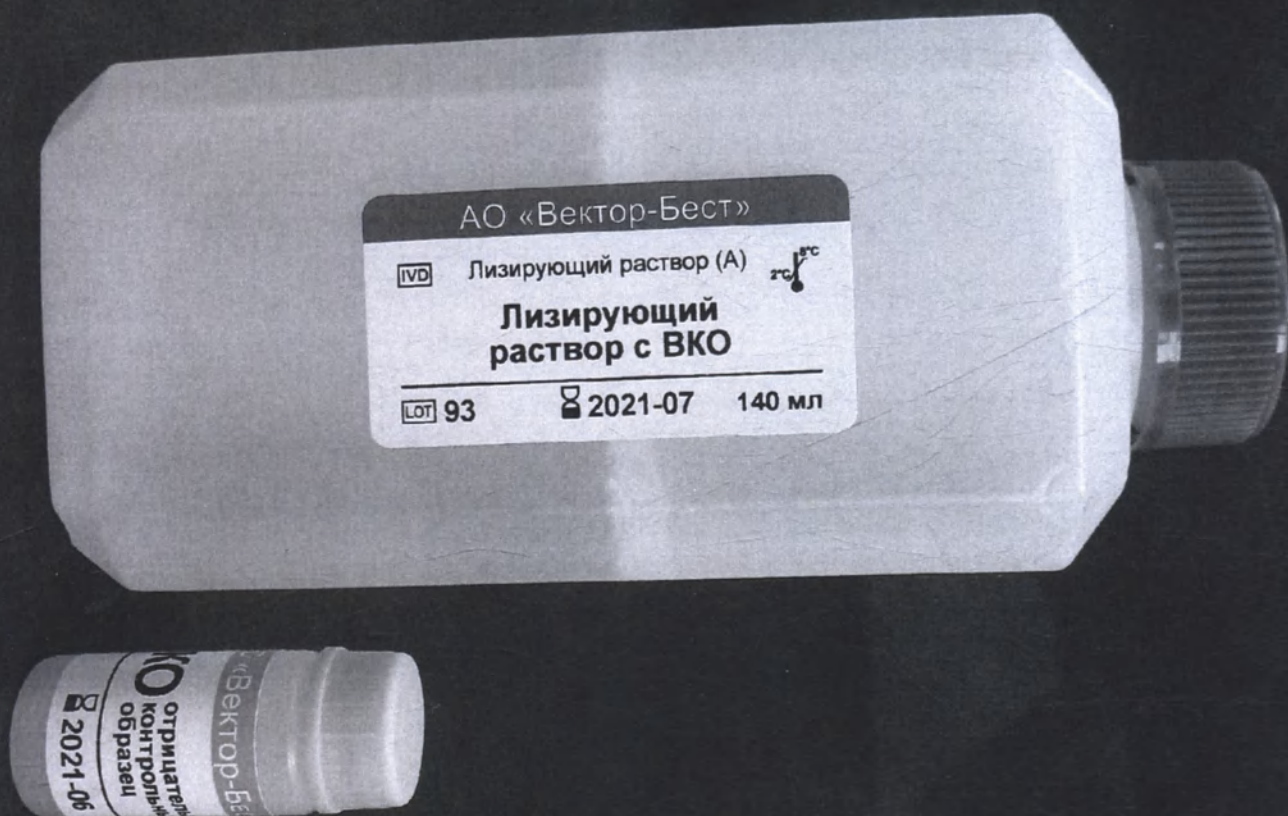

АО «Вектор-Бест»
ИВД
«ВЕСТА»
ОБЩЕСТВО

2019 г.

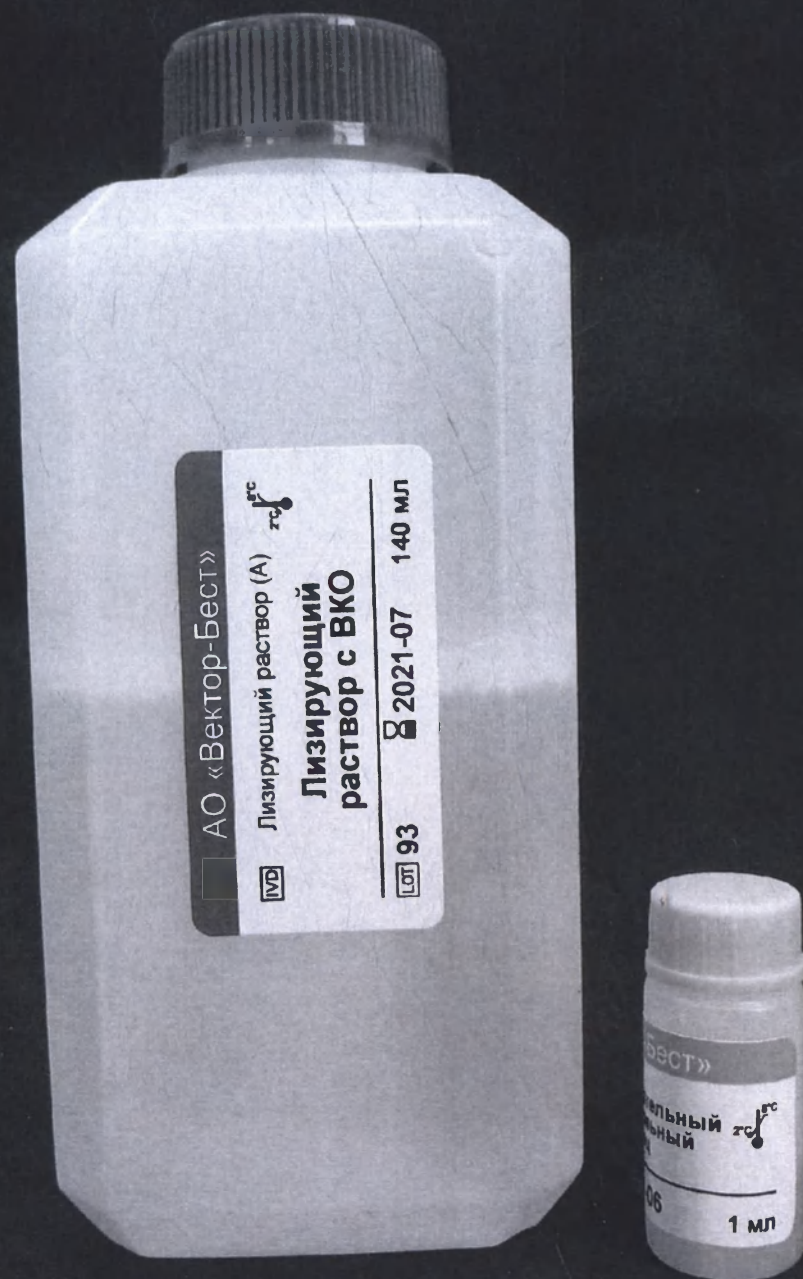

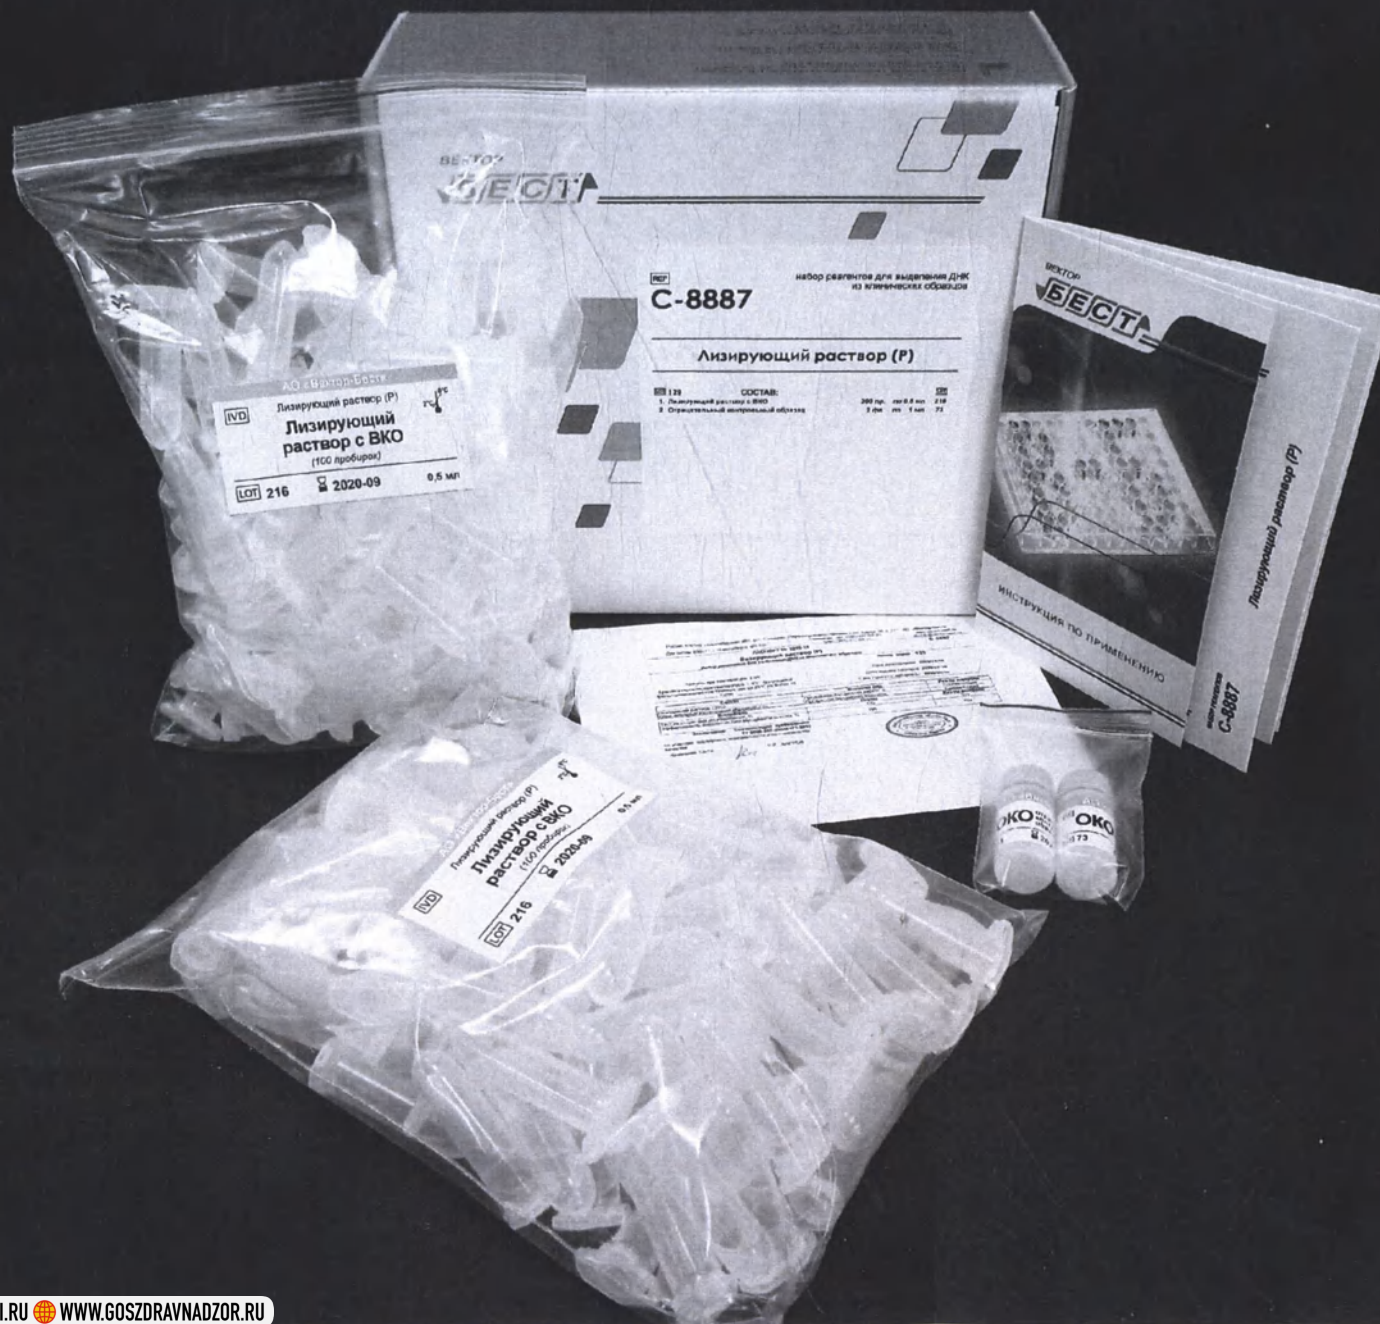



ВЕКТОР

БЕСТ

REF

C-8887

набор реагентов для выделения ДНК
из клинических образцов

Лизирующий раствор (Р)

LOT 129

СОСТАВ:

1. Лизирующий раствор с ВКО
2. Отрицательный контрольный образец

200 пр. по 0,5 мл
2 фл. по 1 мл

LOT

216
73

129


 2019-07-10


2020-07-10




88871007200012900512



 ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

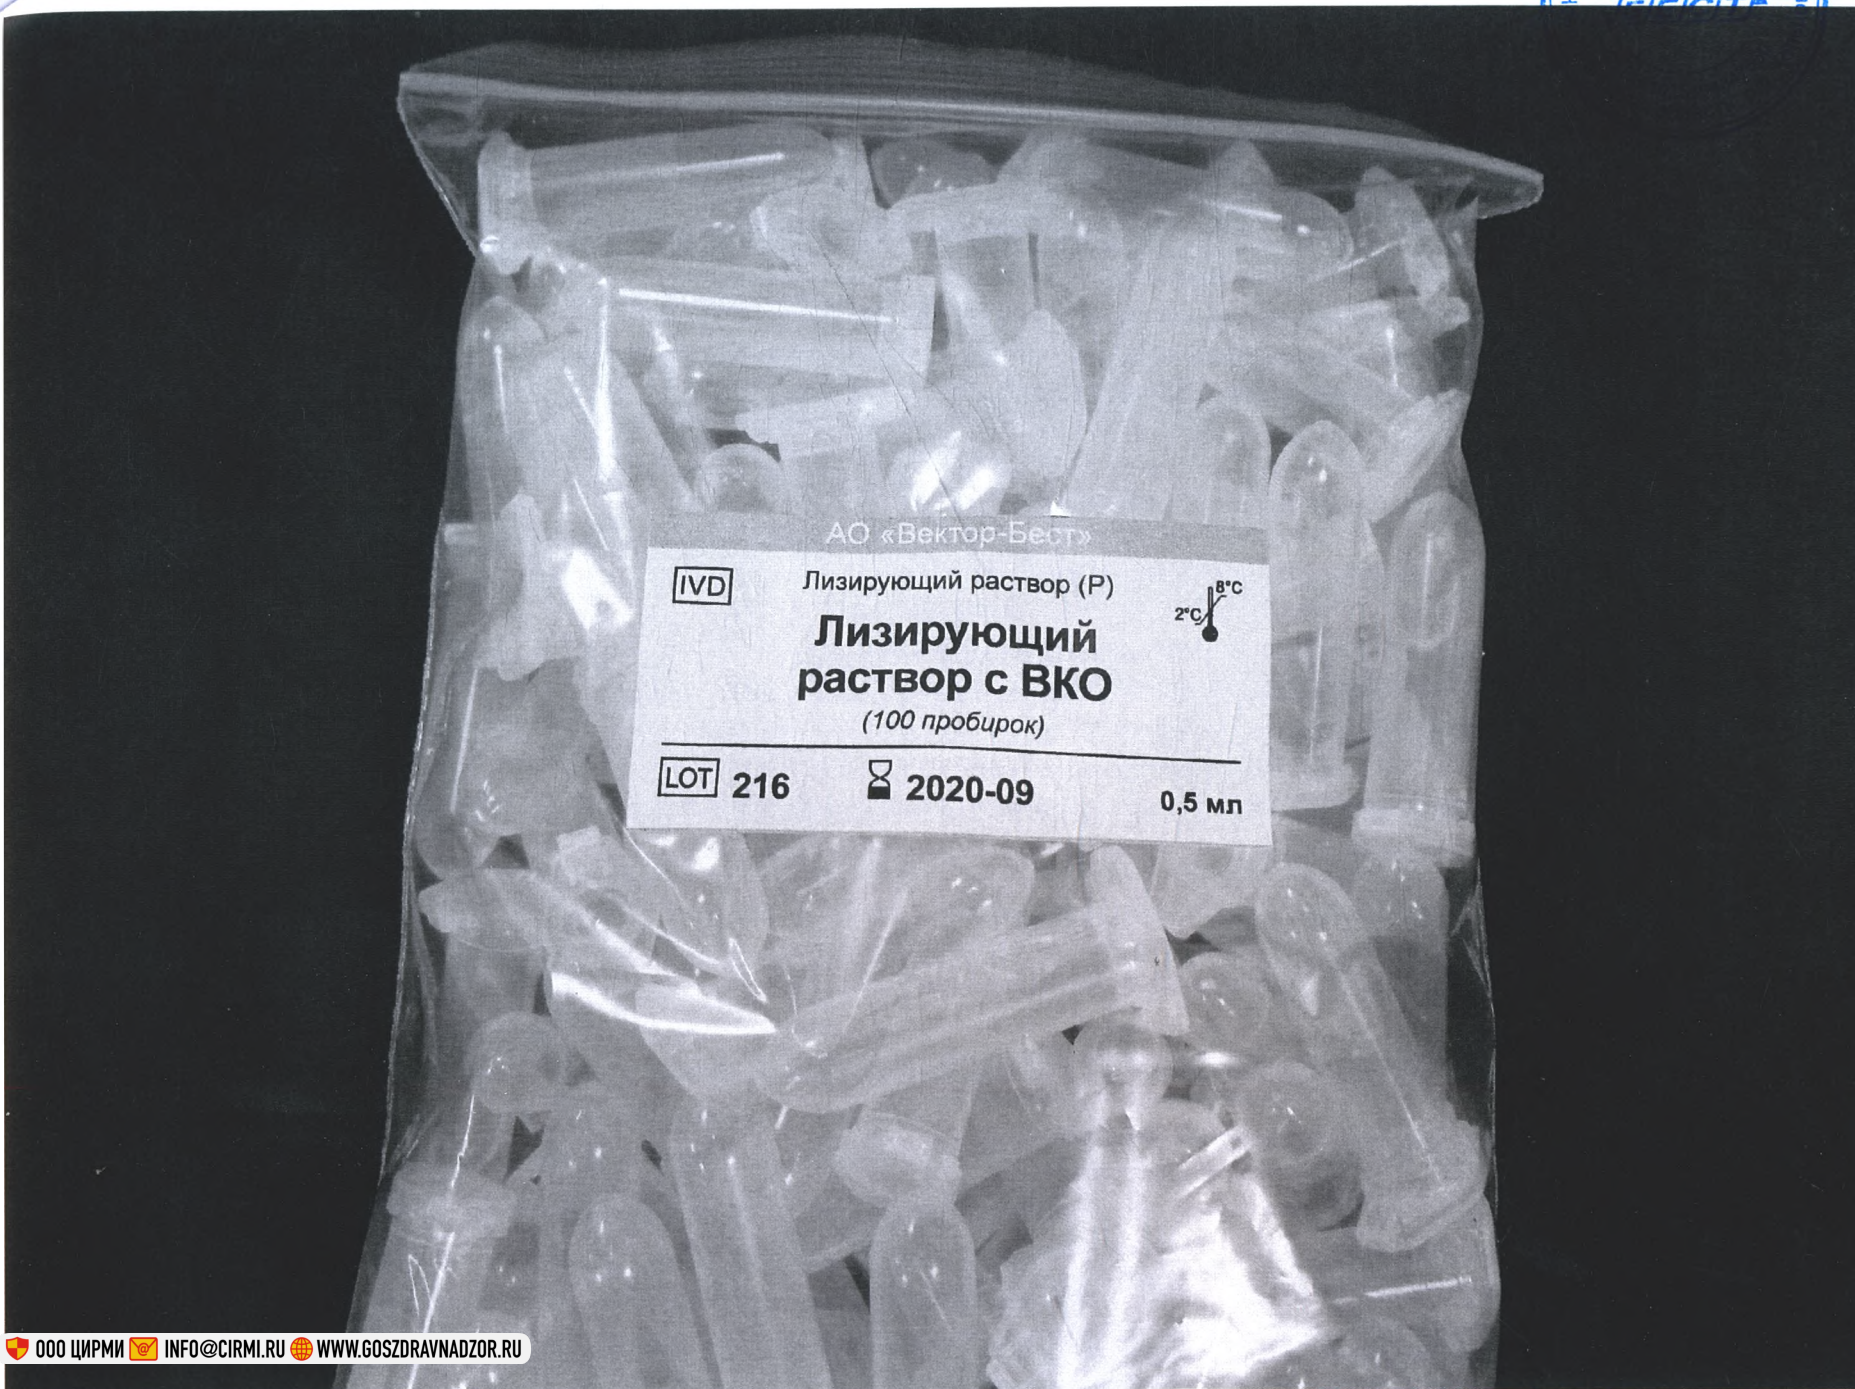

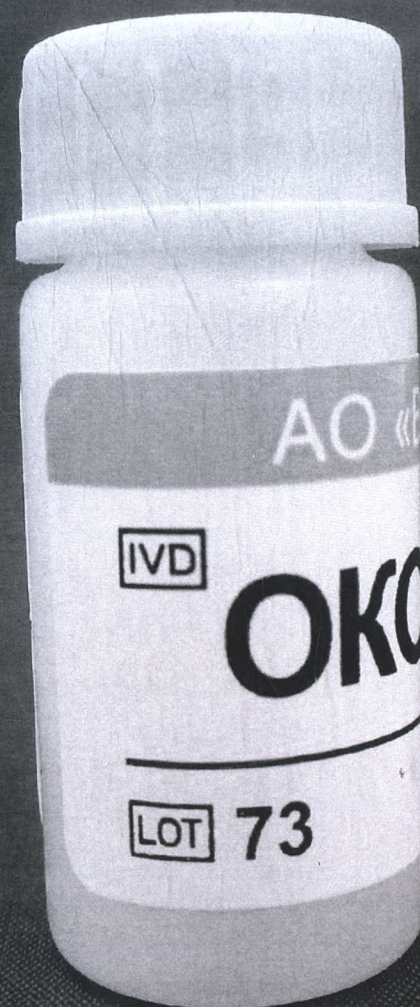

11
13

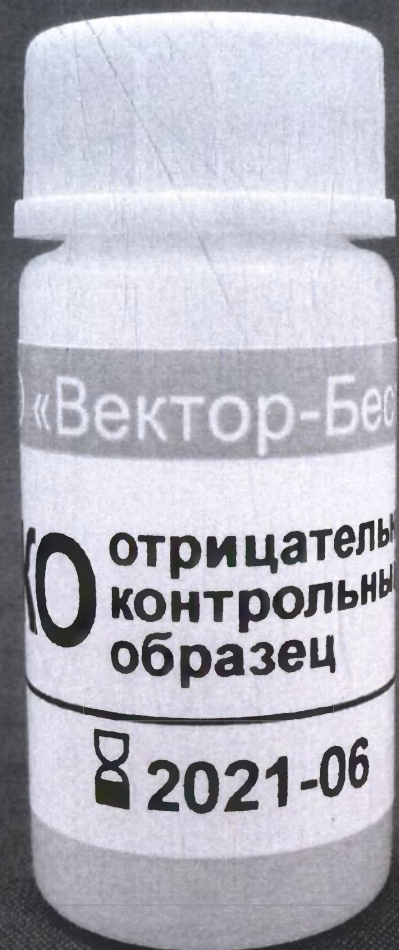

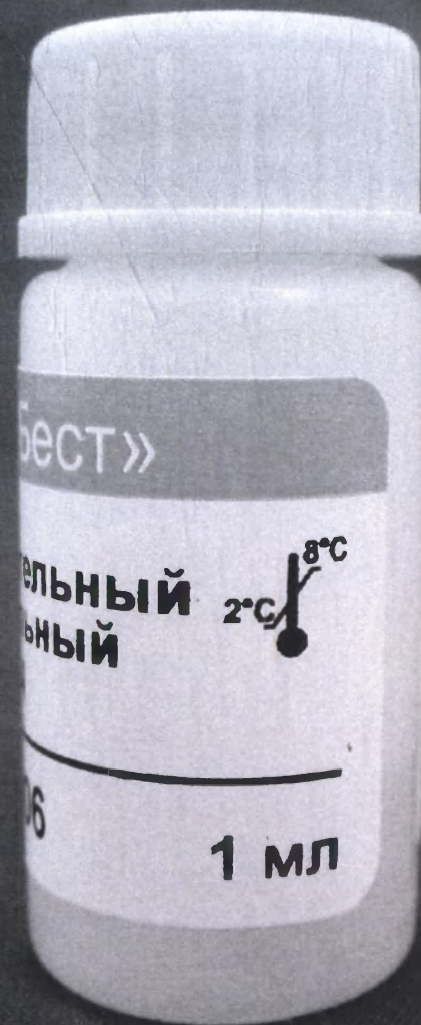

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 73 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

73 _____ Масяго А.В.
201 9 г.

