

Фотографические изображения

Расходные материалы для подготовки образцов для
цитологических исследований на аппаратах ThinPrep 2000 Processor
и ThinPrep 5000 Processor, в наборах и отдельных упаковках

Расходные материалы для подготовки образцов для цитологических исследований на аппаратах ThinPrep 2000 Processor и ThinPrep 5000 Processor в наборах:

1. Врачебный Набор Pap-test ThinPrep:

- флаконы PreservCyt для гинекологических исследований - не более 500 шт.;
- устройства цитобраш/пластиковый шпатель - не более 500 шт.;
- приспособления для сбора материала в виде метелки - не более 500 шт.

приспособления для сбора
материала в виде метелки

устройства цитобраш/
пластиковый шпатель

флаконы PreservCyt для
гинекологических исследований

2. Набор Pap-test ThinPrep:

- фильтры ThinPrep PAP Test Filter - не более 500 шт.;
- флаконы PreservCyt - не более 500 шт.;
- предметные стекла ThinPrep - не более 500 шт.;
- приспособления цитобраш/пластиковый шпатель - не более 500 шт.;
- приспособления для сбора материала в виде метелки - не более 500 шт.

фильтры ThinPrep
PAP Test Filter

приспособления для сбора материала в виде метелки

устройства цитобраш/
пластиковый шпатель

предметные стекла ThinPrep

флаконы PreservCyt для
гинекологических исследований

3. Набор Pap-test ThinPrep для использования с системой анализа изображения ThinPrep:

- фильтры ThinPrep PAP Test Filter - не более 500 шт.;
- флаконы PreservCyt ThinPrep - не более 500 шт.;
- предметные стекла ThinPrep - не более 500 шт.;
- устройства цитобраш/пластиковый шпатель - не более 500 шт.;
- приспособления для сбора материала в виде метелки - не более 500 шт.

фильтры ThinPrep
PAP Test Filter

приспособления для сбора материала в виде метелки

устройства цитобраш/
пластиковый шпатель

флаконы PreservCyt для
гинекологических исследований

предметные стекла ThinPrep

4. Лабораторный набор Pap-test ThinPrep:

- фильтры ThinPrep PAP Test Filter - не более 500 шт.;
- предметные стекла - не более 500 шт.

фильтры ThinPrep
PAP Test Filter



предметные стекла

5. Лабораторный набор Pap-test ThinPrep для использования с Системой анализа изображения ThinPrep:

- фильтры ThinPrep PAP Test Filter - не более 500 шт.;
- предметные стекла - не более 500 шт.

фильтры ThinPrep PAP Test Filter

предметные стекла



6. Набор ThinPrep UroCyt:

- фильтры UroCyt ThinPrep (желтый) - не более 100 шт.;
- предметные стекла UroCyt - не более 100 шт.;
- раствор PreservCyt - не более 50 упаковок по 2 флакона.



7. Набор для сбора мочи UroCyt ThinPrep не более 12 наборов:

- баночка для сбора мочи;
- флакон PreservCyt;
- абсорбирующая прокладка;
- фильтр.

абсорбирующая прокладка

баночка для сбора мочи

флакон PreservCyt

фильтр


8. Набор для сбора мочи UroCyte ThinPrep, не более 20 наборов в коробке:

- фильтры - не более 100 шт.;
- предметные стекла - не более 100 шт.;
- флаконы UroCyte - не более 100 шт.;
- бутылки с раствором CytoLyt 32 унцевых - 1 коробка;
- карта программного обеспечения ThinPrep2000.


бутылки с раствором CytoLyt 32 унцевых



карта программного обеспечения
ThinPrep2000

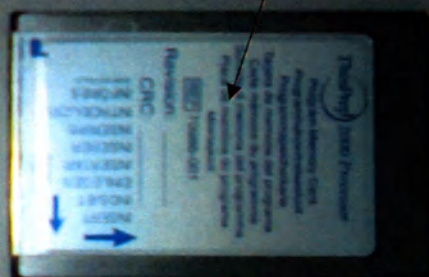


предметные стекла

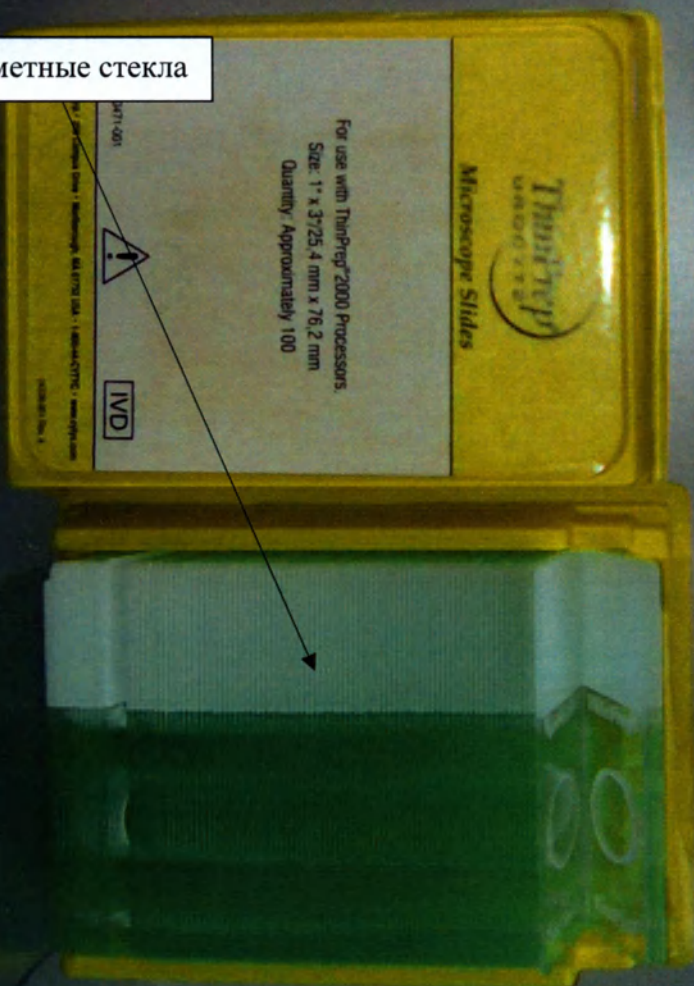

флаконы UroCyte



фильтры

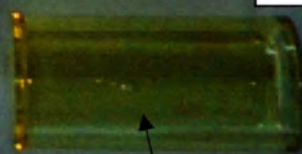

II. Расходные материалы для подготовки образцов для цитологических исследований на аппаратах ThinPrep 2000 Processor и ThinPrep 5000 Processor, в отдельных упаковках:

1. Приспособление для сбора материала в виде метелки- не более 500 шт.



2. Приспособление для сбора материала цитобраш/пластиковый шпатель - не более 500 шт.



3. Предметные стекла ThinPrep - не более 500 шт. в коробке.

THE
ThinPrep®
PAP TEST

Microscope Slides

FOR USE WITH ThinPrep® Processors
TIL BRUG MED ThinPrep®-processorer
VOOR GEBRUIK MET ThinPrep® Processors
À UTILISER AVEC Processeurs ThinPrep®
ZUR VERWENDUNG MIT ThinPrep® Prozessoren
DA USARE CON Processori ThinPrep®
PARA USO CON Procesadores ThinPrep®
PARA UTILIZAÇÃO COM Processadores ThinPrep®
FÖR ANVÄNDNING MED ThinPrep® processorer

Size: 1" x 3"/Størrelse: 25,4 mm x 76,2 mm/Afmeting: 25,4 mm x 76,2 mm/
Dimensions 25,4 mm x 76,2 mm/Größe 25,4 mm x 76,2 mm/Dimensioni 25,4 mm x 76,2 mm/
Tamaño 25,4 mm x 76,2 mm/Tamanho 25,4 mm x 76,2 mm/Storlek 25,4 mm x 76,2 mm

Quantity: Approximately 100/Antal: Cirka 100/Hoeveelheid: ongeveer 100/Quantité : 100 environ/
Menge: Ungefähr 100/Quantità: circa 100/Cantidad: Aproximadamente 100/
Quantidade: aproximadamente 100/Kvantitet: Ungefär 100

REF 70373-001



Made in USA




Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
1-800-442-9892 • +1 (508) 263-2900 • www.hologic.com

Hologic UK Ltd • Link 10 Napier Way • Crawley, West Sussex • RH10 9RA • UK
+44 (0) 1293 522 080

LBL-00801-4401 Rev. 001

4. Негинекологические фильтры (синие) - коробка не более 100 шт.

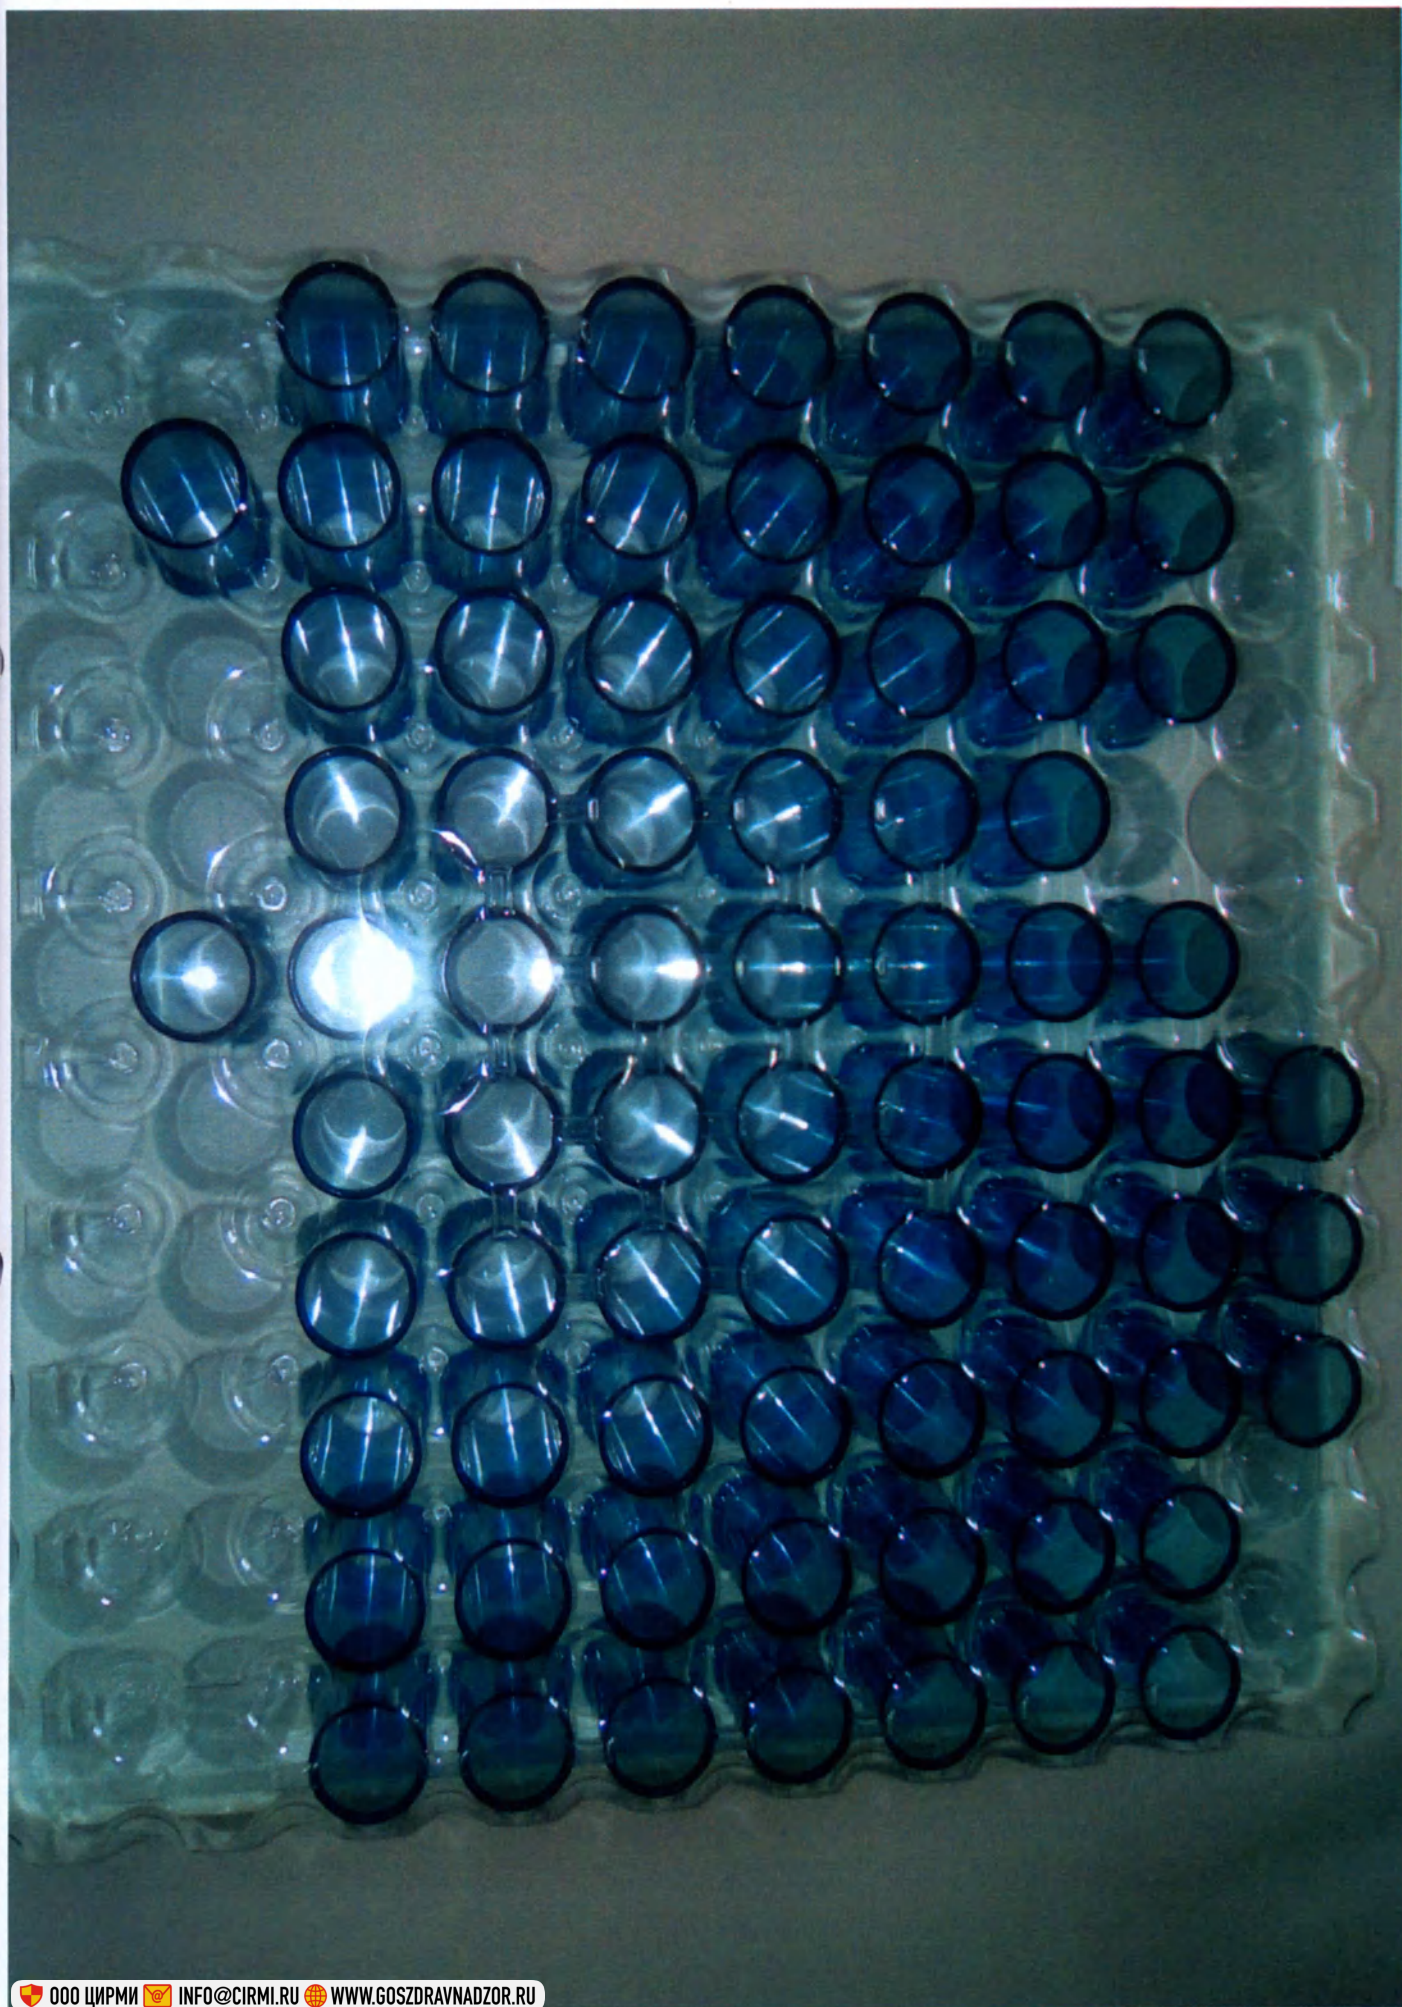

5. Предметные стекла ThinPrep - коробка не более 100 шт.

THE
ThinPrep[®]
PAP TEST

Microscope Slides

FOR USE WITH ThinPrep[®] Processors
TIL BRUG MED ThinPrep[®]-processorer
VOOR GEBRUIK MET ThinPrep[®] Processors
À UTILISER AVEC Processeurs ThinPrep[®]
ZUR VERWENDUNG MIT ThinPrep[®] Prozessoren
DA USARE CON Processori ThinPrep[®]
PARA USO CON Procesadores ThinPrep[®]
PARA UTILIZAÇÃO COM Processadores ThinPrep[®]
FÖR ANVÄNDNING MED ThinPrep[®] processorer

Size: 1" x 3"/Størrelse: 25,4 mm x 76,2 mm/Almeting: 25,4 mm x 76,2 mm/
Dimensions 25,4 mm x 76,2 mm/Größe 25,4 mm x 76,2 mm/Dimensioni 25,4 mm x 76,2 mm/
Tamaño 25,4 mm x 76,2 mm/Tamanho 25,4 mm x 76,2 mm/Storlek 25,4 mm x 76,2 mm

Quantity: Approximately 100/Antal: Cirka 100/Hoeveelheid: ongeveer 100/Quantité : 100 environ/
Menge: Ungefähr 100/Quantität: circa 100/Cantidad: Aproximadamente 100/
Quantidade: aproximadamente 100/Kvantitet: Ungefär 100

REF 70373-001



Made in USA



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
1-800-442-9892 • +1 (508) 263-2900 • www.hologic.com



Hologic UK Ltd • Link 10 Napier Way • Crawley, West Sussex • RH10 9RA • UK
+44 (0) 1293 522 080

LBL-00891-4401 Rev. 001

6. Предметные стекла ThinPrep для иммуноцитохимии Immuno - коробка не более 72 шт.

ThinPrep
IMAGING SYSTEM

Microscope Slides

FOR USE WITH ThinPrep[®] Processors
TIL BRUG MED ThinPrep[®]-processorer
VOOR GEBRUIK MET ThinPrep[®] Processors
À UTILISER AVEC Processeurs ThinPrep[®]
ZUR VERWENDUNG MIT ThinPrep[®] Prozessoren
DA USARE CON Processori ThinPrep[®]
PARA USO CON Procesadores ThinPrep[®]
PARA UTILIZAÇÃO COM Processadores ThinPrep[®]
FÖR ANVÄNDNING MED ThinPrep[®] processorer

Size: 1" x 3"/Størrelse: 25,4 mm x 76,2 mm/Afmeting: 25,4 mm x 76,2 mm/
Dimensions 25,4 mm x 76,2 mm/Größe 25,4 mm x 76,2 mm/Dimensioni 25,4 mm x 76,2 mm/
Tamaño 25,4 mm x 76,2 mm/Tamanho 25,4 mm x 76,2 mm/Storlek 25,4 mm x 76,2 mm

Quantity: Approximately 100/Antal: Cirka 100/Hoeveelheid: ongeveer 500/Quantité : 100 environ/
Menge: Ungefähr 100/Quantità: circa 100/Cantidad: Aproximadamente 100/
Quantidade: aproximadamente 100/Kvantitet: Ungefär 100

REF 70824-001



Made in USA



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA
1-800-442-9892 • +1 (508) 263-2900 • www.hologic.com



Hologic UK Ltd • Link 10 Napier Way • Crawley, West Sussex • RH10 9RA • UK
+44 (0) 1293 522 080

LBL-00893-4401 Rev. 001

7. Раствор PreservCyt (50 флаконов объемом 50 мл, заполненных на 20 мл) - коробка не более 50 шт.



8. Раствор PreservCyt (946 мл в бутылке объемом 32 унции) - не более 4 бутылки в коробке.



9. Раствор CytoLyt (946 мл в бутылке объемом 32 унции) - не более 4 бутылки в коробке.



10. Раствор CytoLyt (30 мл в 50 мл центрифужной пробирке) - не более 80 пробирок в коробке.



11. Раствор CytoLyt (30 мл в 120 мл банке) - не более 50 банок в коробке.



12. Фильтры ThinPrep UroCyte (желтый) - не более 100 шт. в лотке.



13. Предметные стекла UroCyte ThinPrep - не более 100 шт. в коробке



14. Баночки с раствором PreservCyt ThinPrep UroCyt - не более 50 шт.



15. Флаконы 20 мл с раствором PreservCyt - в коробке не более 50 шт.



Прошнуровано, пронумеровано
/ 24 / двадцать четыре
лист а

Генеральный директор
ООО "Райфарм"
Дмитриев Д. В.

