


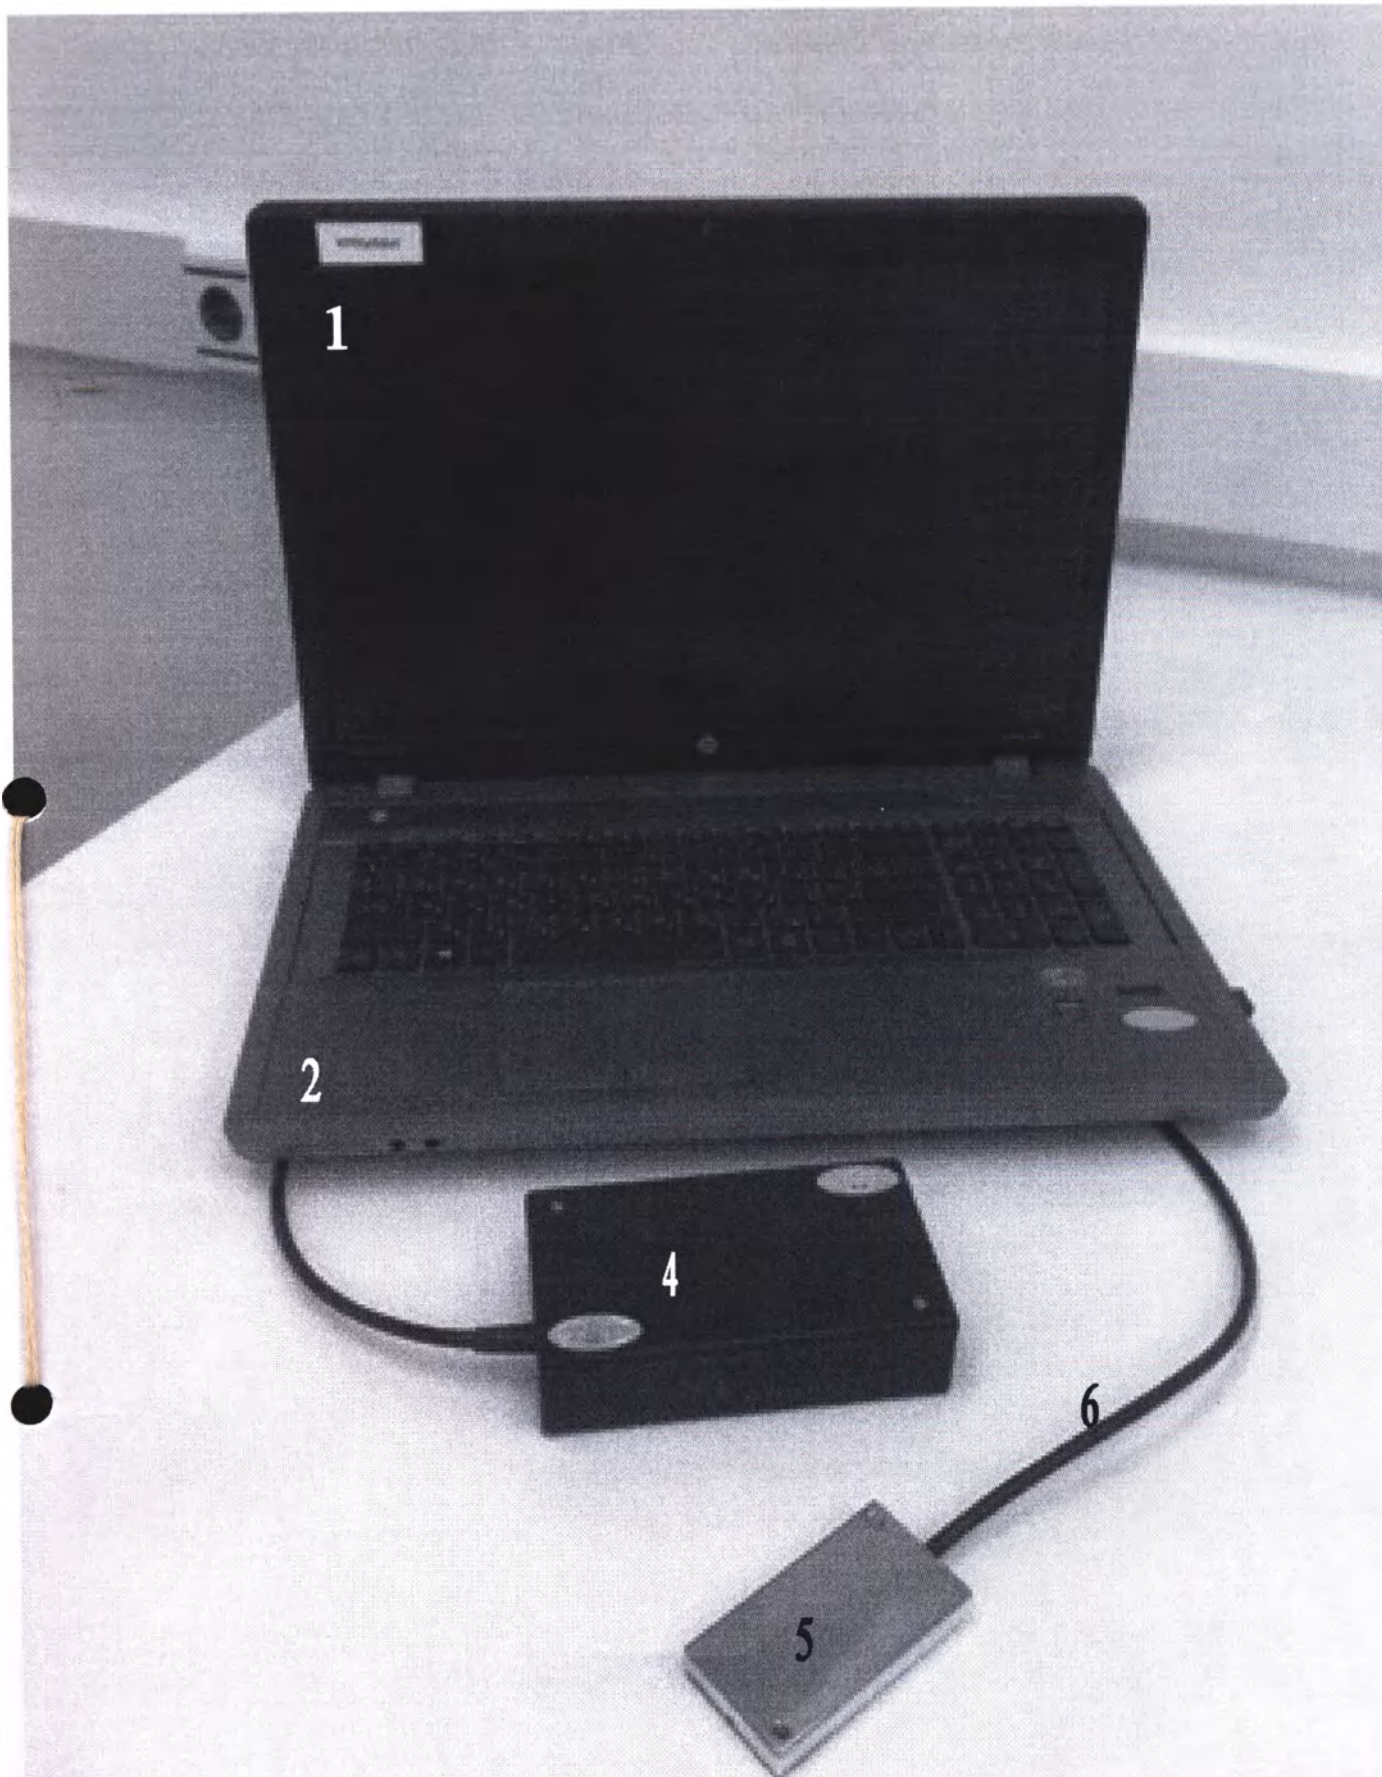

«Комплекс медицинский спектрально-динамический по ТУ ВУ 190980726.001-2009» в составе:

1. Комплекс программ для комплекса медицинского спектрально-динамического (программный продукт «Doctors Assistant» и программный продукт «Diagnosis») – установлены на HDD компьютер типа «notebook»;
2. Компьютер типа «notebook» (изготовитель: Hewlett Packard, Toshiba, Samsung, Acer, Dell, IBM);
3. Блок питания для компьютера типа «notebook» (изготовитель: Hewlett Packard, Toshiba, Samsung, Acer, Dell, IBM) – на фотографии не показан;
4. Блок первичного преобразователя информации комплекса медицинского спектрально-динамического;
5. Электрод для снятия диагностической информации;
6. Кабель блока первичного преобразователя информации;
7. Манипулятор «мышь» оптическая – в комплект обязательной комплектации не входит;
8. Сумка для комплекса медицинского спектрально-динамического - на фотографии не показана.

Комплекс медицинский
спектрально-динамический

(КМД)

КМД.001.000.00

ТУ ВУ 190980726.001-2009

Предприятие-изготовитель:

ООО «Спектрально-динамические системы»,

г. Минск, Республика Беларусь

Заводской номер

0000003 2011

год изготовления

~230В (50±0,1 Гц), 200В•А, IP 20



«Комплекс медицинский спектрально-динамический по ТУ ВУ 190980726.001-2009»,
заводской номер 0000003, год изготовления 2011 (шильдик)



Генеральный директор
ООО «Спектрально-динамические системы»

_____ А.О. Лукьянов

Прочито, пронумеровано,
скреплено печатью

2

_____ листов