




ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Реагент-1-ЗИКА, 140 (мкл)
Серия: 02-04-2016
Дата изготовления: 06.04.2016 г.
Годен до: 05.04.2017 г.
Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С
Только для диагностики

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Вектор-ПЦР-Зика
ОКО-ЗИКА, 100 (мкл)
Серия: 02-04-2016
Дата изготовления: 06.04.2016 г.
Годен до: 05.04.2017 г.
Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С
Только для диагностики

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Реагент-2-ЗИКА, 10 (мкл)
Серия: 02-04-2016
Дата изготовления: 06.04.2016 г.
Годен до: 05.04.2017 г.
Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С
Только для диагностики

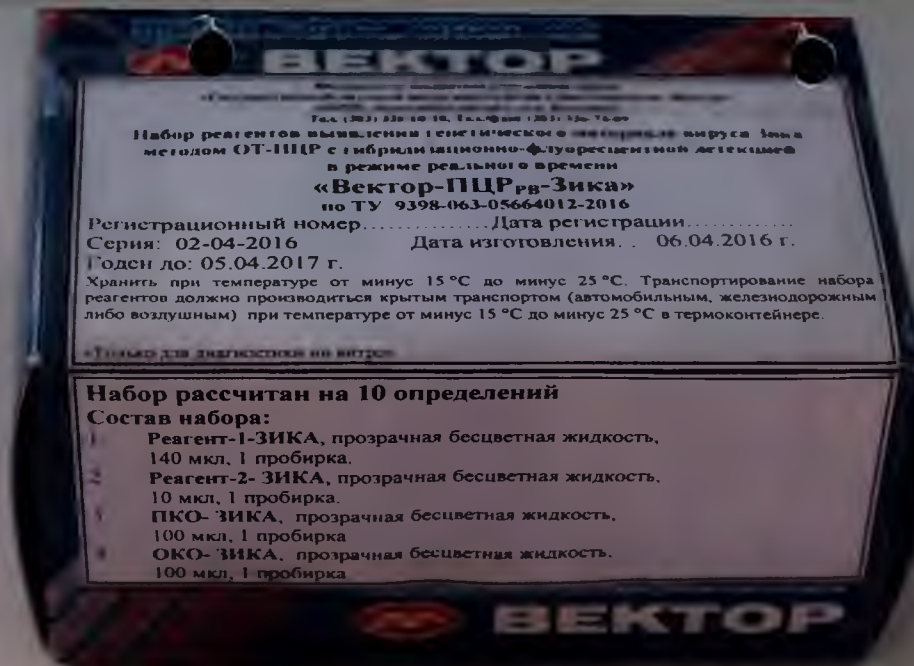

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
ПКО-ЗИКА, 100 (мкл)
Серия: 02-04-2016
Дата изготовления: 06.04.2016 г.
Годен до: 05.04.2017 г.
Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С
Только для диагностики