

Генеральный директор
ЗАО «Вектор-Бест»

Хусанов М.Д.
«24» сентября 2015 г.



Мультикалибратор на основе
человеческой сыворотки
для субстратов и электролитов

**Мультикалибратор-СЭ
(вариант 1)**

Состав: Мультикалибратор (1 x4 мл)
Алюминия х Вит. С₂ и витамин С₁
Термостабильный растворитель

ТУ 9398-528-23548172-2015
РД №

Приложение к паспорту № 3

Мультикалибратор - СЭ
Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки
для субстратов и электролитов

Серия 020915

Анализ / показатель, ед. изм.	Метод
Билирубин, г/л	С бромкрезоловым зеленым
Албумин, г/л	Биуретовый
Уробилиноген, г/л	С диазотиро сульфанил кислотой
Общий, г/л	Реакция дихлор- зид

«Литные материалы»
г. Кольцово, ул. 121, ЗАО «Вектор-Бест»

1.1. Мультикалибратор на основе
человеческой сыворотки для субстратов и электролитов

ПАСПОРТ № 3
Мультикалибратор-СЭ (вариант 1)
Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки
для субстратов и электролитов

ТУ 9398-528-23548172-2015

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.
Транспортировать при температуре от 2 до 8 °С.
Допускается транспортирование при температуре
до 25 °С на более 10 дней.

ИНСТРУКЦИЯ
для субстратов и электролитов
Мультикалибратор-СЭ
профильный

Тел./Факс (383) 363-13-46
E-mail: vobik@vector-best.ru

Номер серии **020915**
Дата изготовления **Сентябрь 2015**
Дата выдачи паспорта **21.09.2015**
Срок годности наборов до **Март 2017**

Информация
17 января
7-113 «М»
Минздрав
Следствие

Генеральный директор
ЗАО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«20» августа 2015 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению мультикалибратора на основе человеческой сыворотки
для субстратов и электролитов
Мультикалибратор-СЭ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Мультикалибратор на основе чл-
субстратов

Тел./факс (383) 363-13-46
E-mail: vbobik@vector-best.ru

распространени
работе в кли
бно-профиланти
дравом СССР
иях МУ 287
ии

Приложение к паспорту № 1
Мультикалибратор-СЭ
Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки
для субстратов и электролитов

Серия 010815

Метод
С бромкрезоловым
индикатором

630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
п. Кольцово, д/я 121, ЗАО «Вектор-Бест»

ПАСПОРТ № 1
Мультикалибратор-СЭ (вариант 1)
Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки
для субстратов и электролитов

Генеральный директор
ЗАО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.
«29» августа 2015 г.



Приложение к паспорту № 2
Мультикалибратор на основе
для субстратов

ИНСТРУКЦИЯ
по применению мультикалибратора на основе человеческой сыворотки
для субстратов и электролитов
Мультикалибратор-СЭ

630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н,
п. Кольцово, д/п 121, ЗАО «Вектор-Бест»

Тел: (383) 227-67-64 Тел/факс (383) 363-13-46
227-75-50, 332-37-58 E-mail: ybolvik@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 2
Мультикалибратор-СЭ (вариант 2)
Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки
для субстратов и электролитов

Номер серии 010815

Дата изготовления Август 2015
Дата выдачи паспорта 20.08.2015
Срок годности наборов до Февраль 2017

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.
Транспортировать при температуре от 2 до 8 °С.
Допускается транспортирование при температуре
до 25 °С не более 10 суток.

Наименование показателя	Характеристика и нормы	Рез-ты контроля
Внешний вид	Лиофилизированная масса желтоват	Лиофилизированная масса

Мультикалибратор, серия 010815


инфекционных
ико-диагностических
еских учреждений»,
7 января 1991 г. и в
13 «Методические
изационной очистке
о назначения», ути.
Минздрава РФ от
следует надева
ые перчатки, т
ассматривать
ные длитель
сы гепатита
жкий.
знание, кот

Генеральный директор
ЗАО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

«21 сентября 2015 г.»

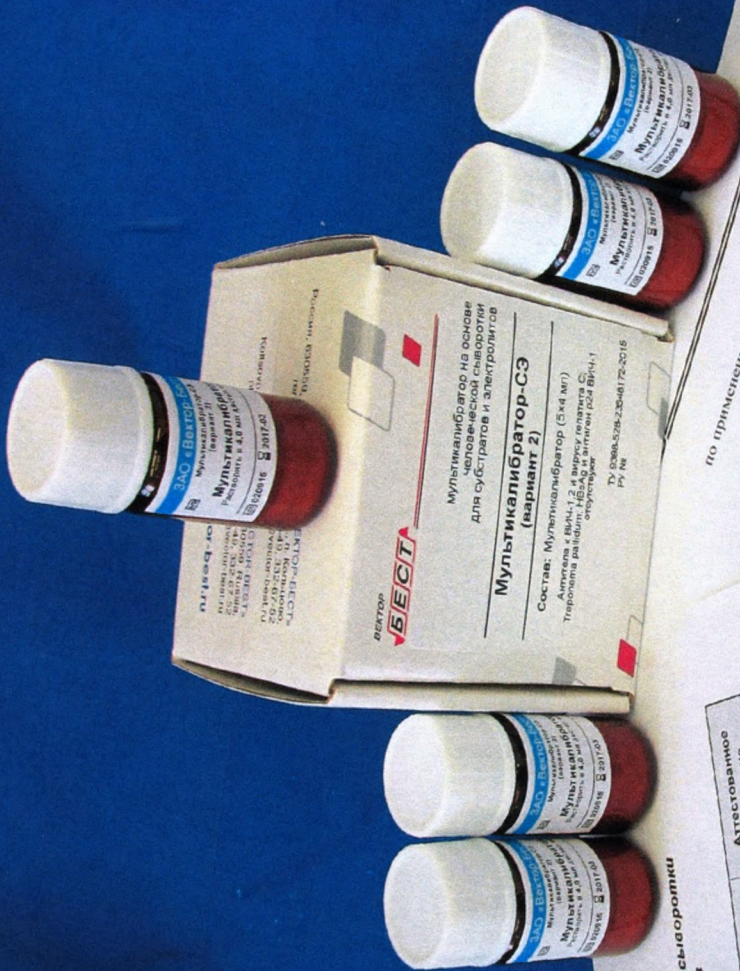

Приложение к паспорту № 4
Мультикалибратор - СЭ
Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки
для субстратов и электролитов

Серия 020915		Аттестованное значение	
Метод	Стандарт	Серии	А1.7
С бромкрезоловым зеленым	ERM-DA470KLE Materials and SRM 909c Tl	630559, Новосибирская обл. п. Кольцово, а/я 121, ЗАО «Вектор-Бест»	
Бипуретовый	Калибратор Rcd		
С диазотированной сульфаниловой	SRM 91E		
Реакция с солью 3,5-пилюрфенилдиазония	SRM		

ПАСПОРТ № 4
Мультикалибратор на основе человеческой сыворотки
для субстратов и электролитов
ТУ 9398-528-23548172-2015

Хранить при температуре от 2 до 8 °С.
Транспортировать при температуре от 2 до 8 °С.
Допускается транспортирование при температуре

Инструкция
для субстратов и электролитов
Мультикалибратор-СЭ

Номер серии 020915
Дата изготовления Сентябрь 2015
Дата выдачи паспорта 21.09.2015
Срок годности наборов до Март 2017

Инфекционно-паразитарные заболевания
Лактобактерии
СР 17 января 1991
Терминационная
исского назначения
ра Минздрава
юм следует
тиковые пер
ет рассма