

давлением)



Рис 1. Аппарат для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением



Рис 2. Адаптер питания

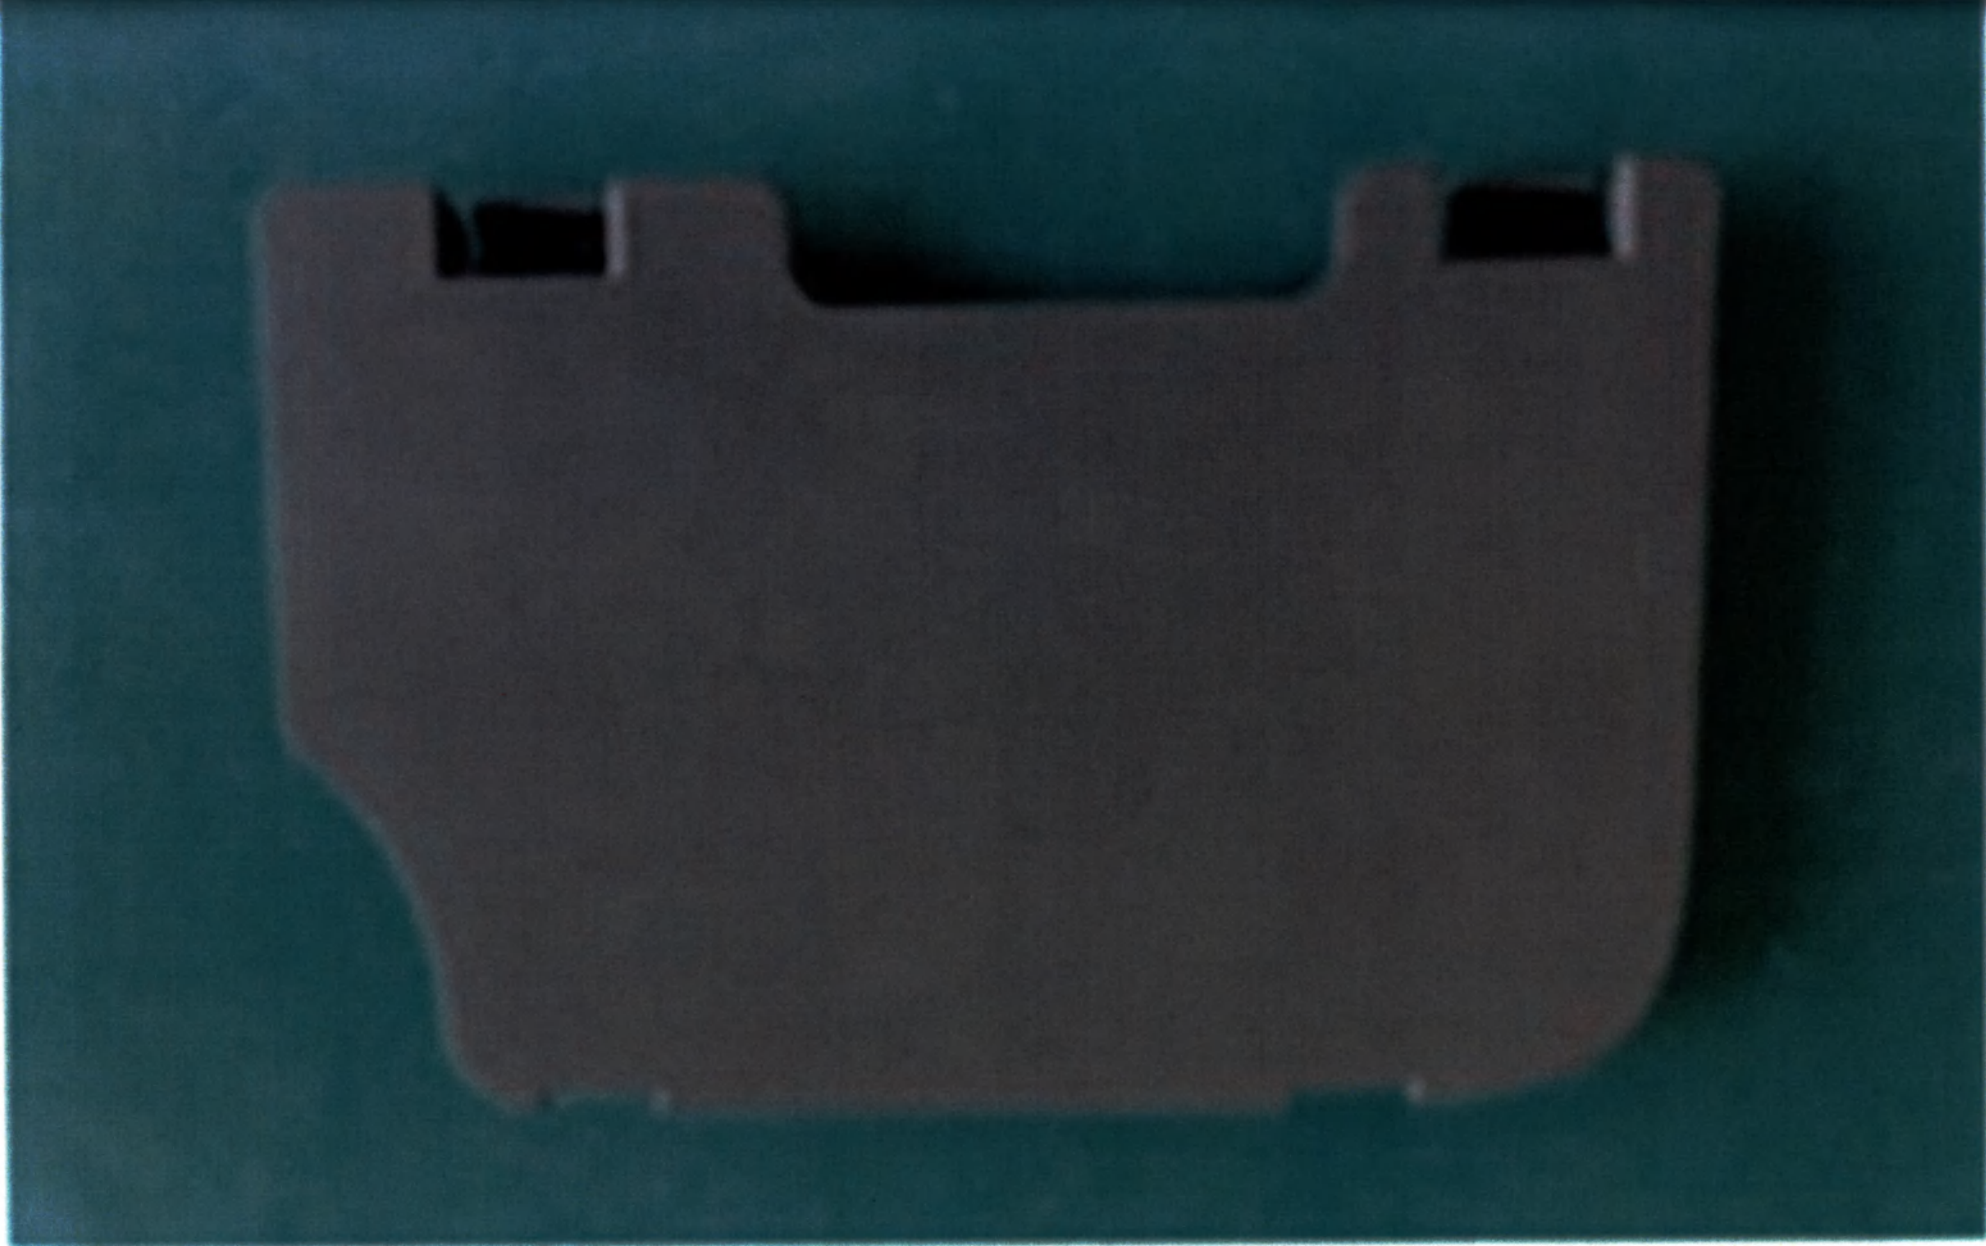


Рис 3. Крышка защитная

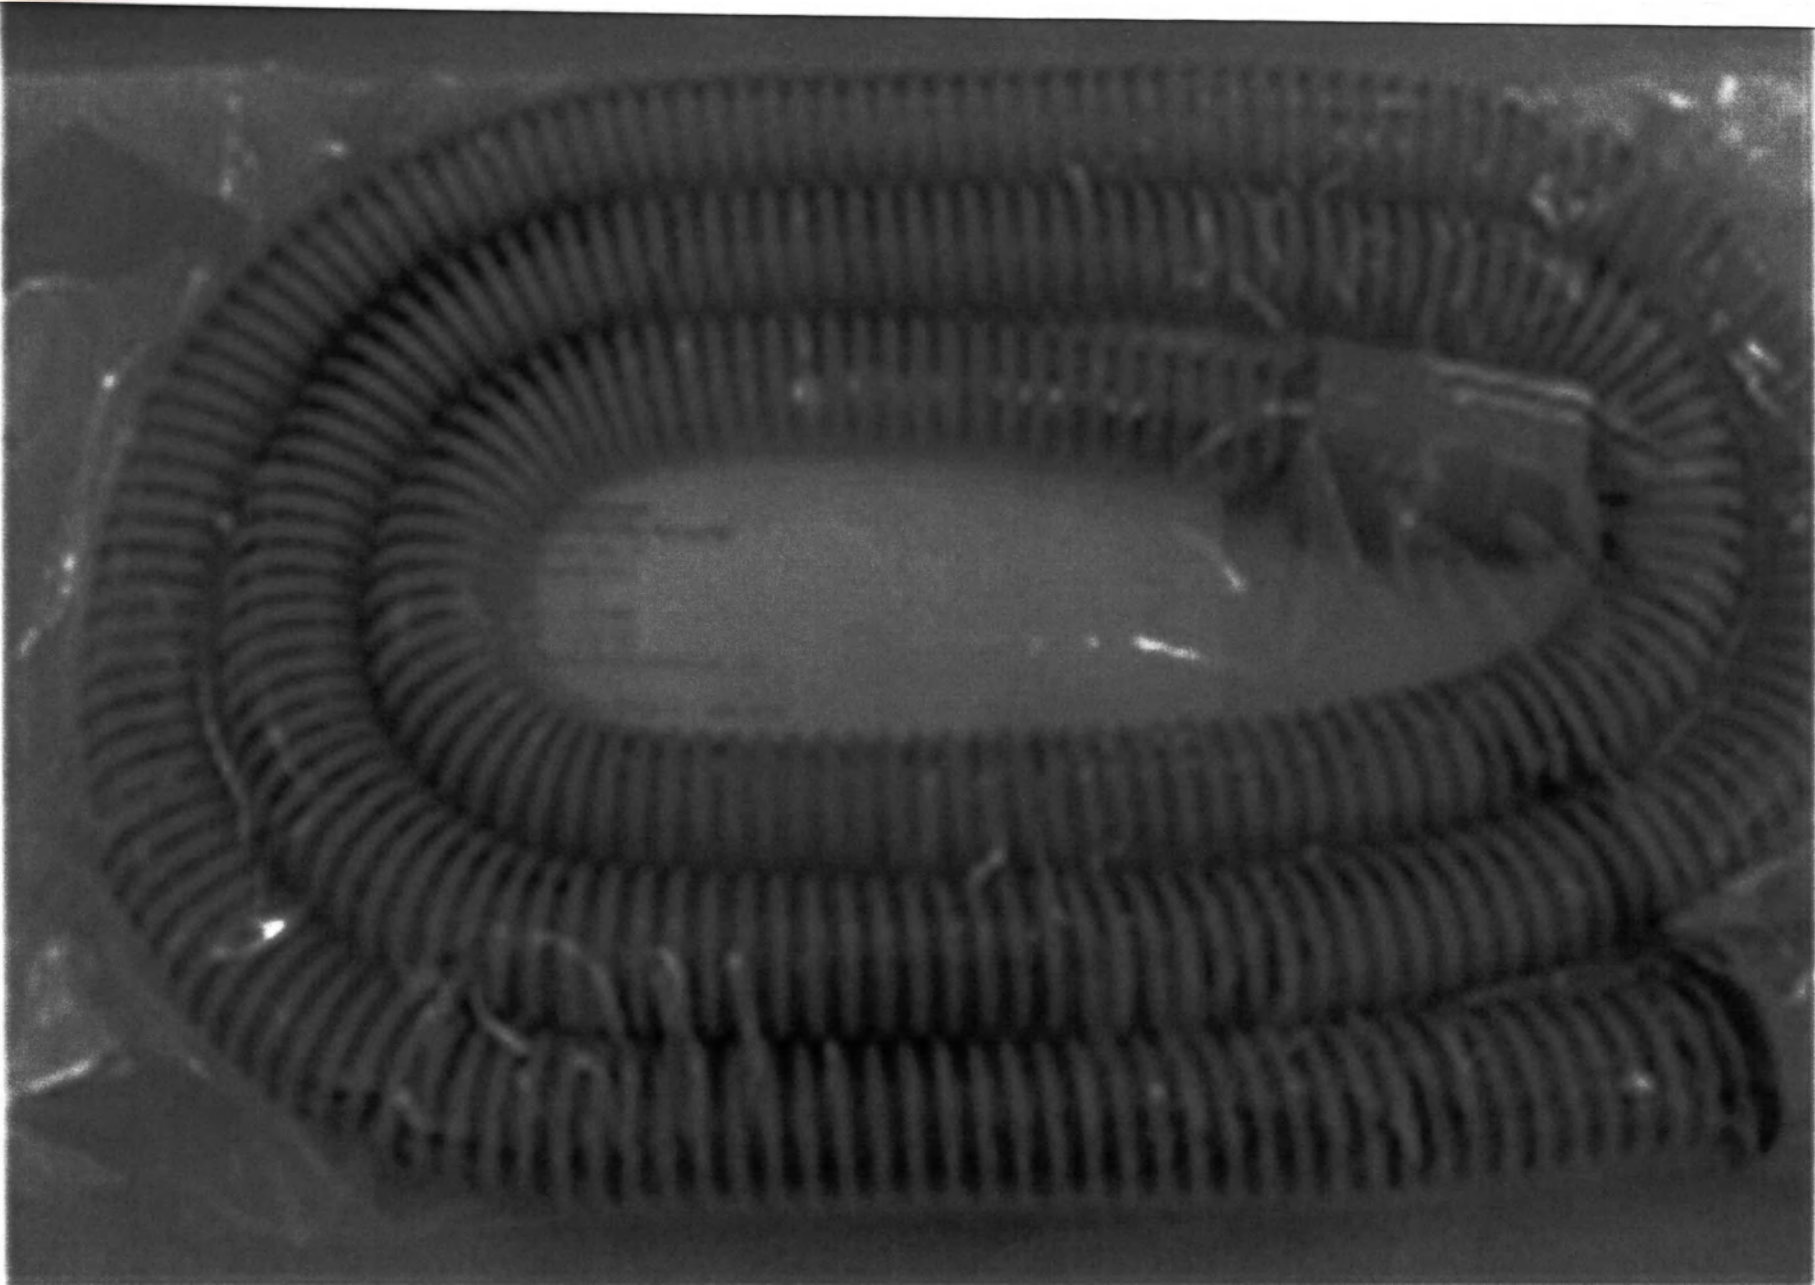


Рис 4. Трубка



Рис 5. Устройство основное

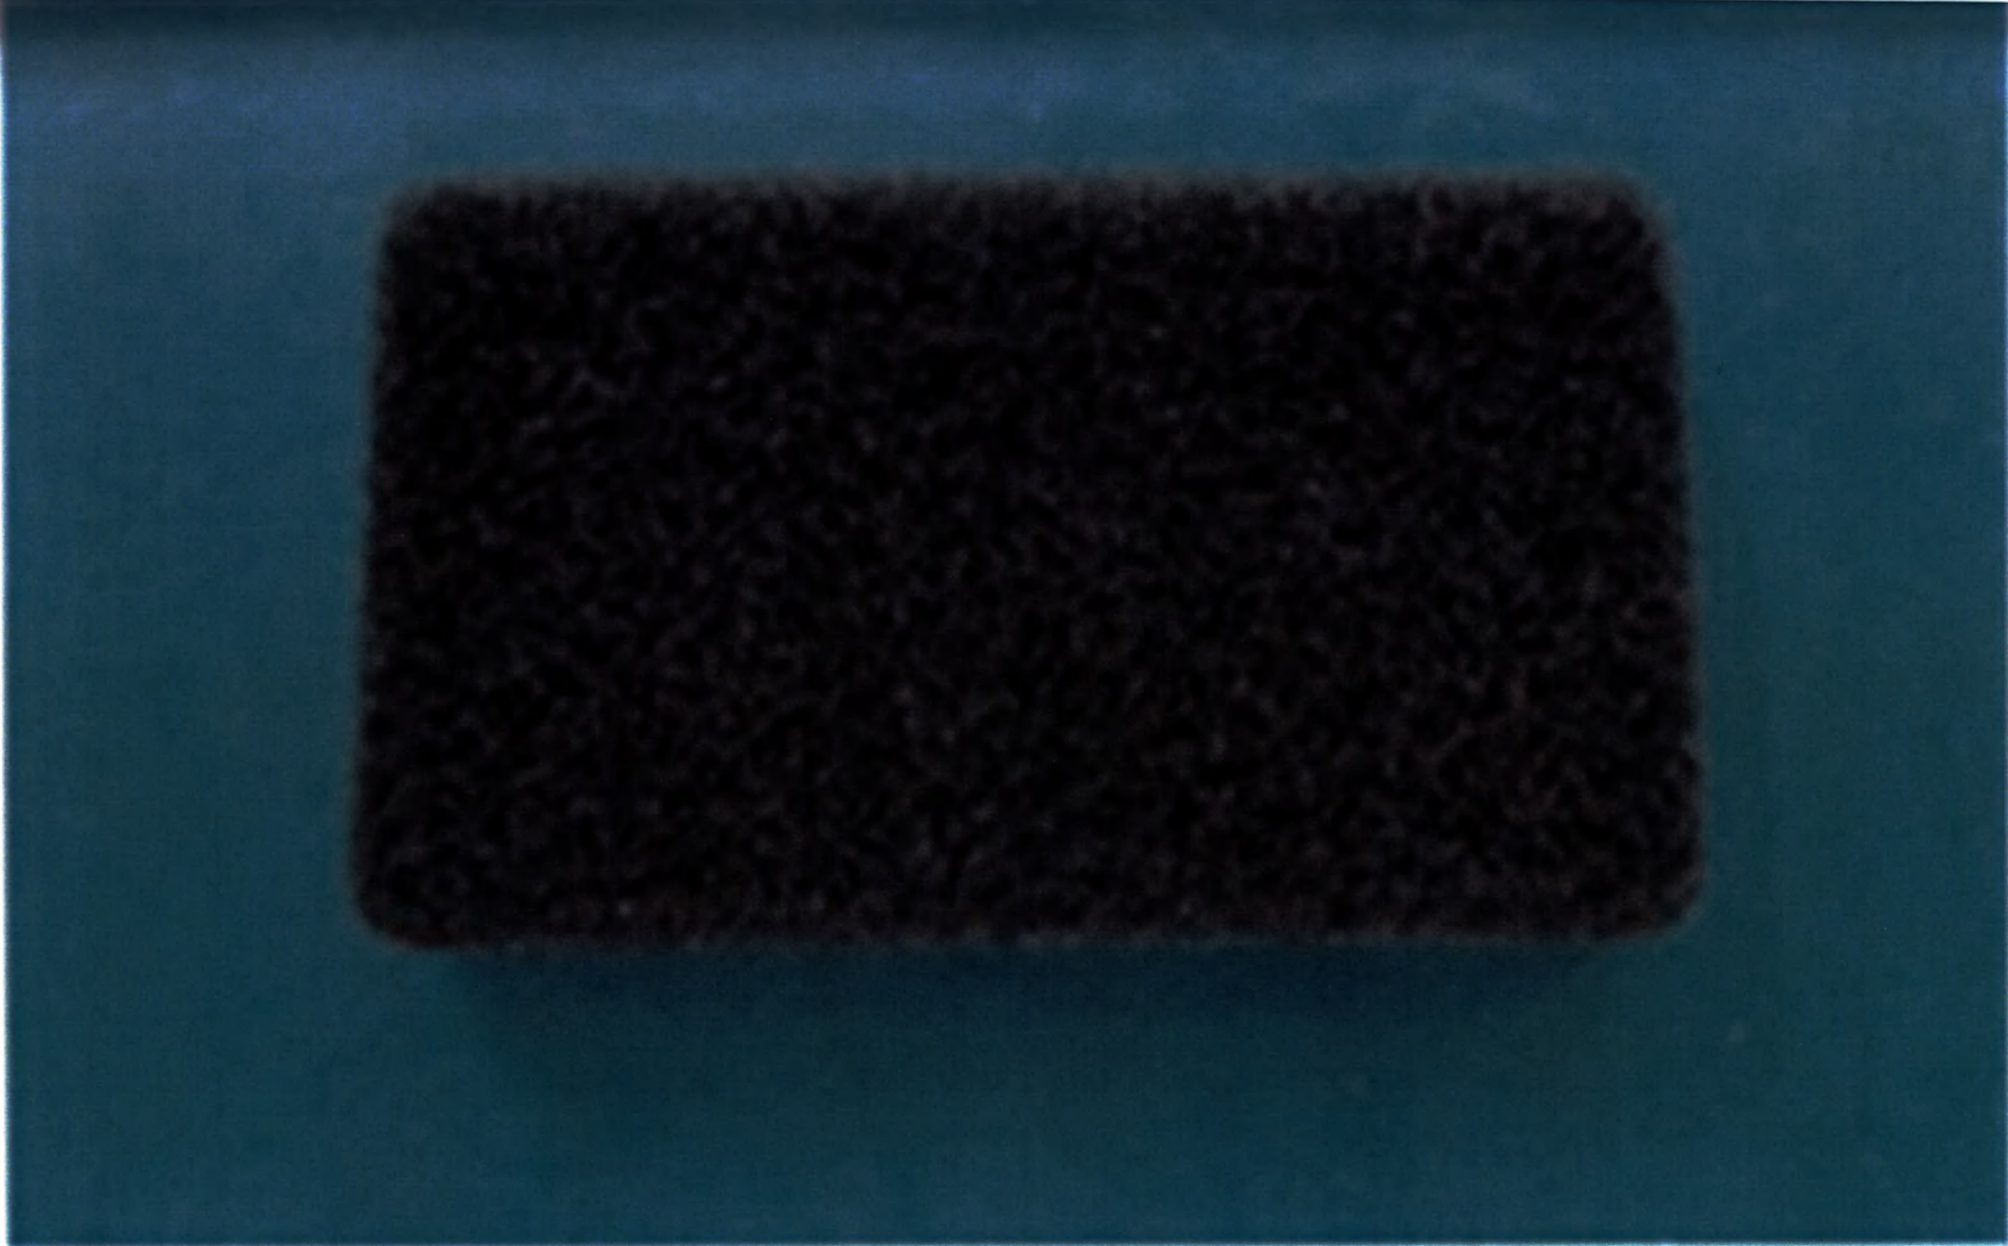


Рис 6. Фильтр воздушный

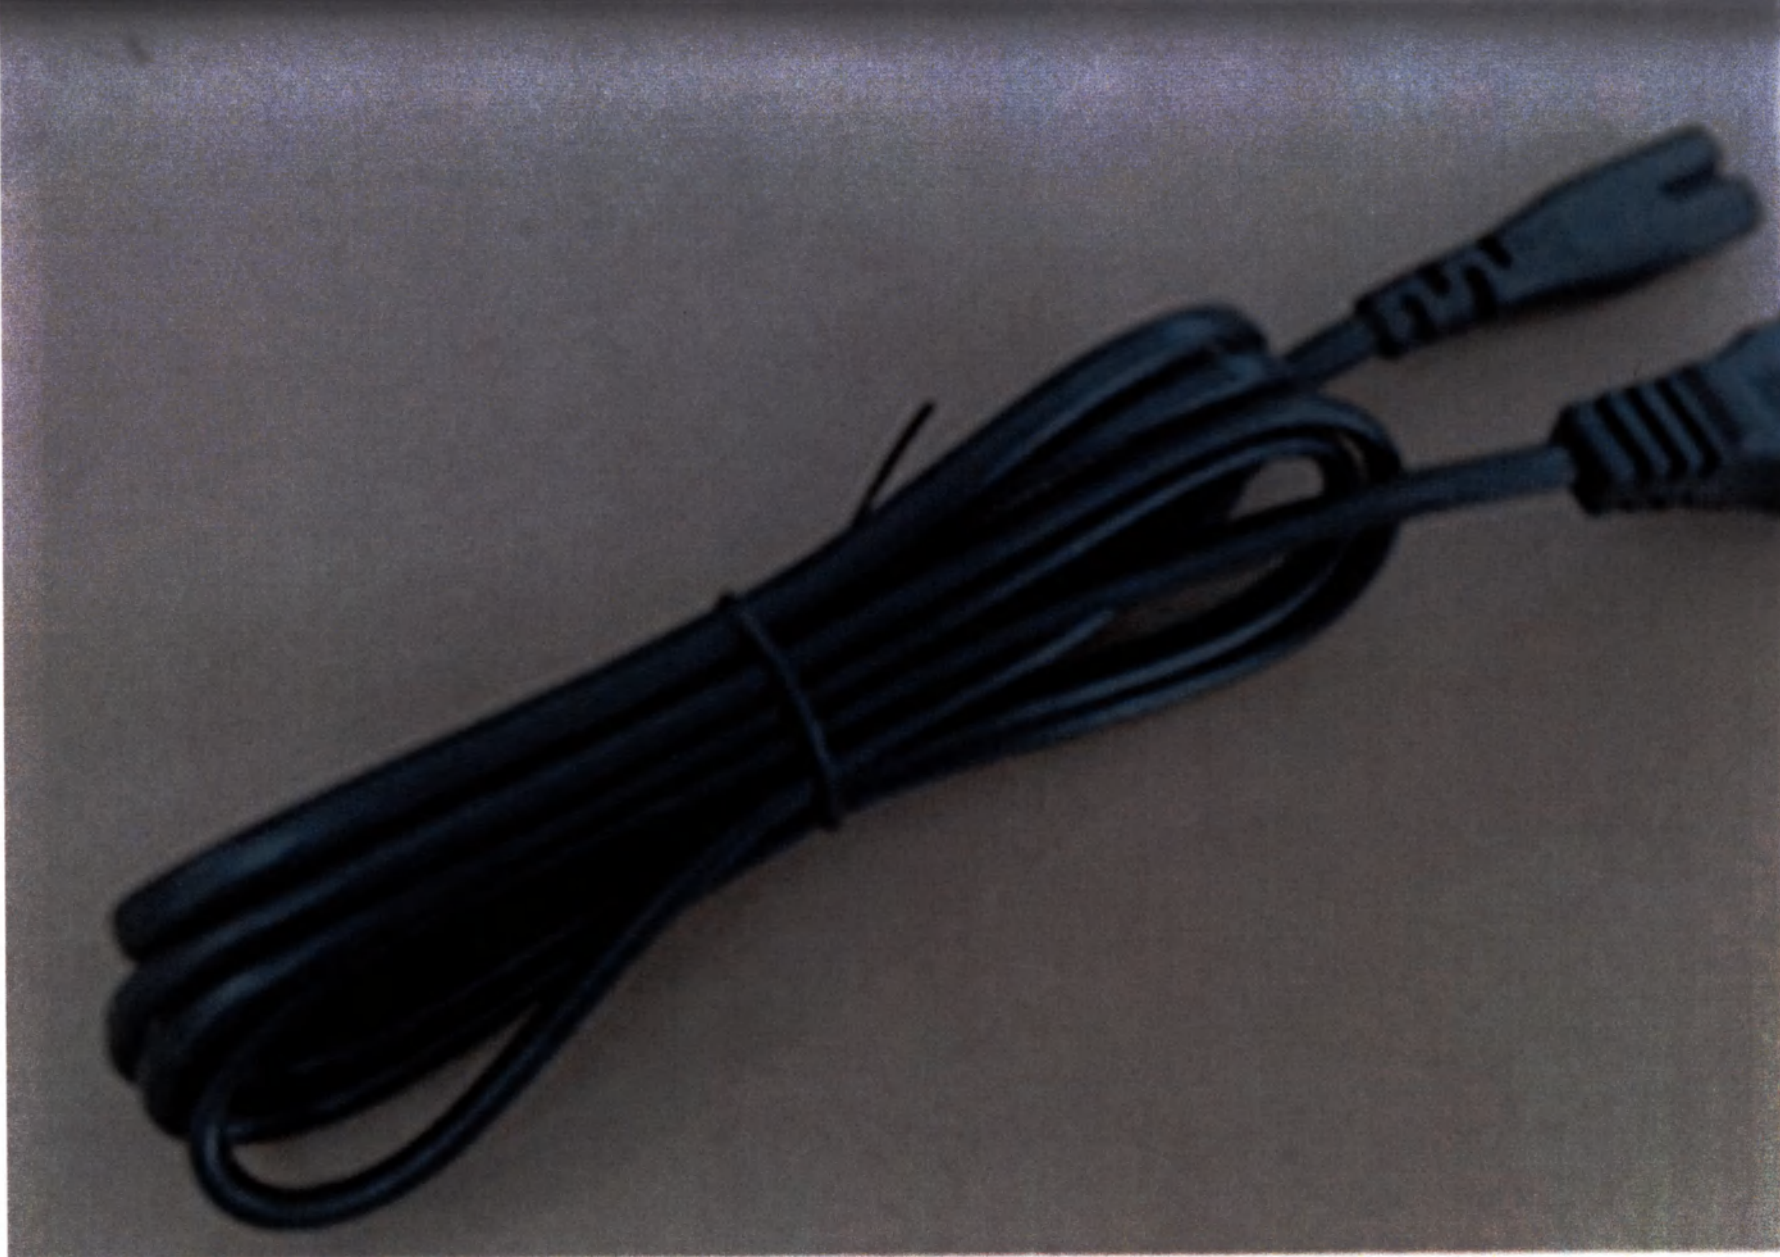


Рис 7. Шнур питания



Рис. 8. Карта SD



Рис 9. Комплект SpO2



Рис 10. Маска на все лицо: BMC-FM



Рис 11. Маска на все лицо: BMC-FM1A



Рис 12. Маска носовая: BMC-NM



Рис 13. Маска носовая: BMC-NM2



Рис 14. Маска типа «носовые канюли»: BMC-PM



Рис 15. Сумка для пе-реноски



Рис 16. Увлажнитель с подогревом

RESmart G II BPAP System



Model: T-30T

AC 100-240V, 50/60Hz, Max 2A

IP22


SN

T2C15A02700




BMC Medical Co., Ltd.

Room 110 Tower A Fengyu Building,
No. 115 Fucheng Road, Haidian,
100036 Beijing, P.R.China



**Shanghai International Holding
Corp. GmbH (Europe)**

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY



SpO2



Рис 17. Аппарат для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением. – Маркировка.

ПОДПИСЬЮ _____ ИСТОВ (-в)

Директор
ООО «Элмас»

