



PHILIPS

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

«Система магнитно-резонансной томографии Multiva 1.5T с принадлежностями»


УТВЕРЖДАЮ

Директор по нормативно-правовому
регулированию и качеству

ООО «ФИЛИПС»

О.В.Бахвалова

« 08 » сентября 2016 г.

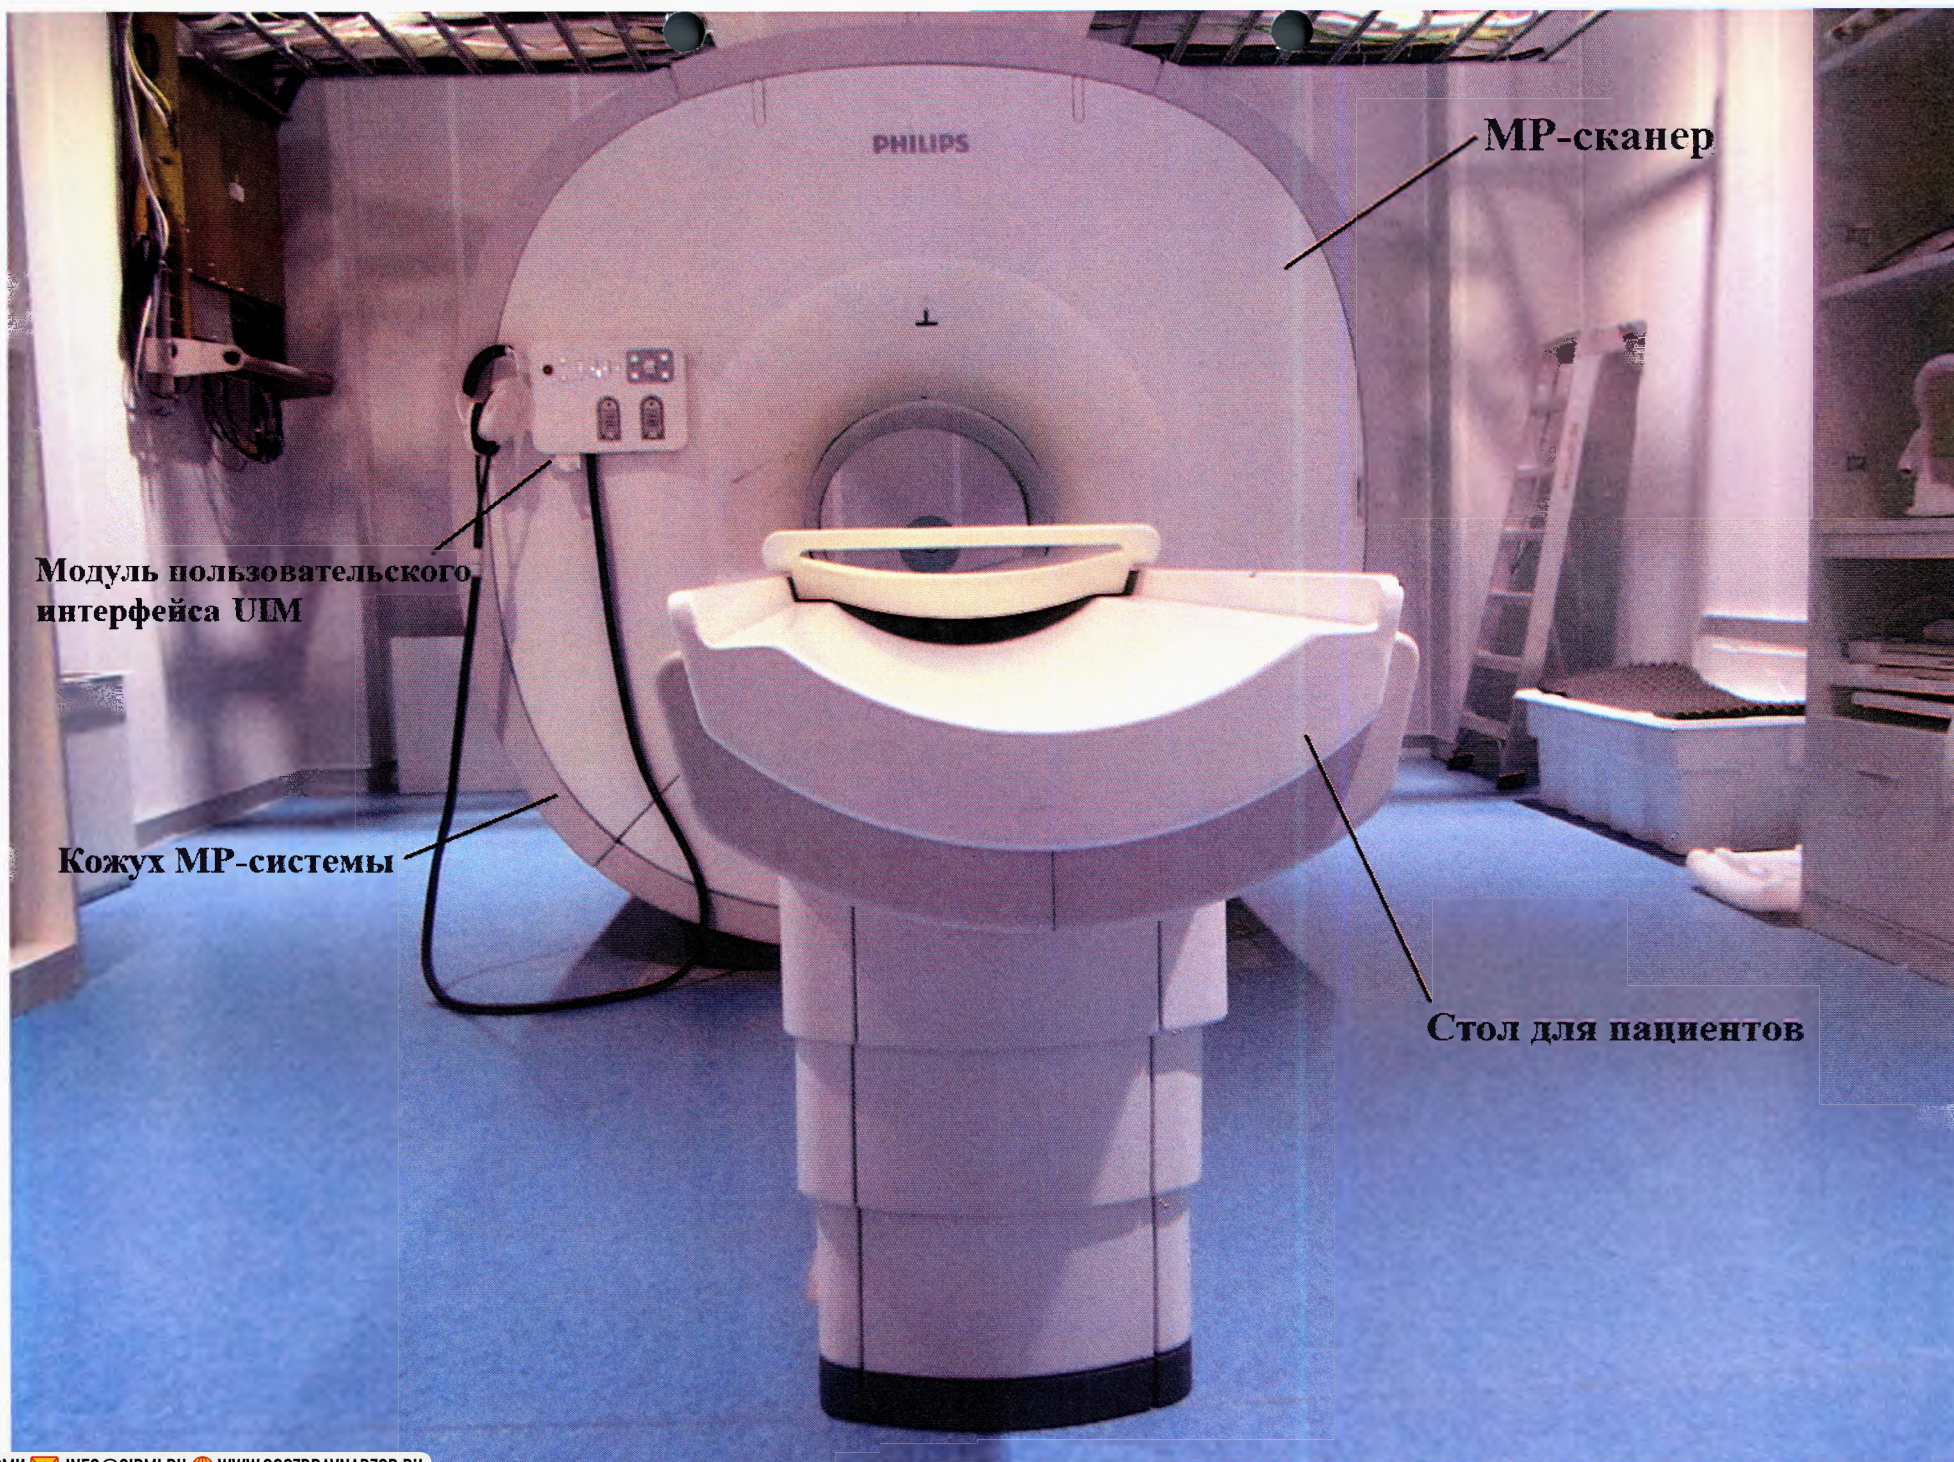



МР-сканер

Модуль пользовательского
интерфейса UIM


Кожух МР-системы


Стол для пациентов

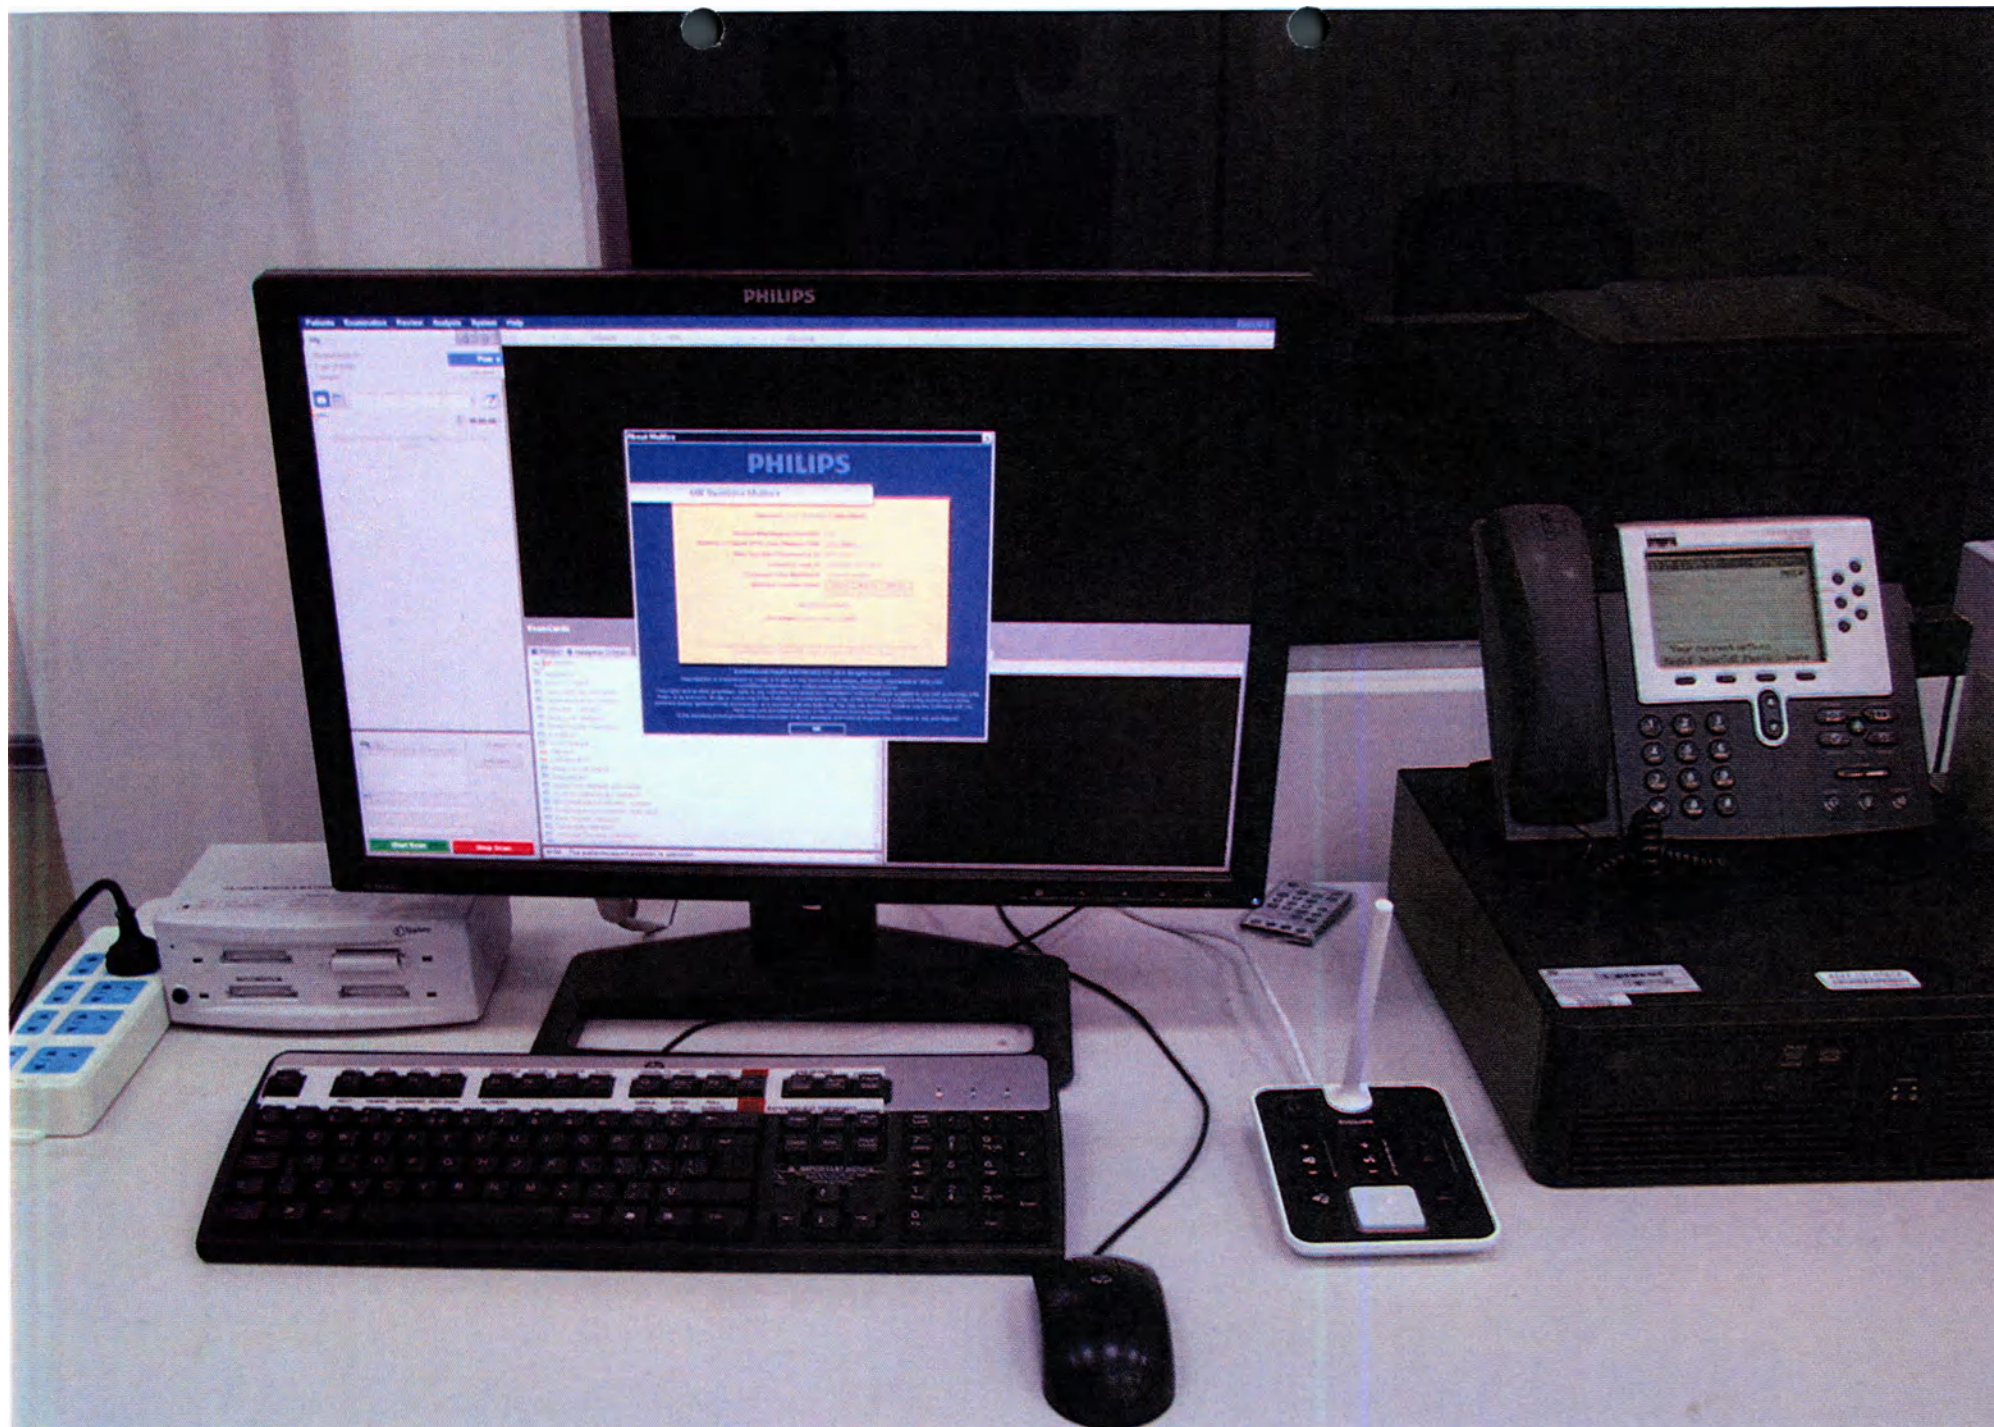

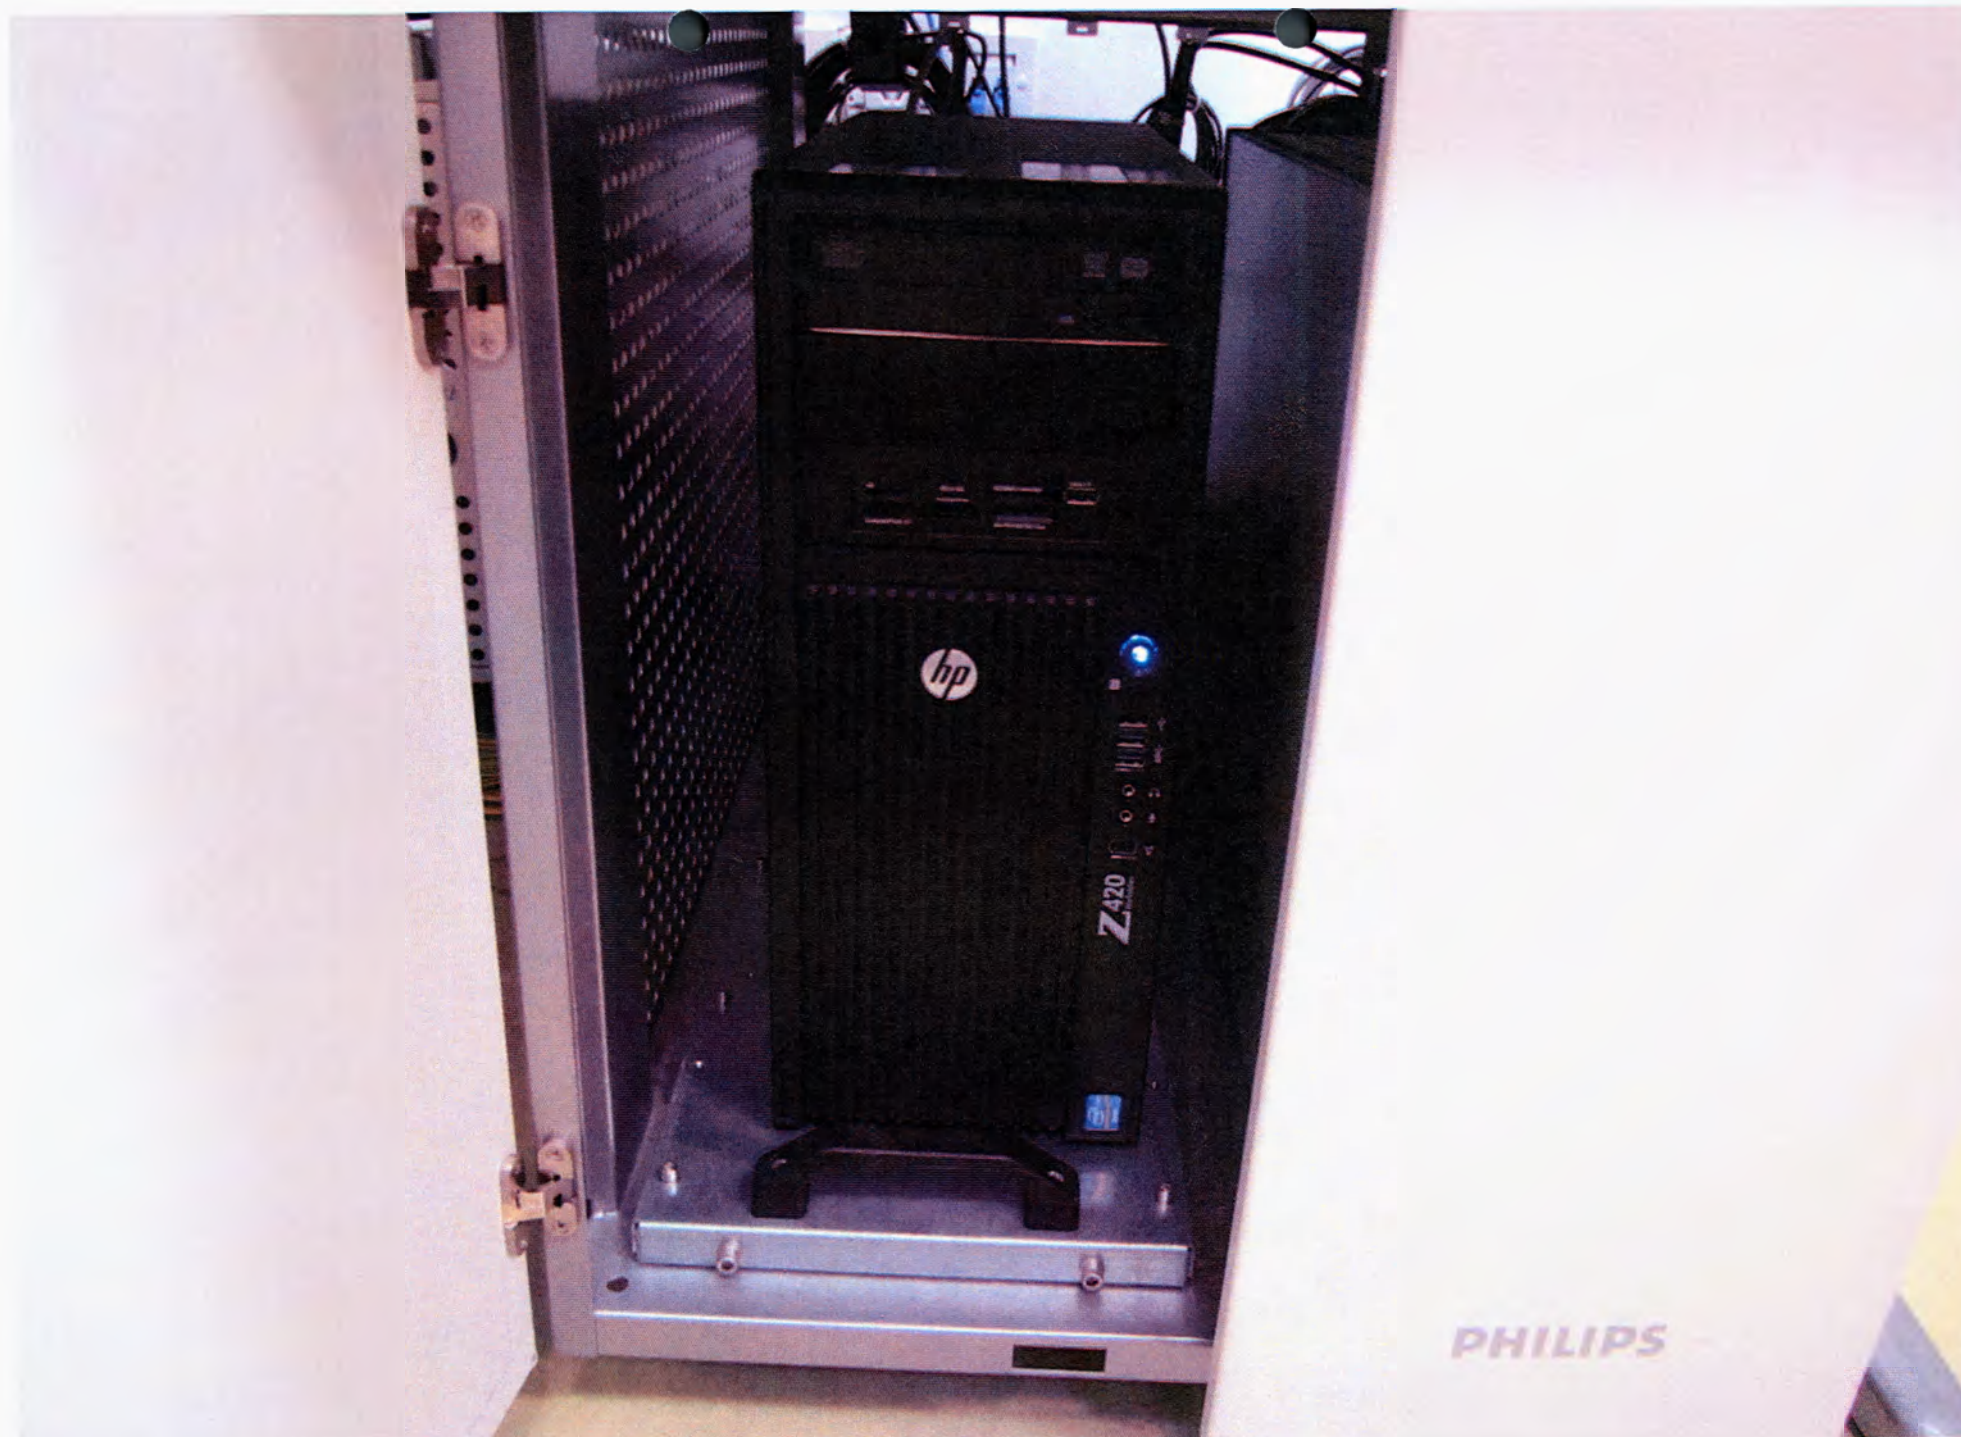




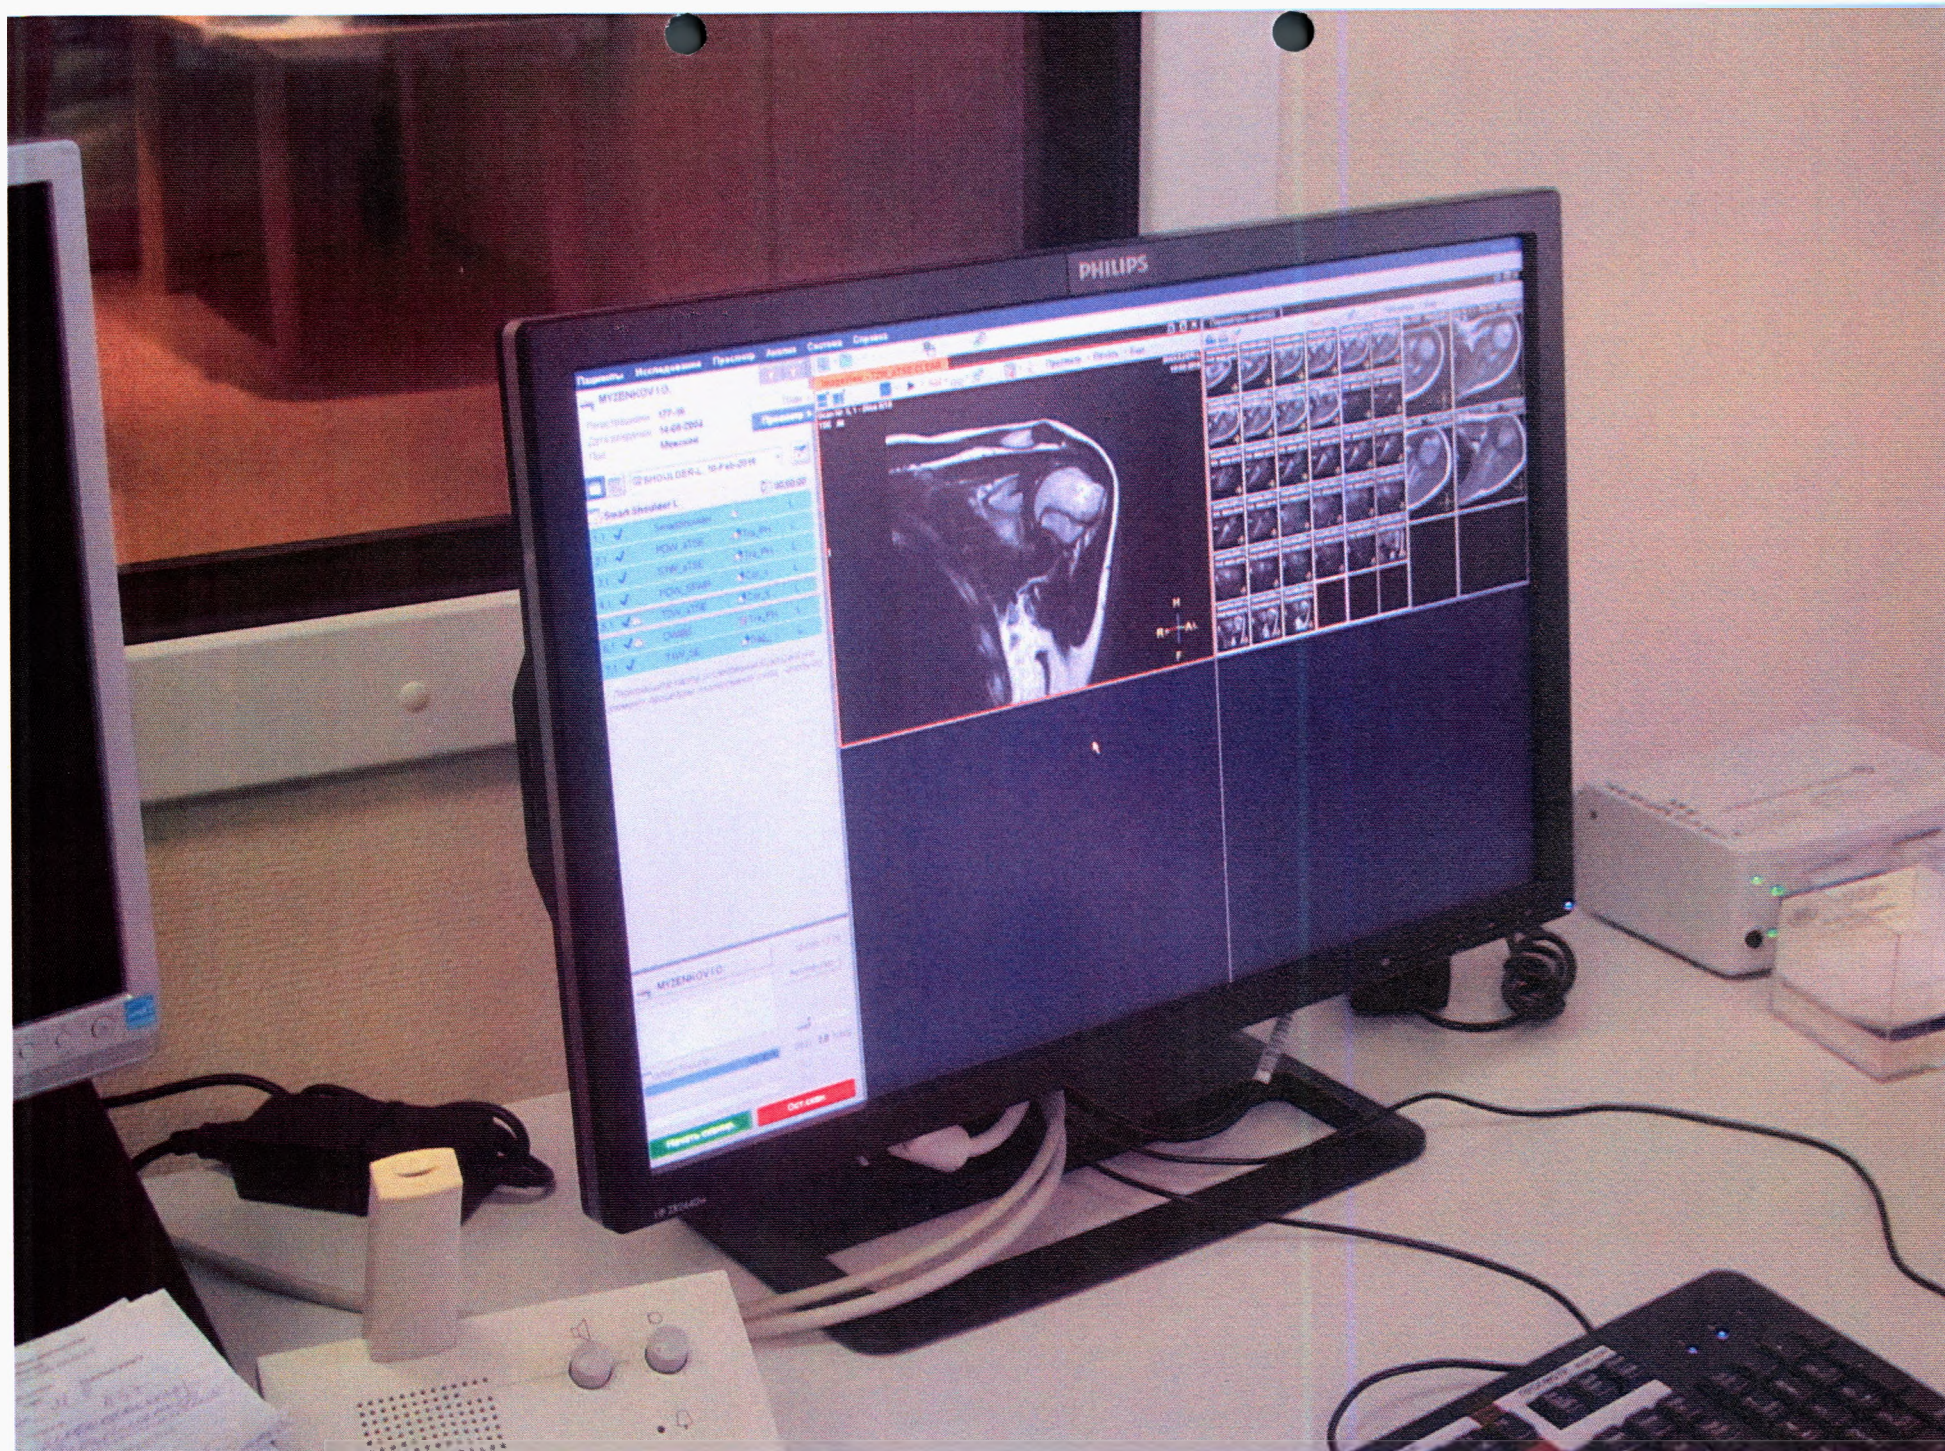


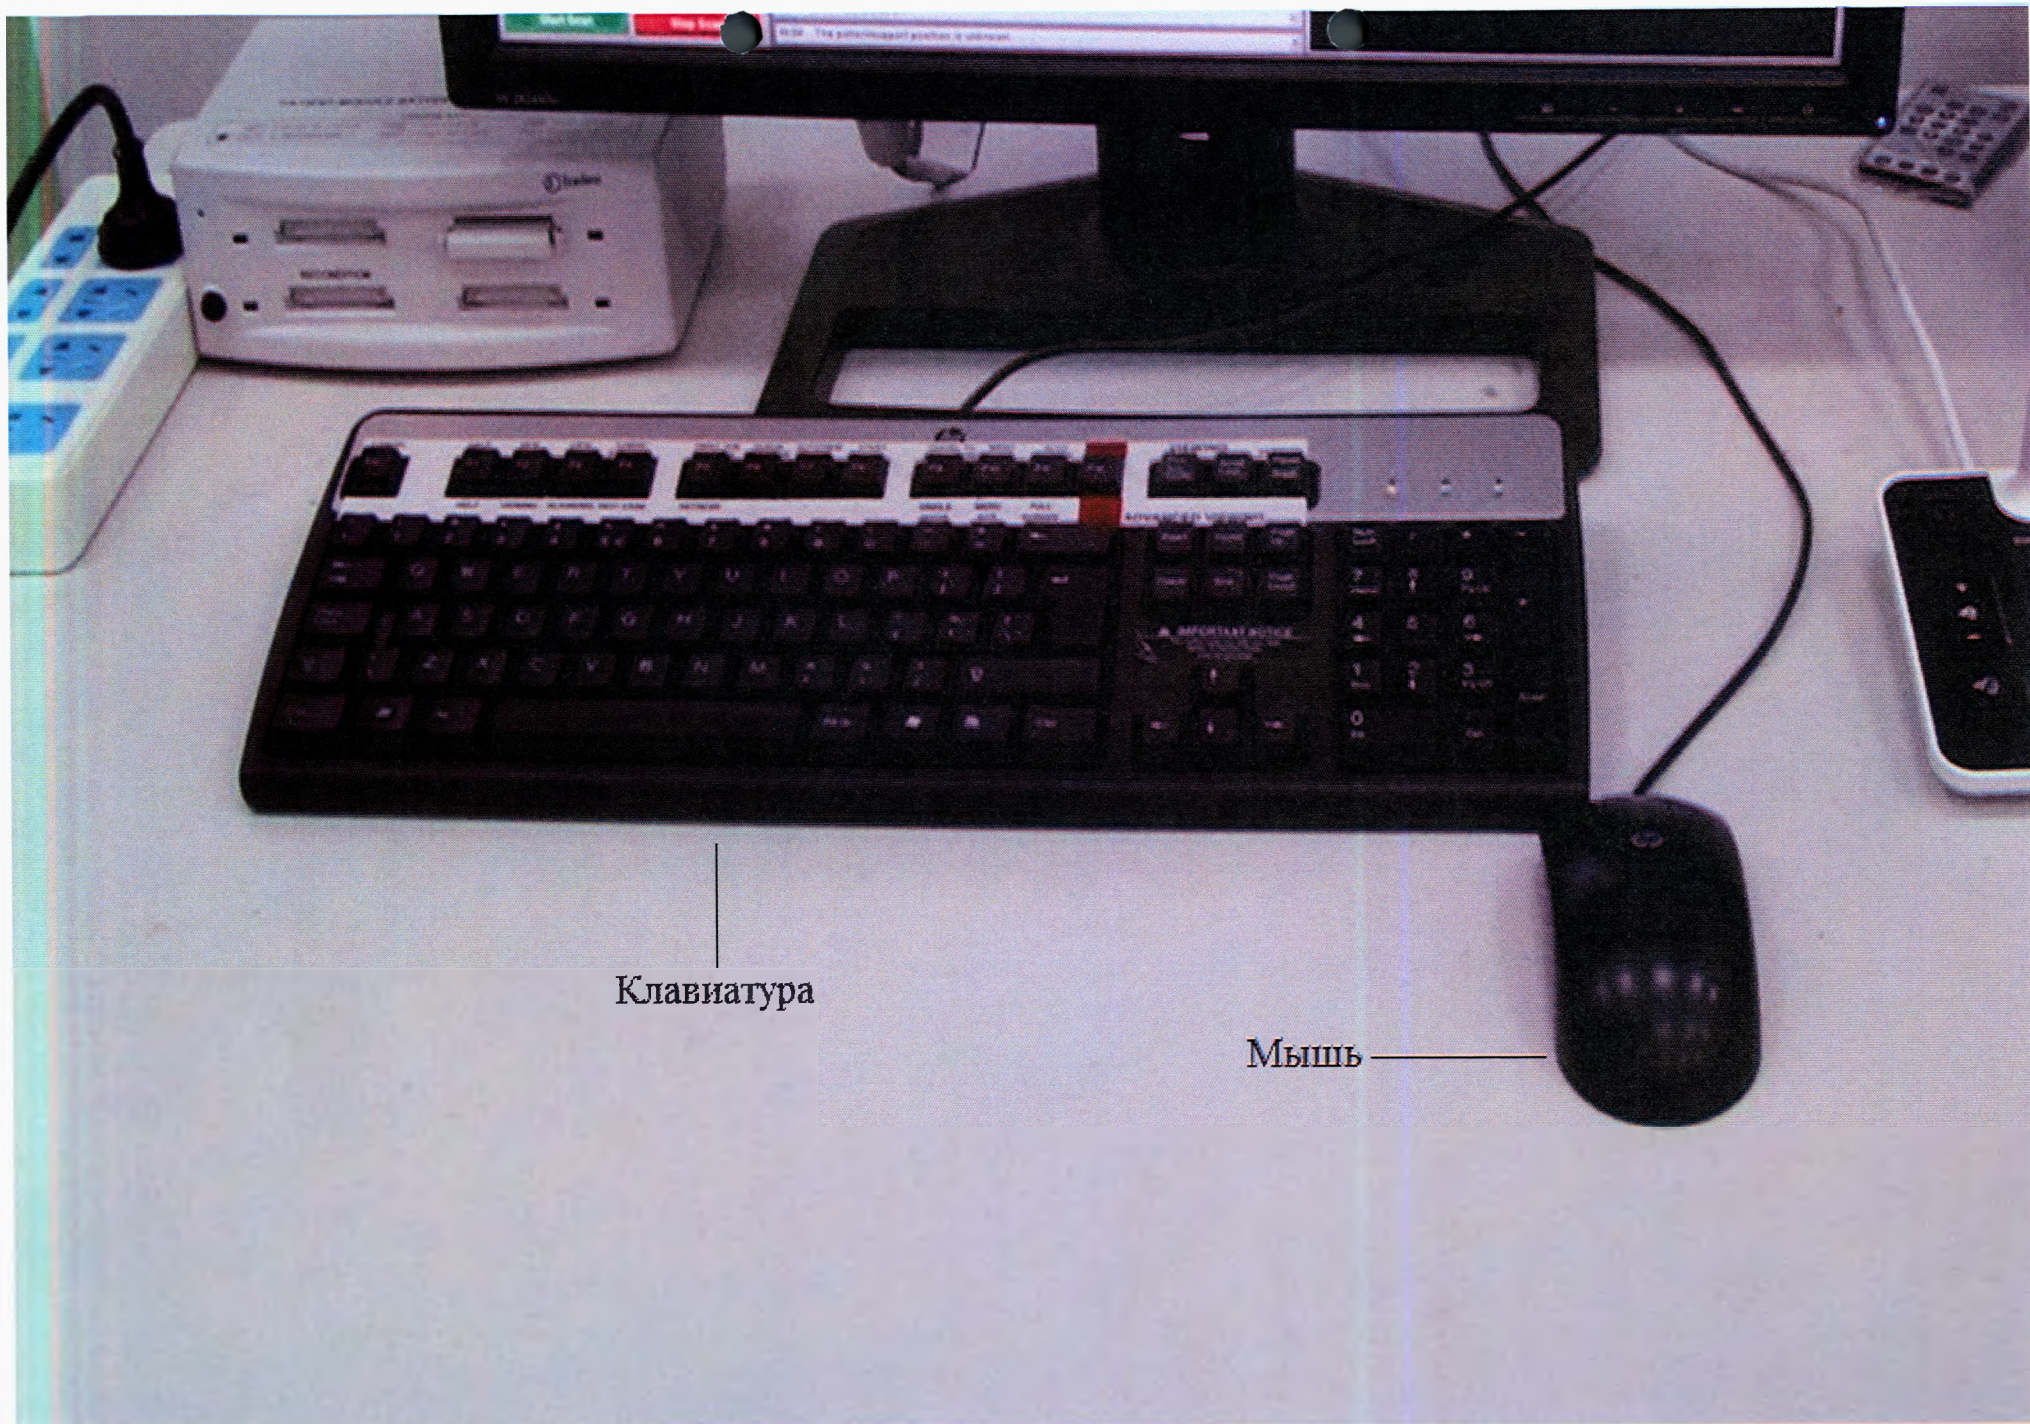


Клавиатура


Мышь

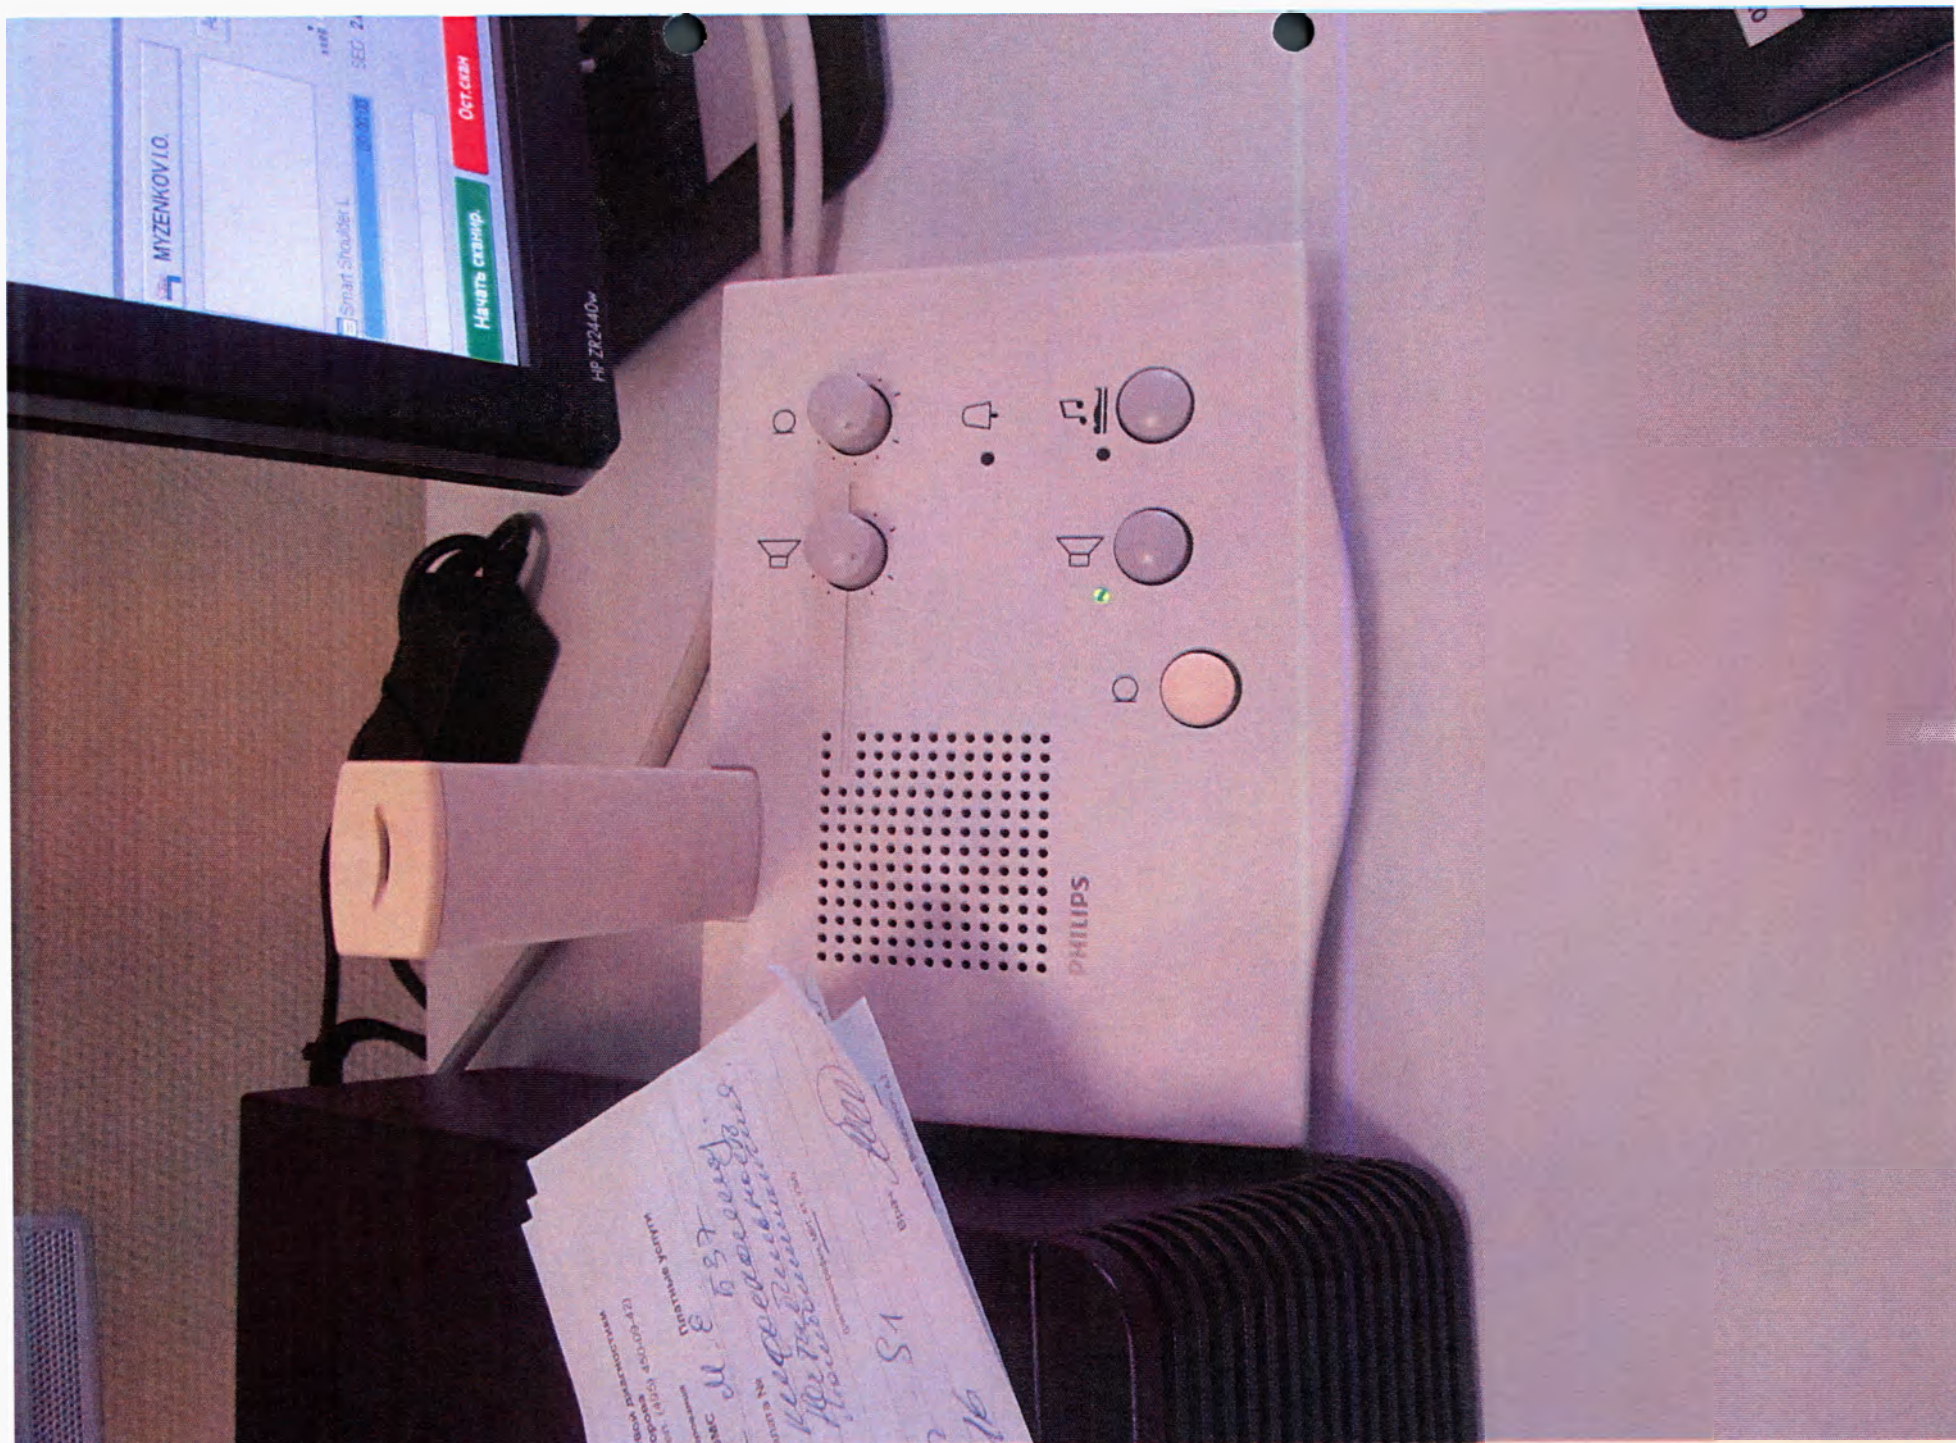

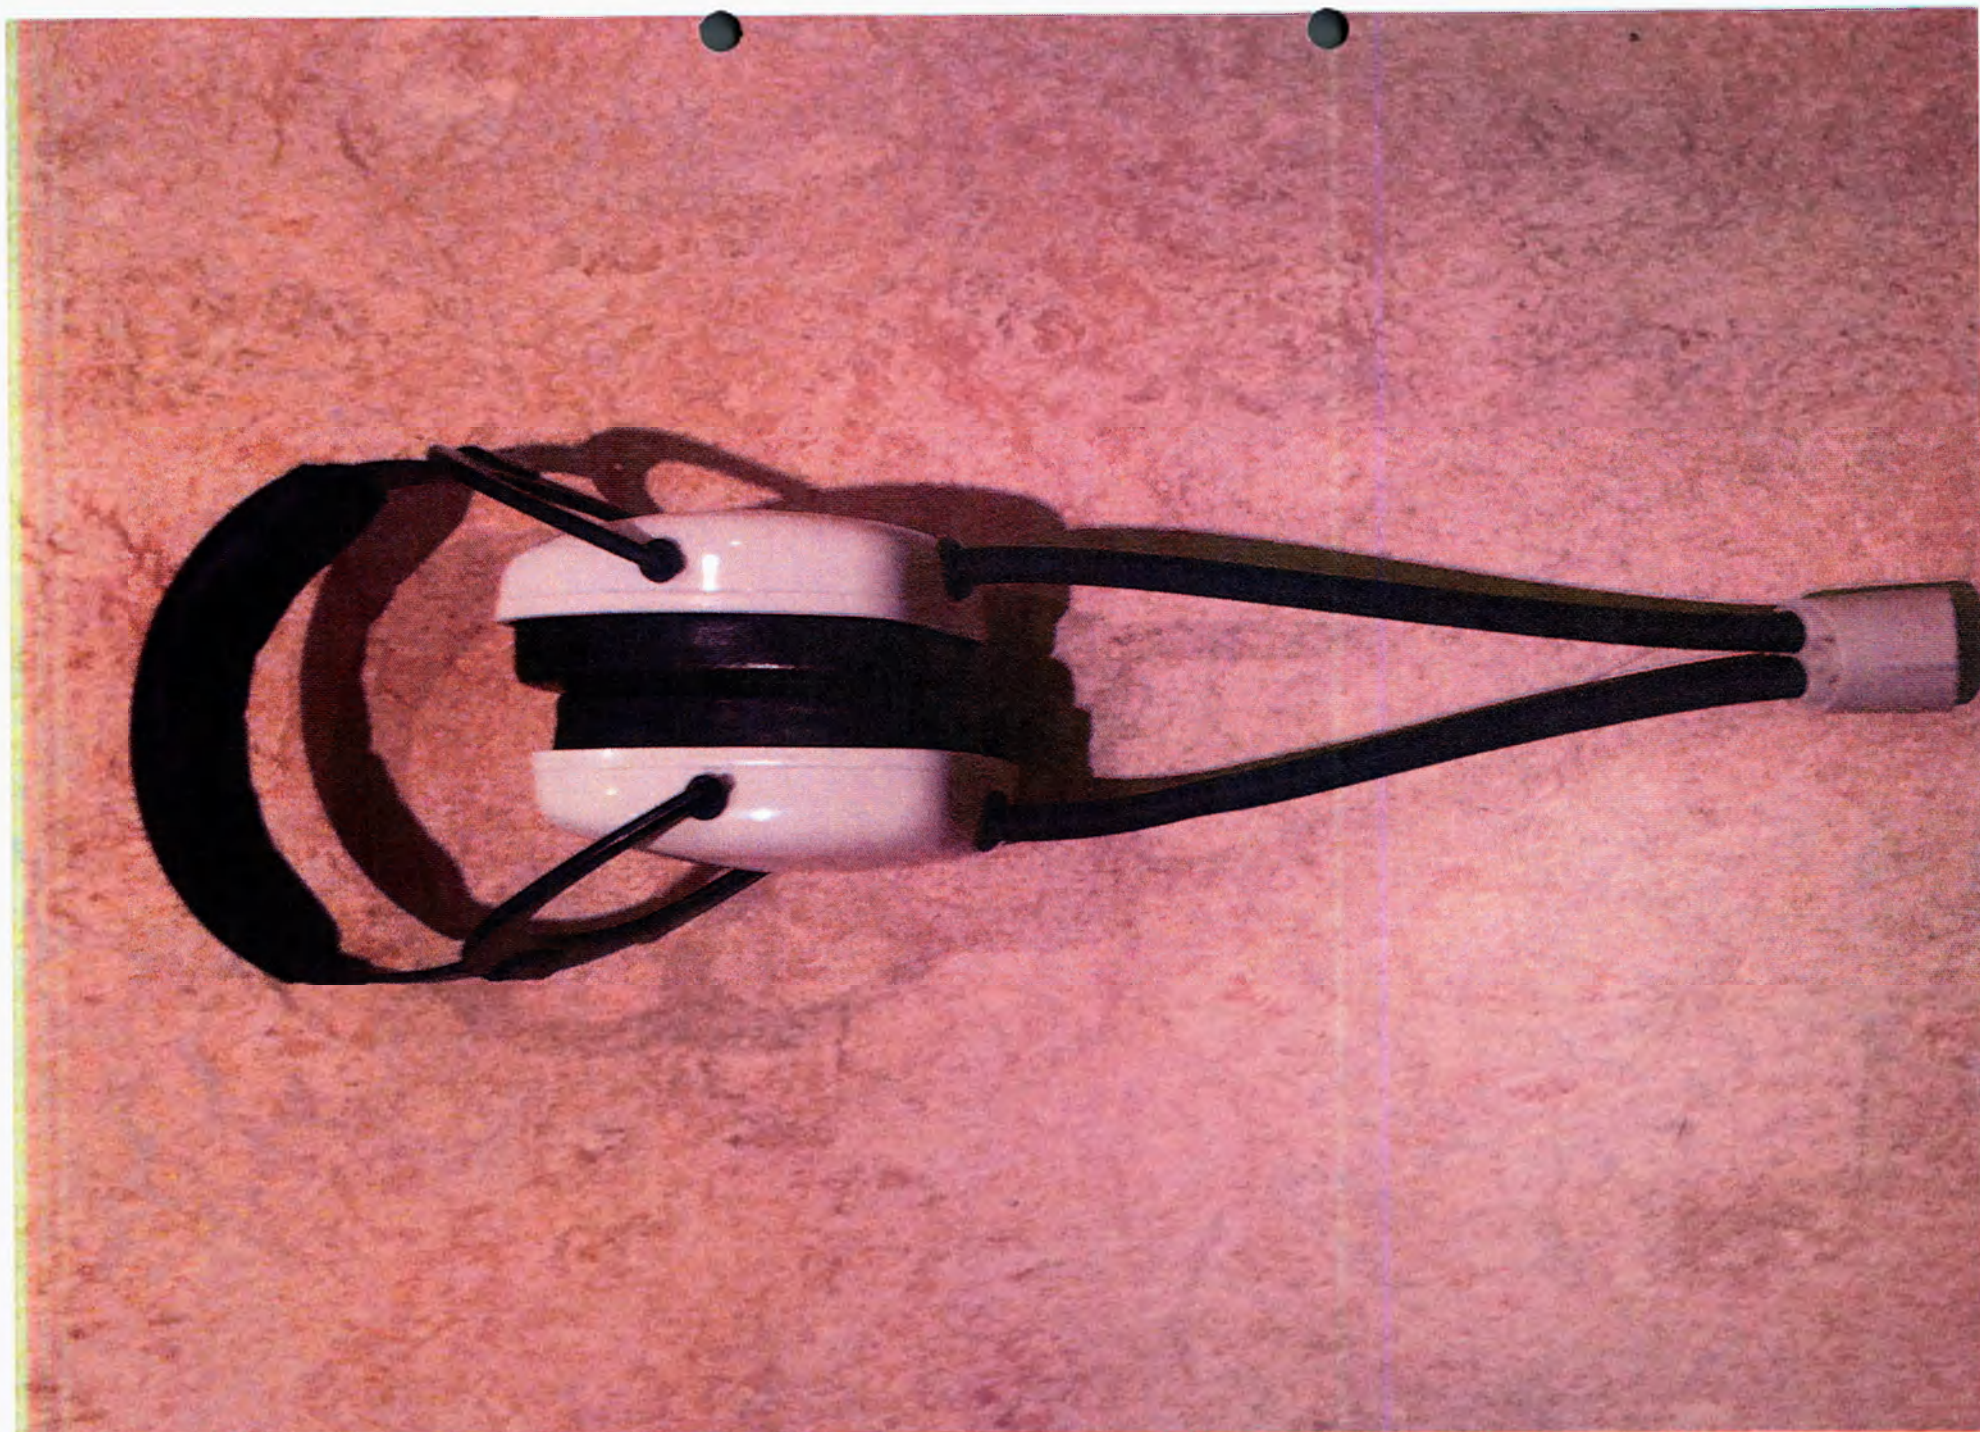



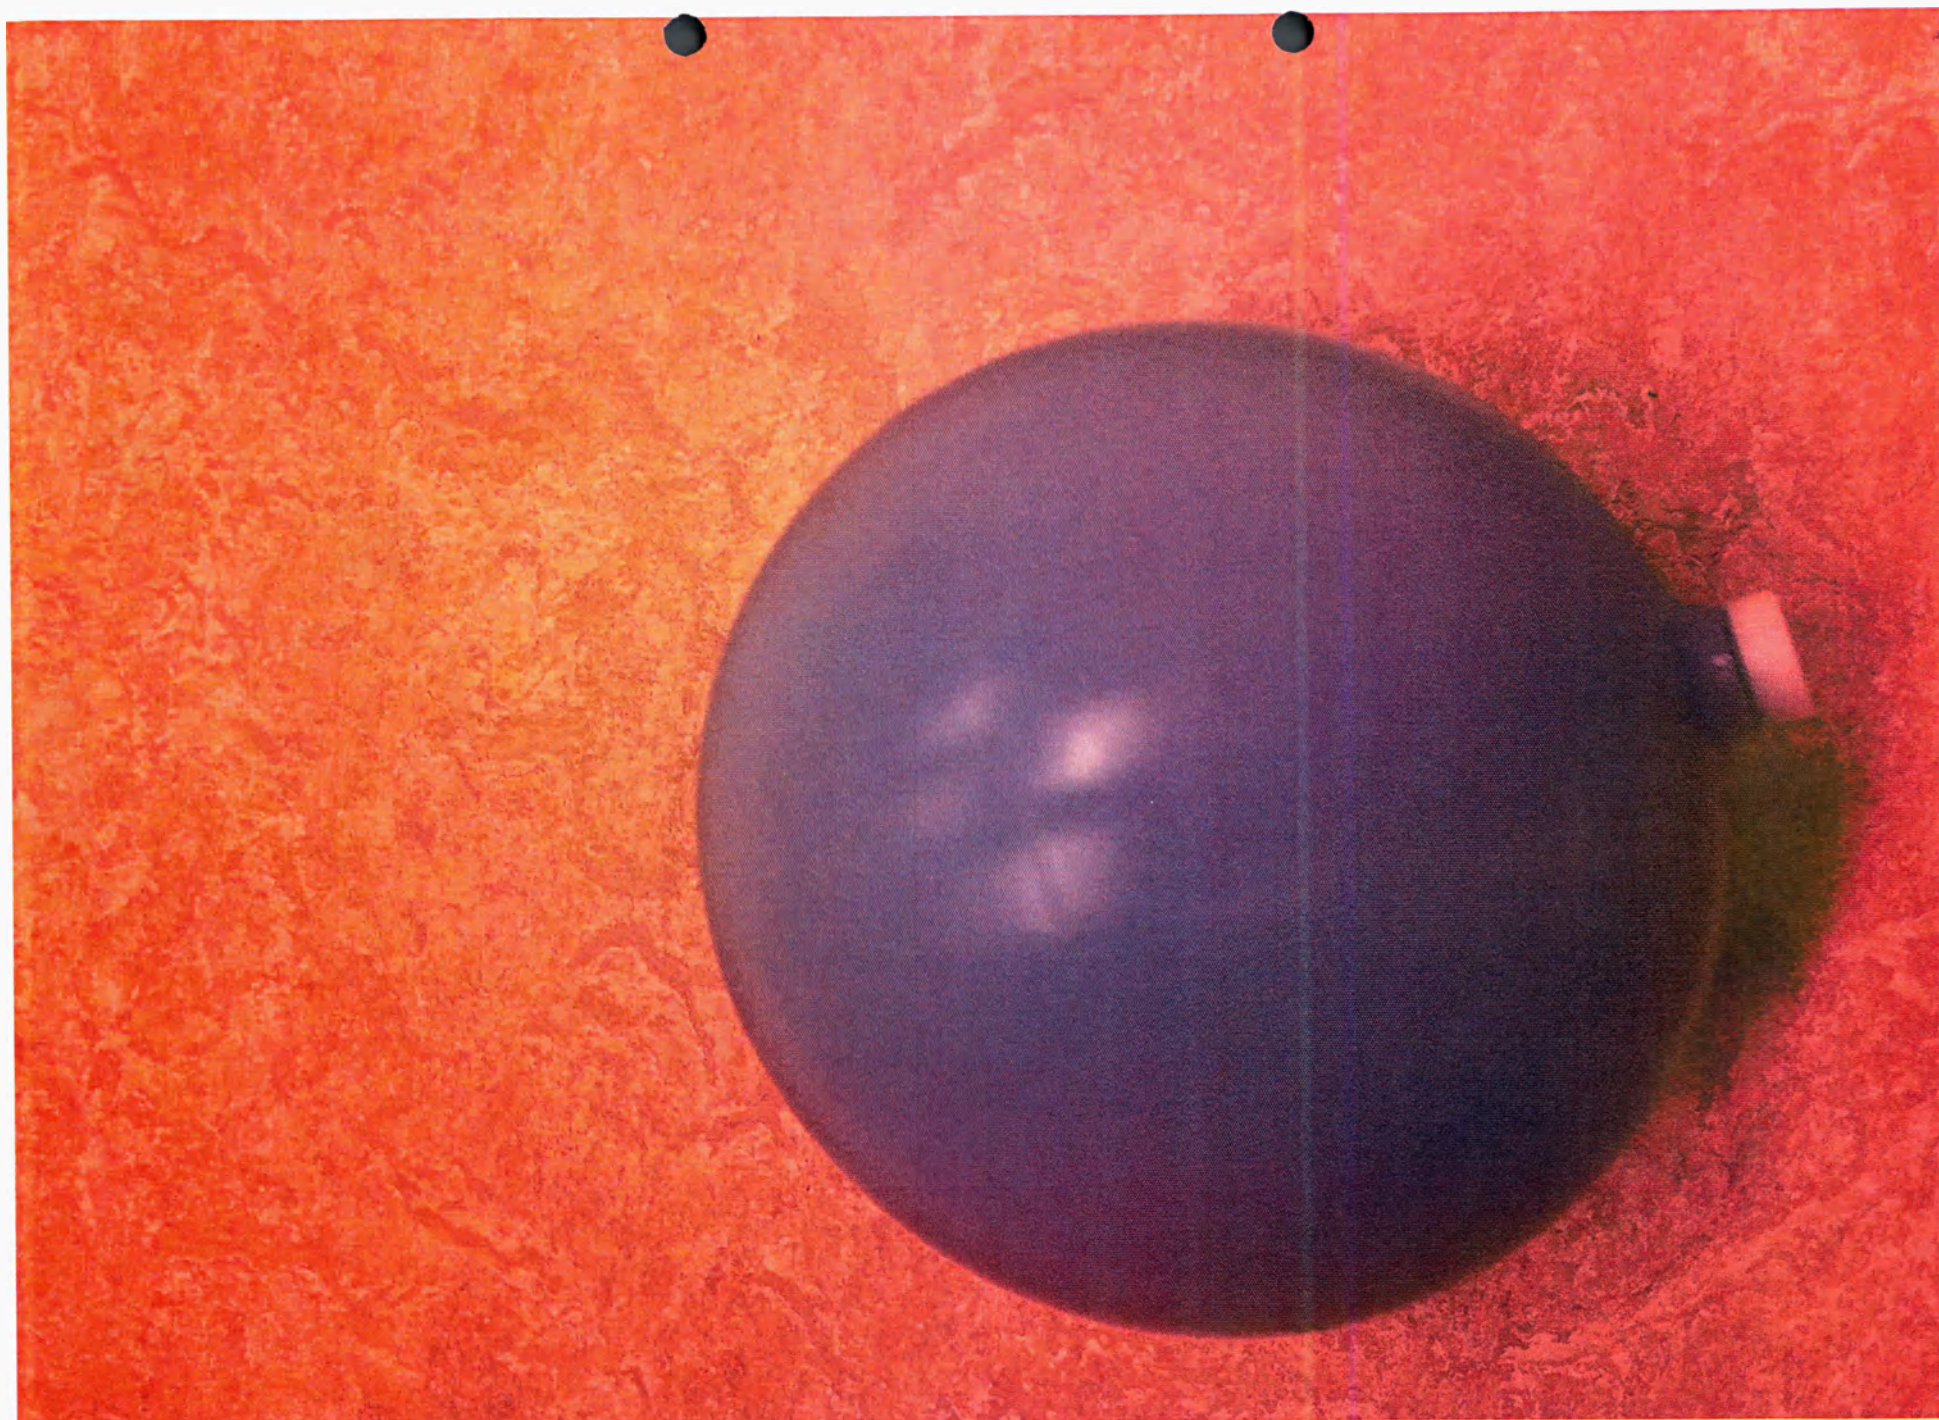

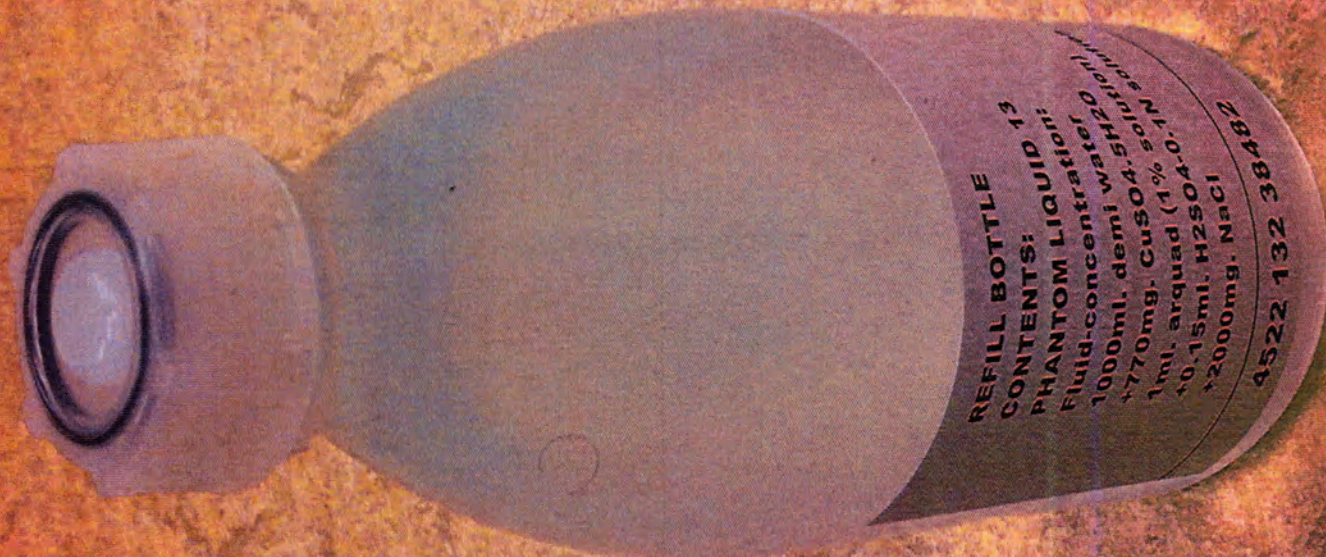


REFILL BOTTLE
CONTENTS: 13
PHANTOM LIQUID
Fluid-concentrate
1000ml. demi water
1770mg. CuSO₄. 5H₂O
1ml. arquad (1% solution)
10.15ml. H₂SO₄-0.0-1
2000mg. NaCl


4522 132 38482







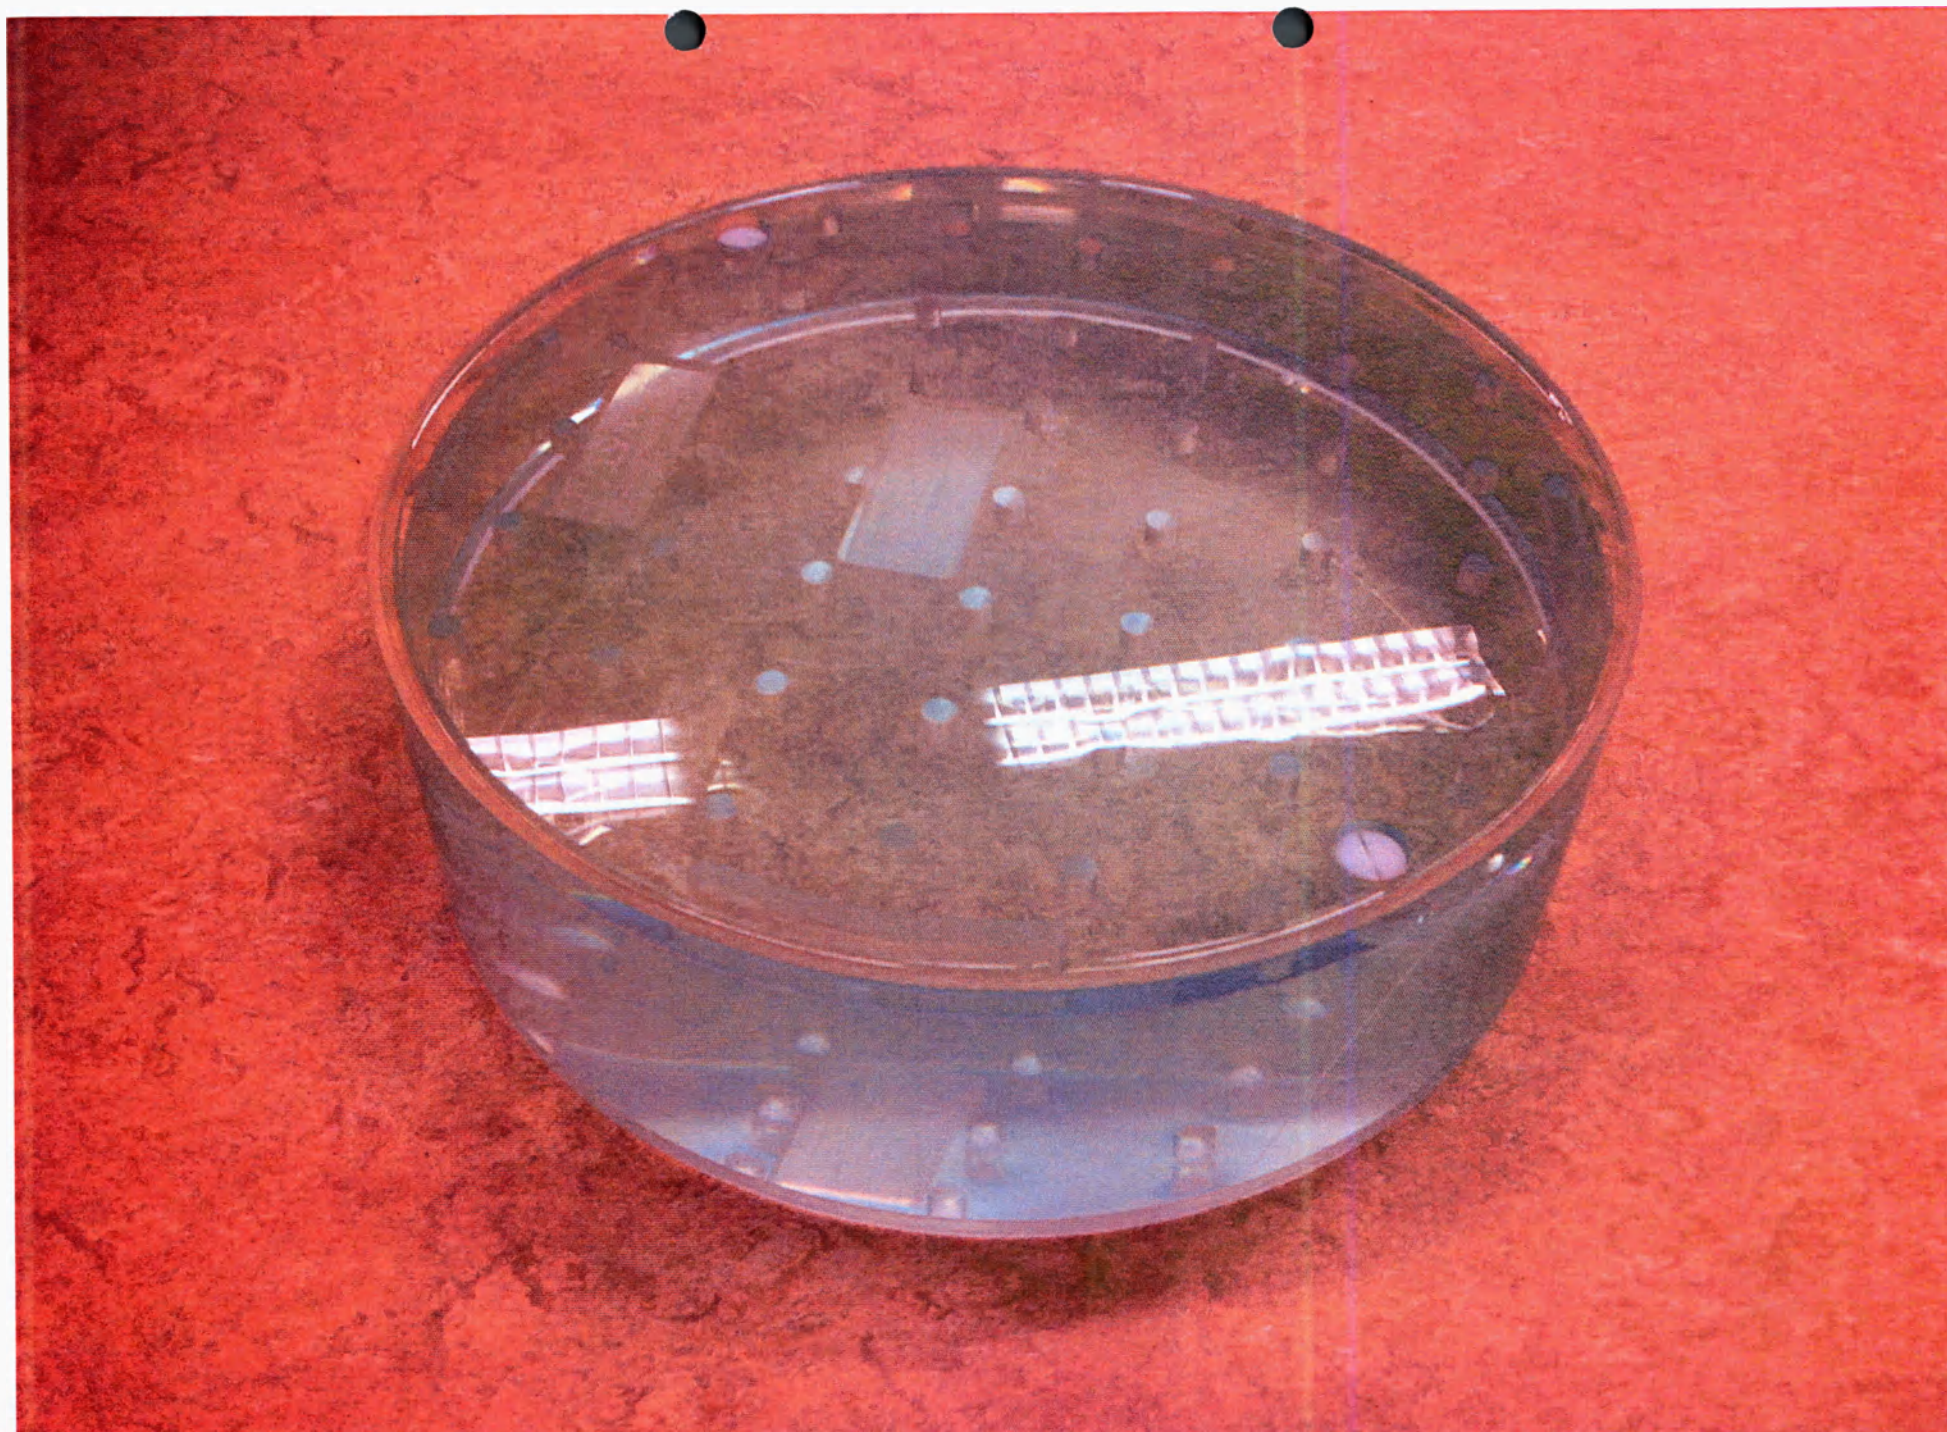




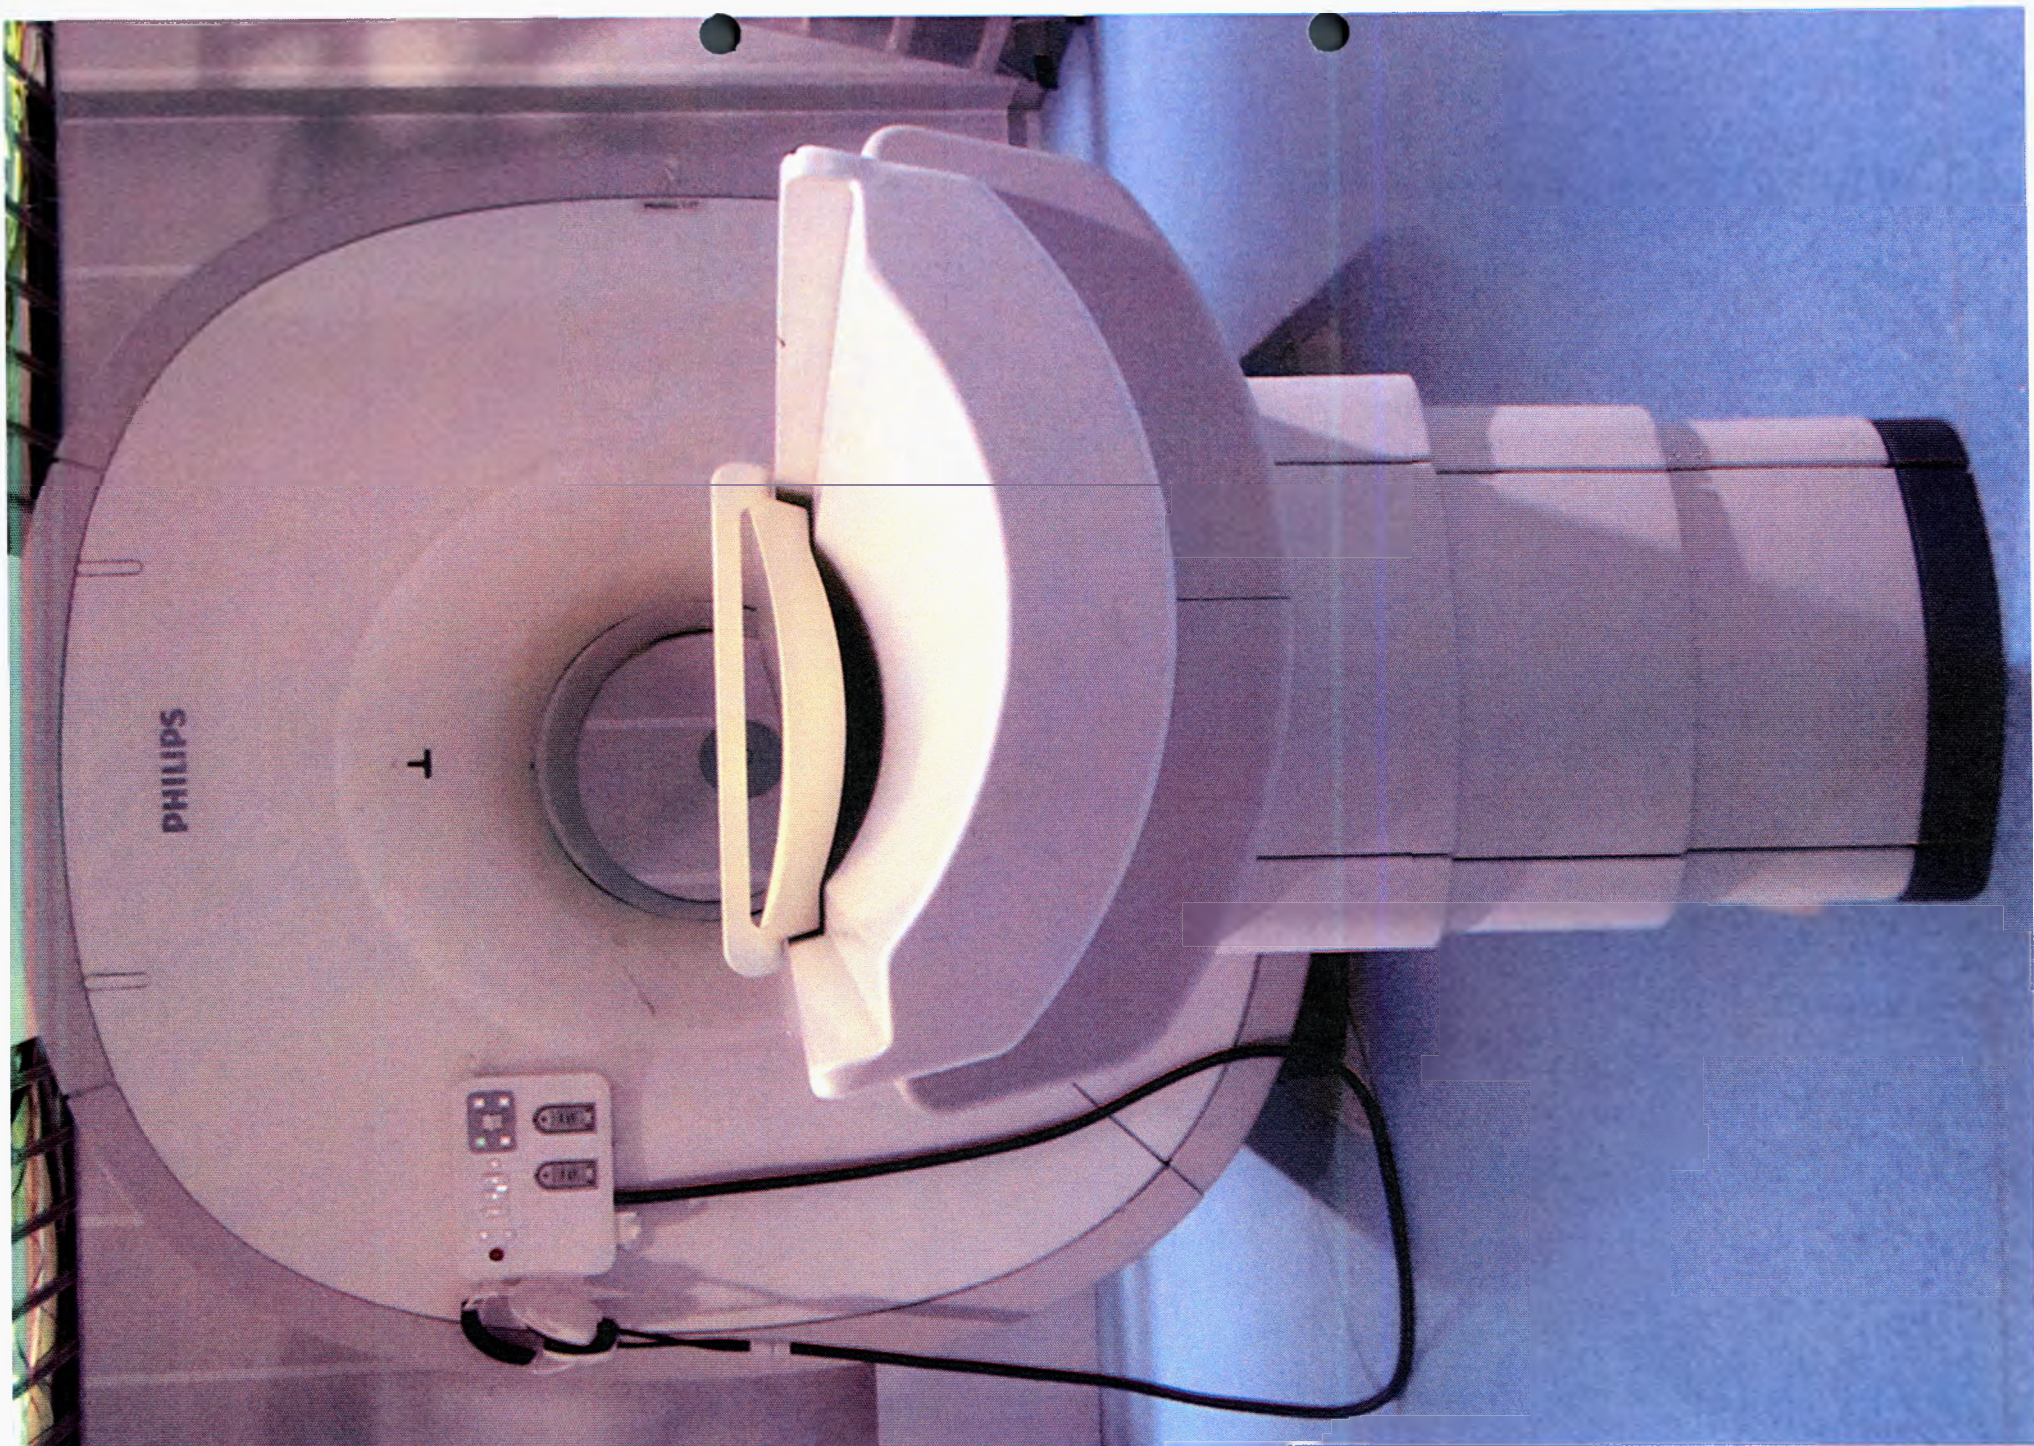


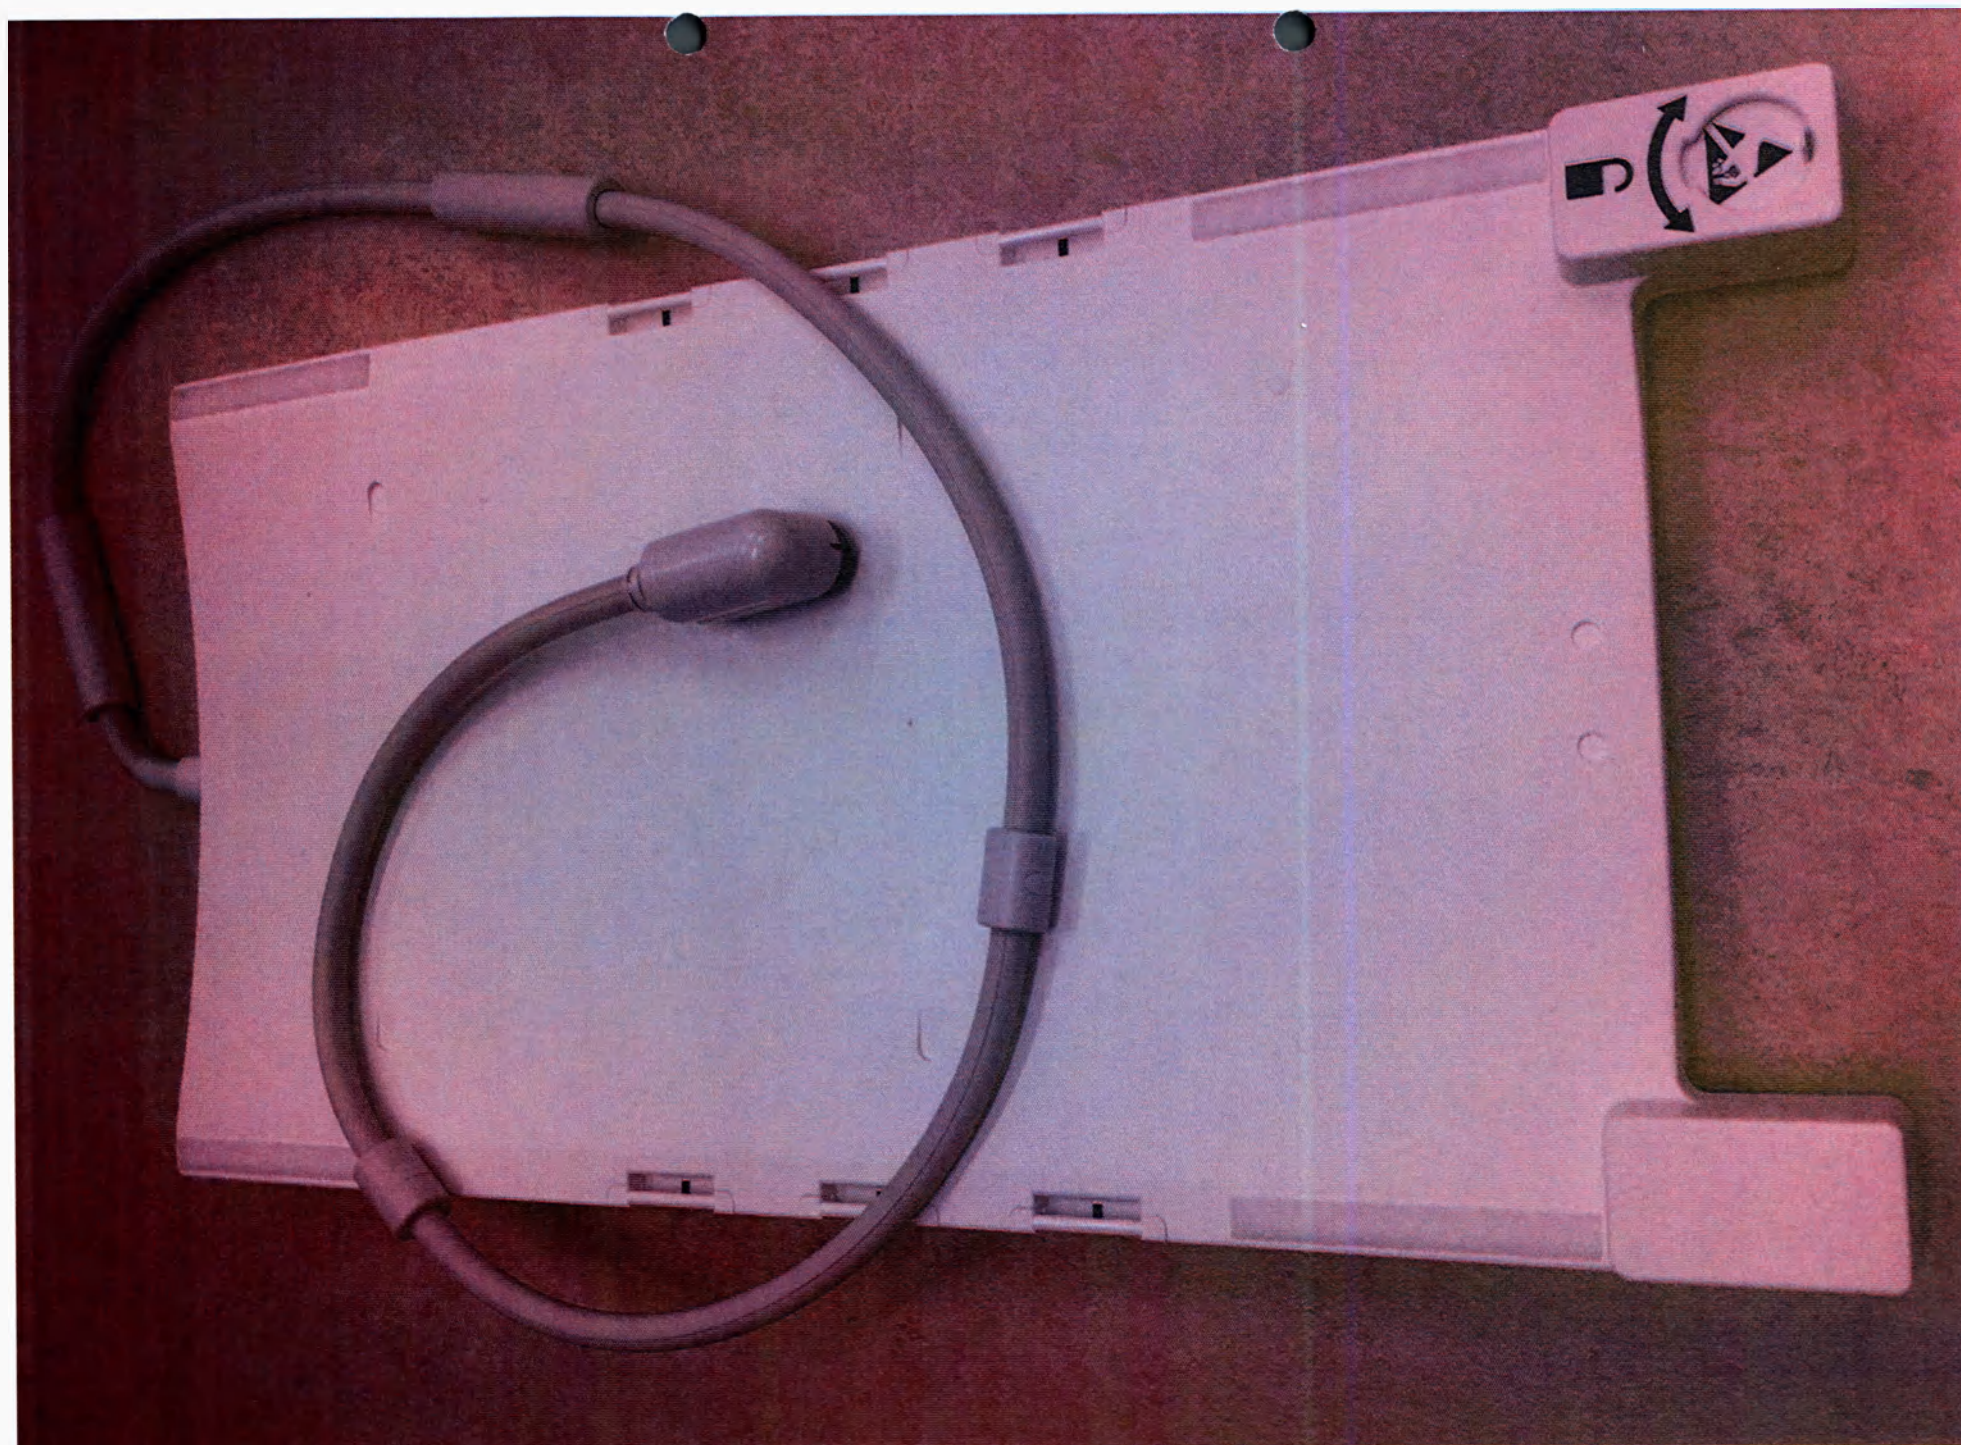


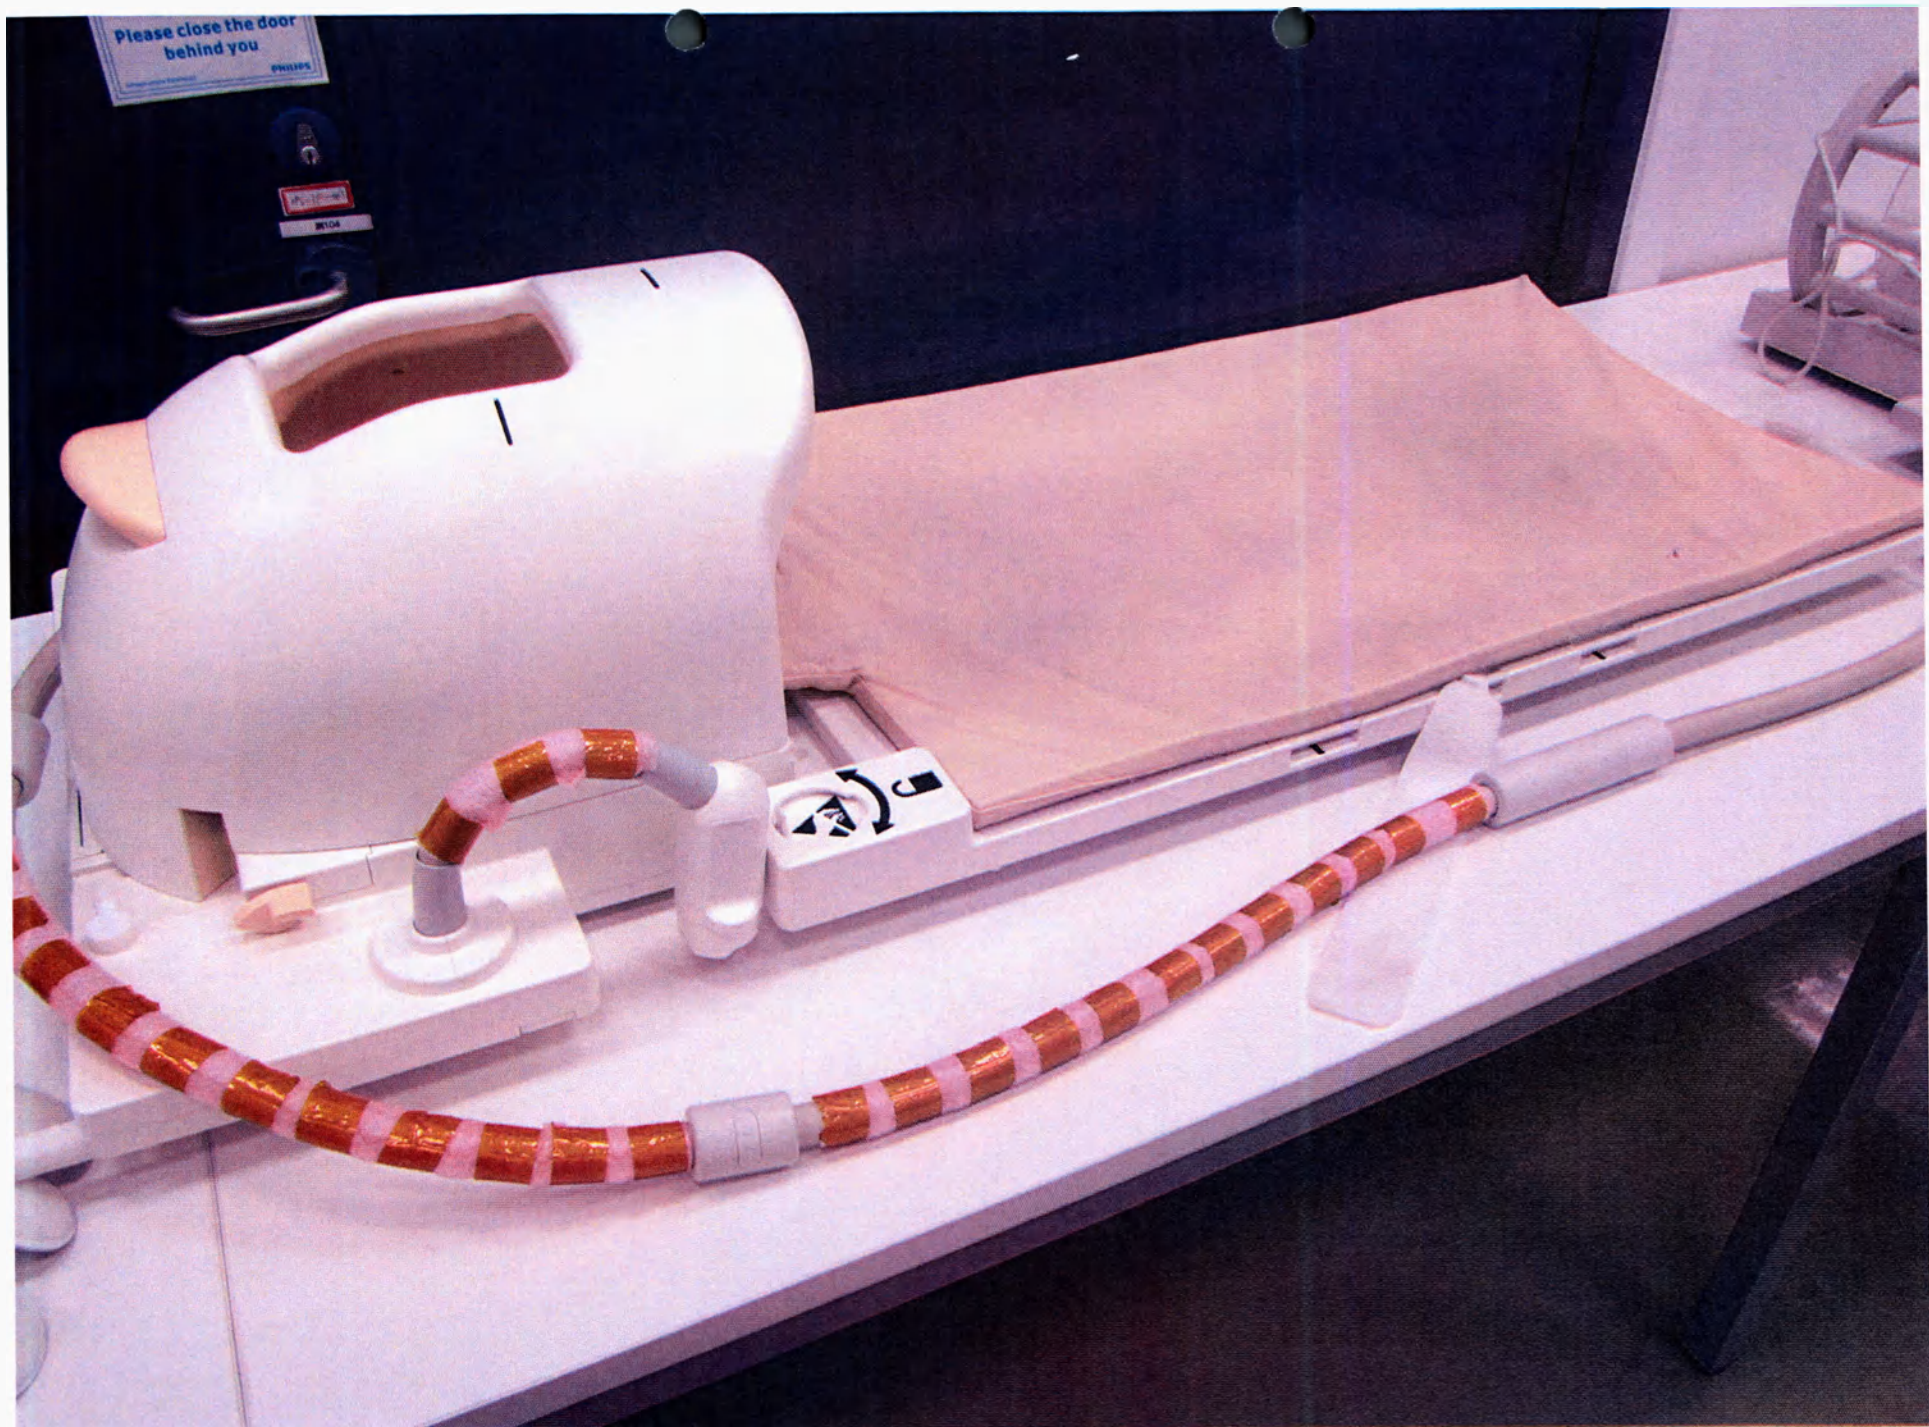




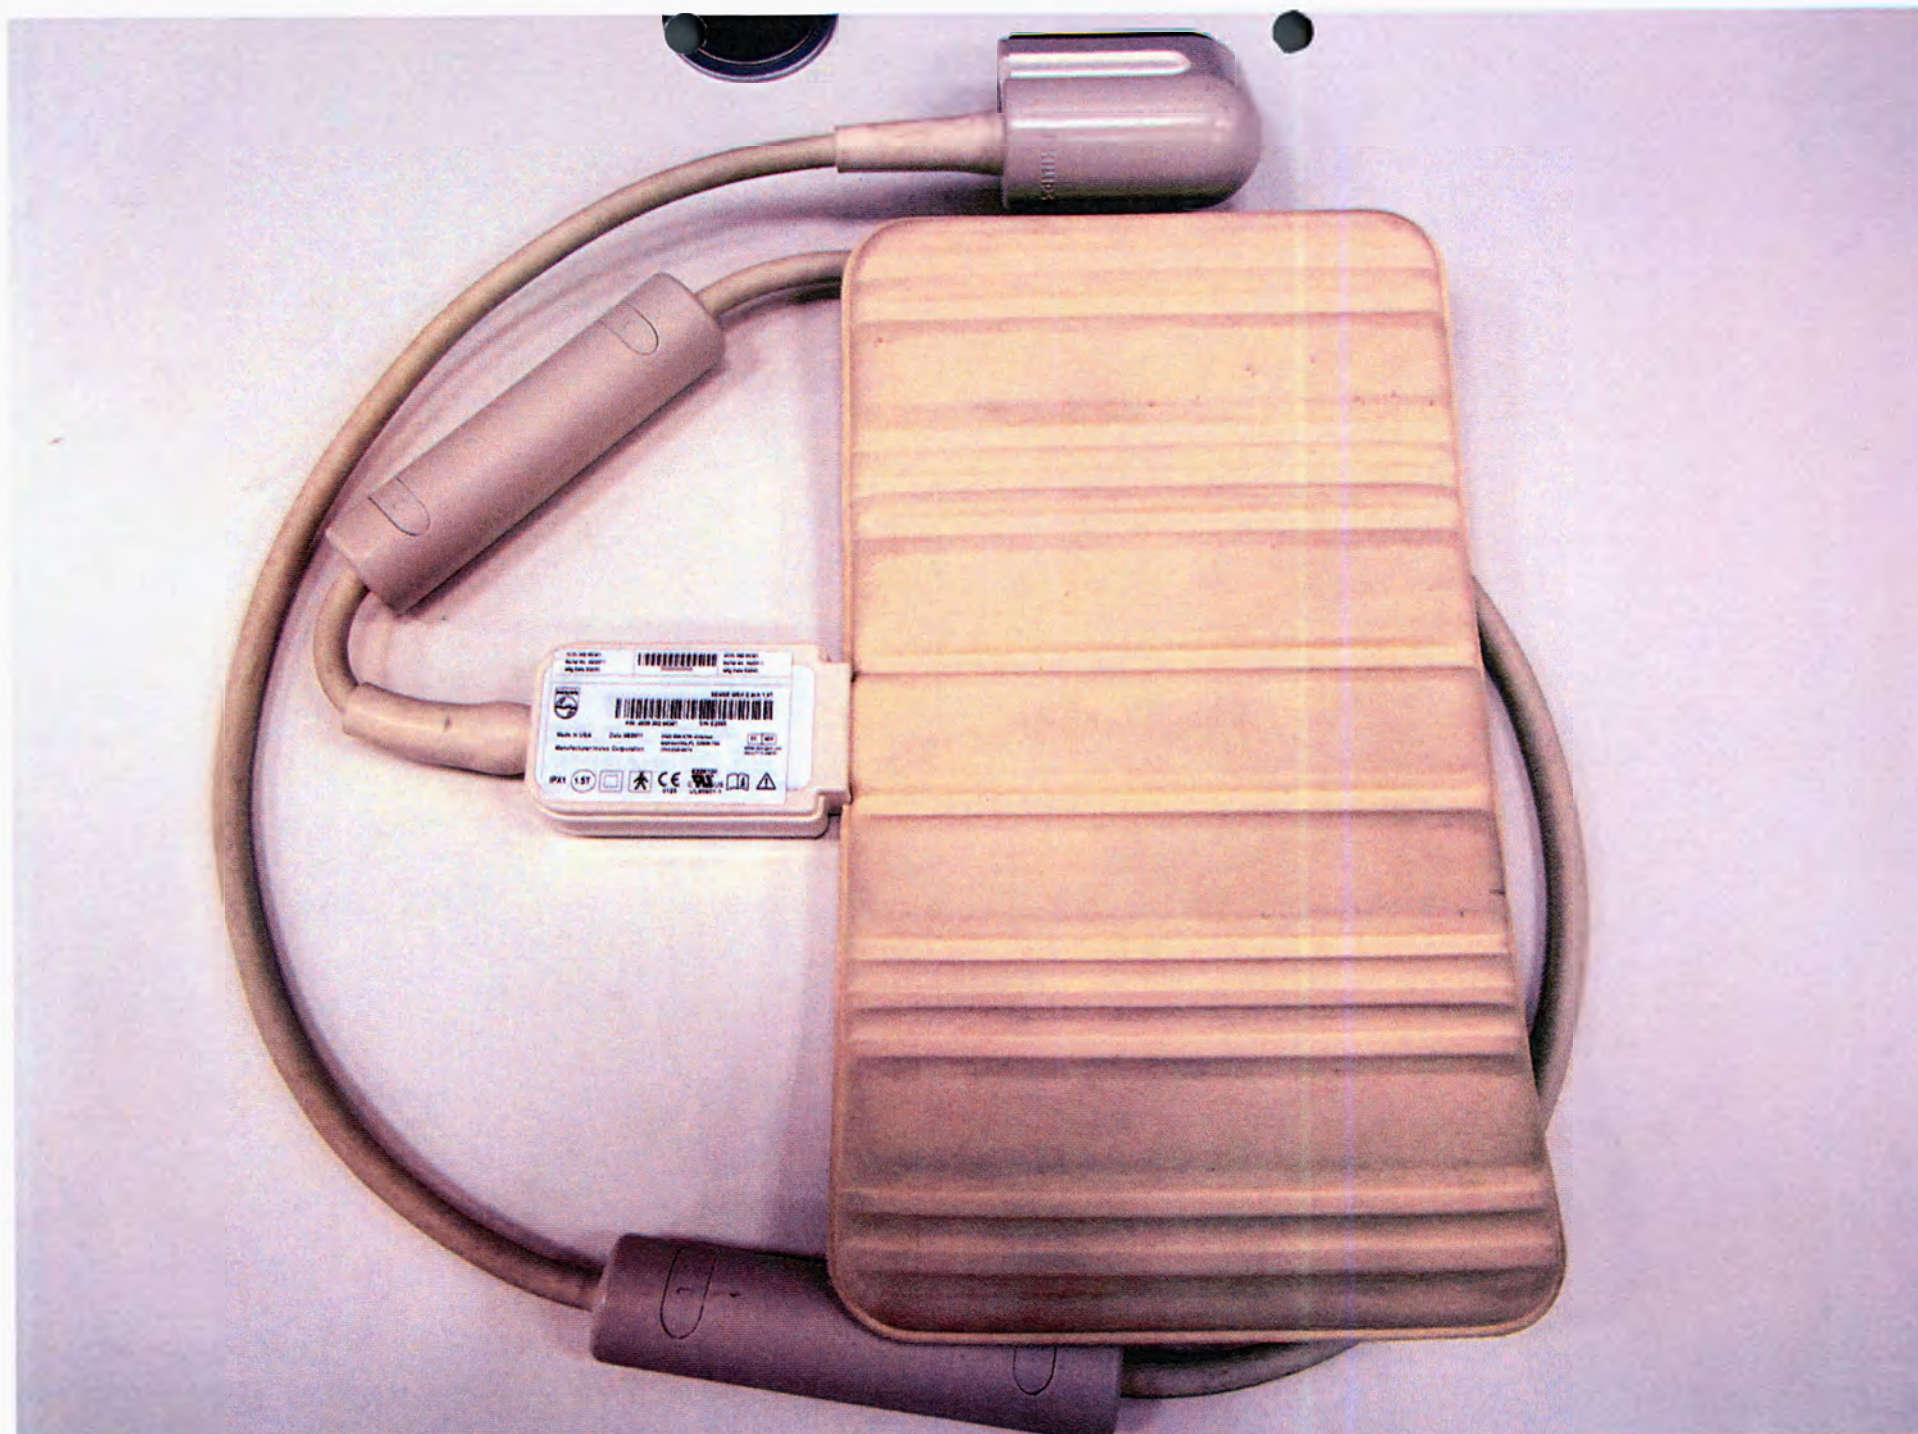


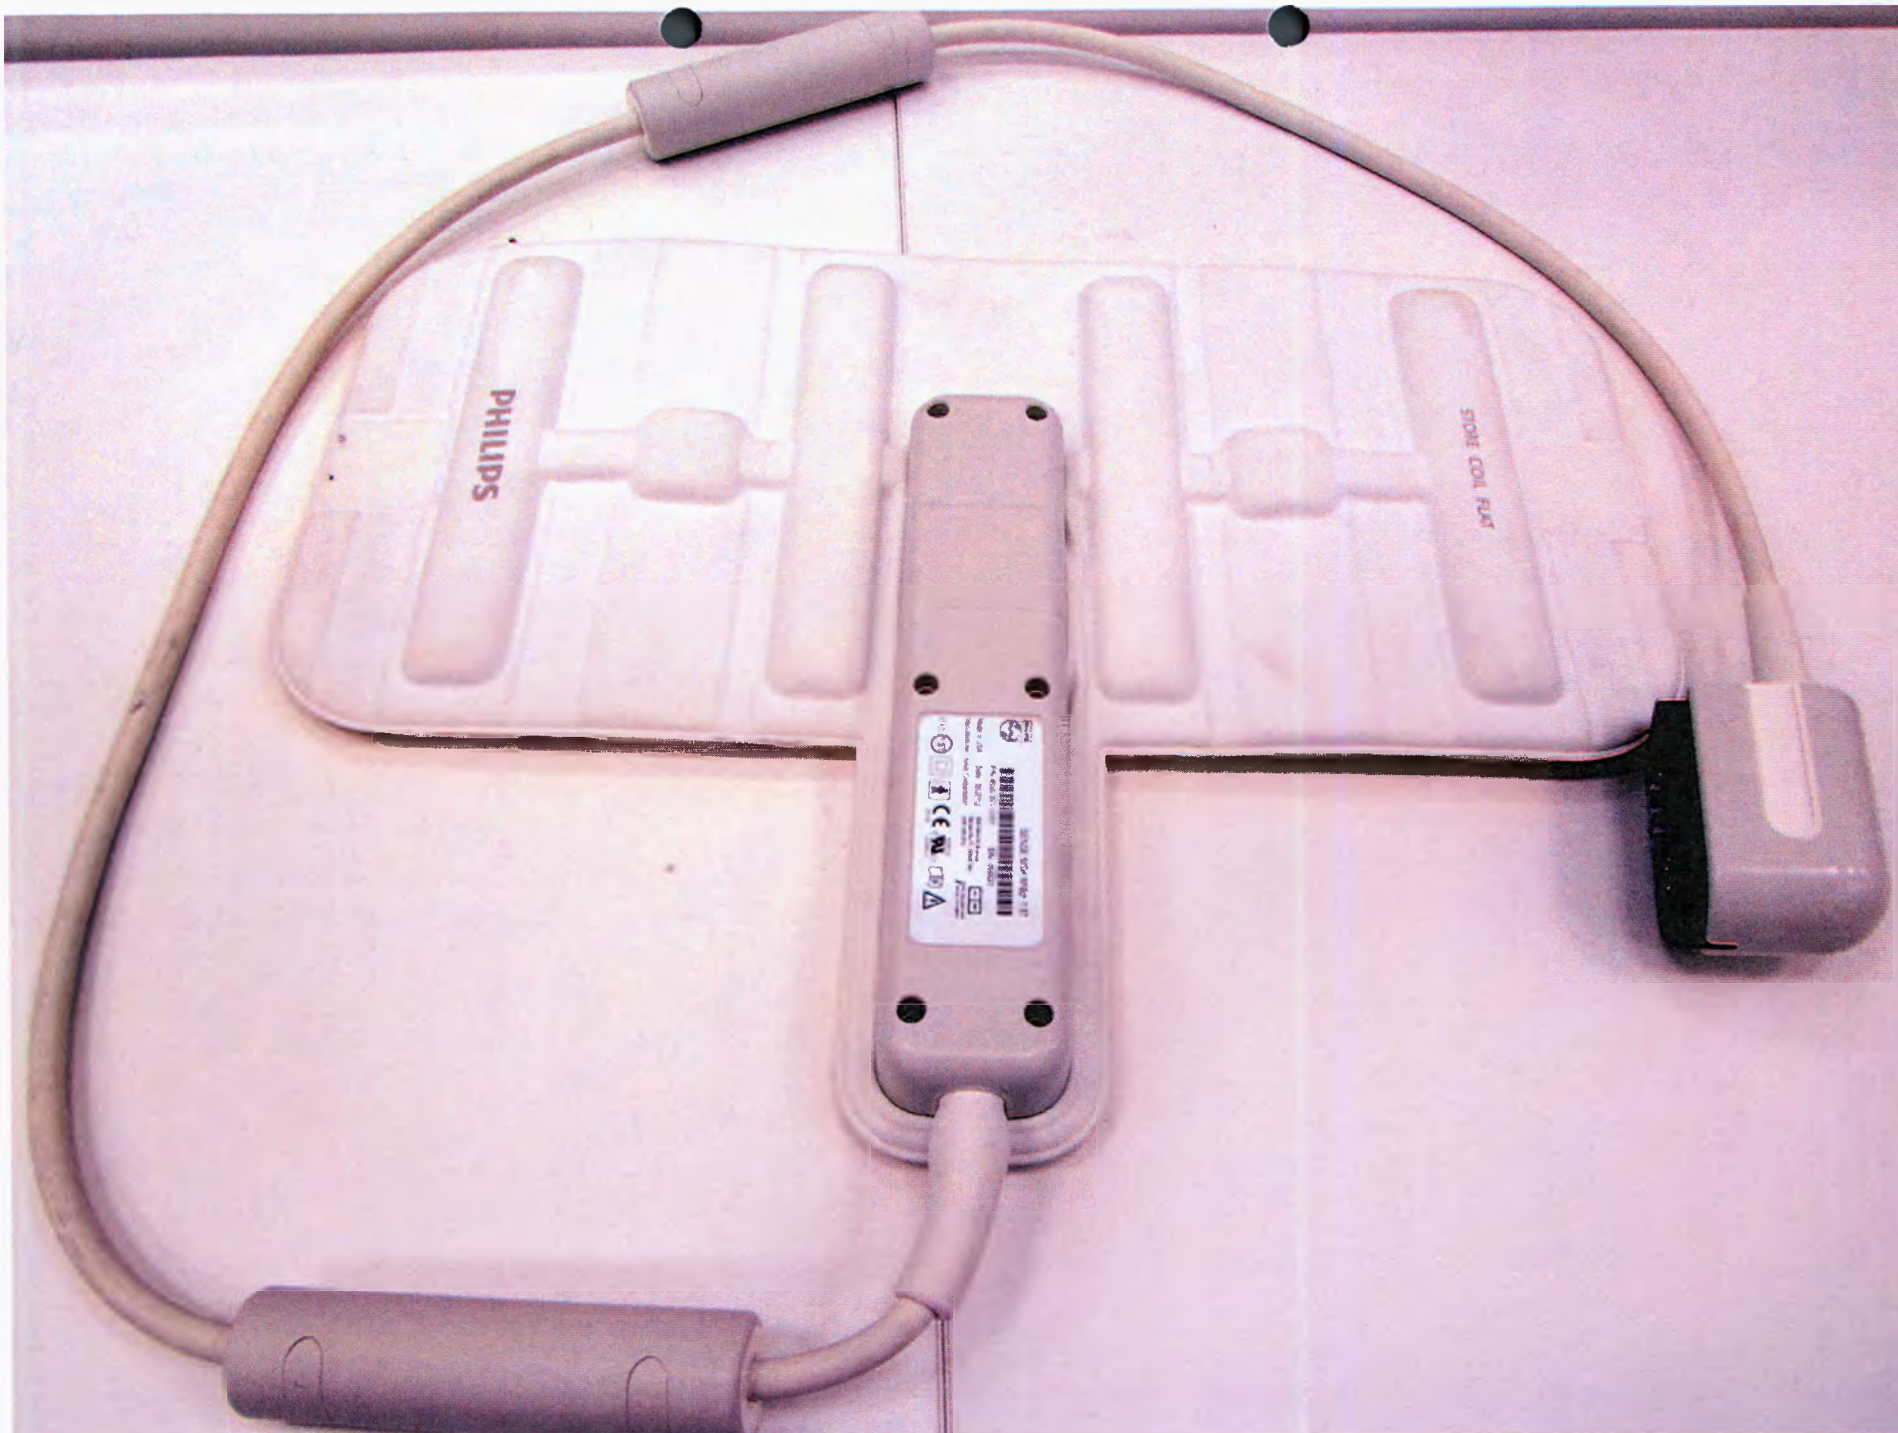


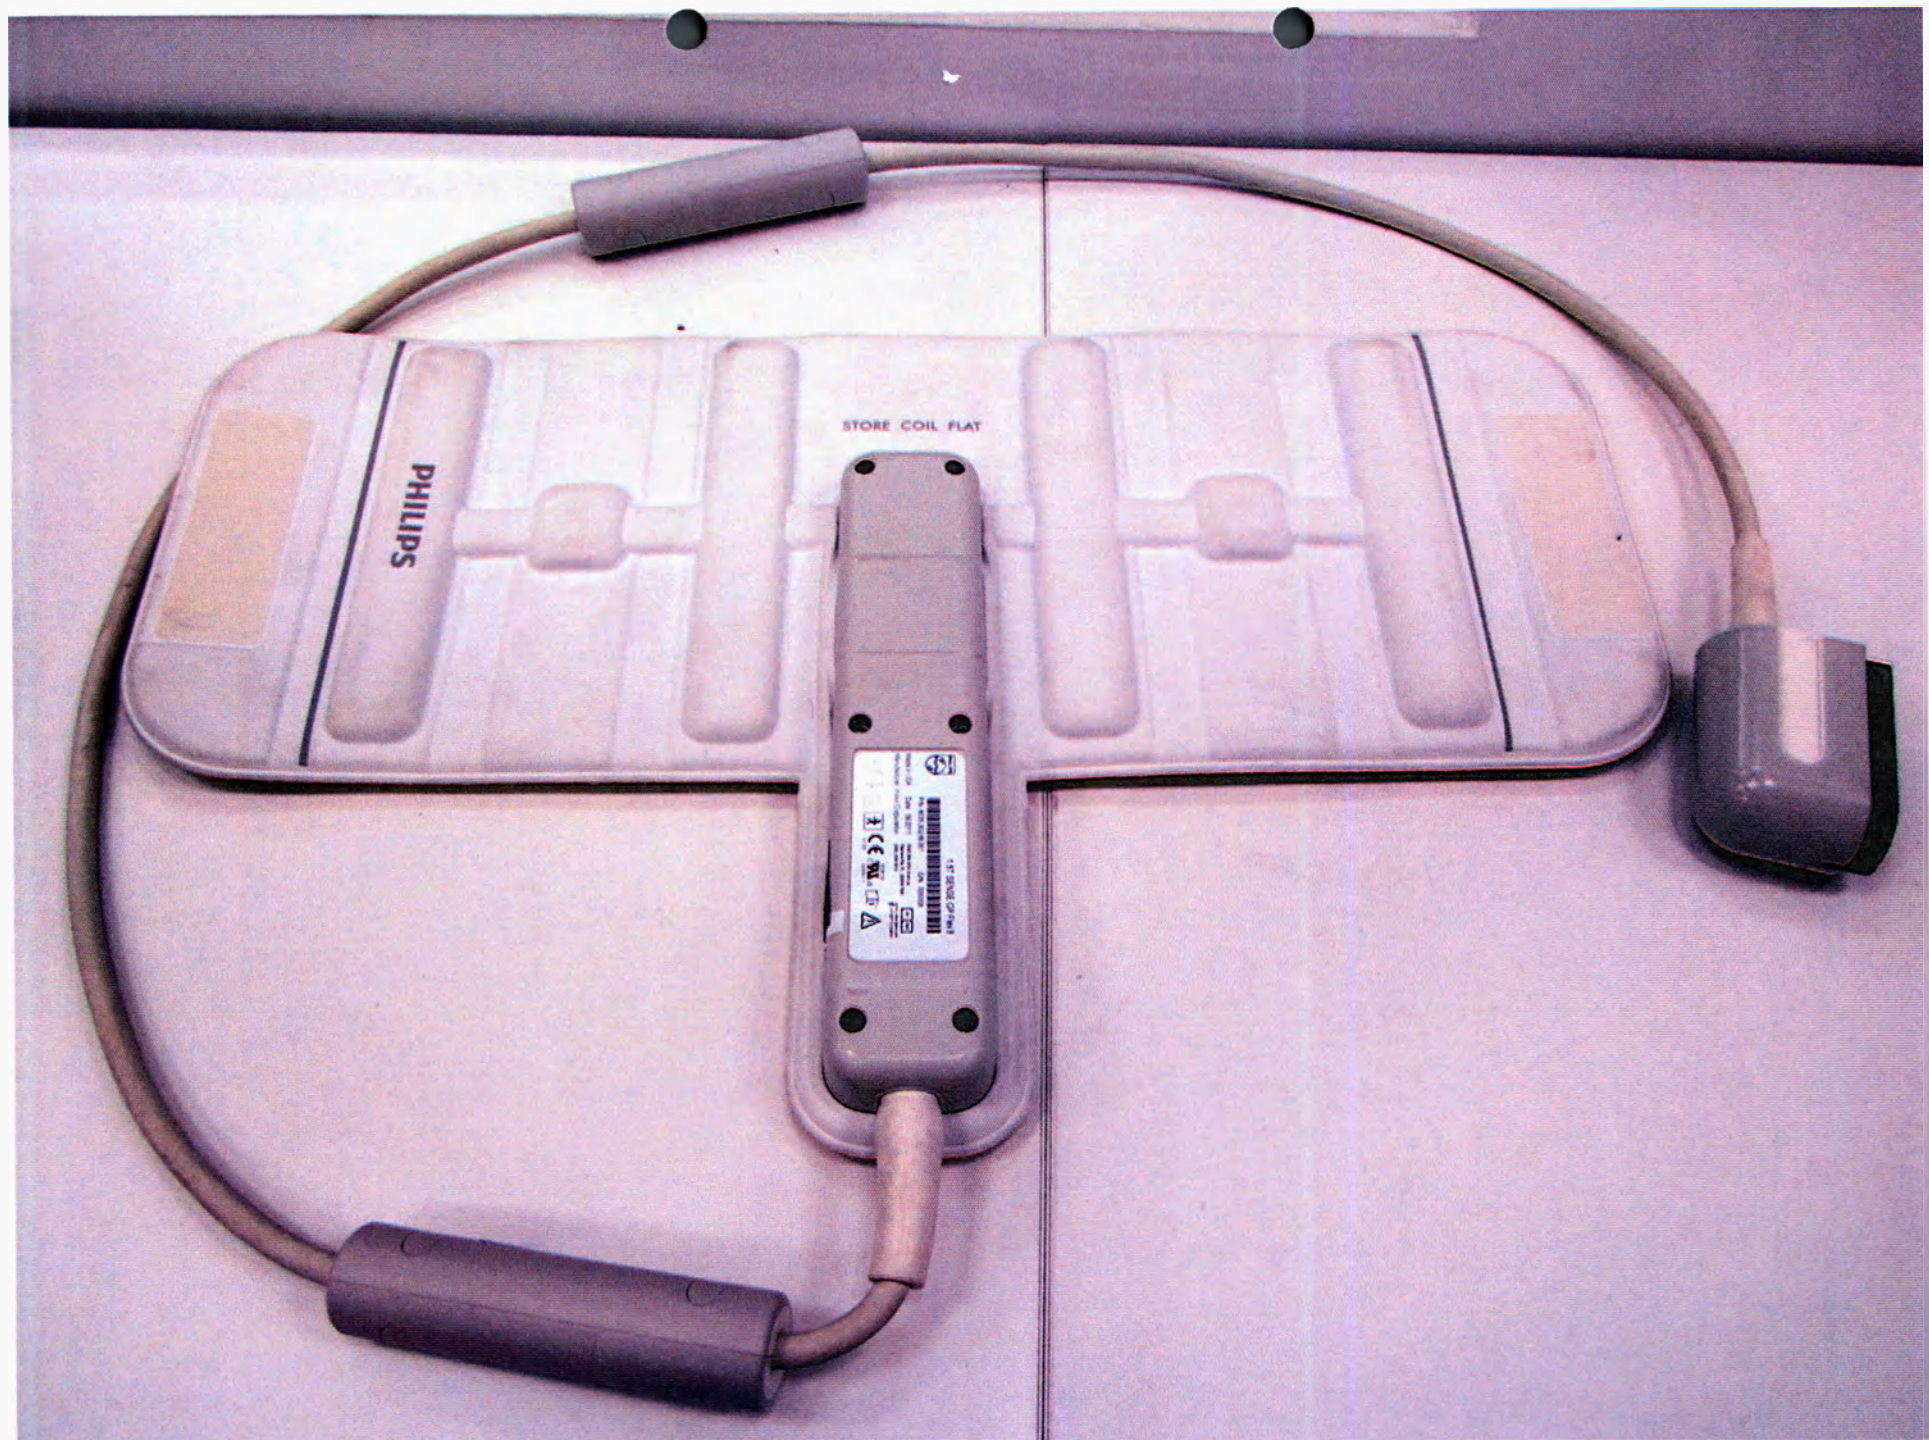



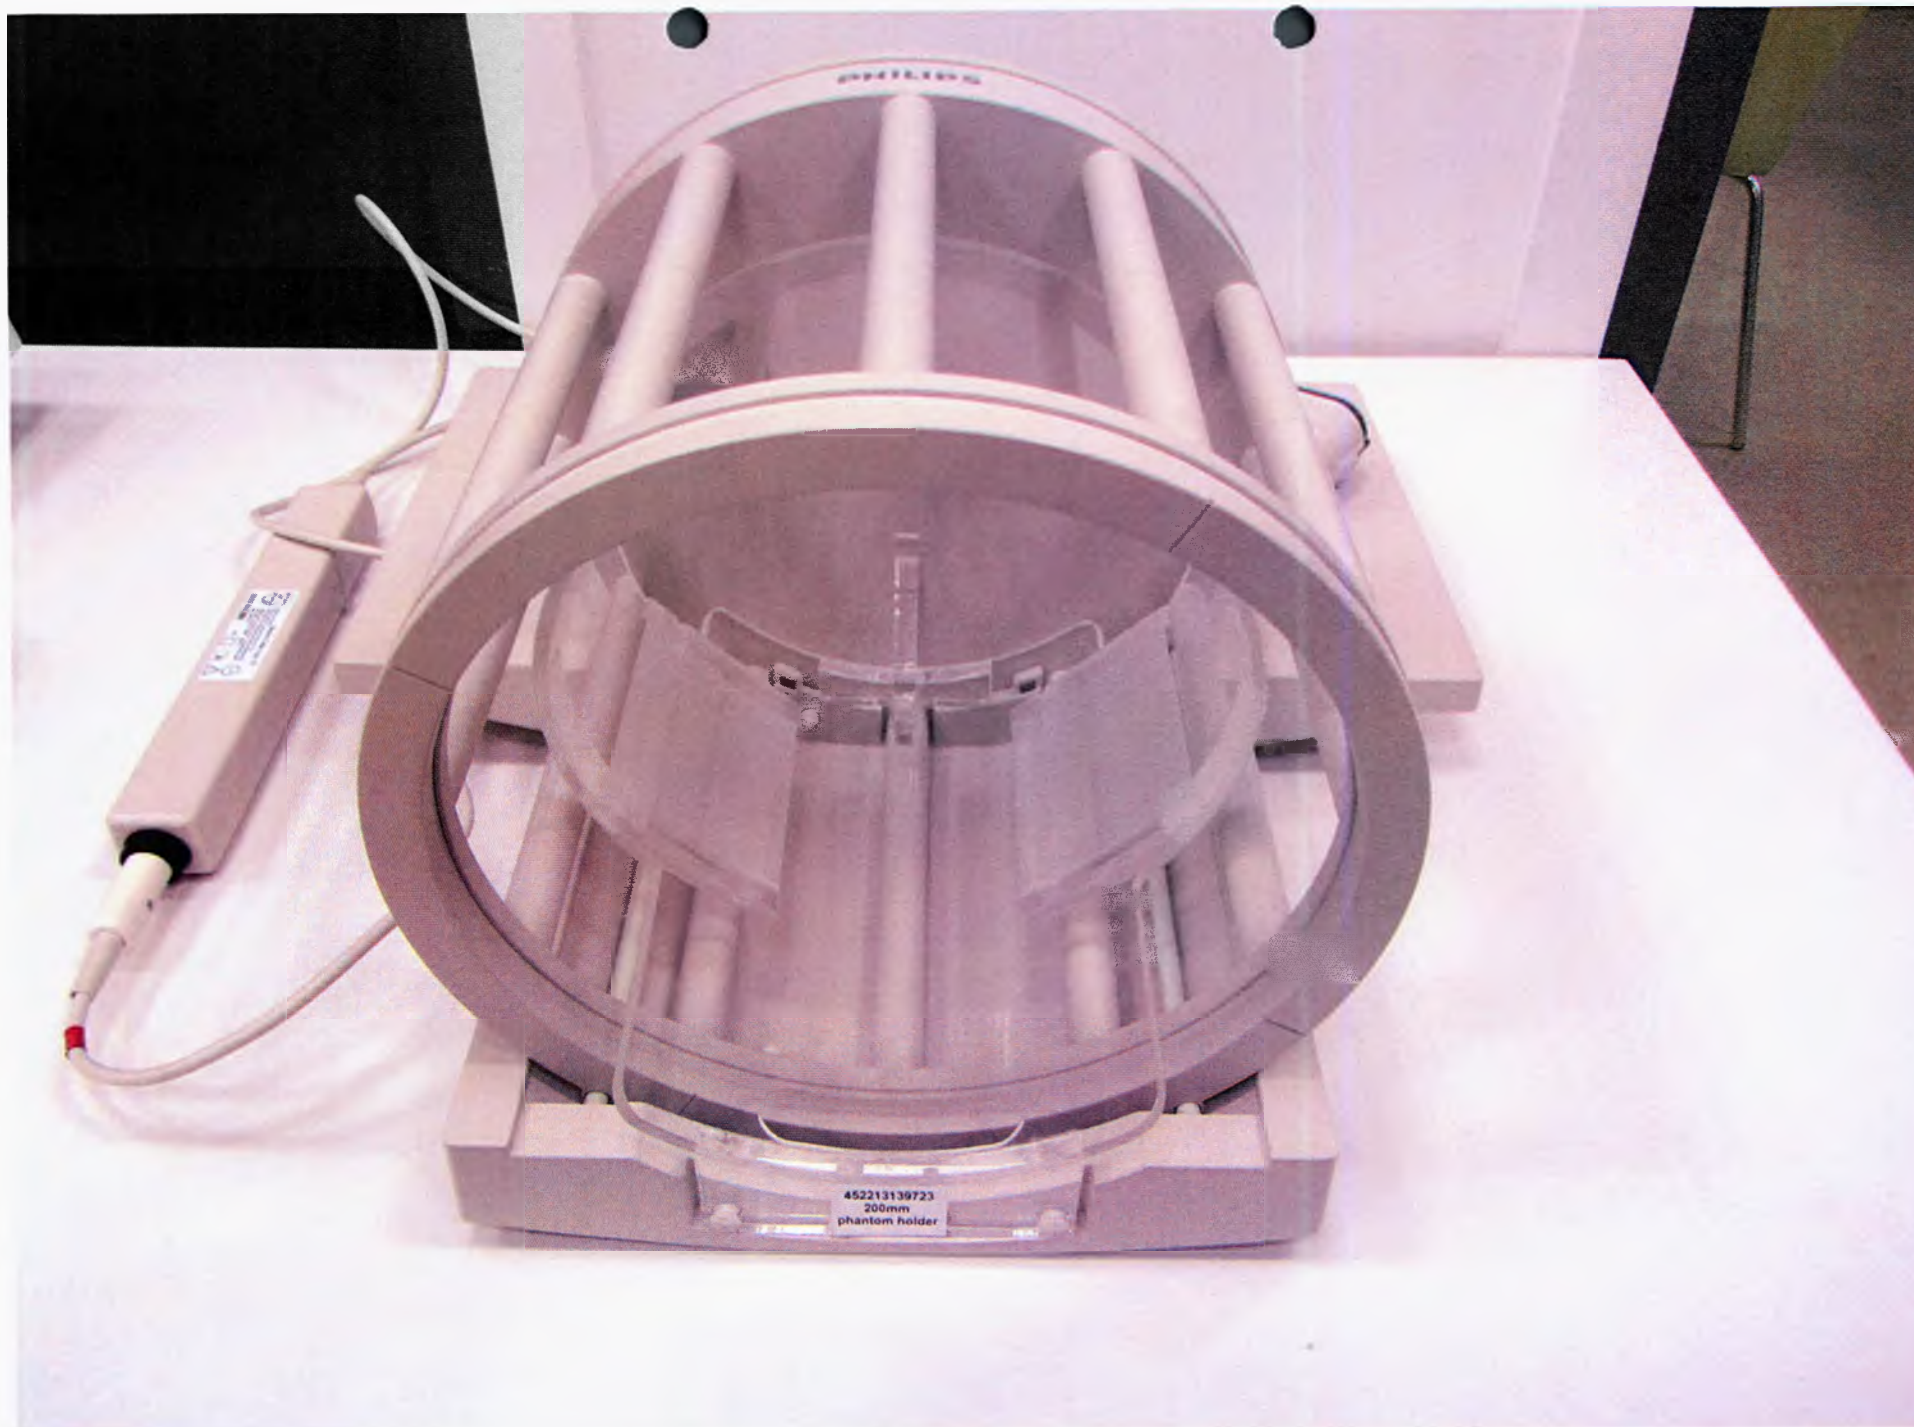

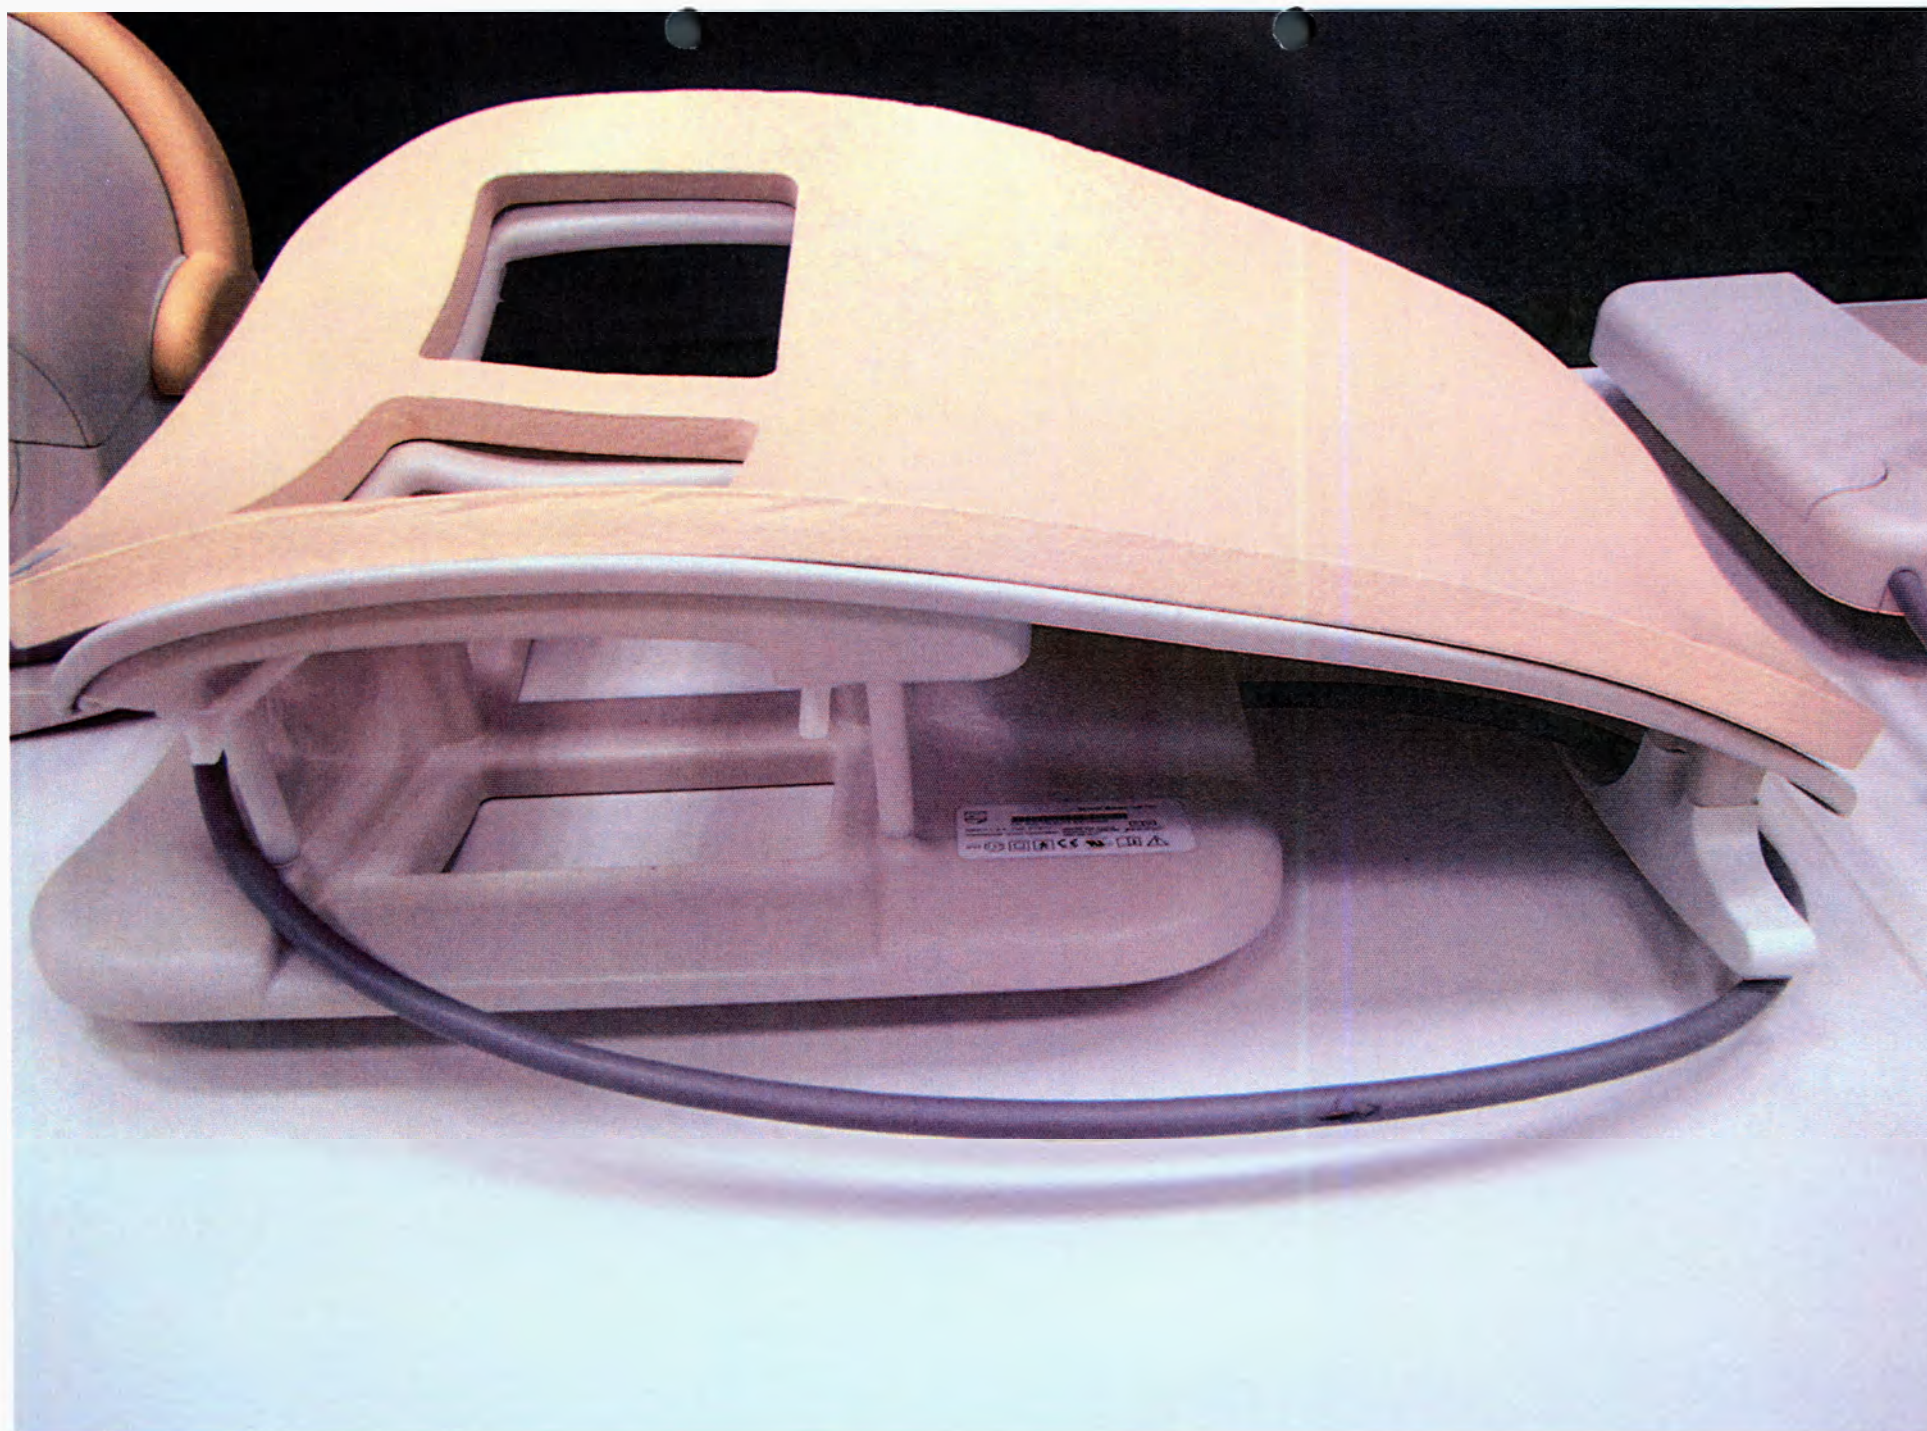

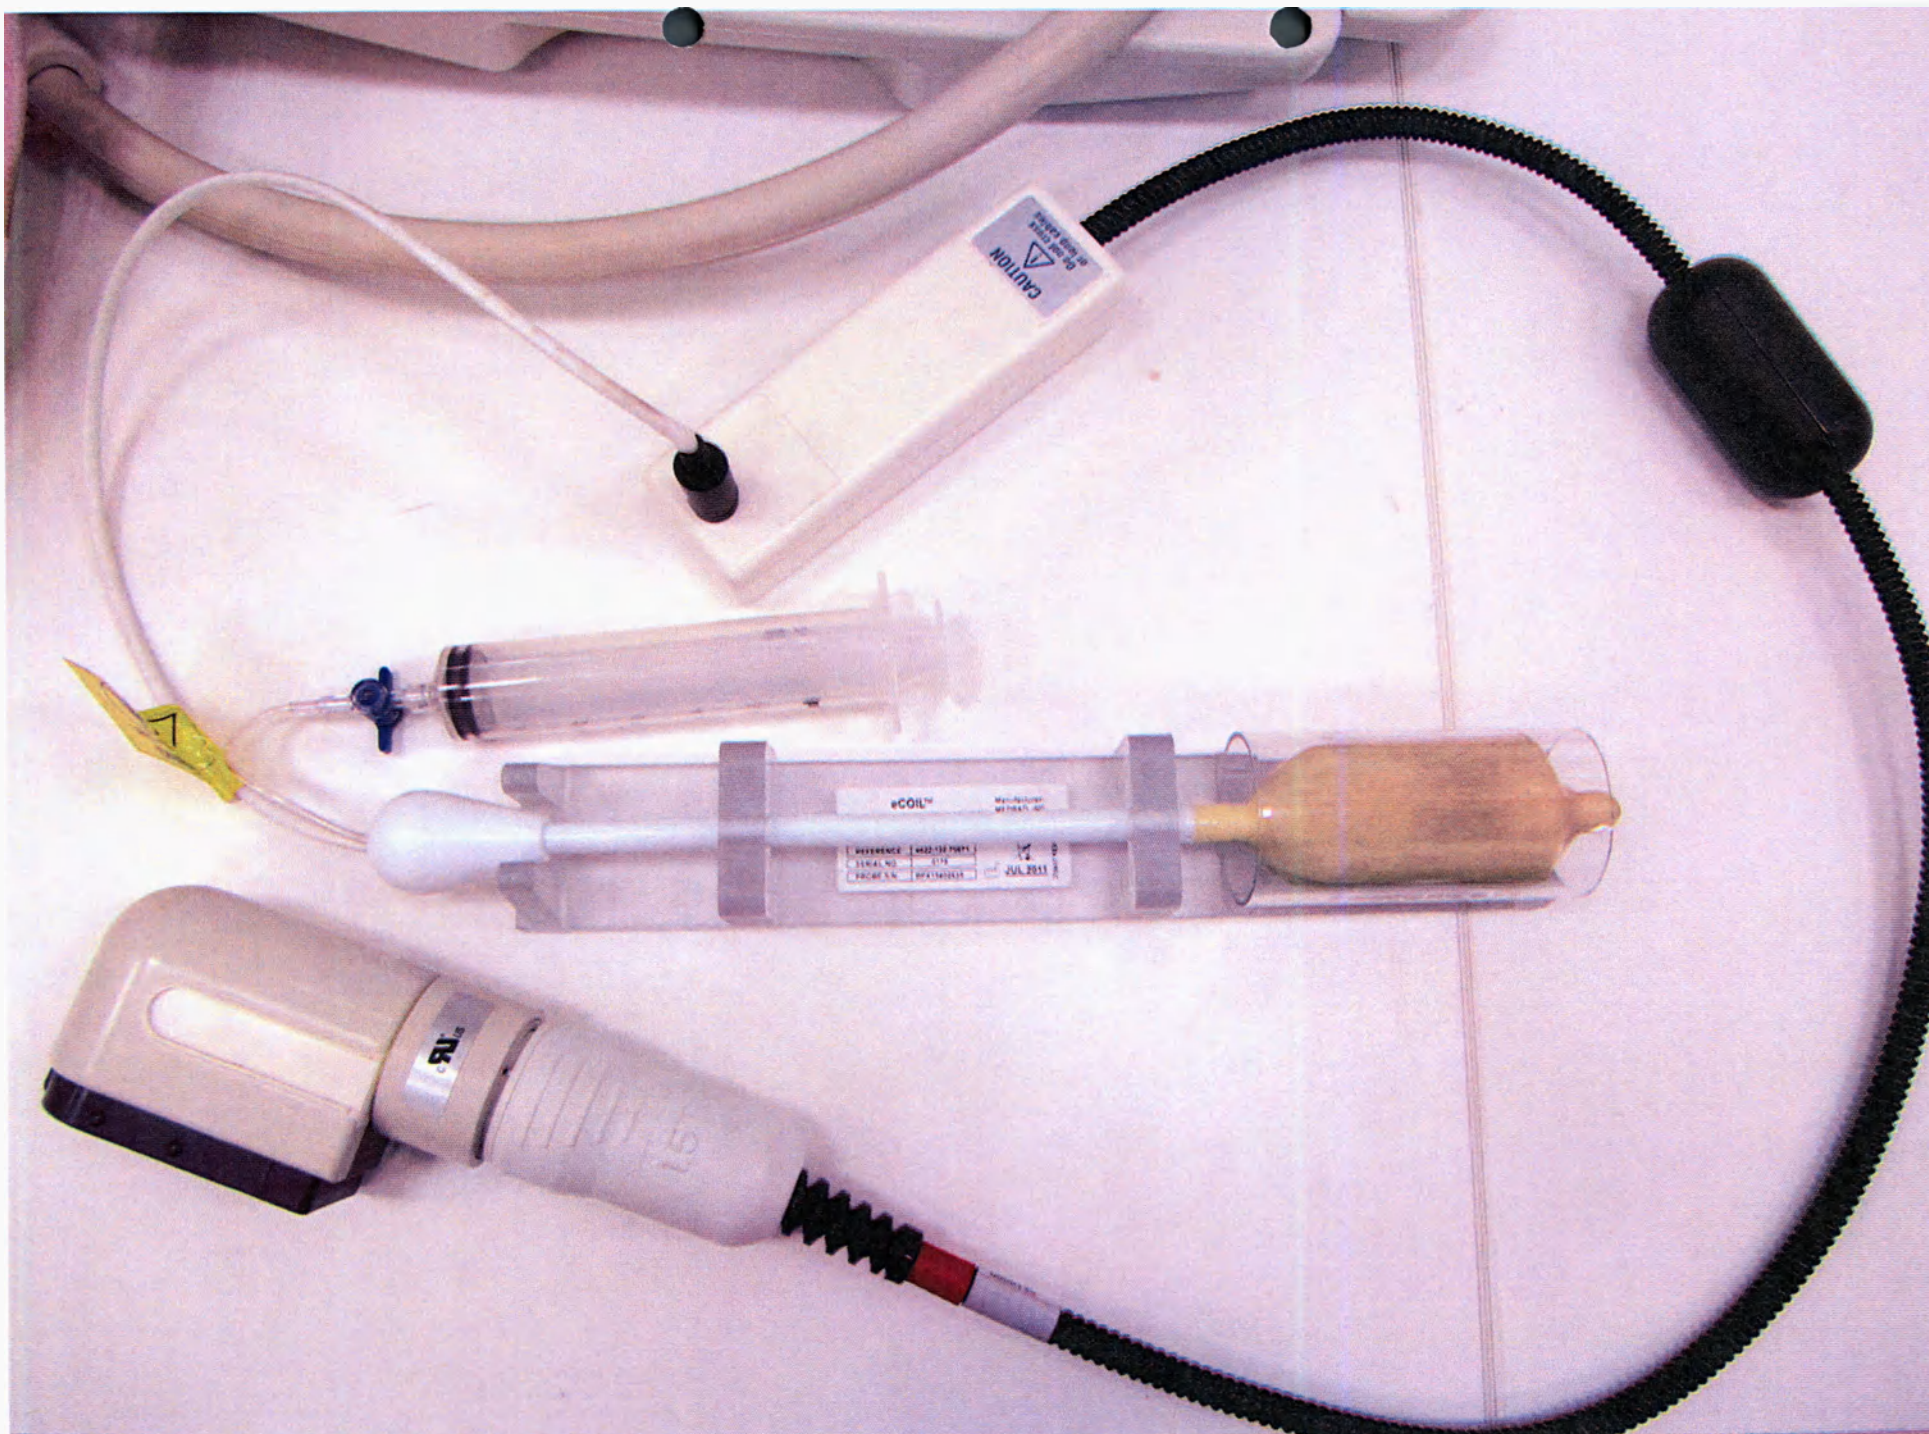






РЧ-катетер Sense Wrist 8







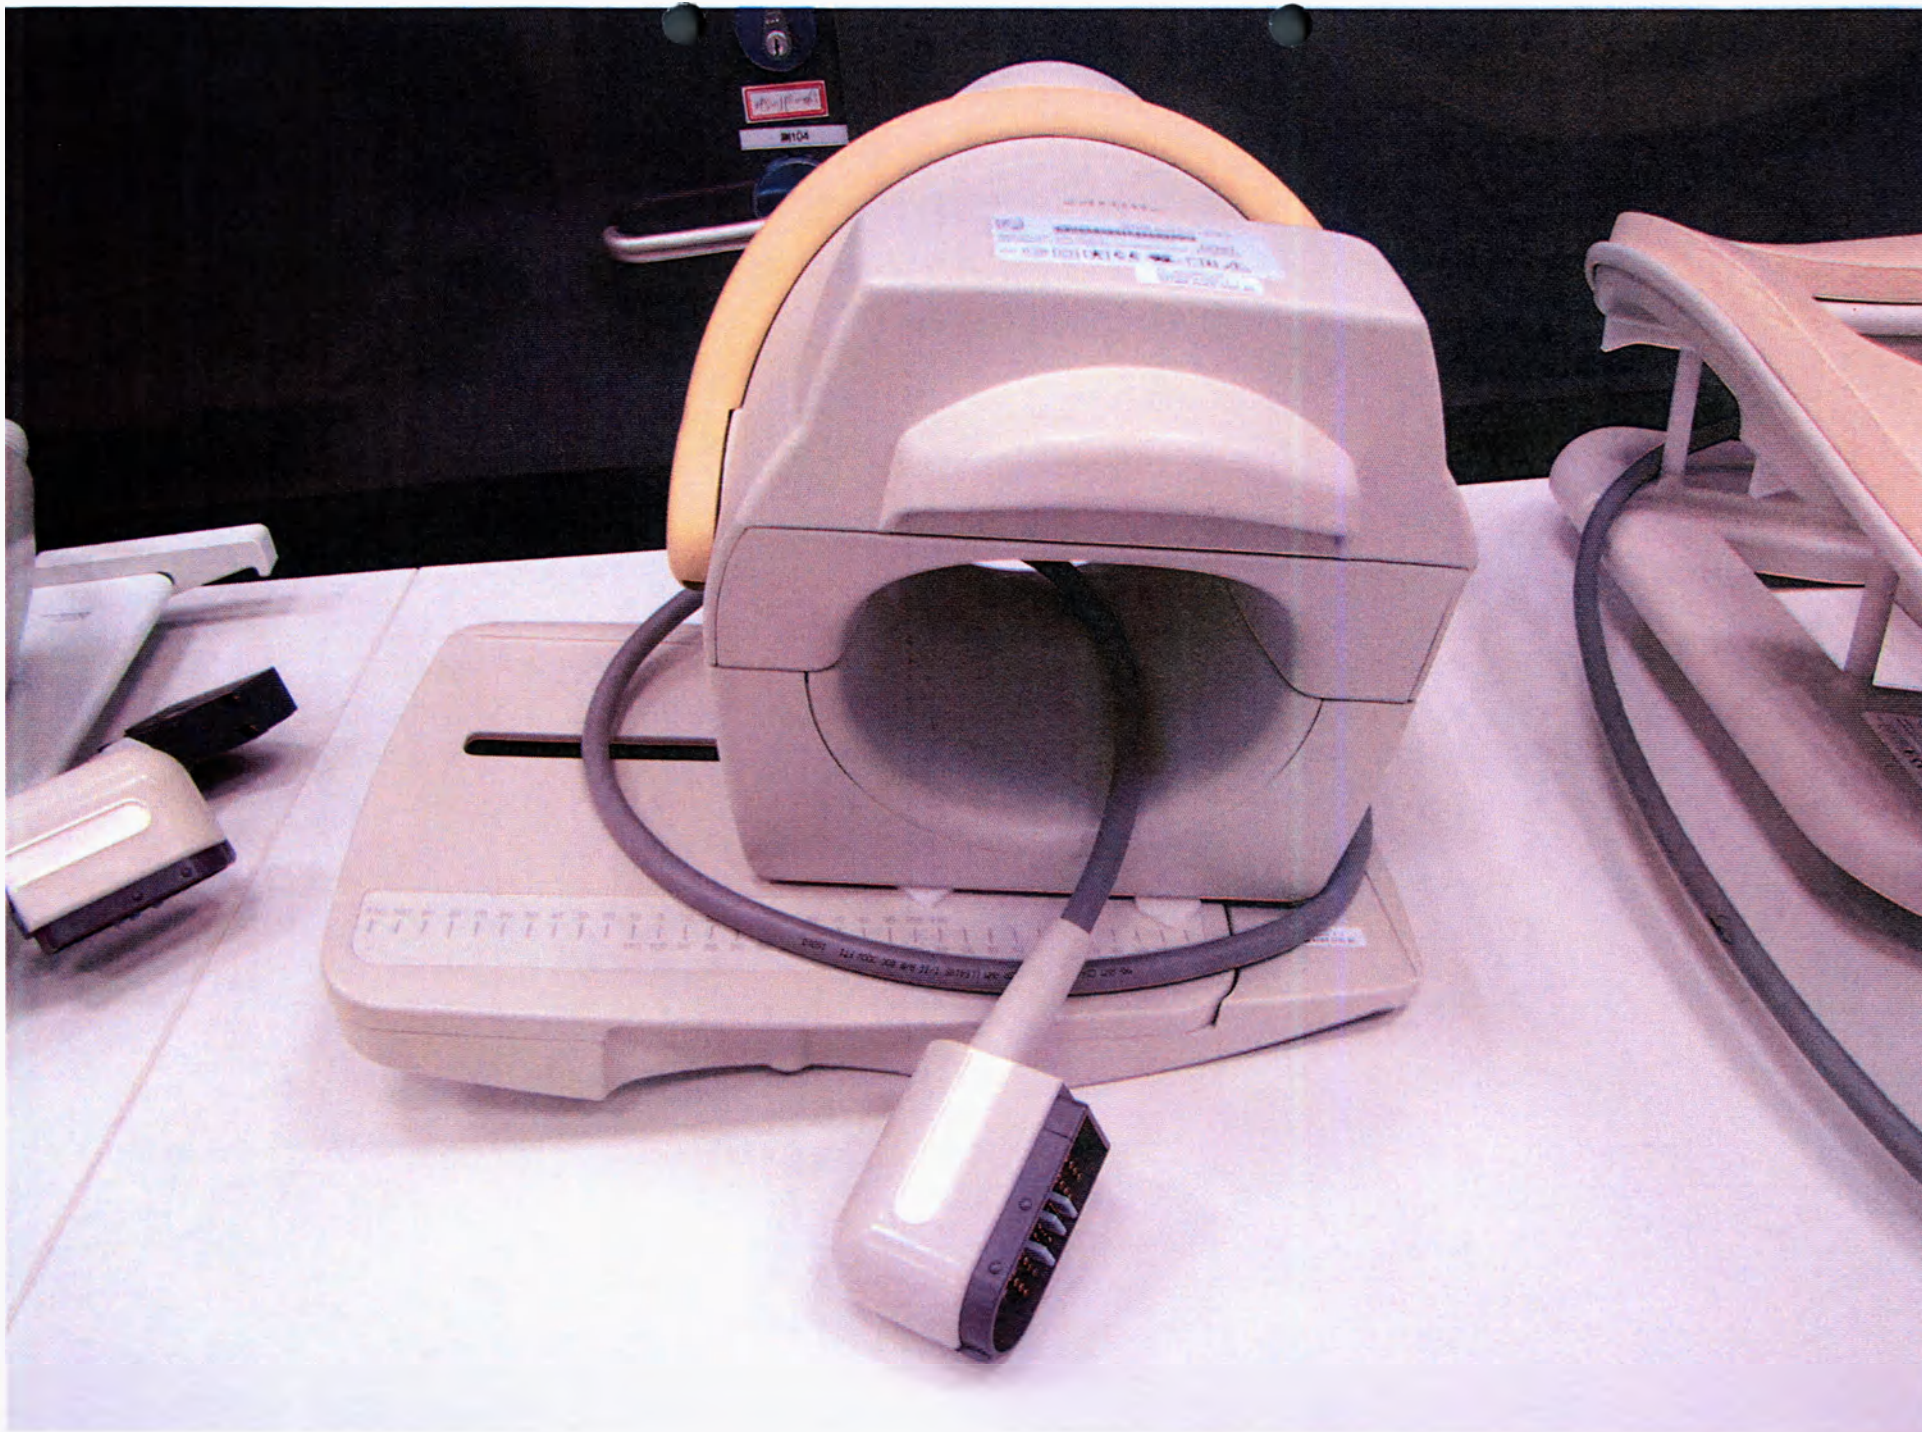







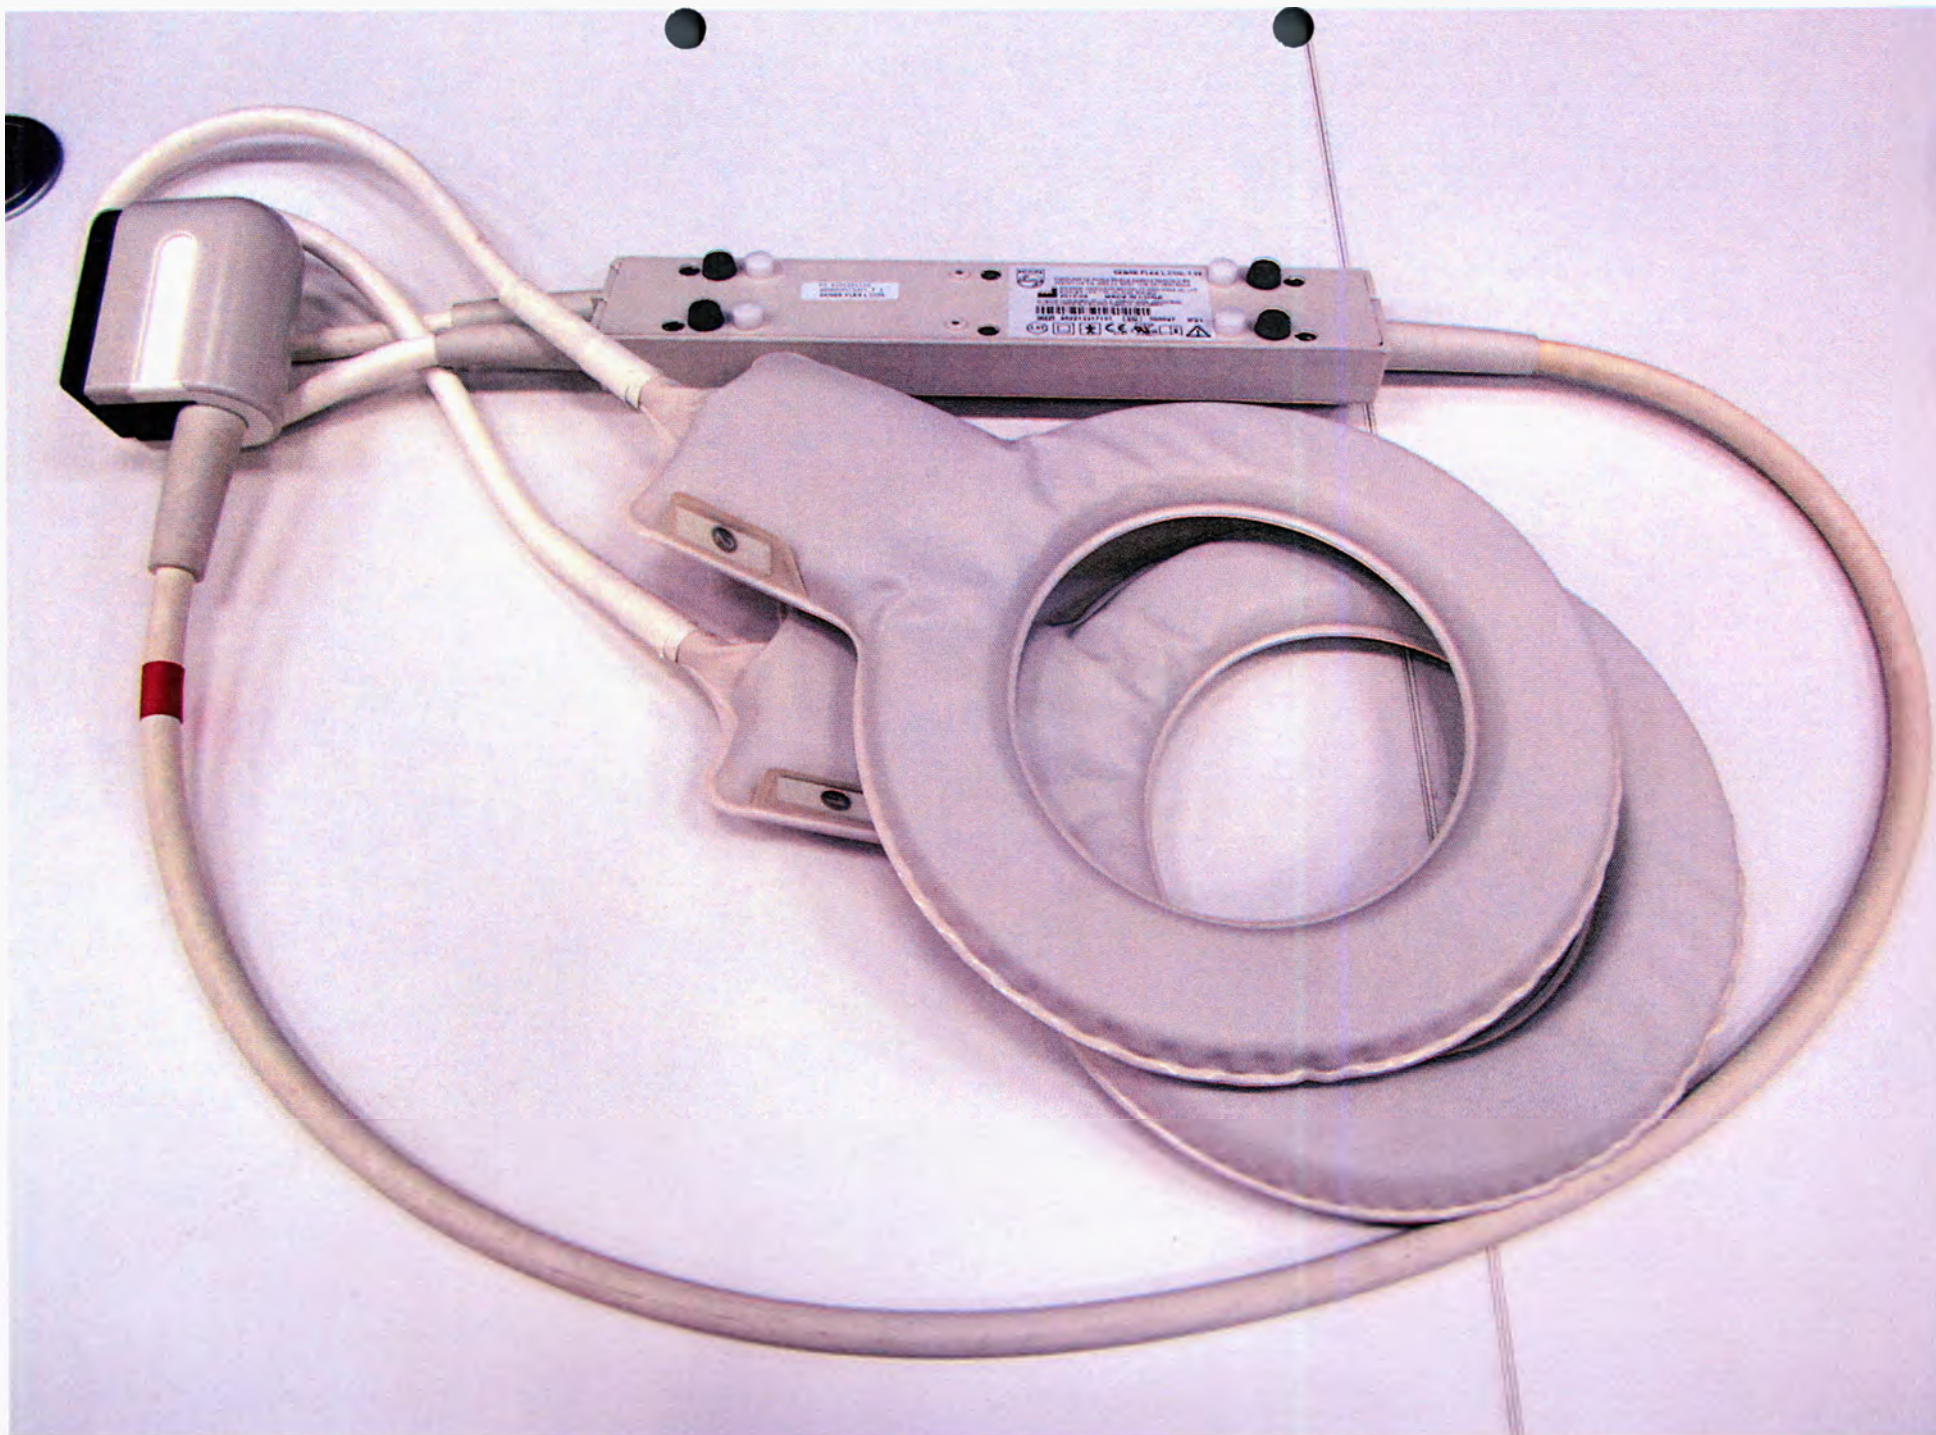

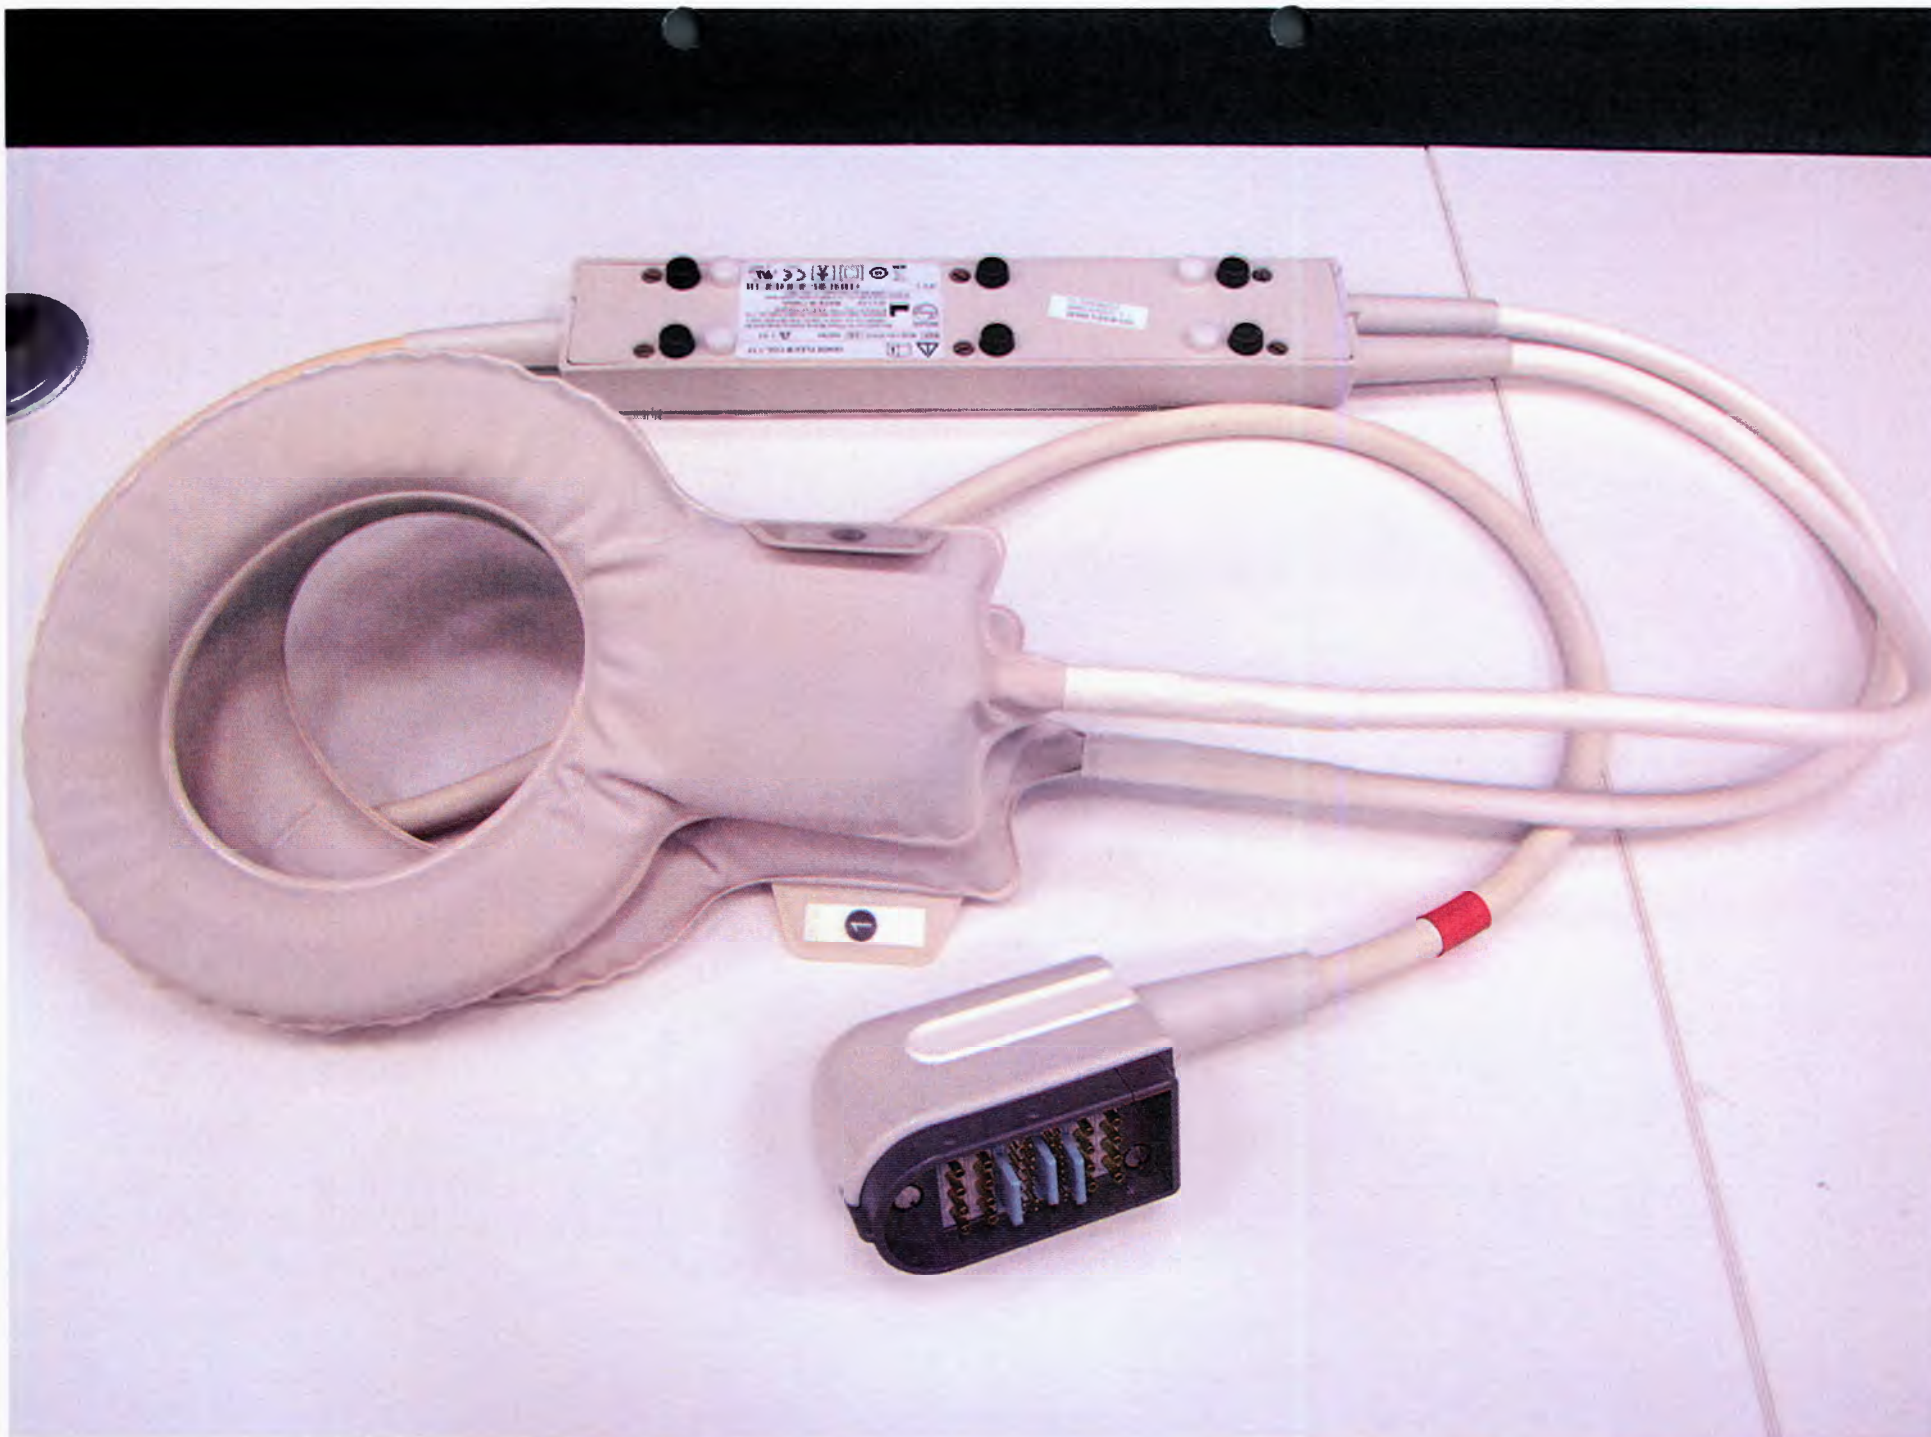


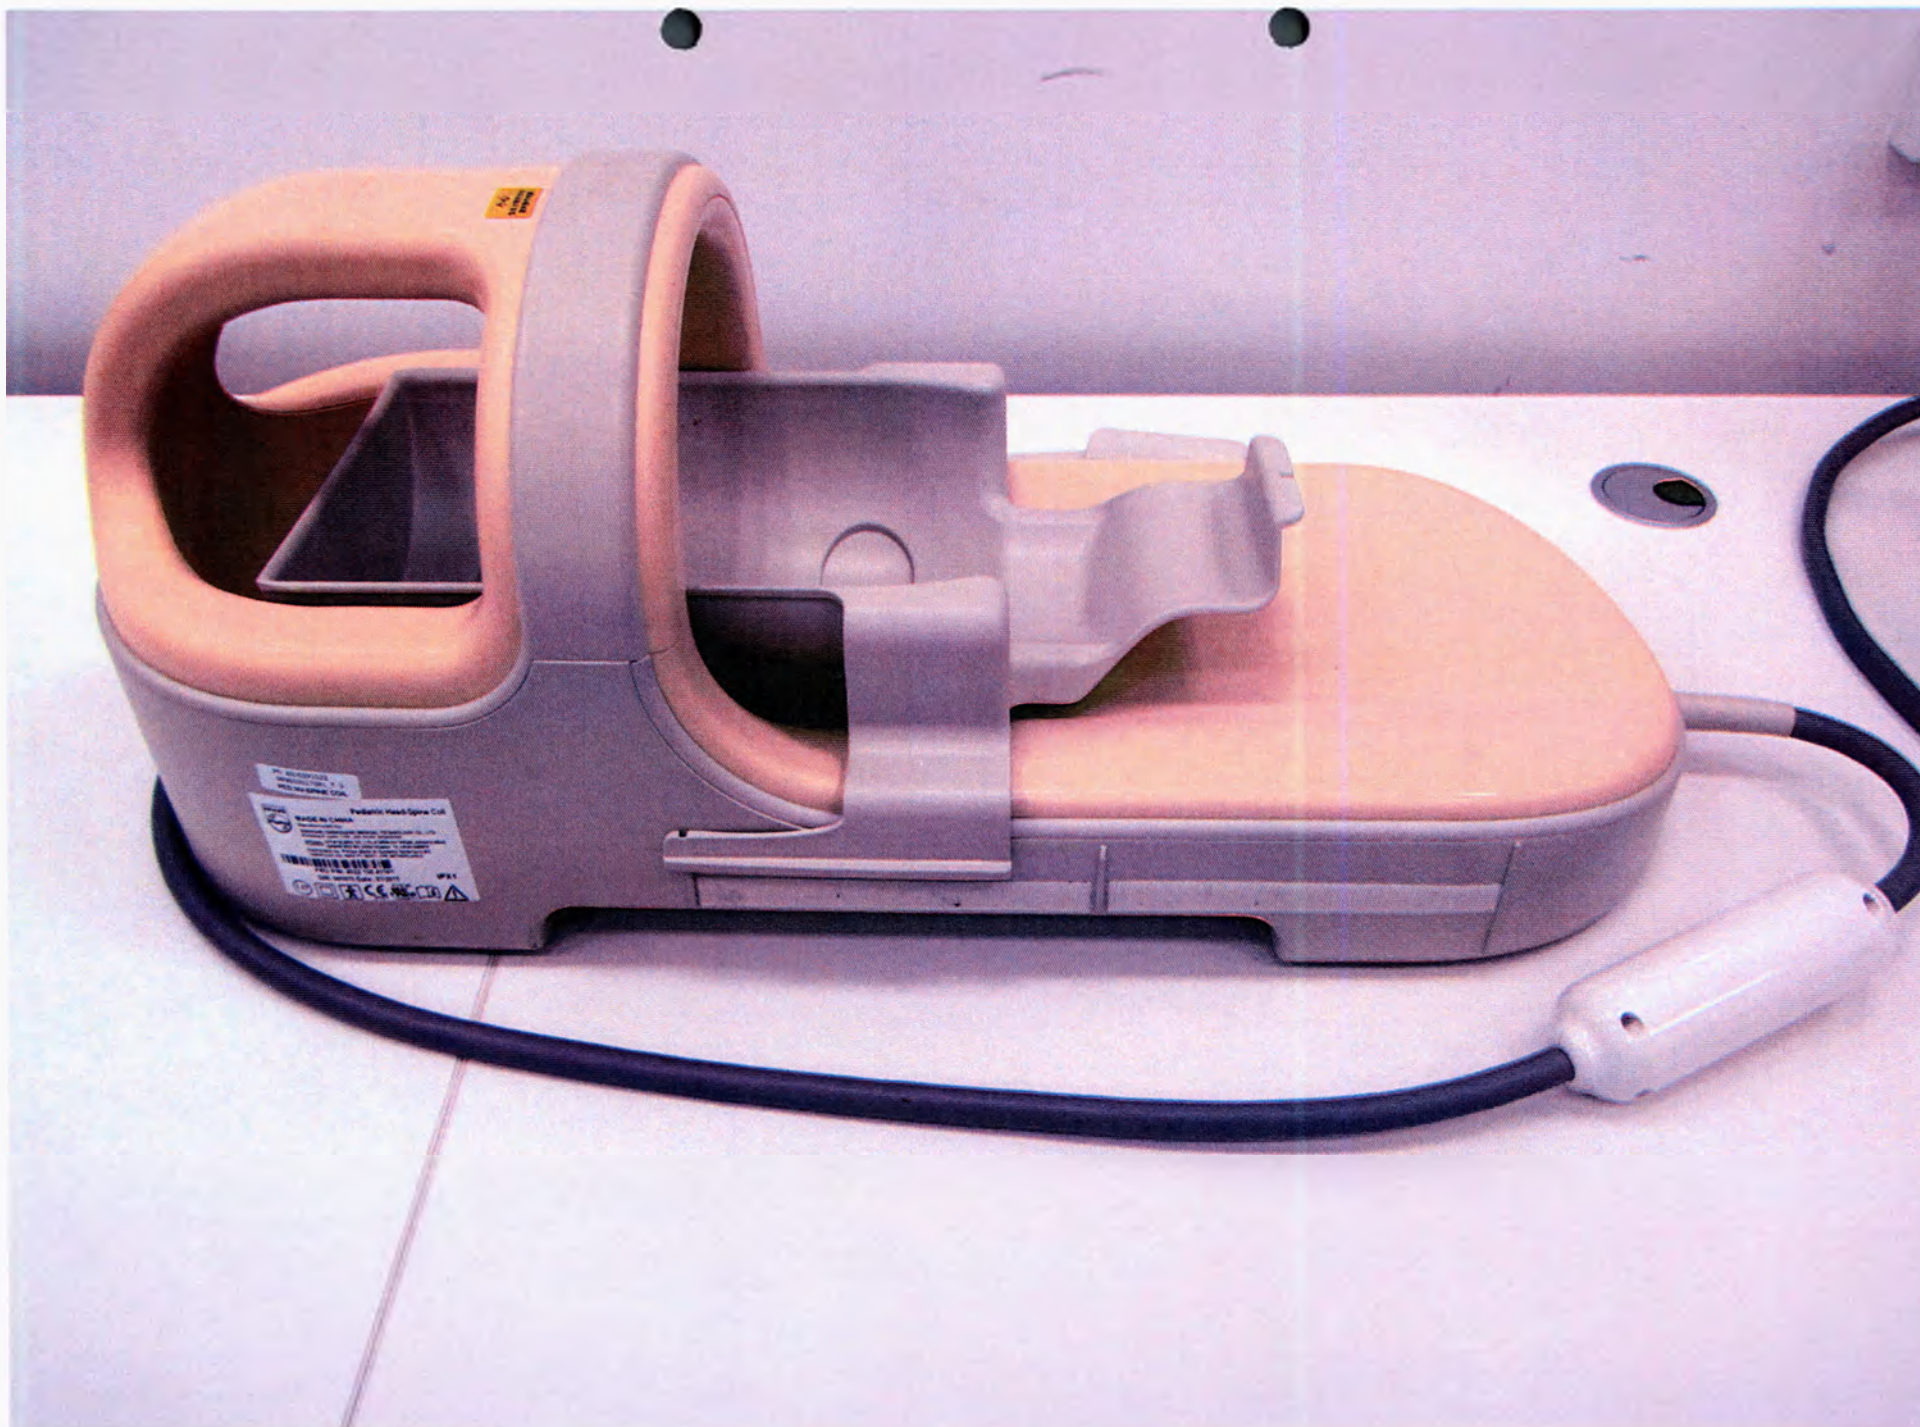



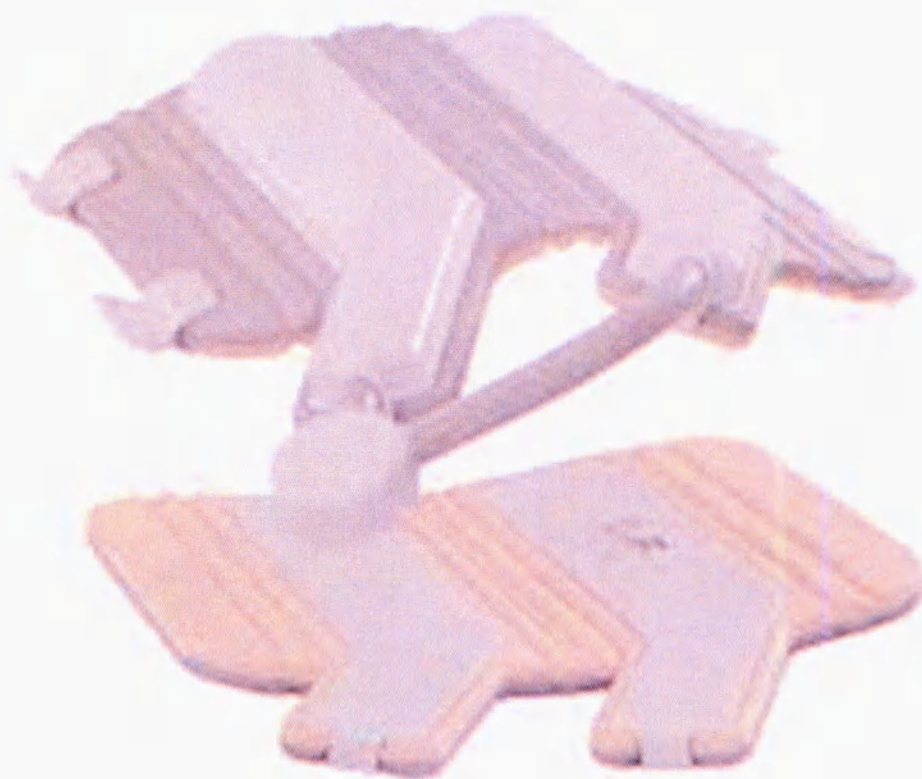


РЧ-катетер Sense Cardiac 32

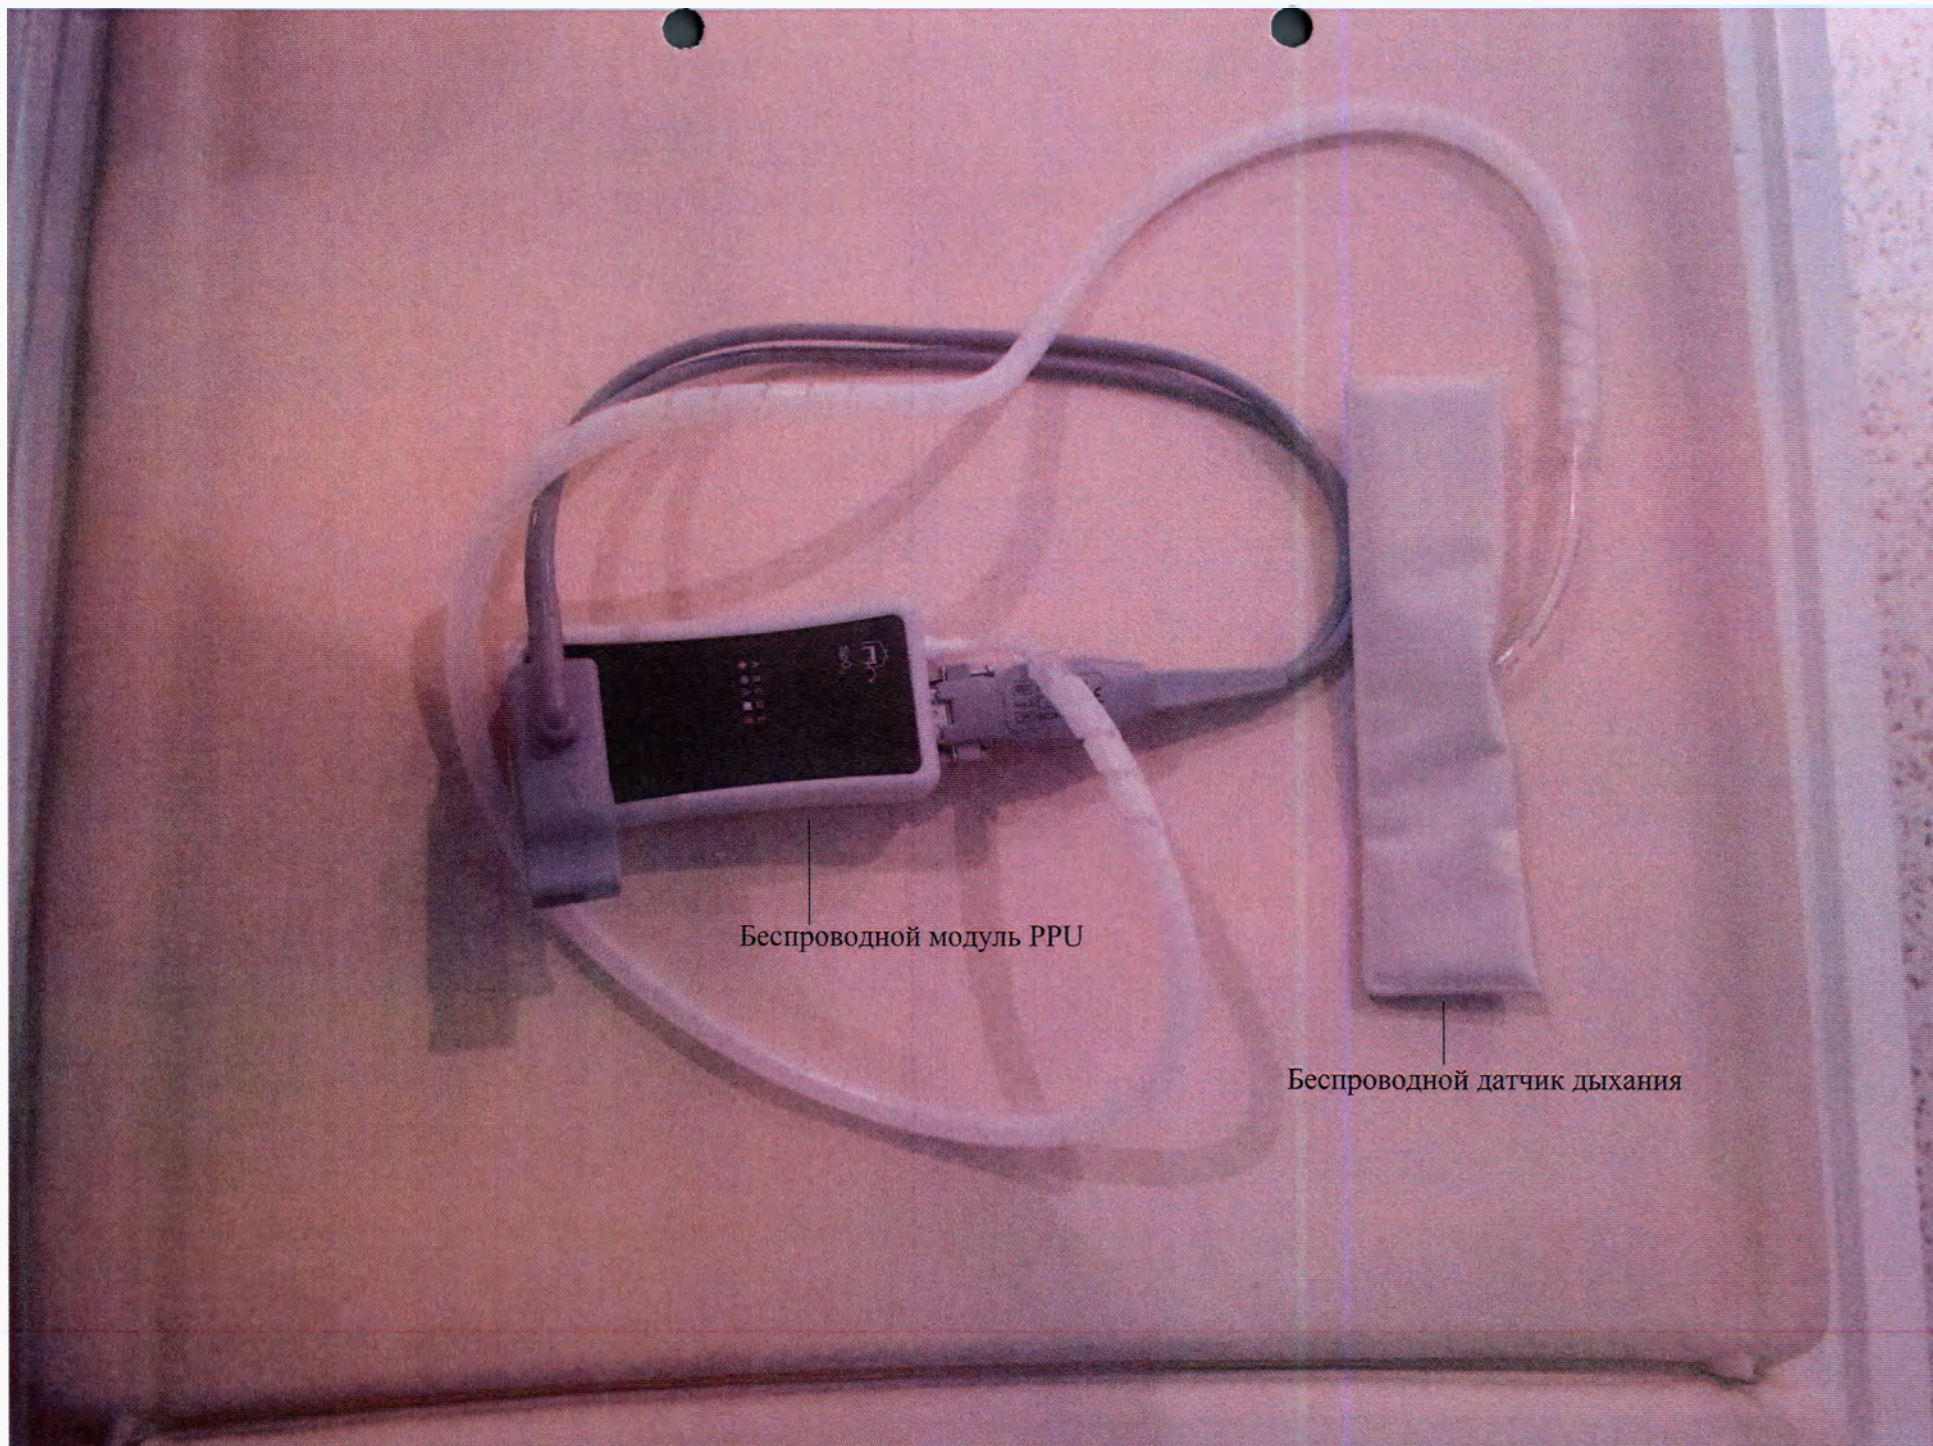


Беспроводной модуль RPU


Беспроводной датчик дыхания




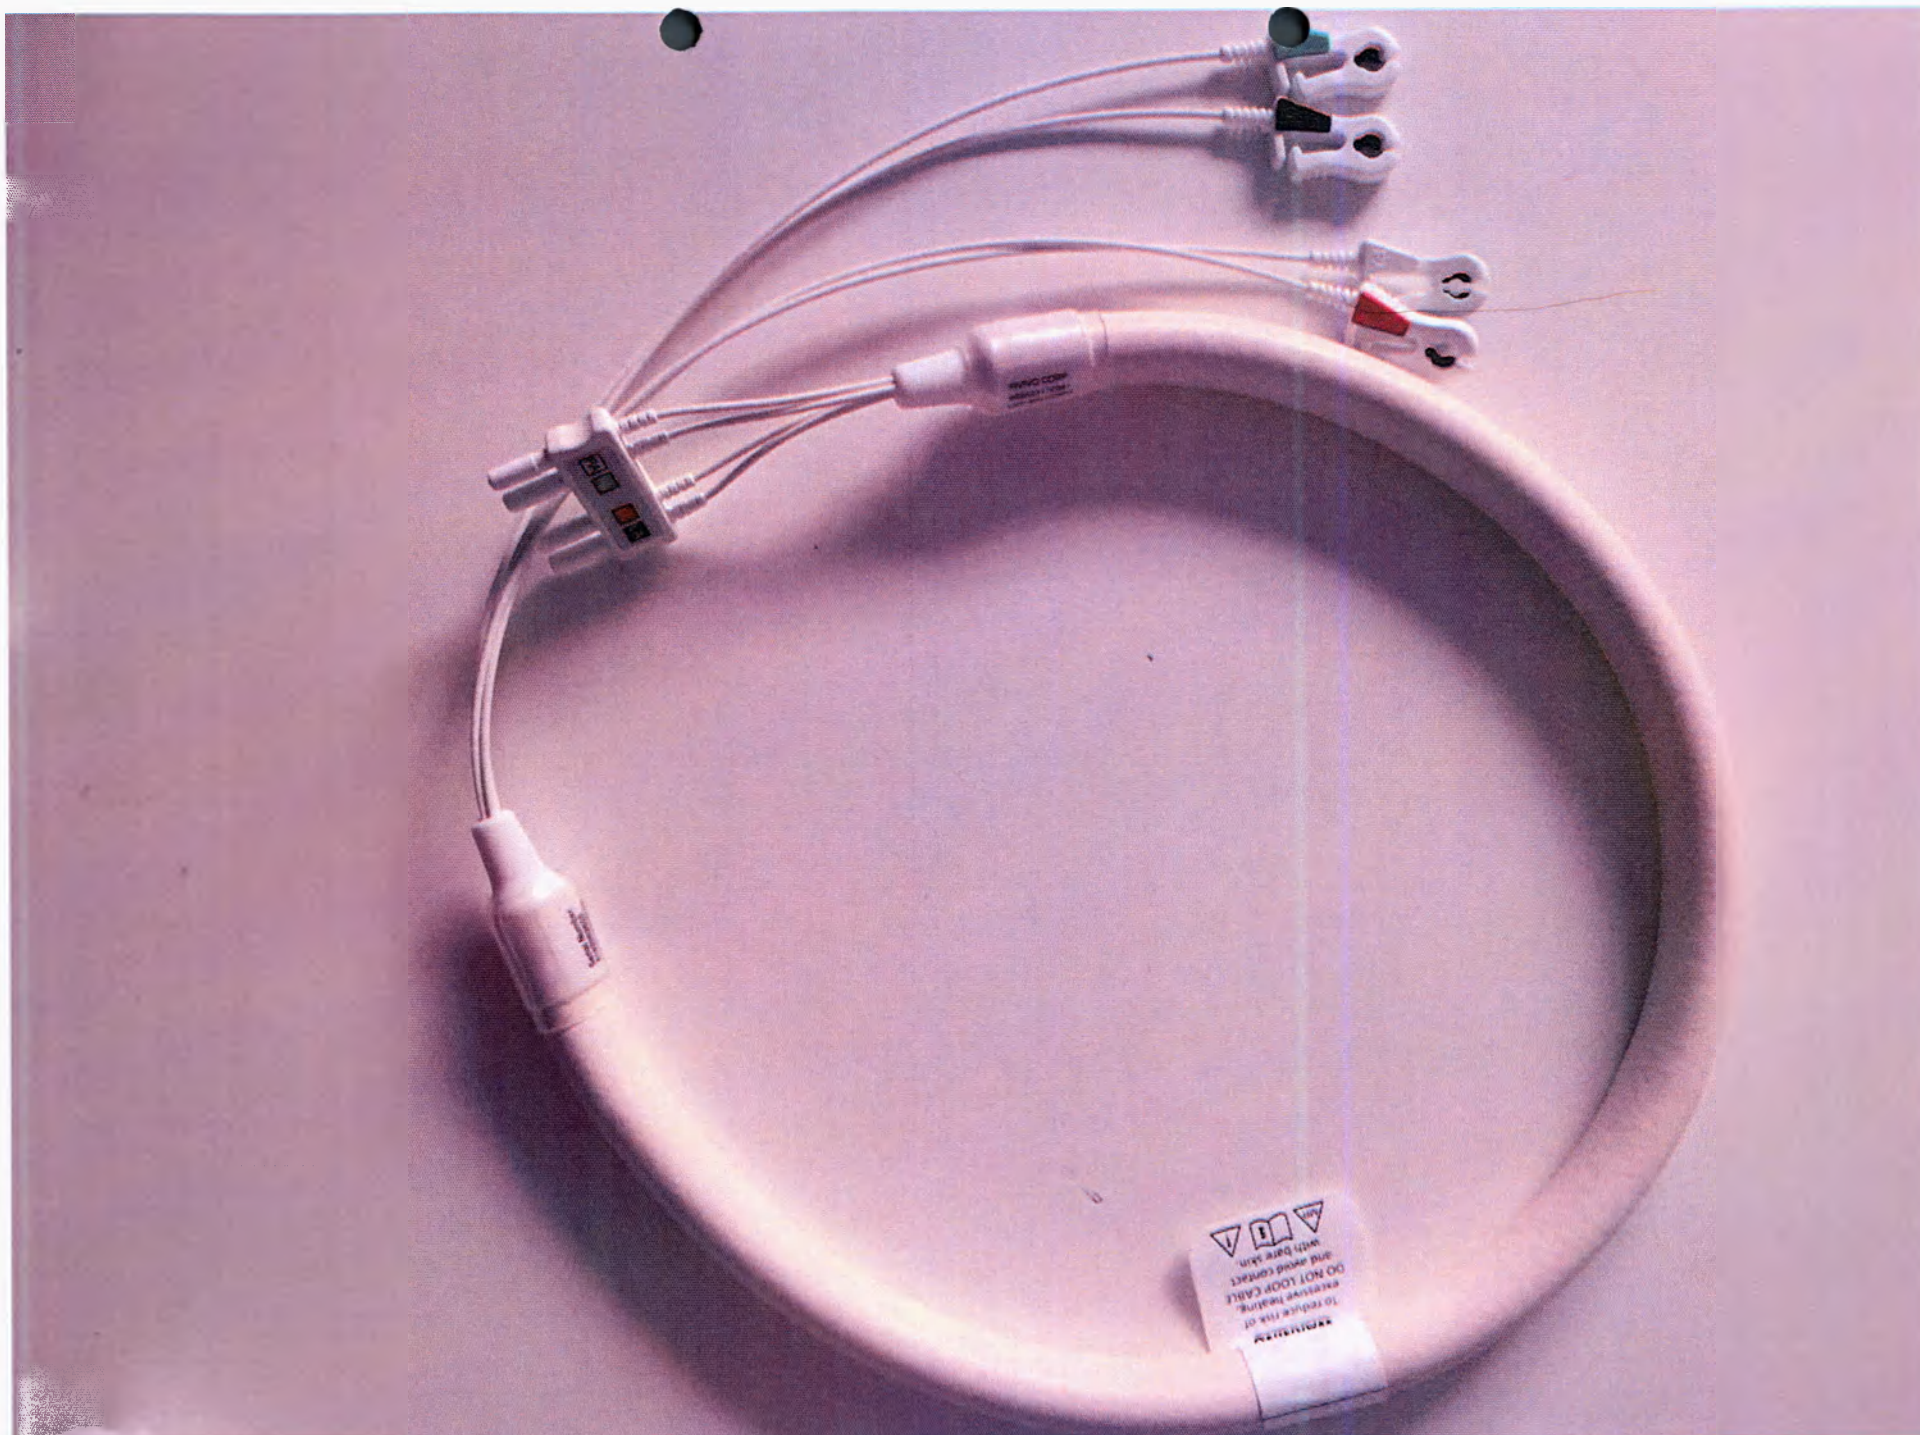



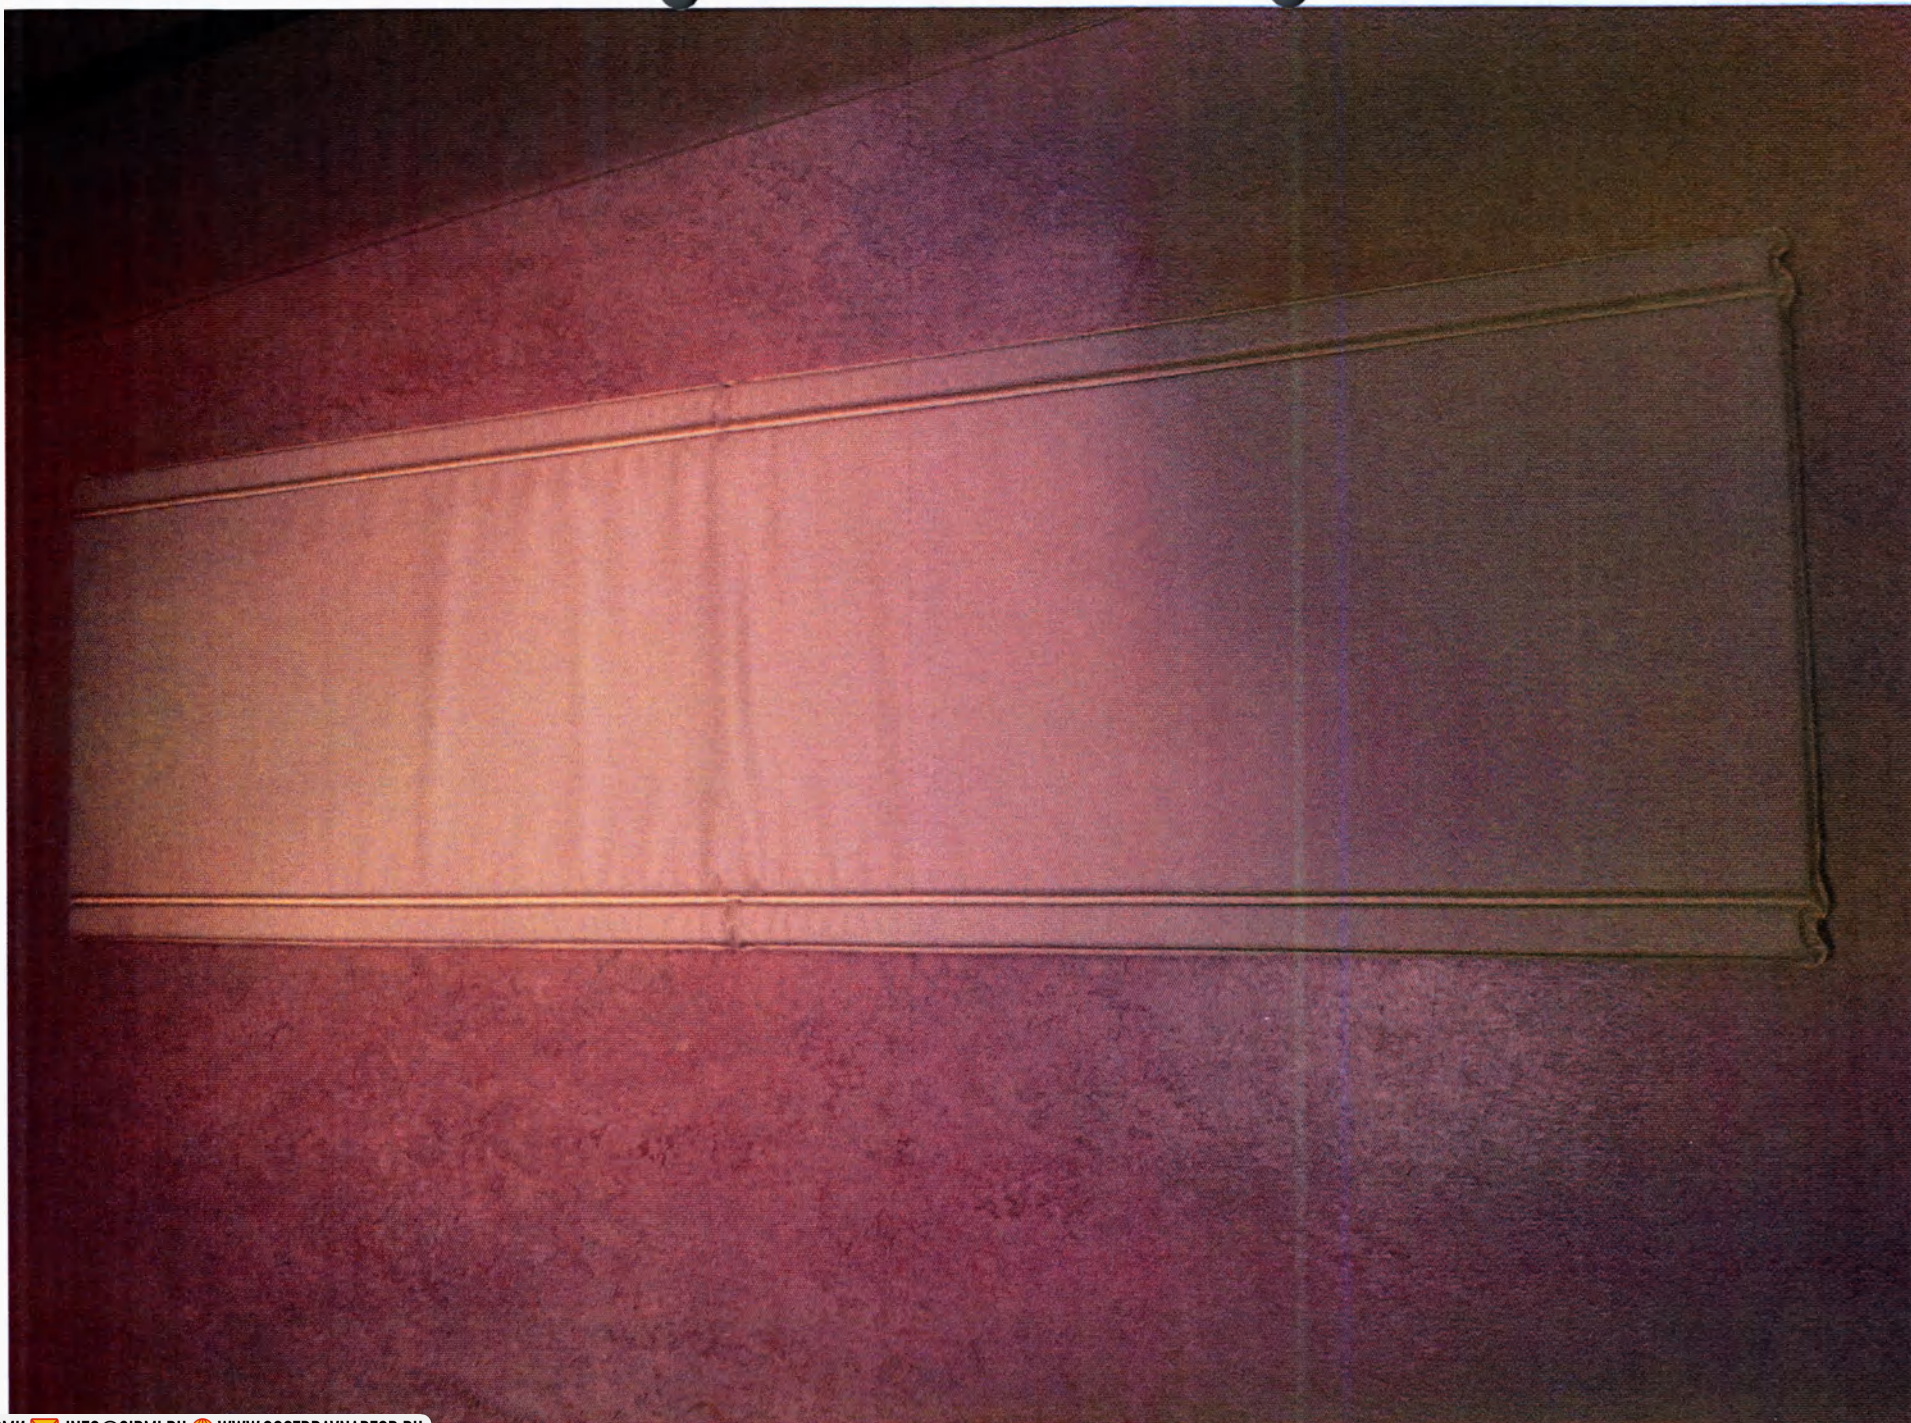


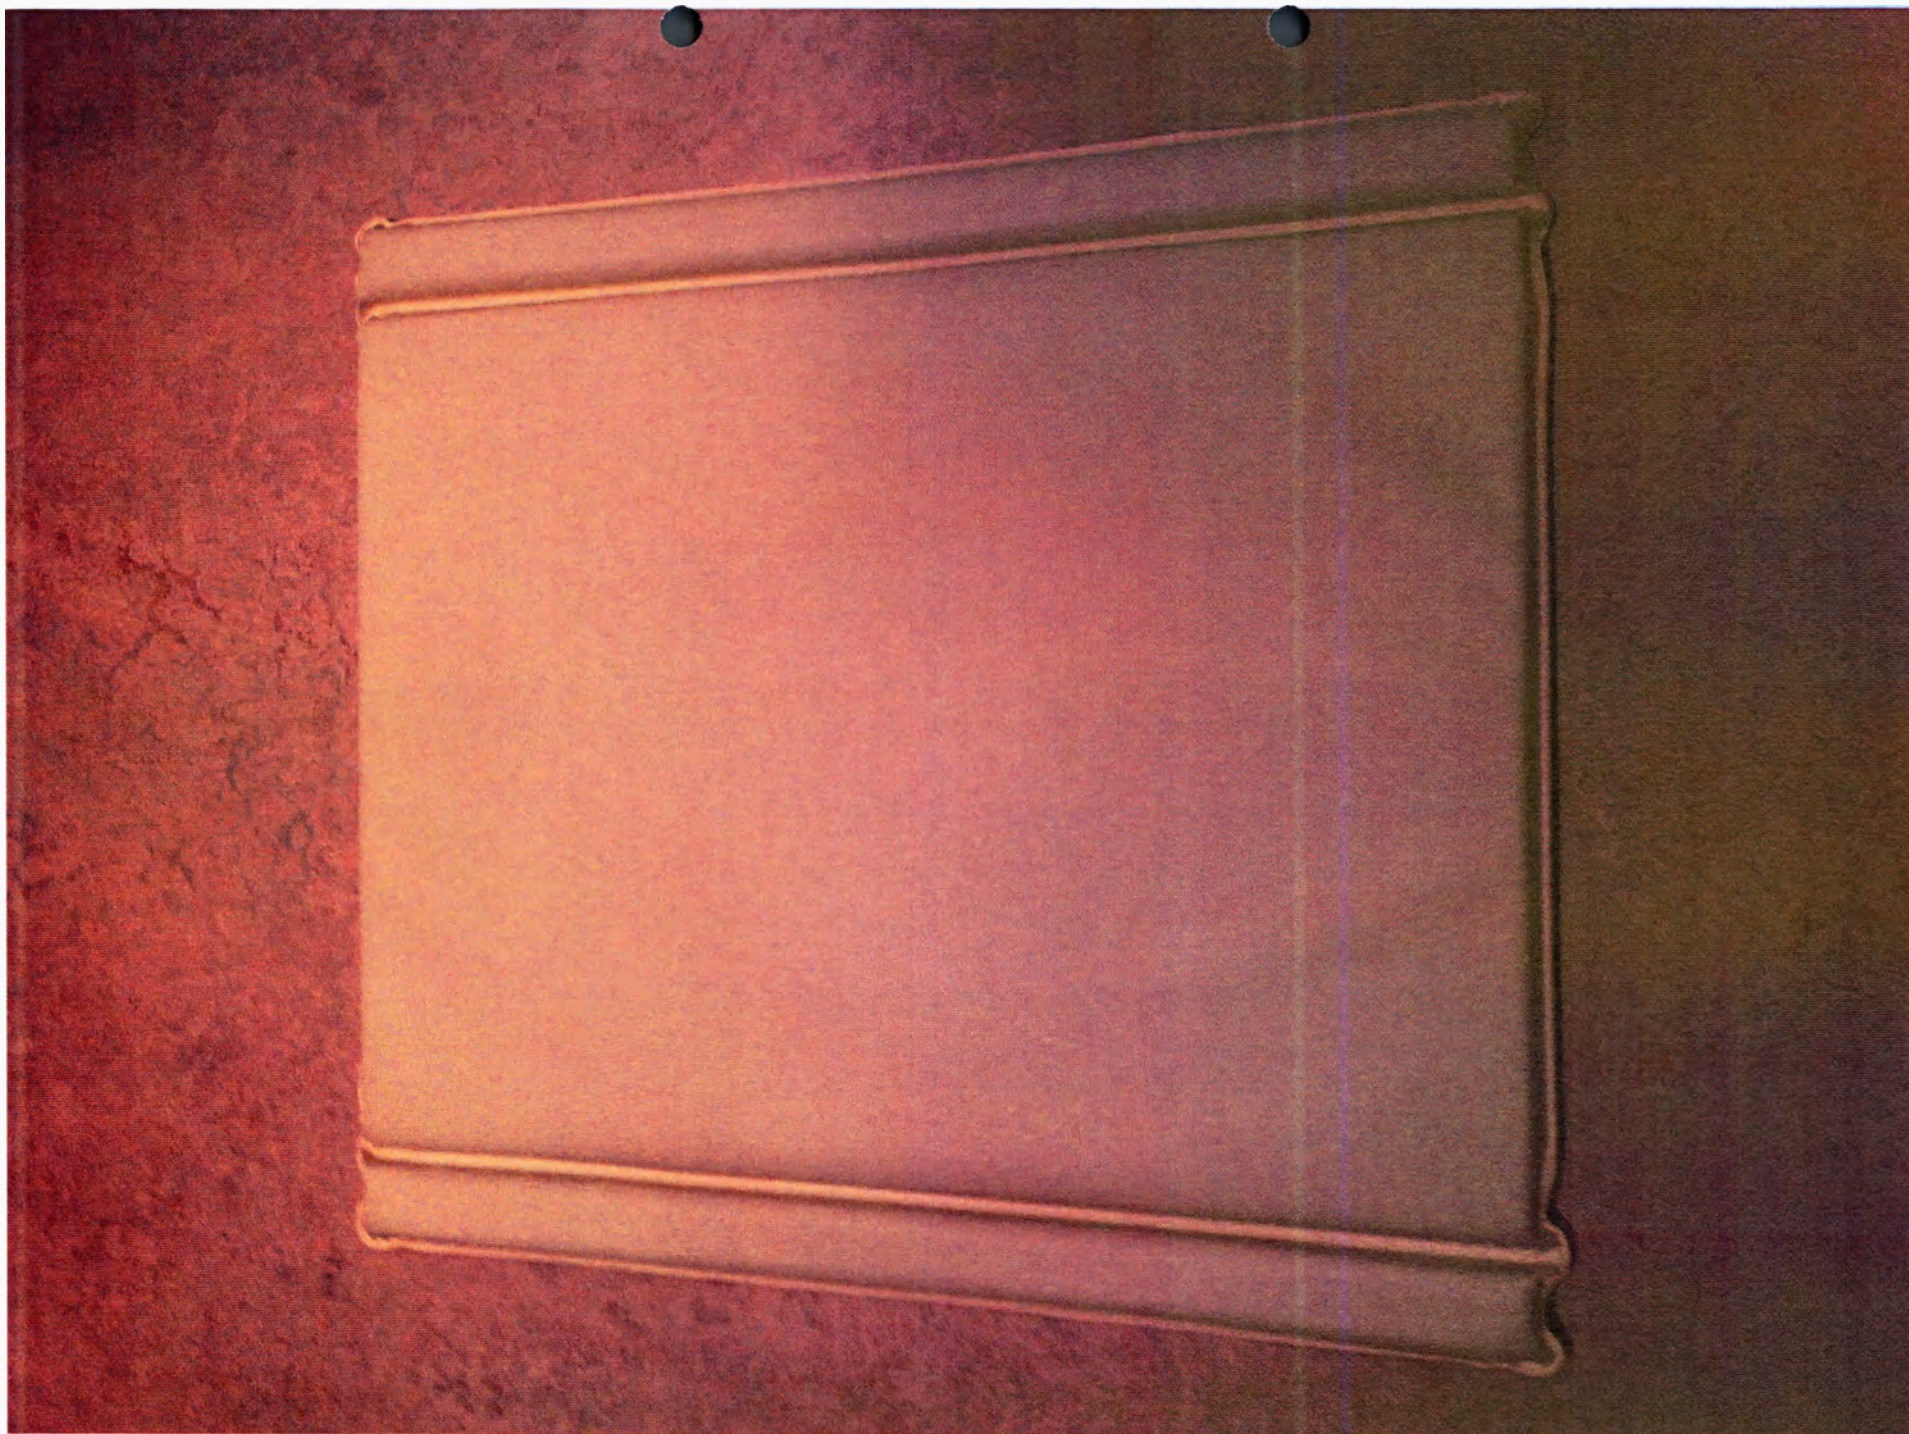


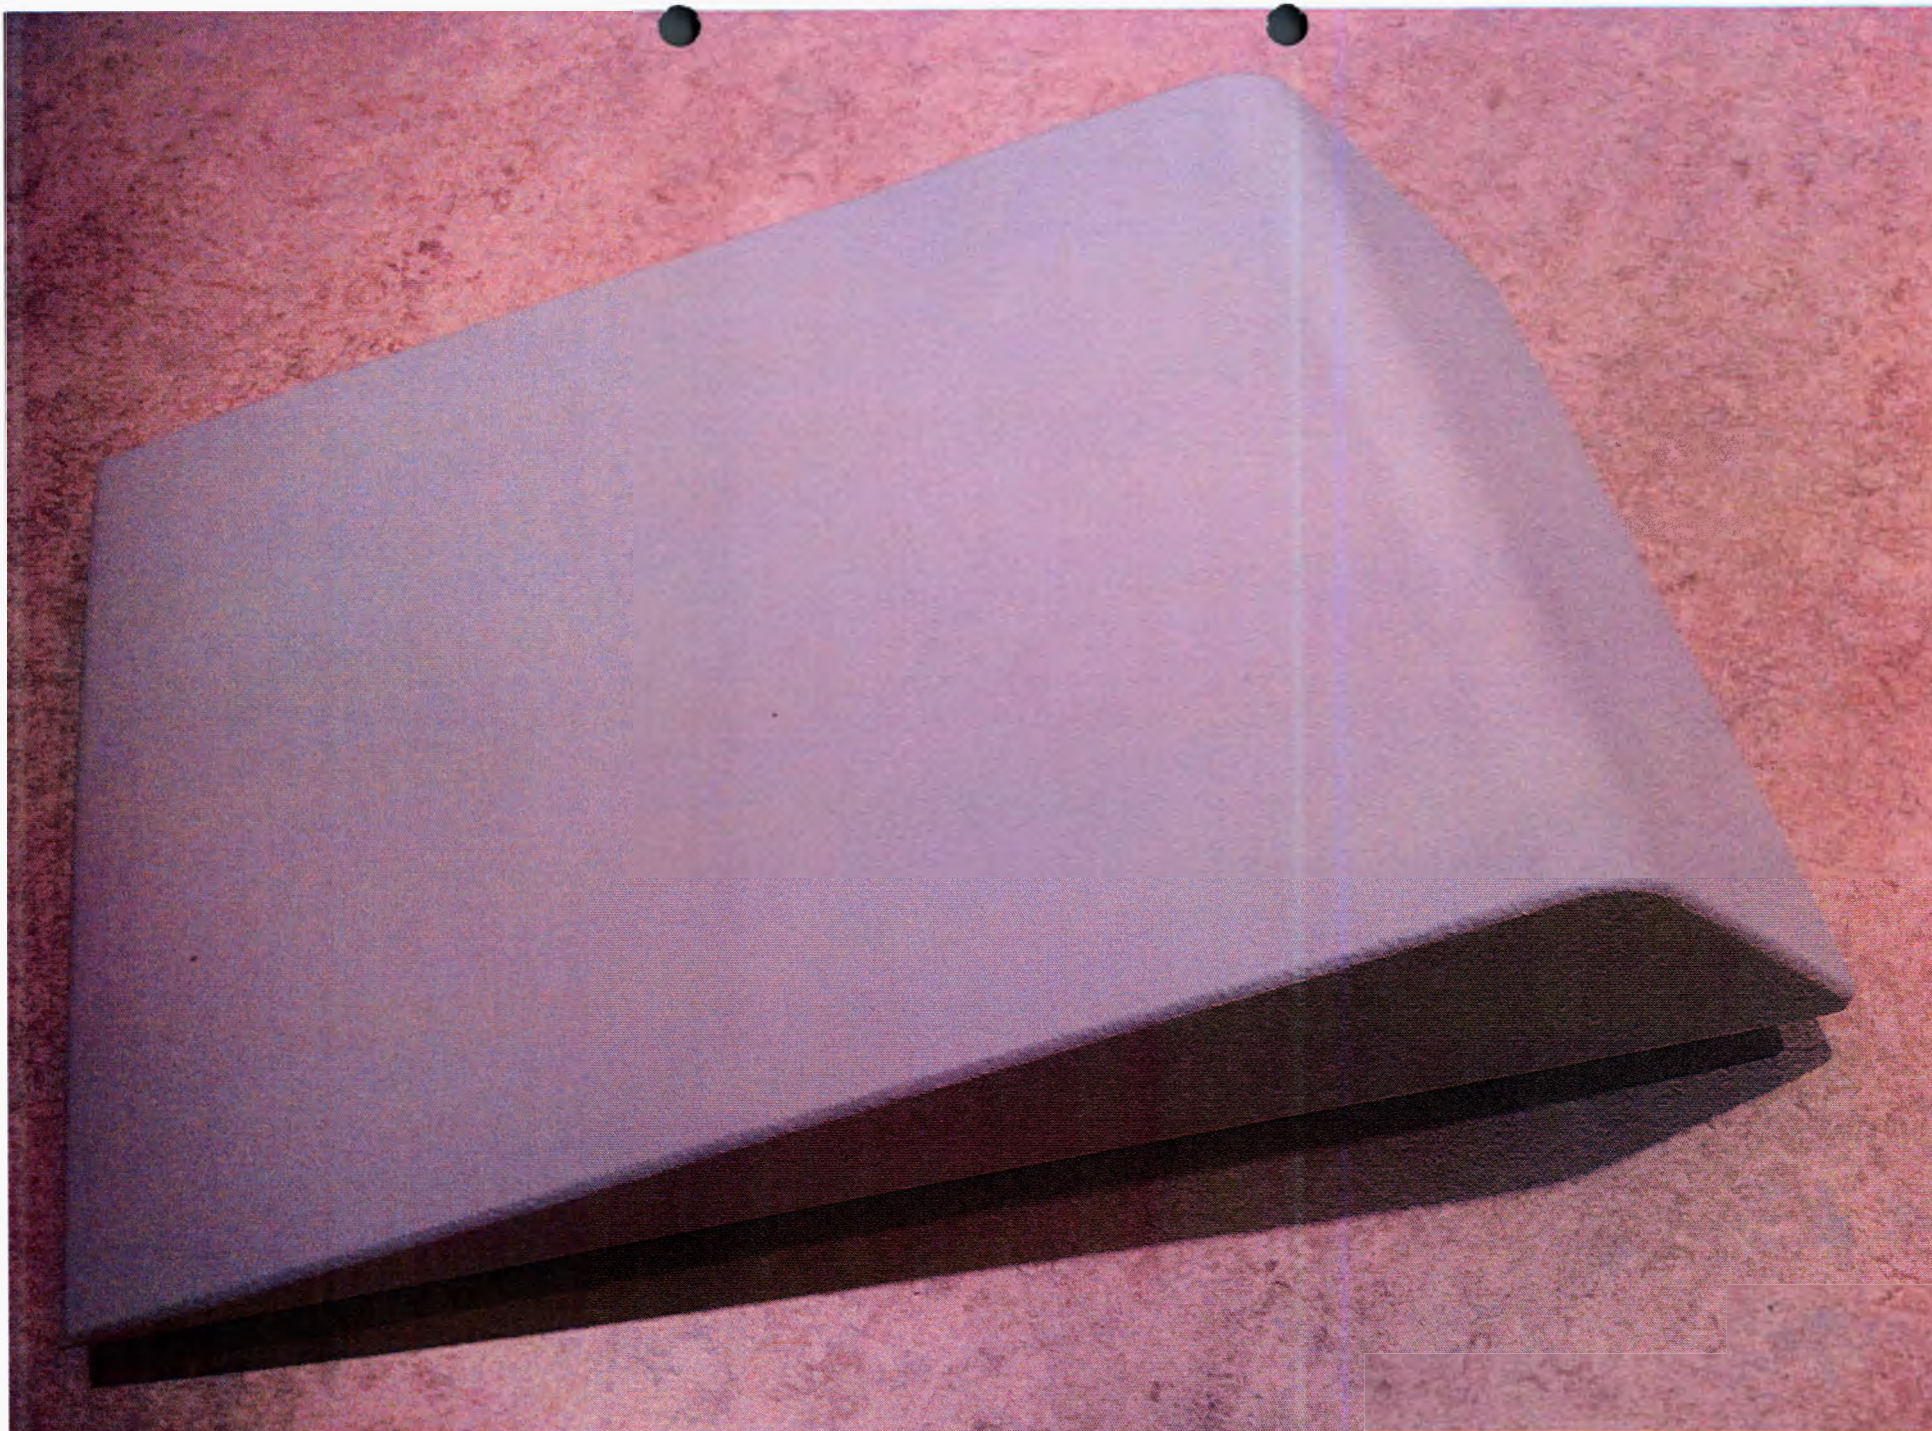







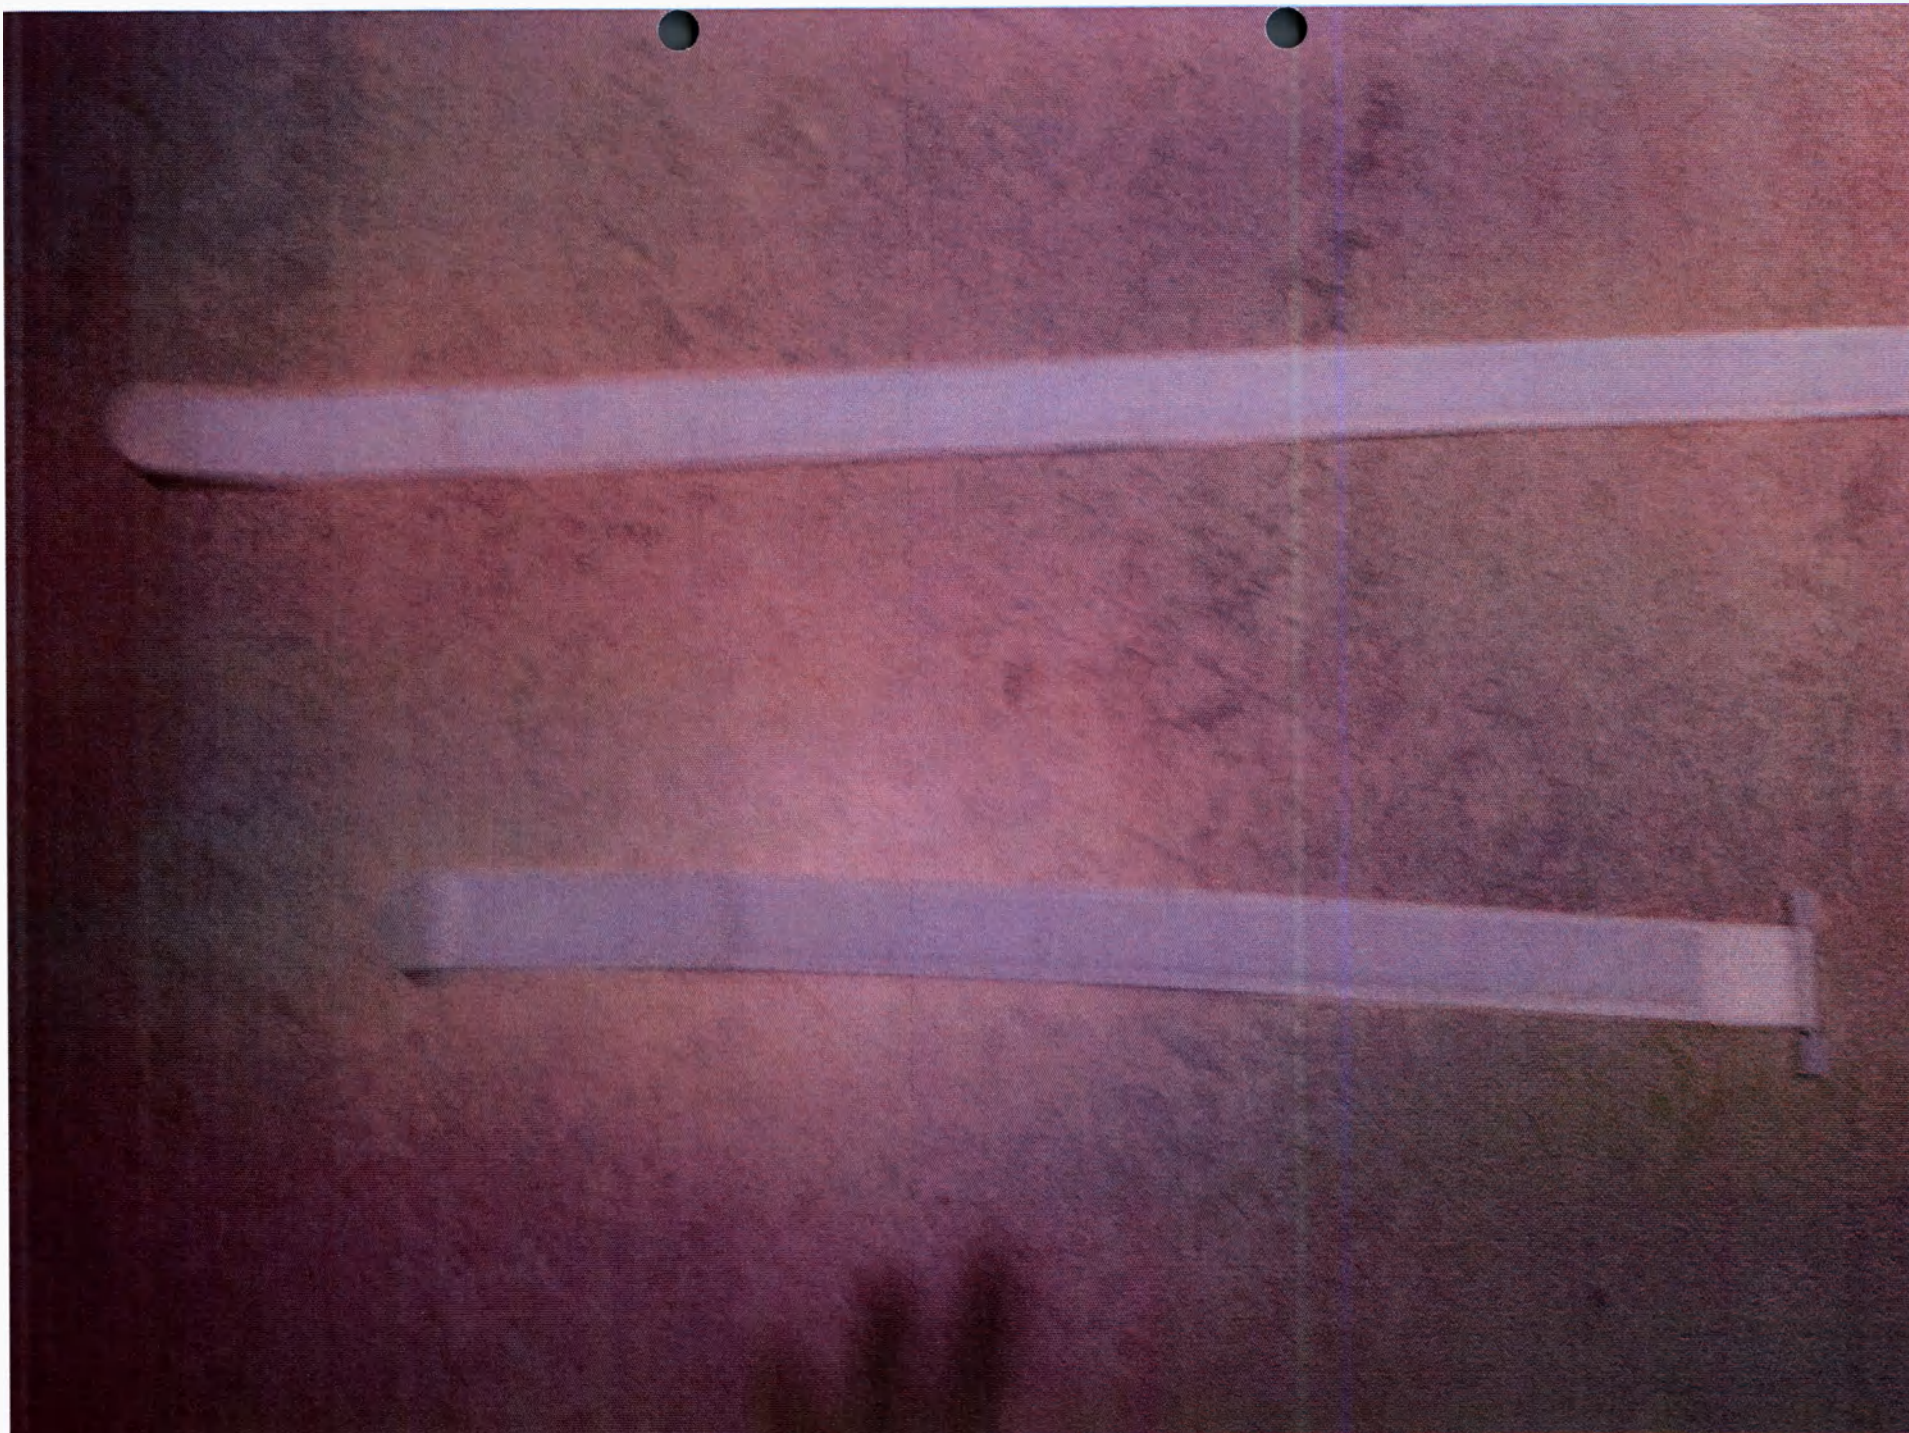


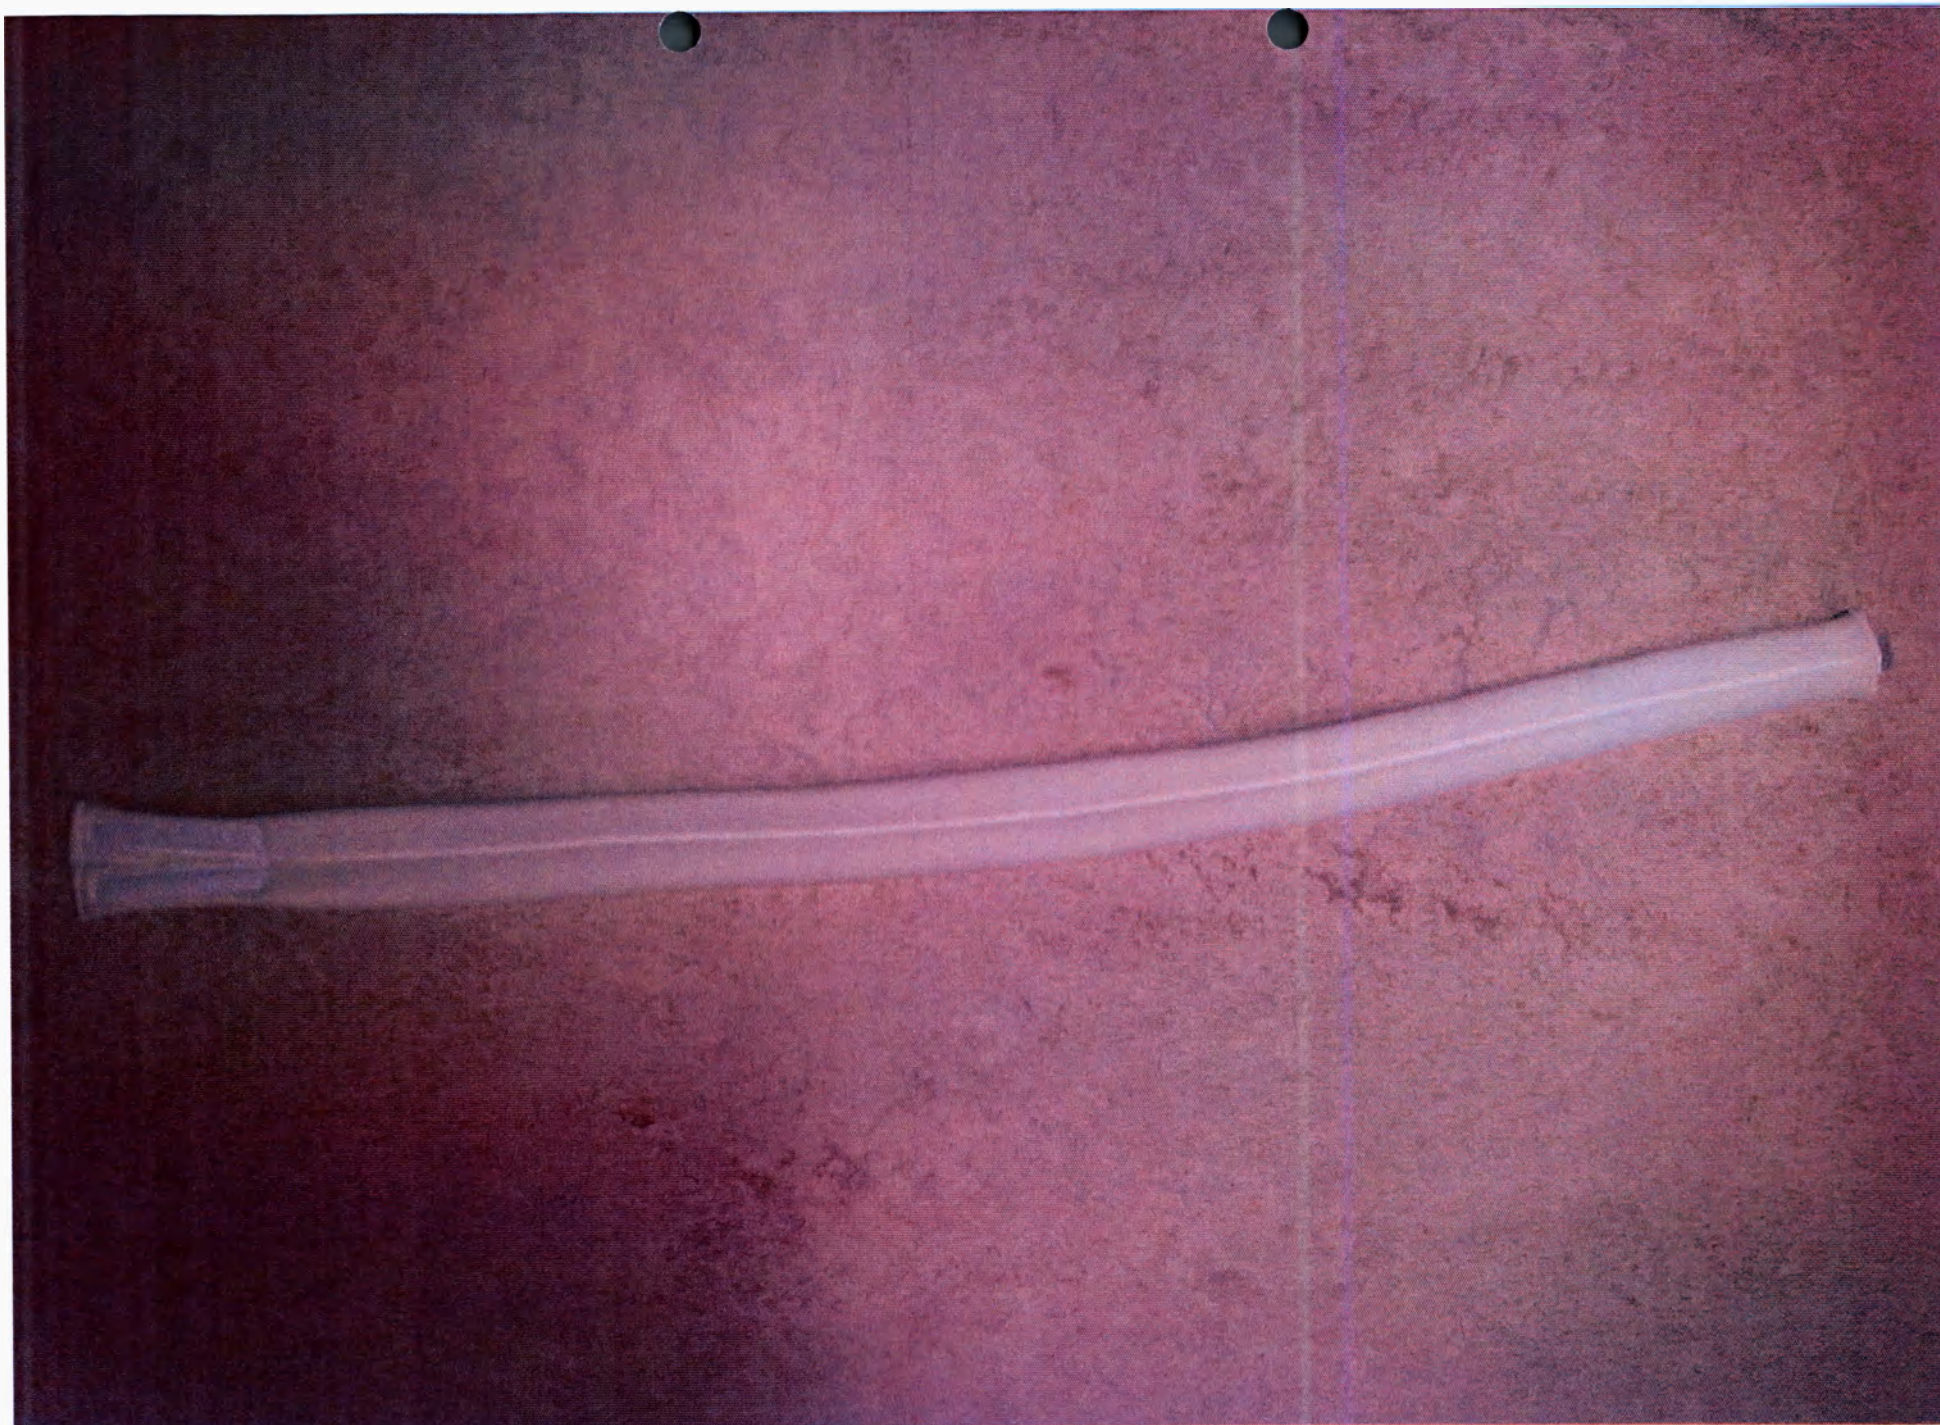

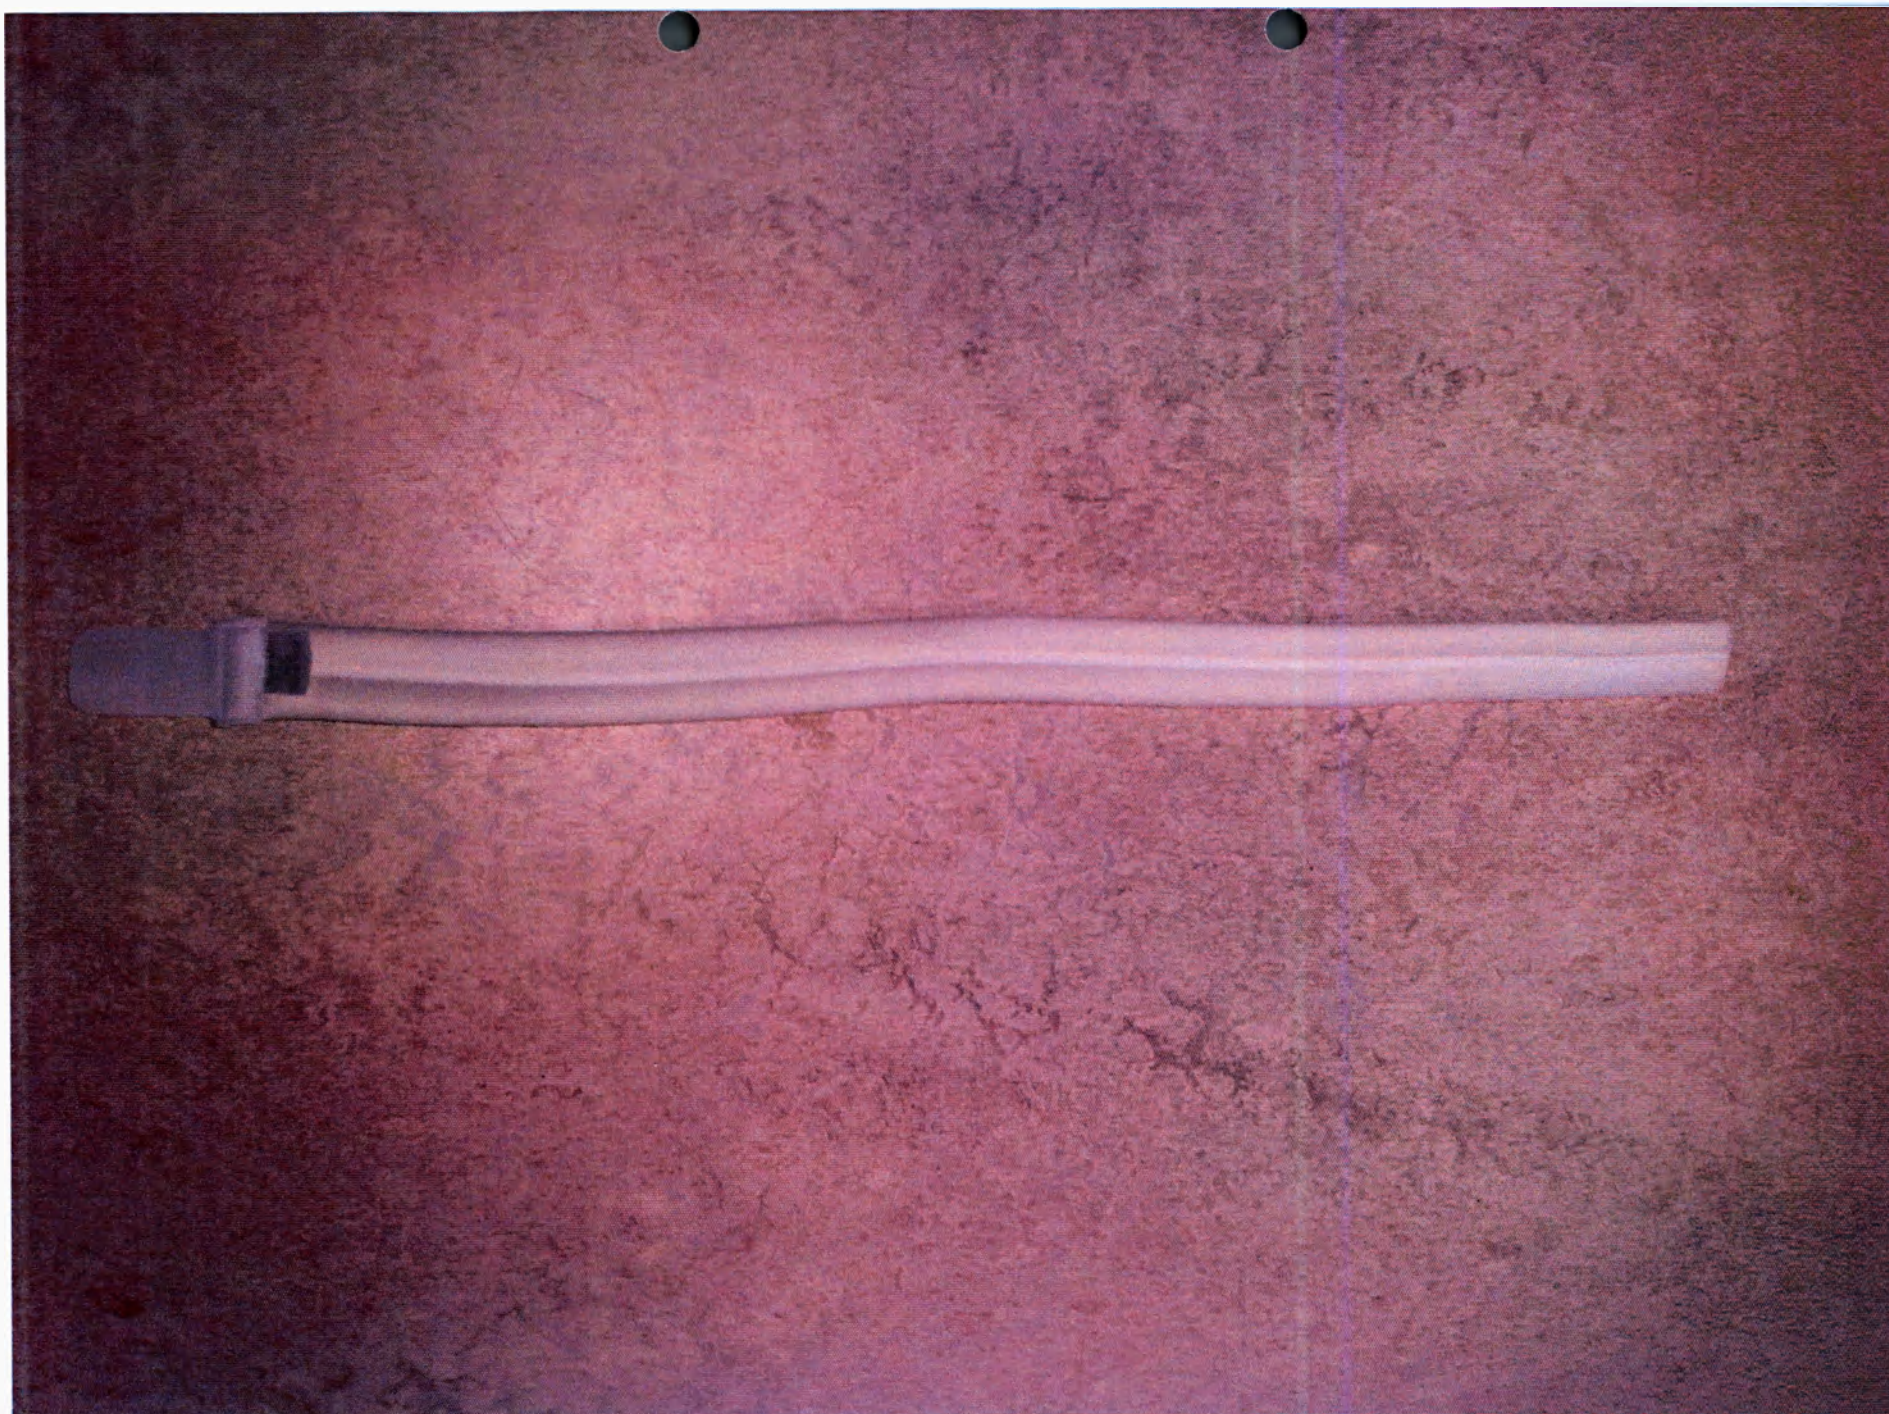

Ремень для головы/глазниц и иммобилизационный ремень (с двумя липучками).

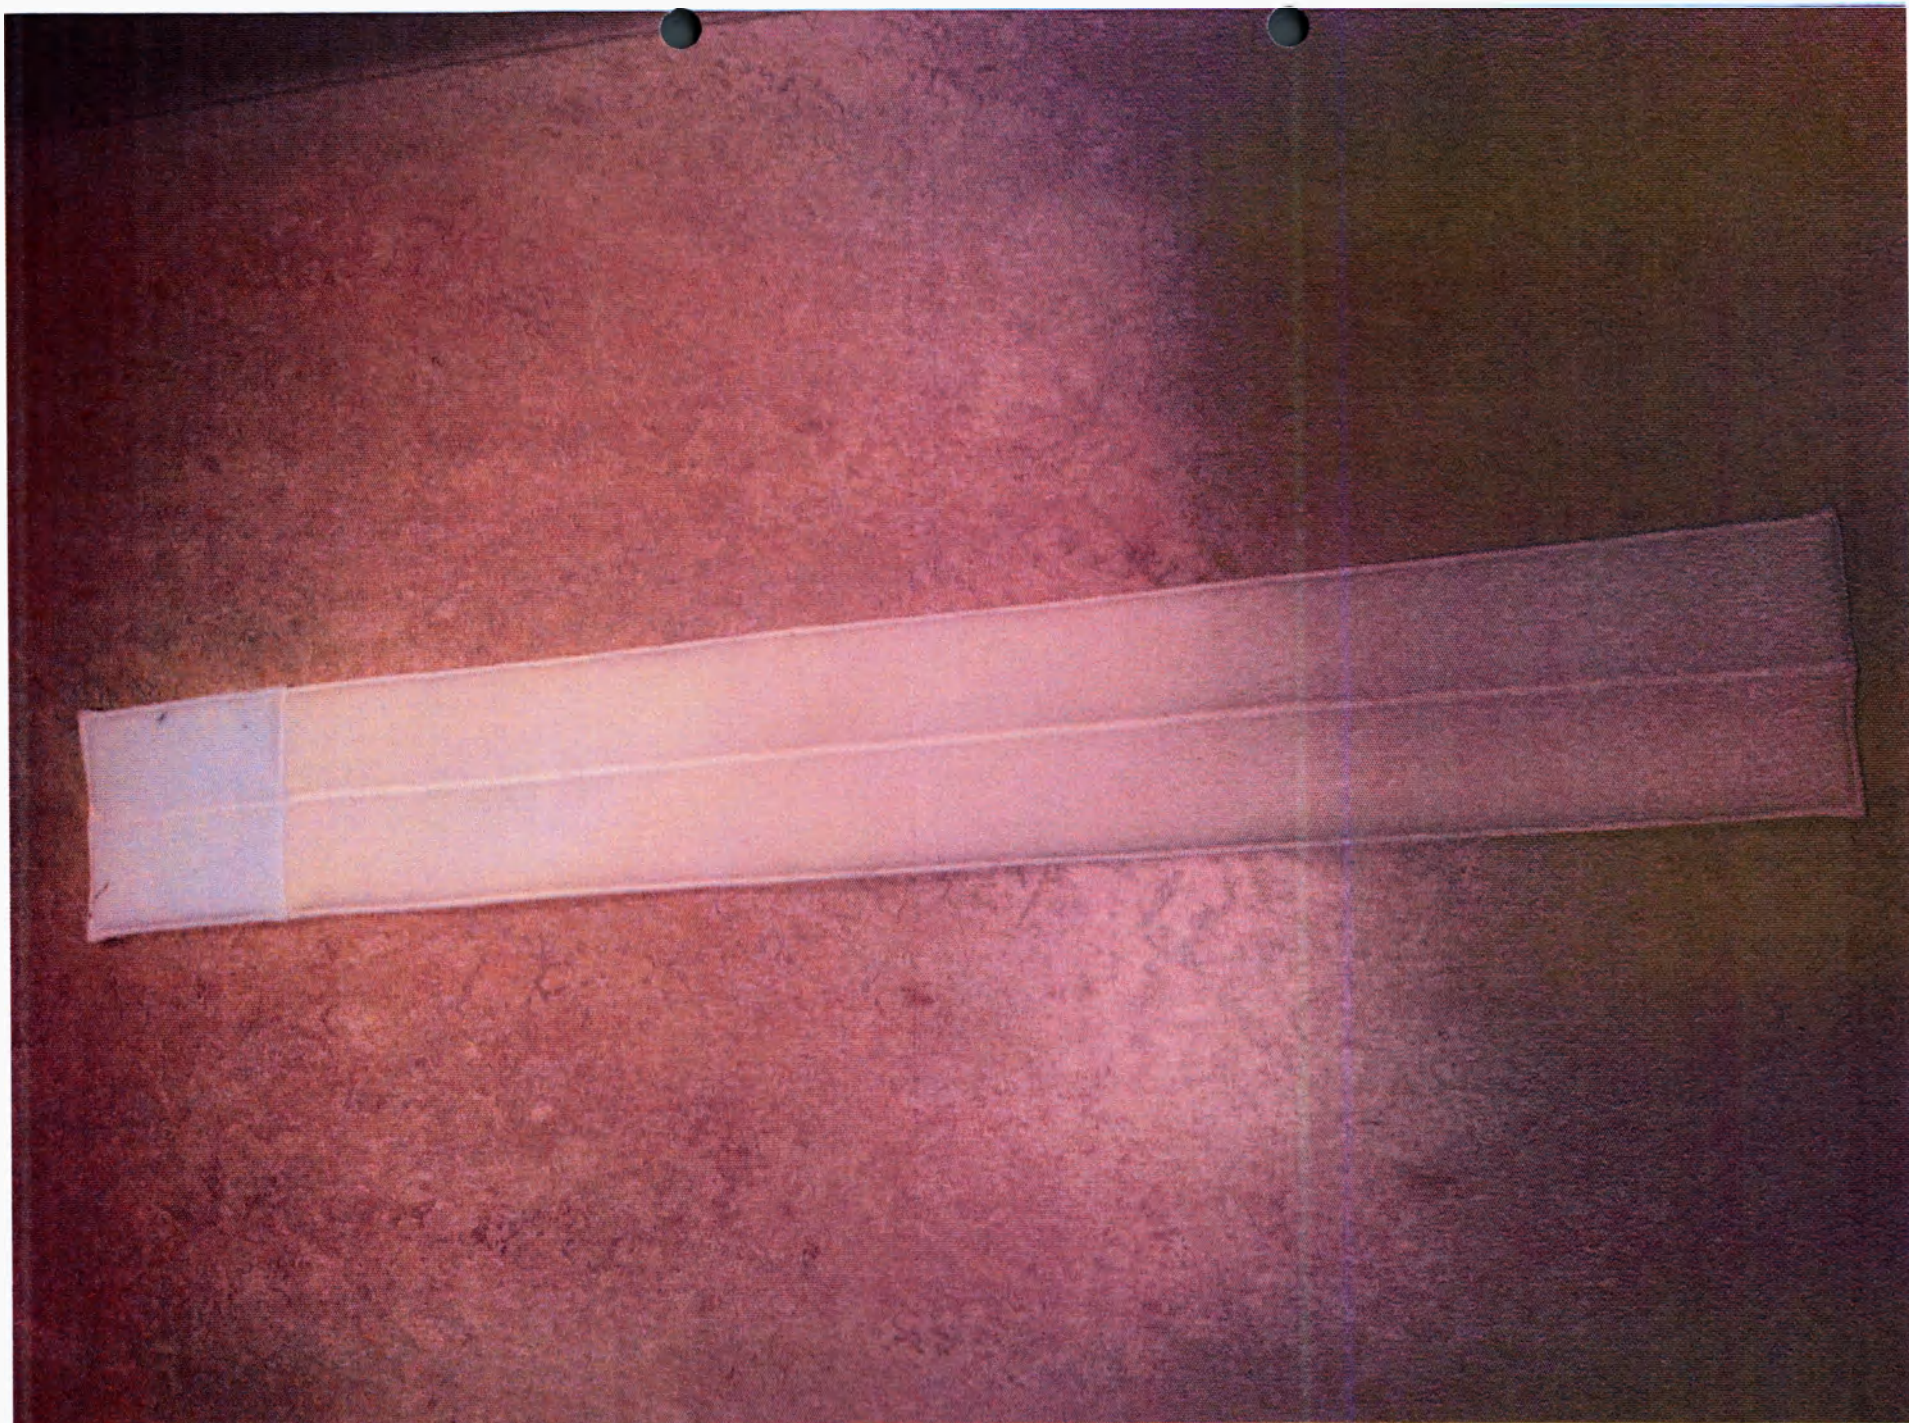

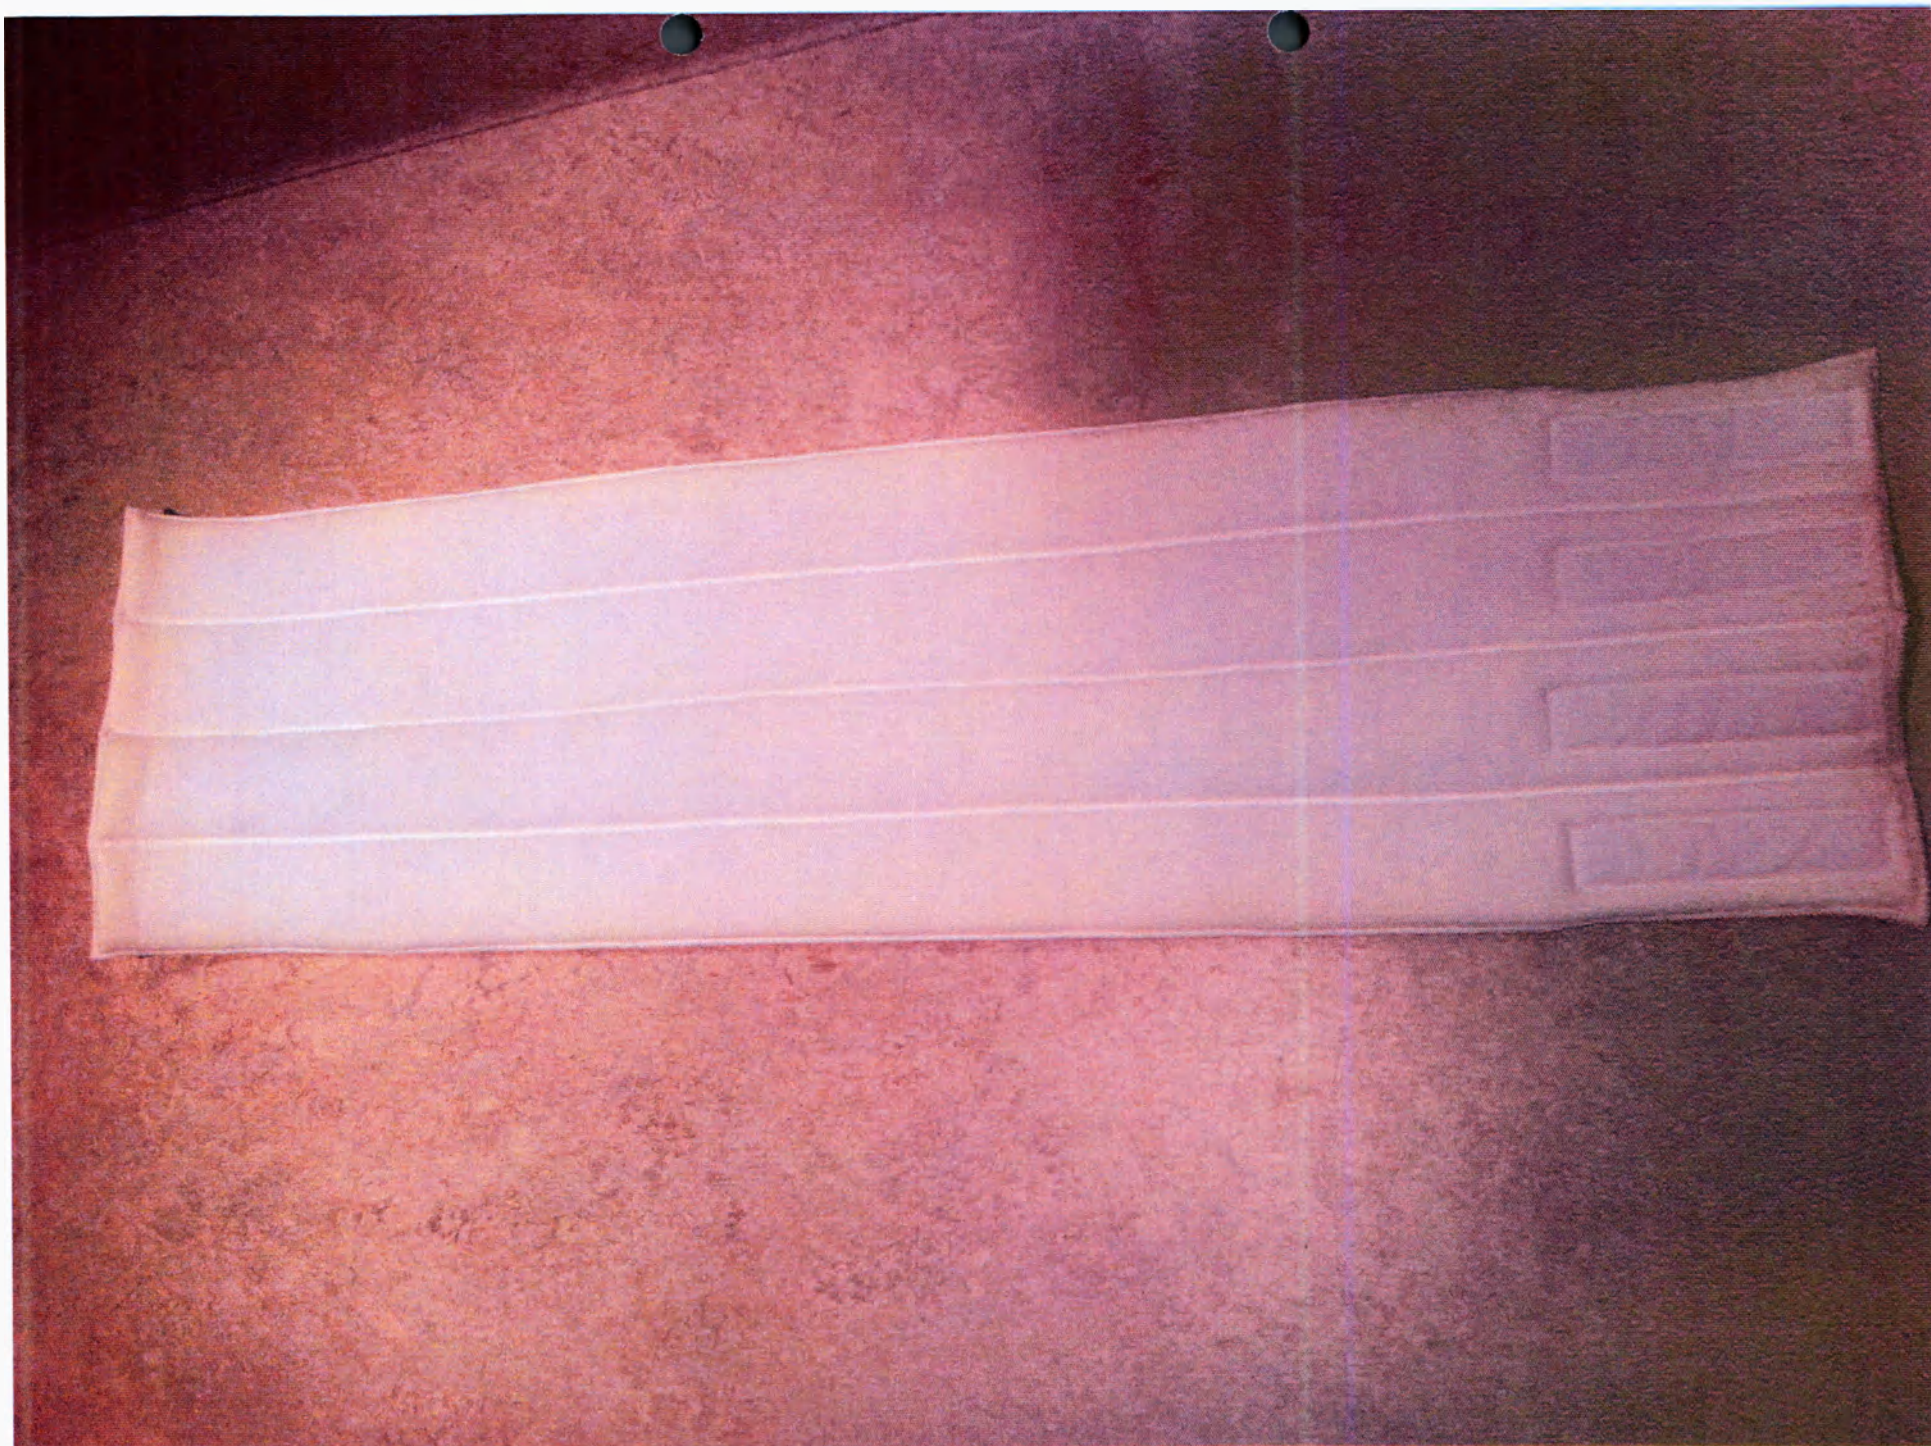





— Треугольный клин большой,
основание 5 см (не более 2 шт.)





Треугольный клин малый, основание 3 см (не более 2 шт.)





Треугольный клин средний, основание 4 см (не более 2 шт.)




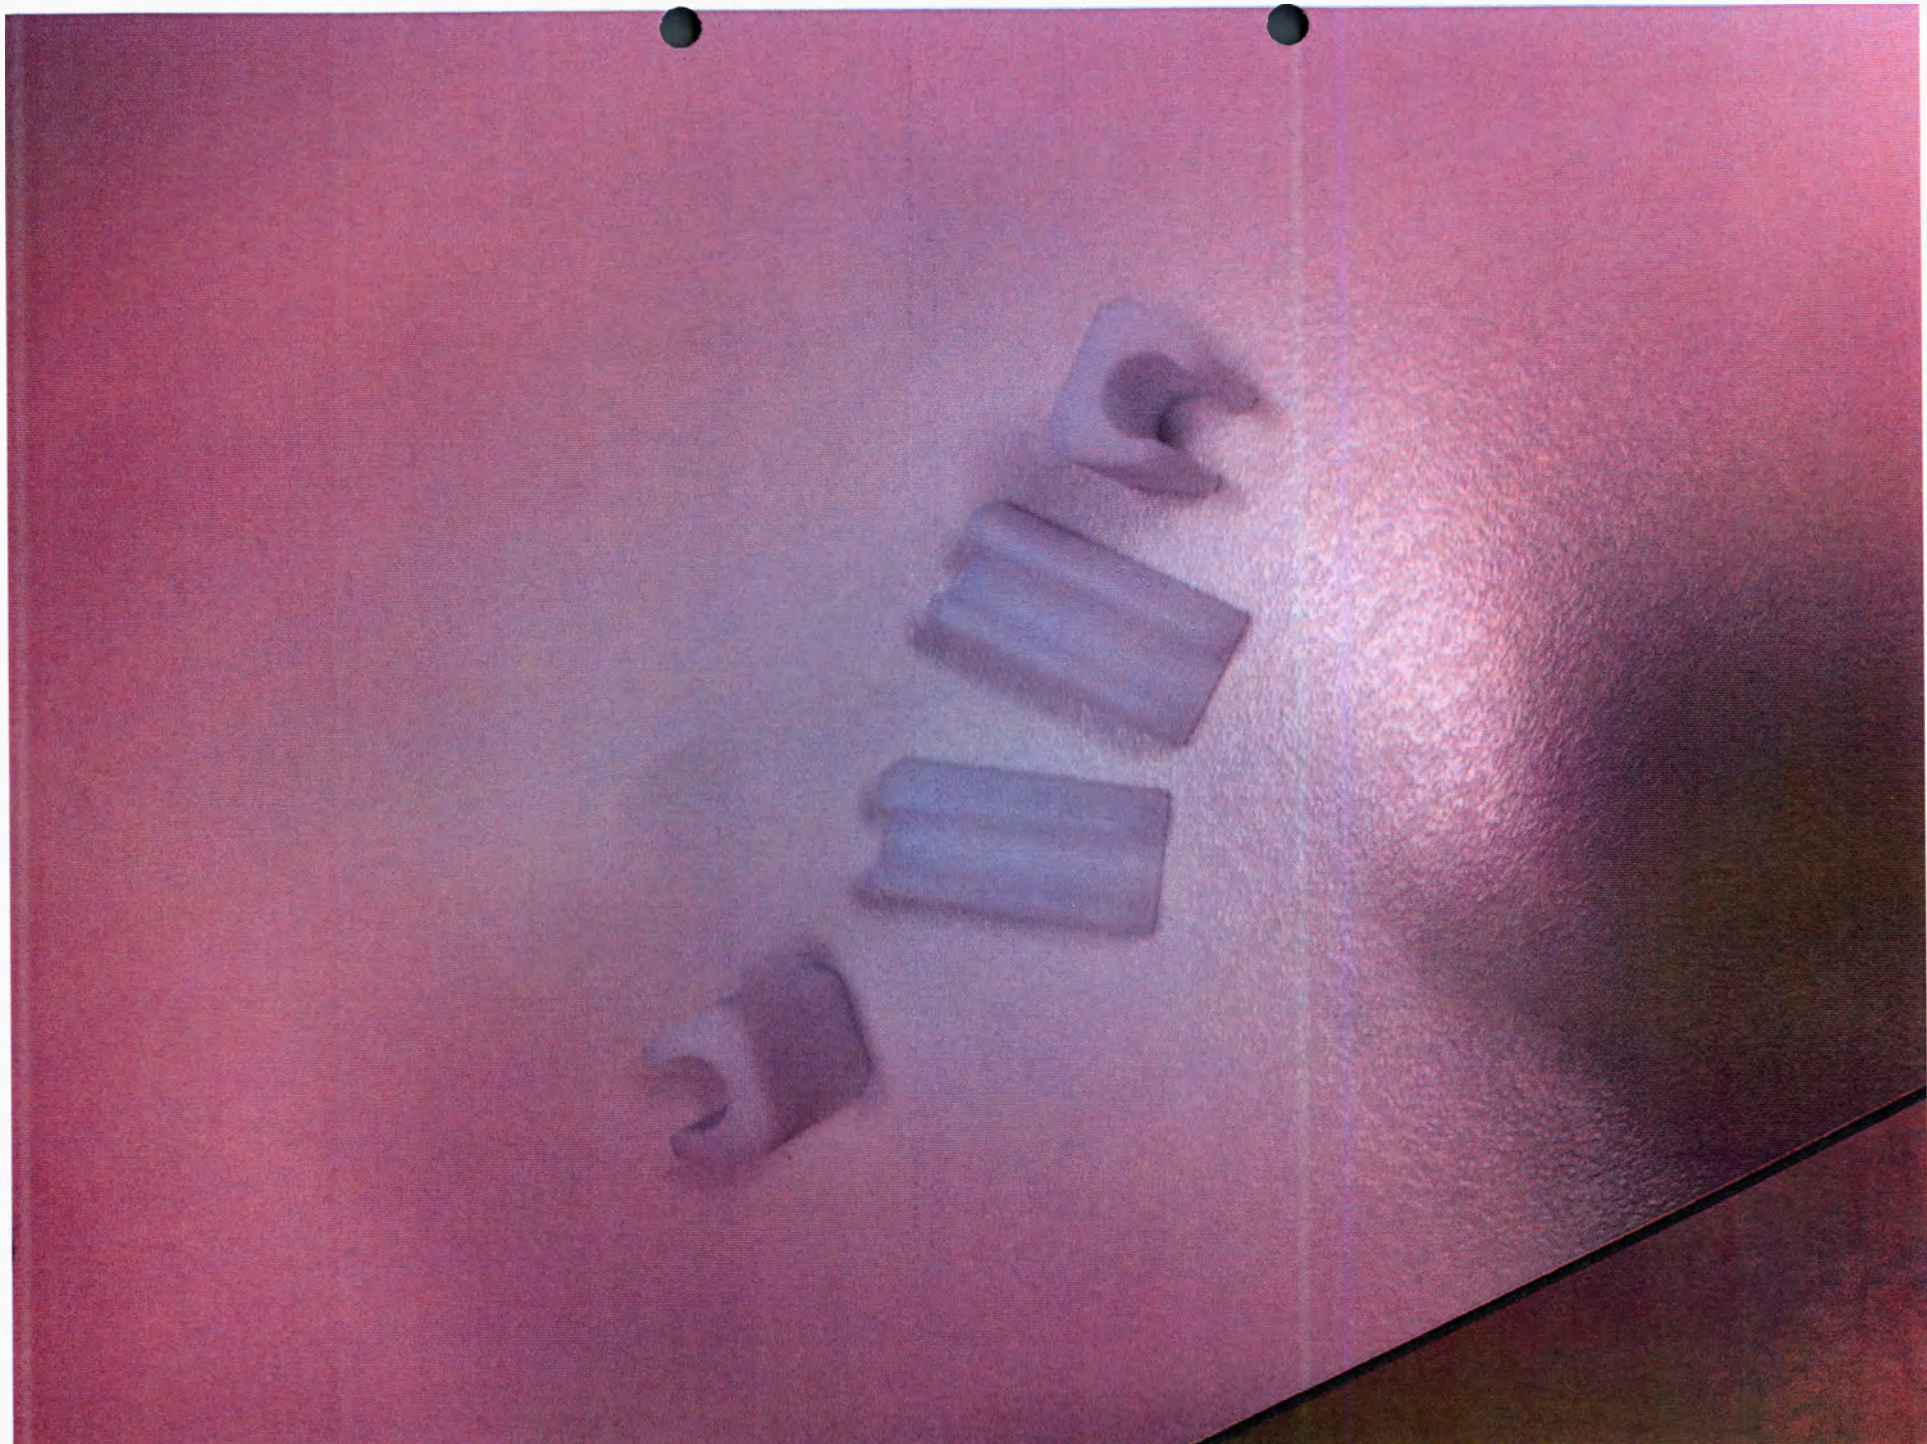


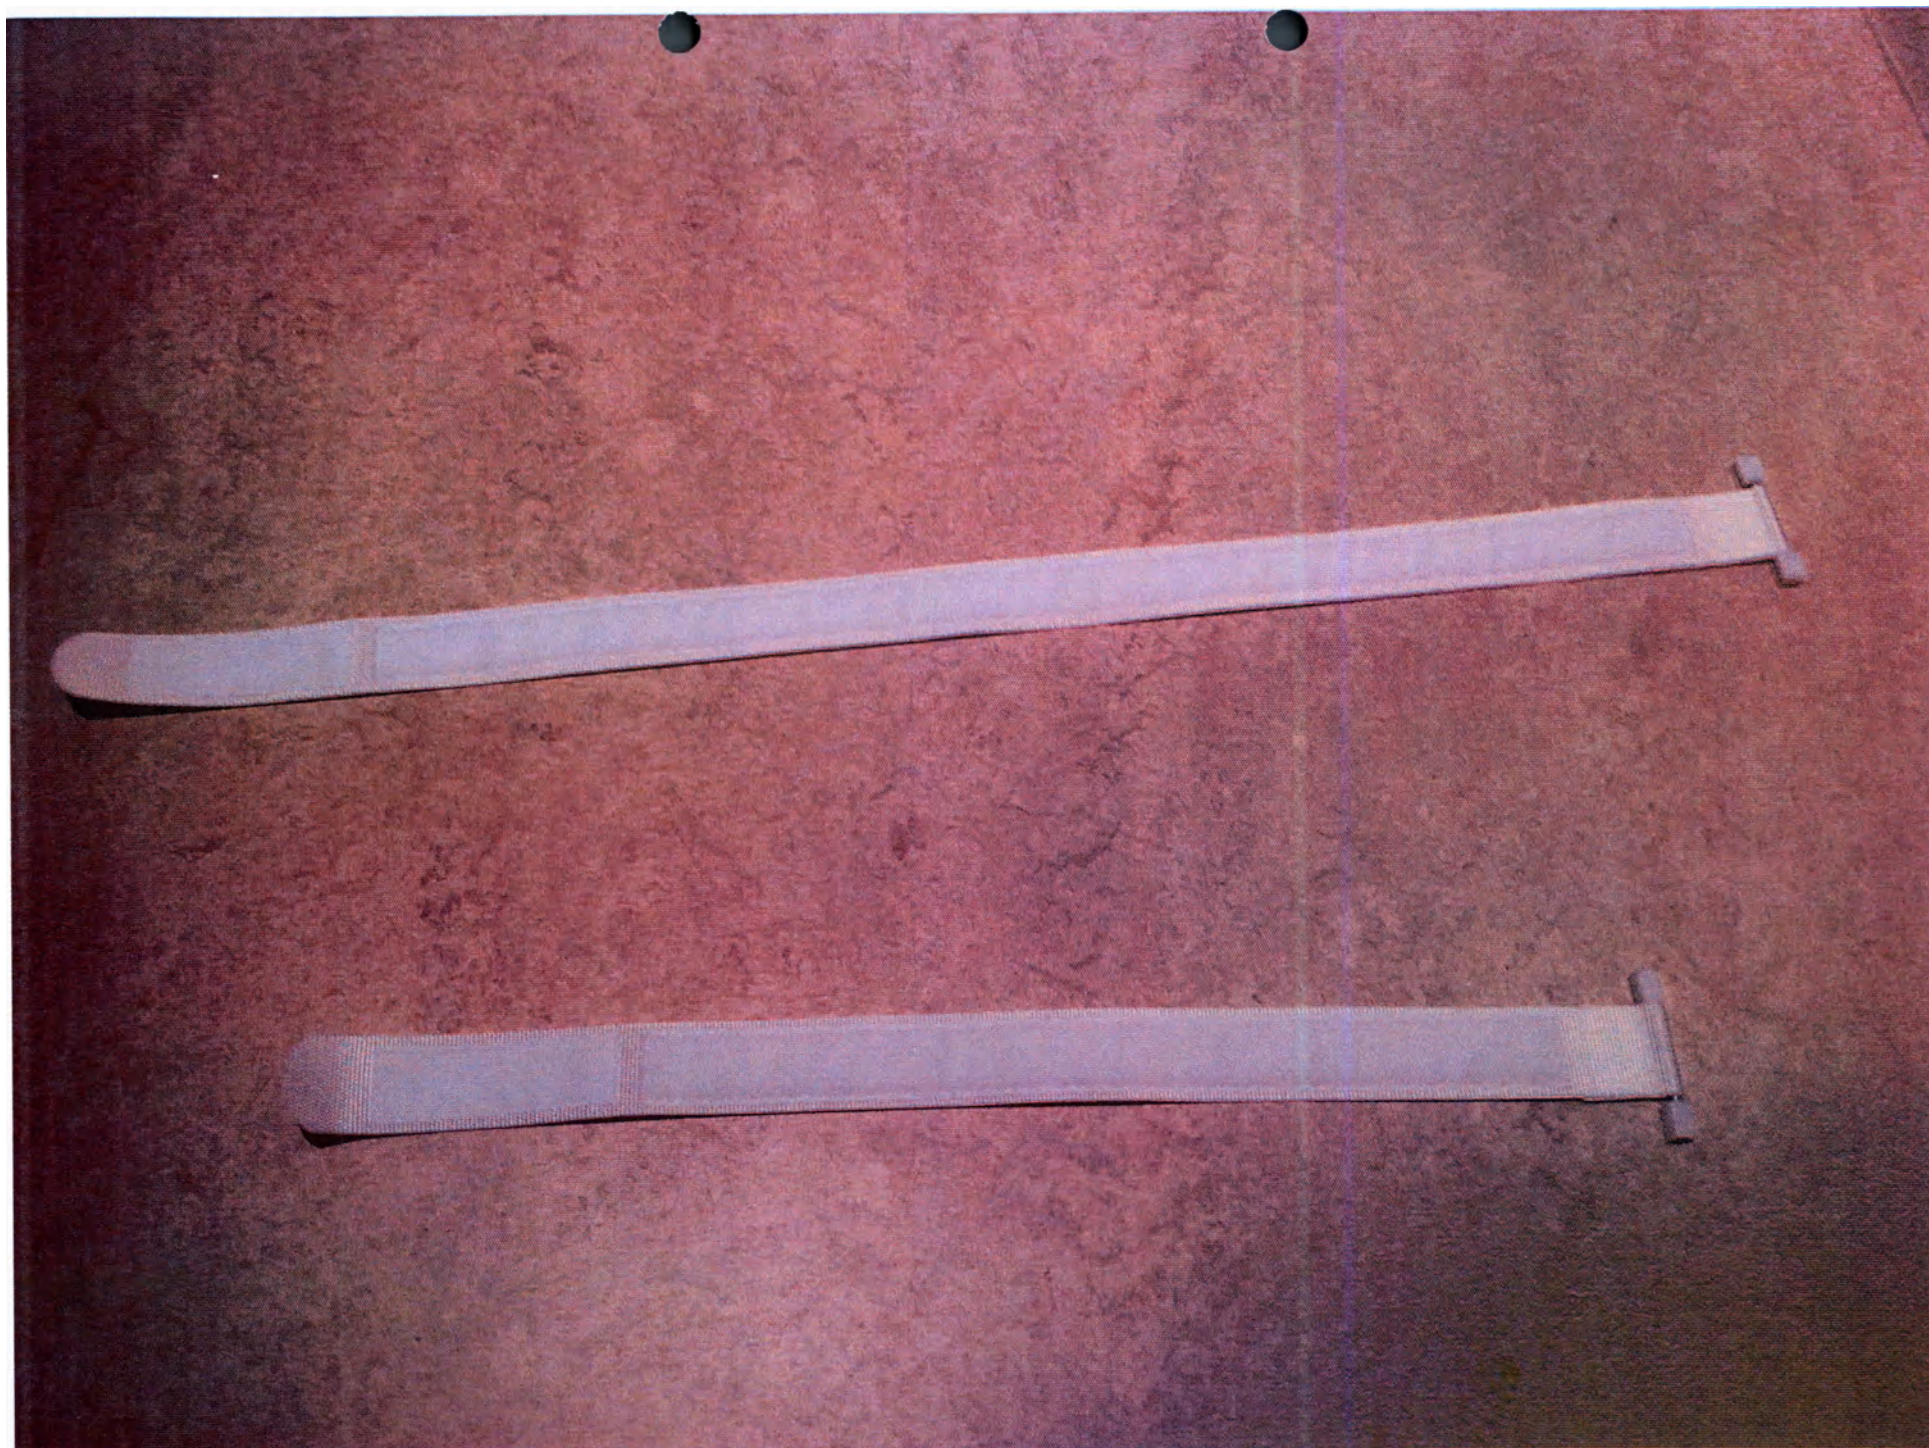


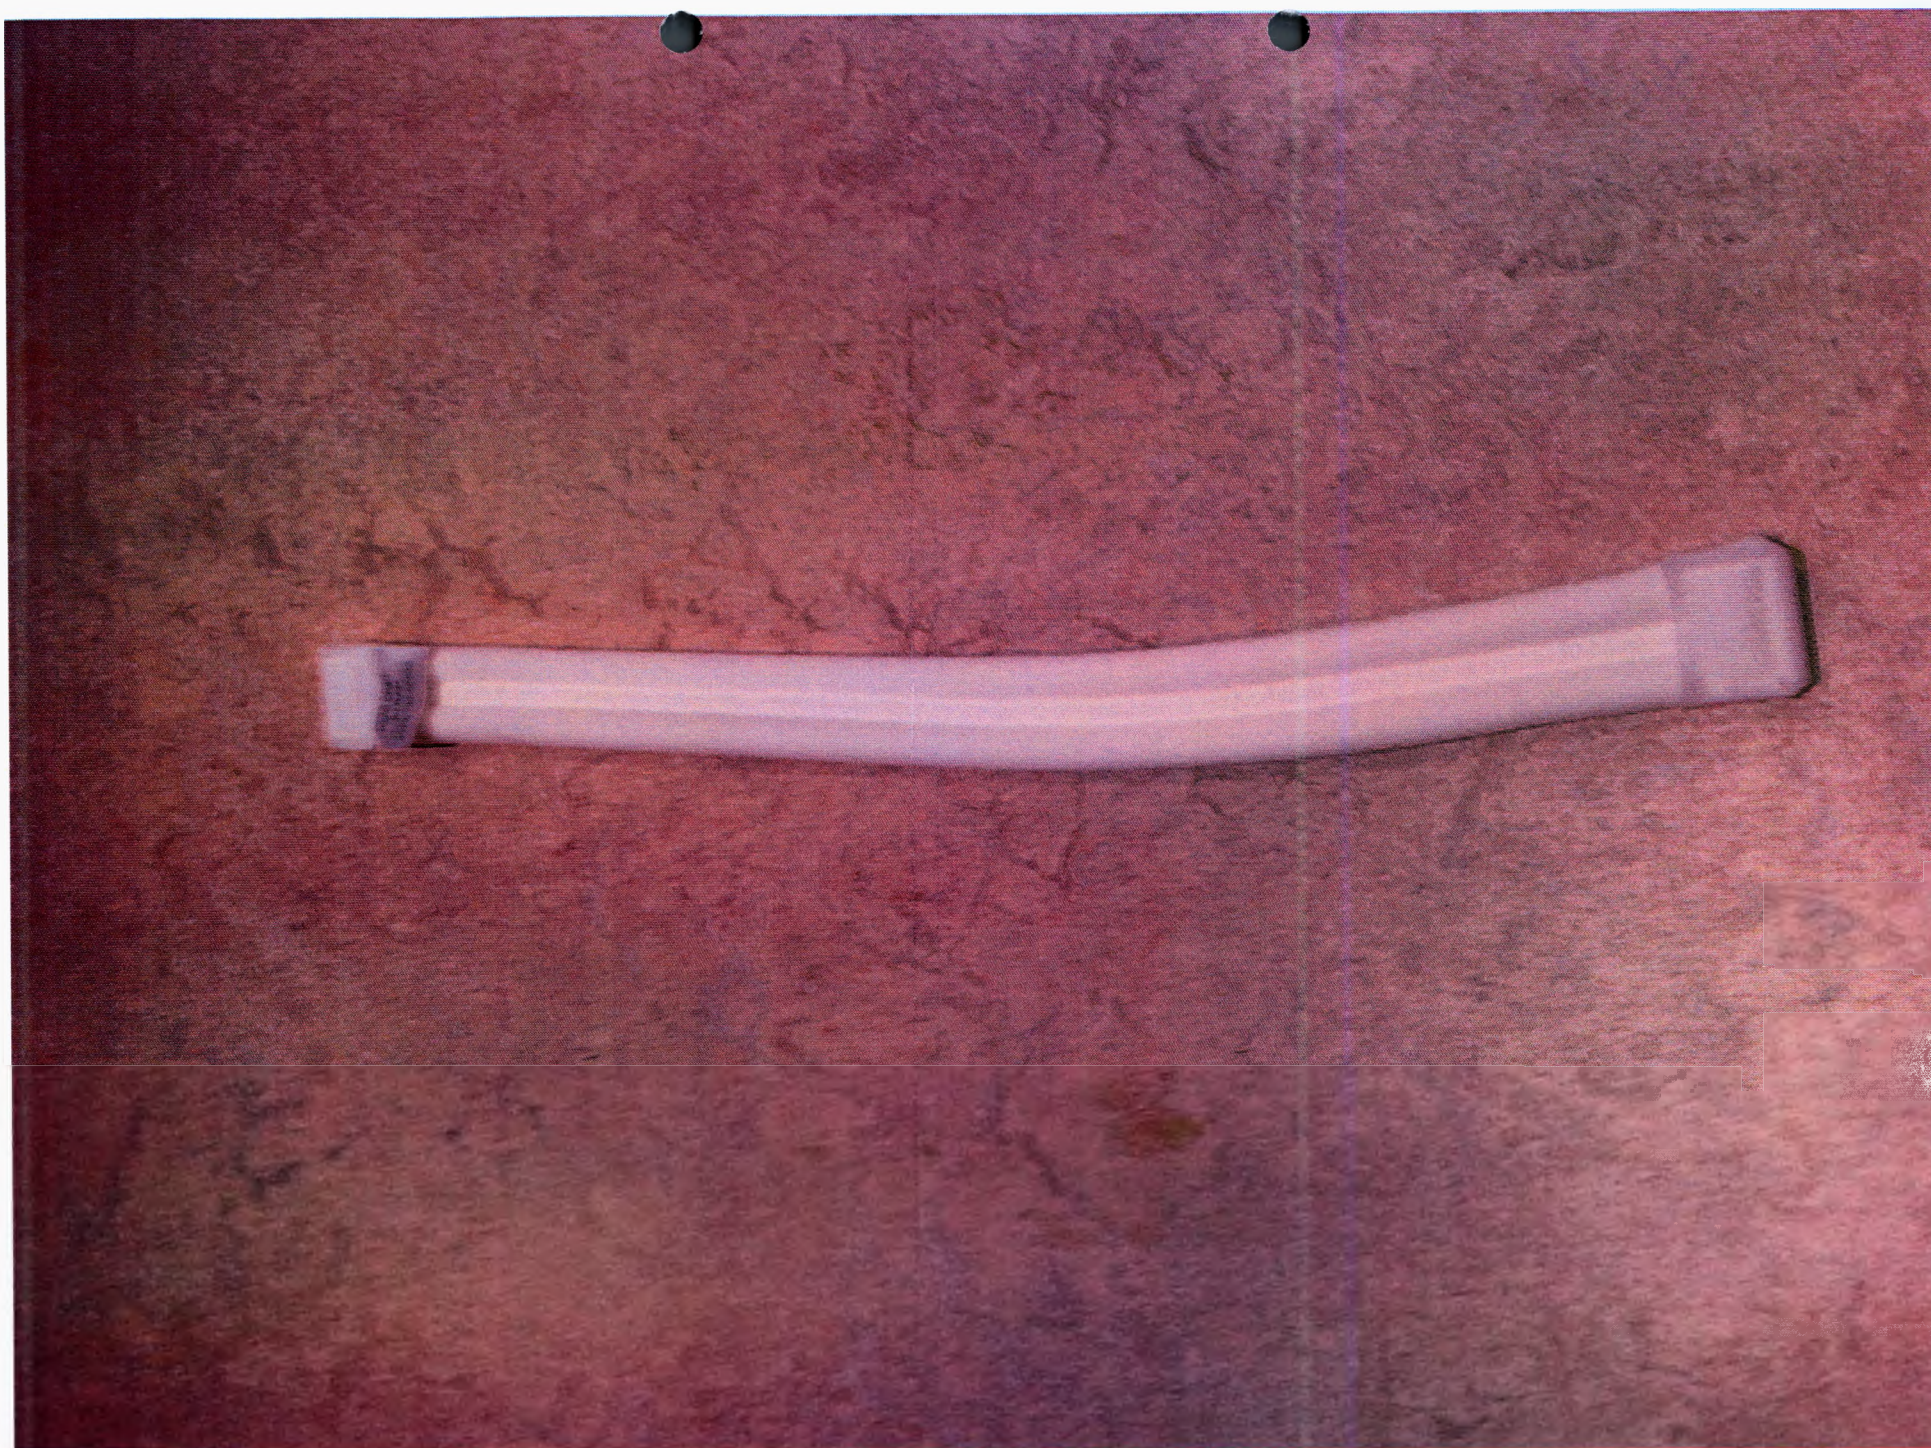

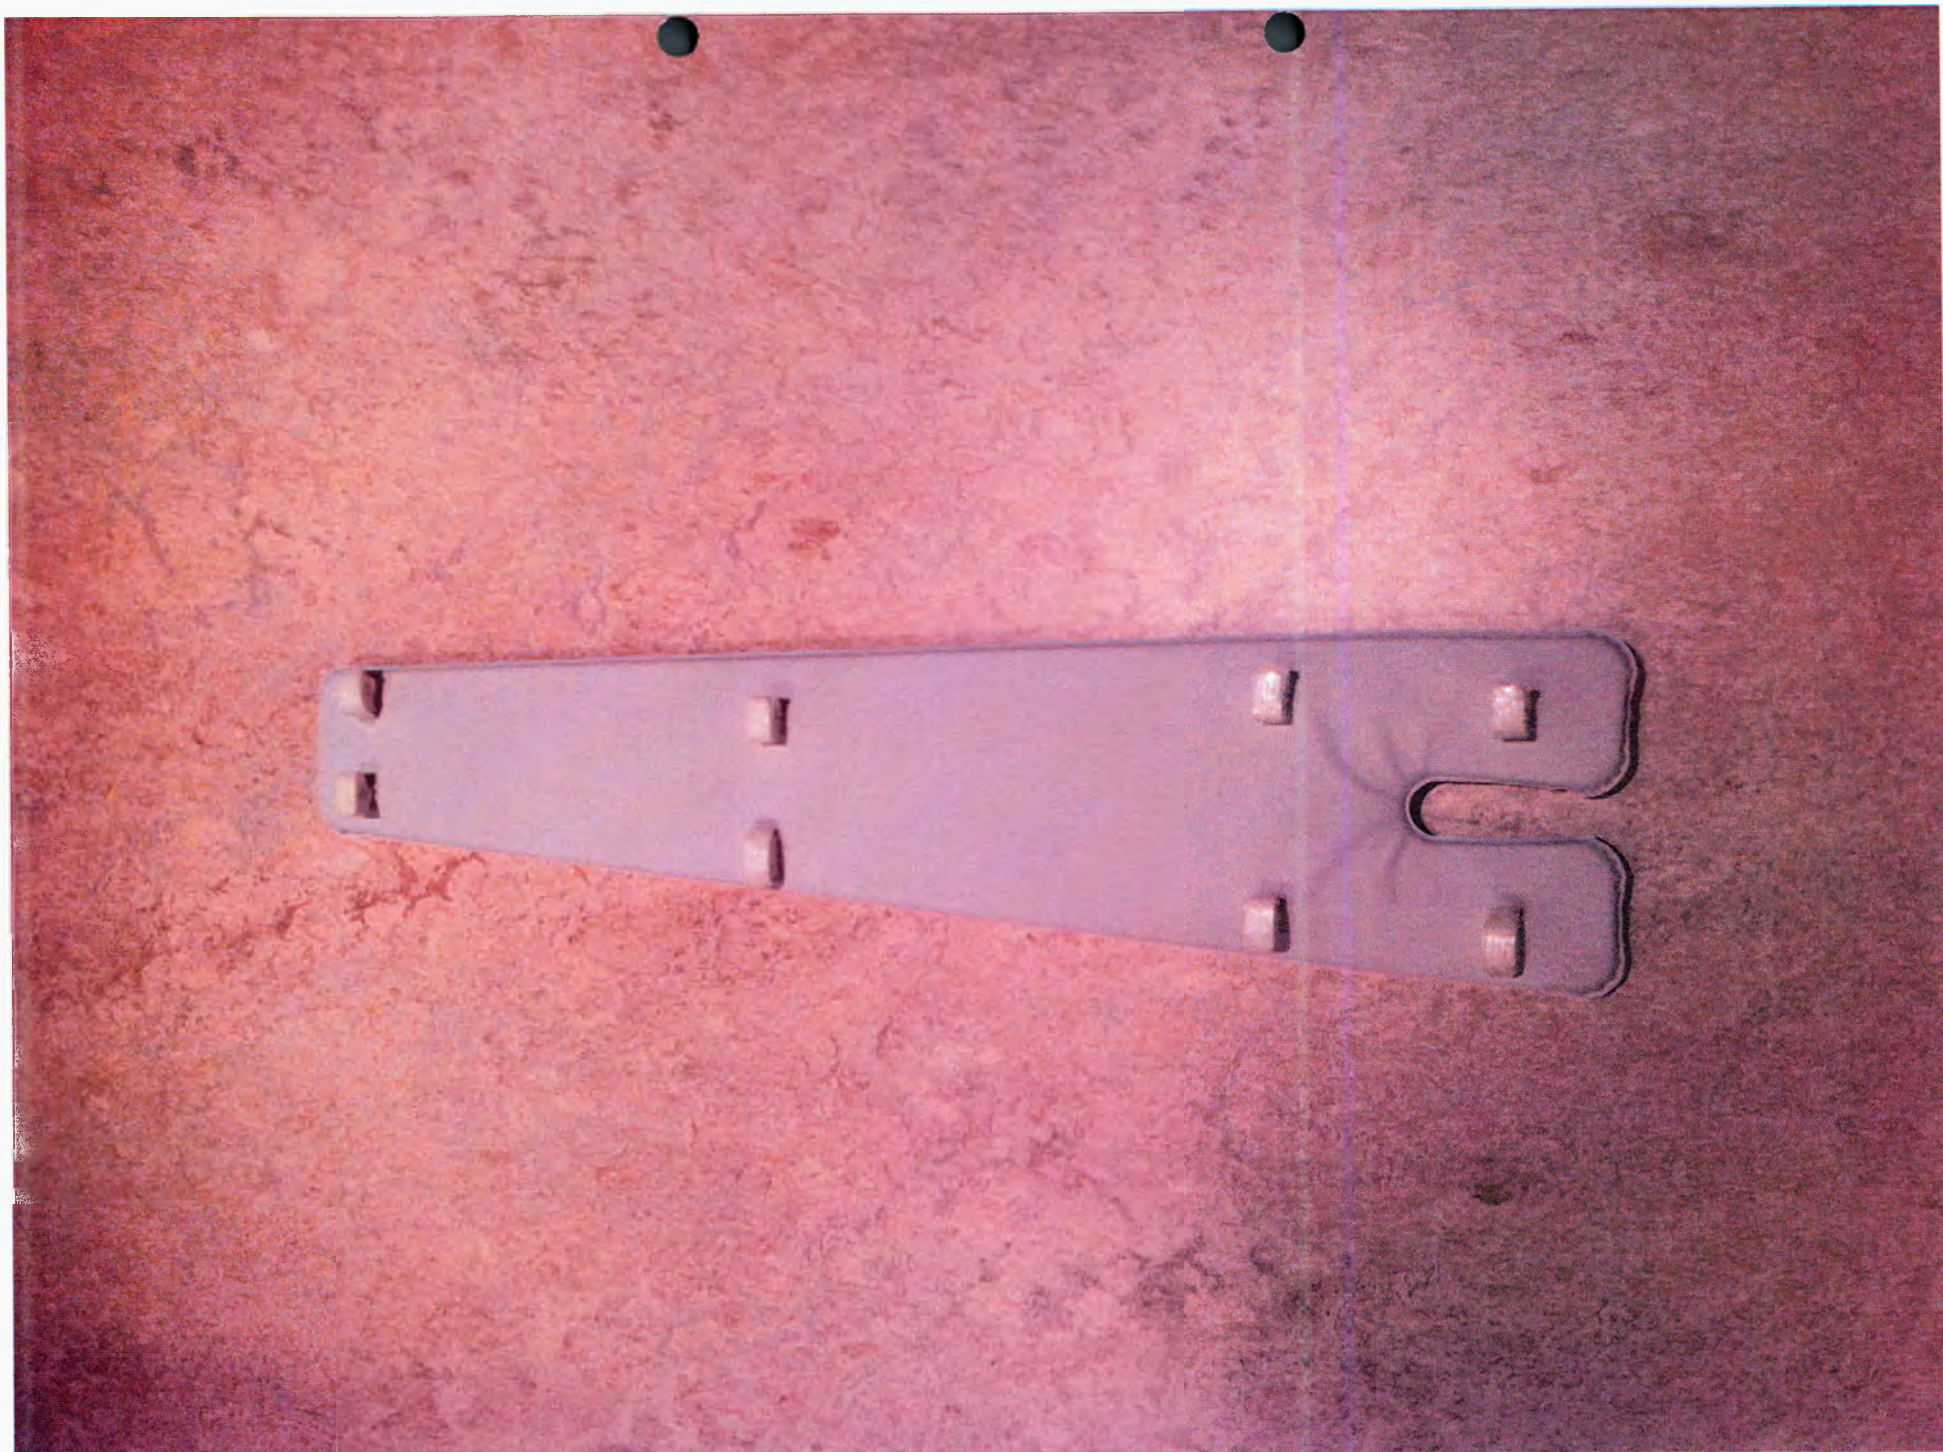


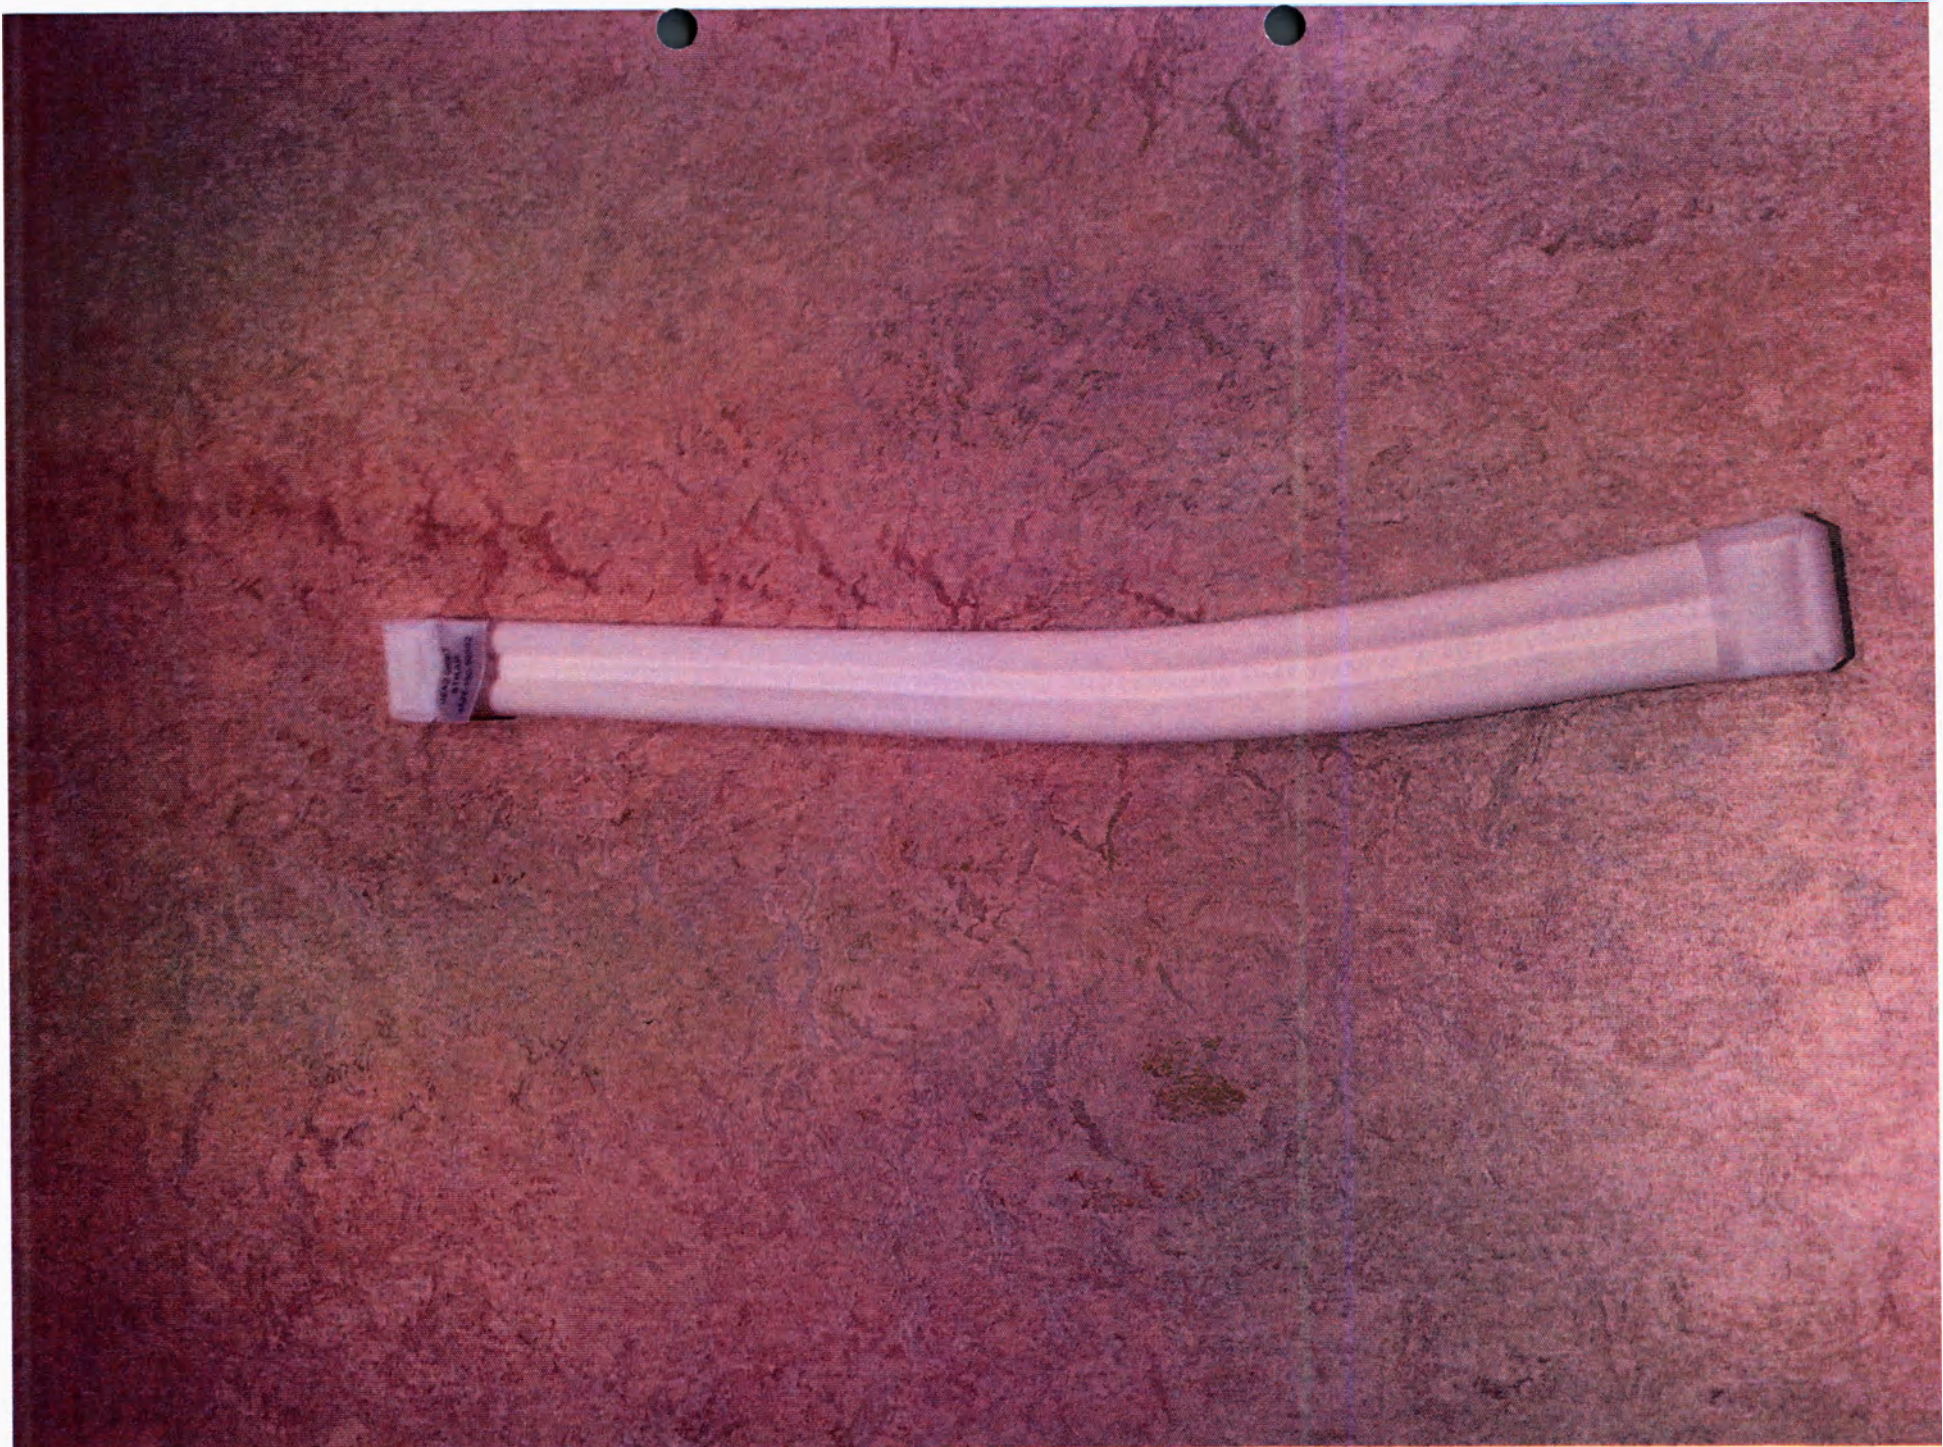


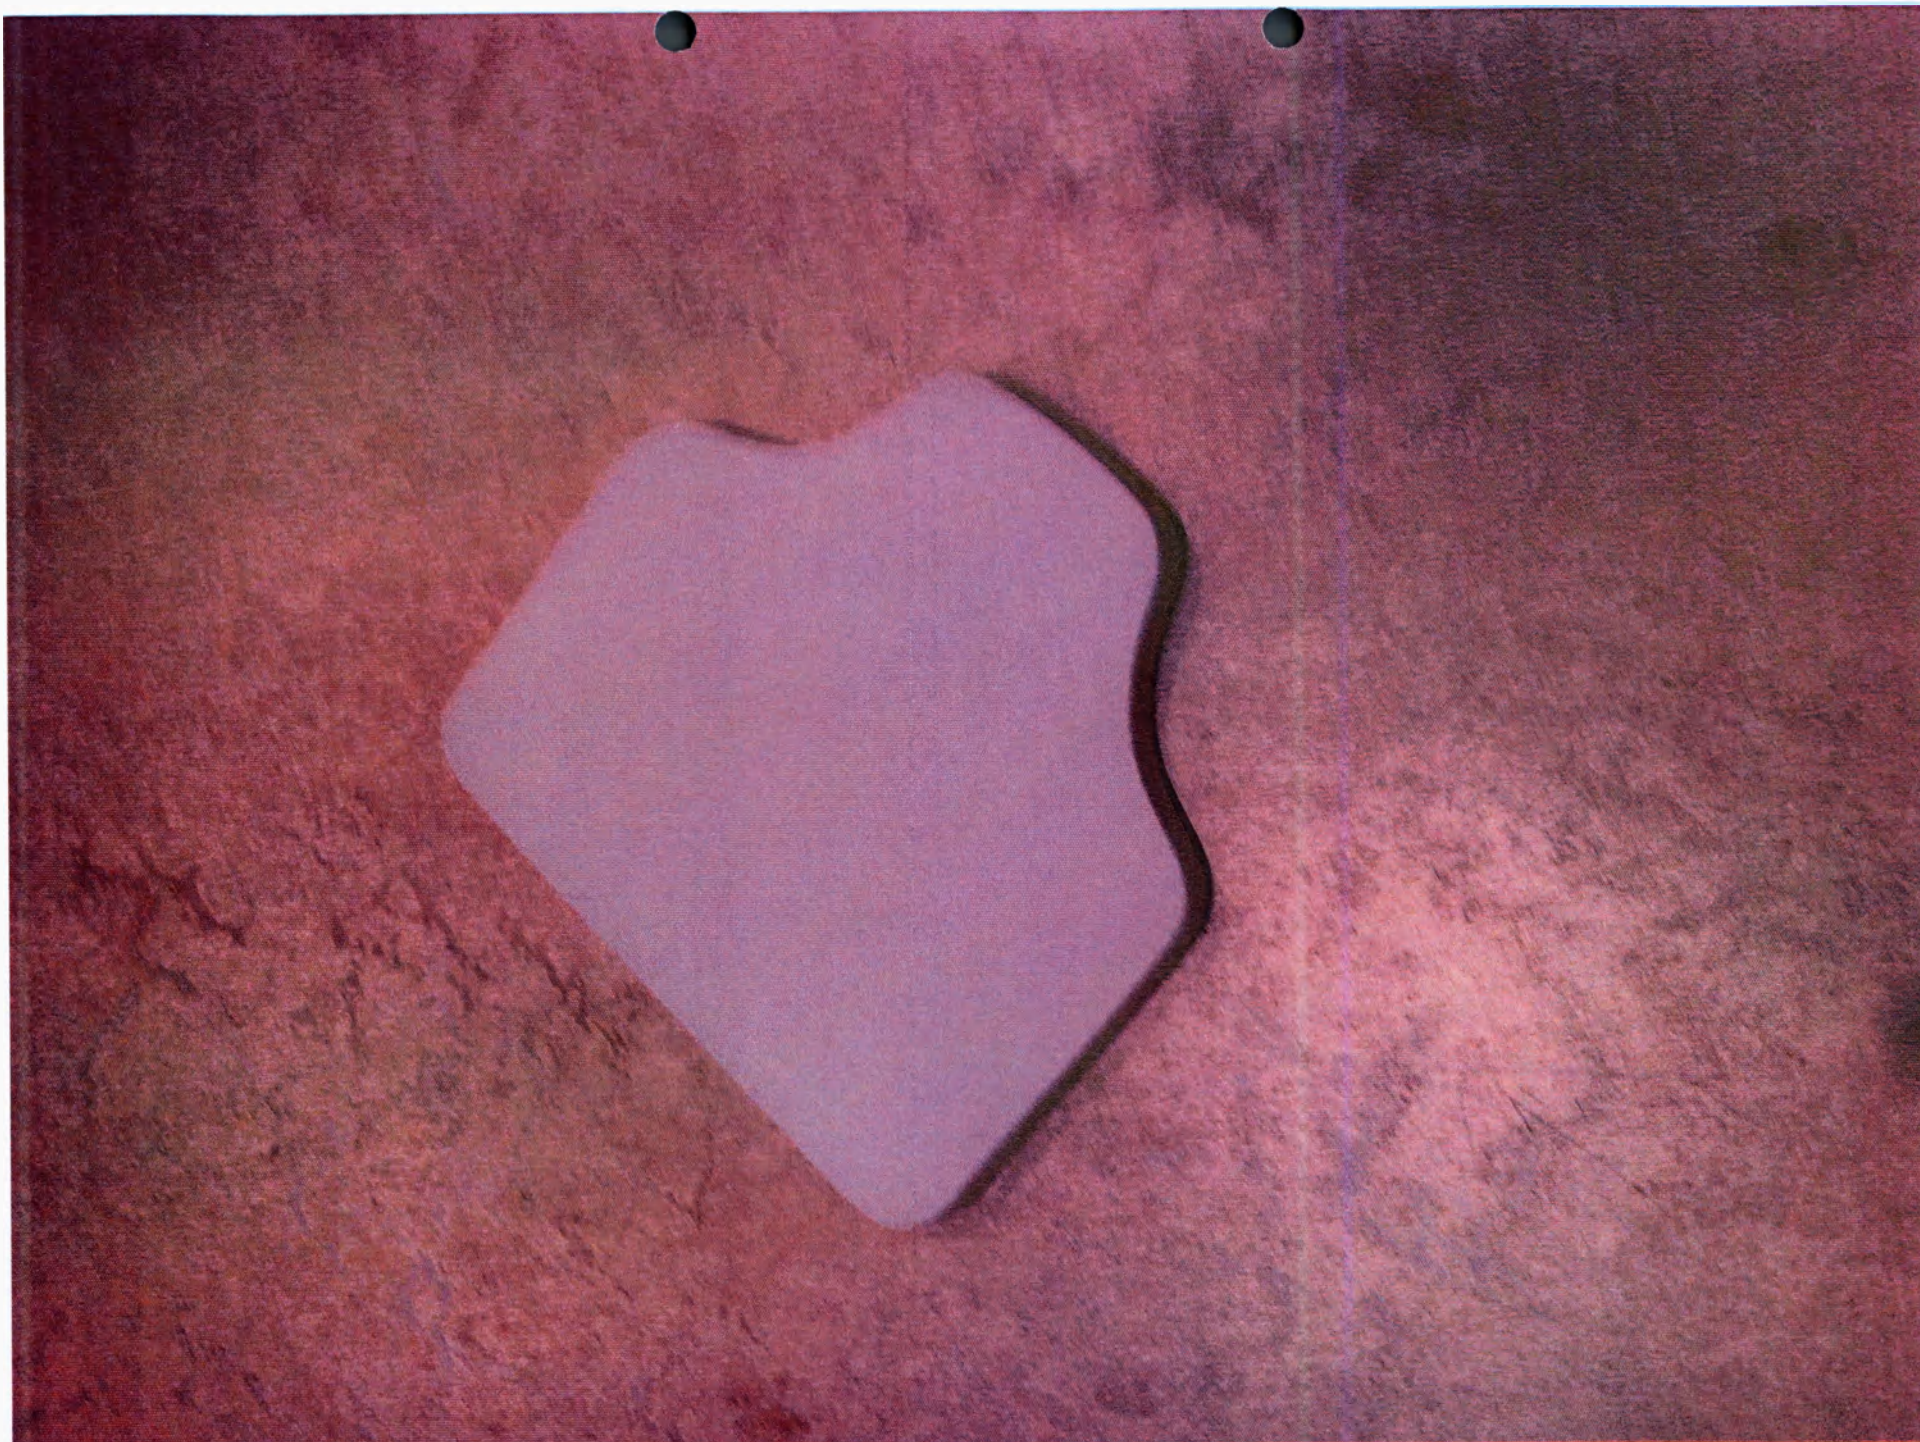

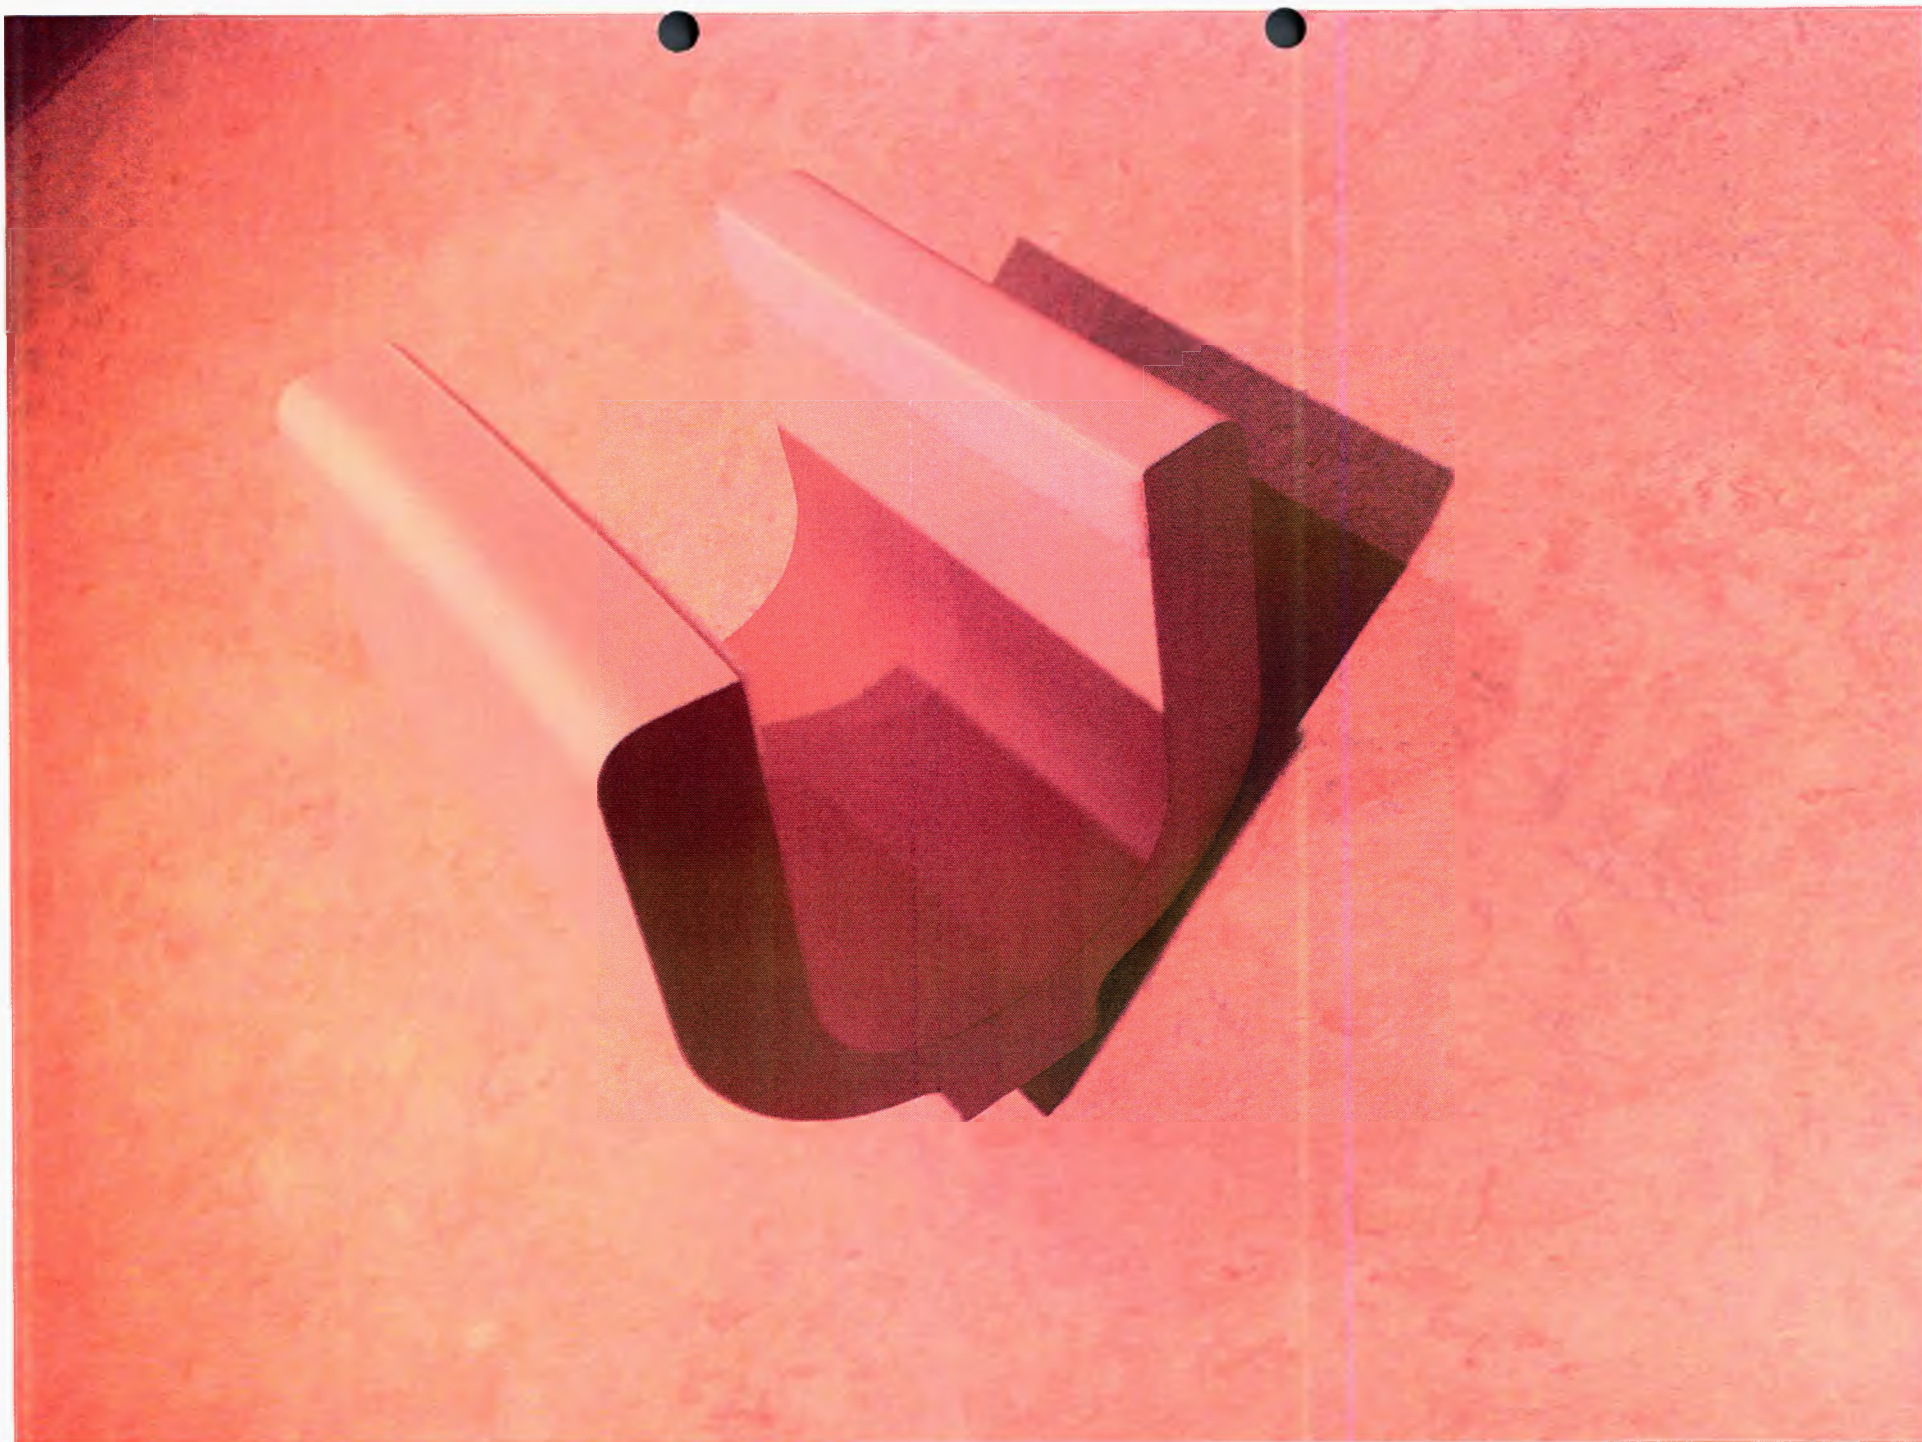





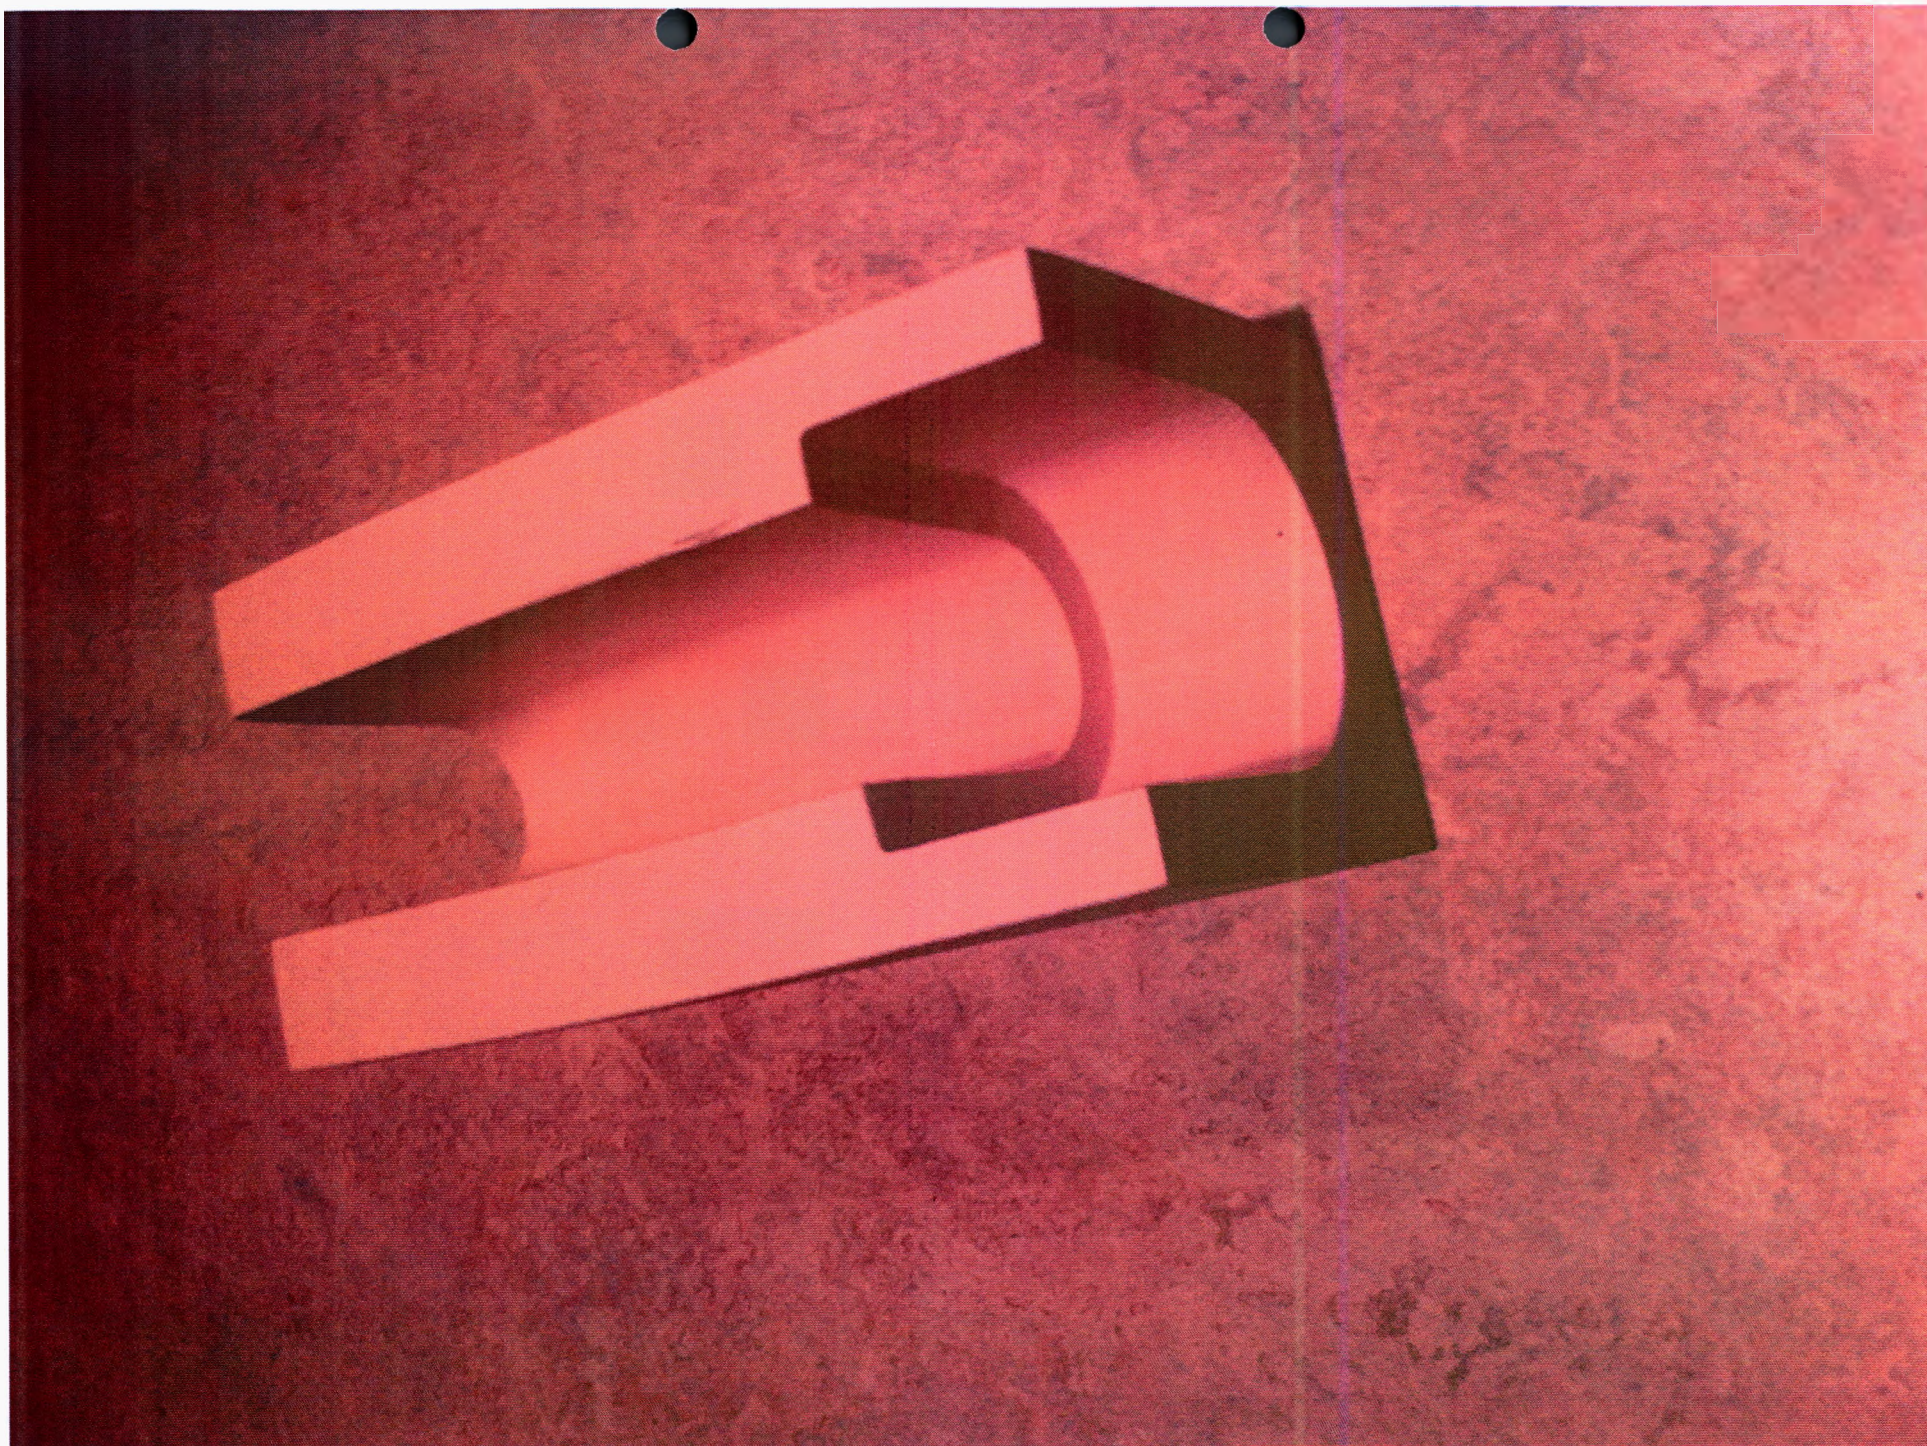


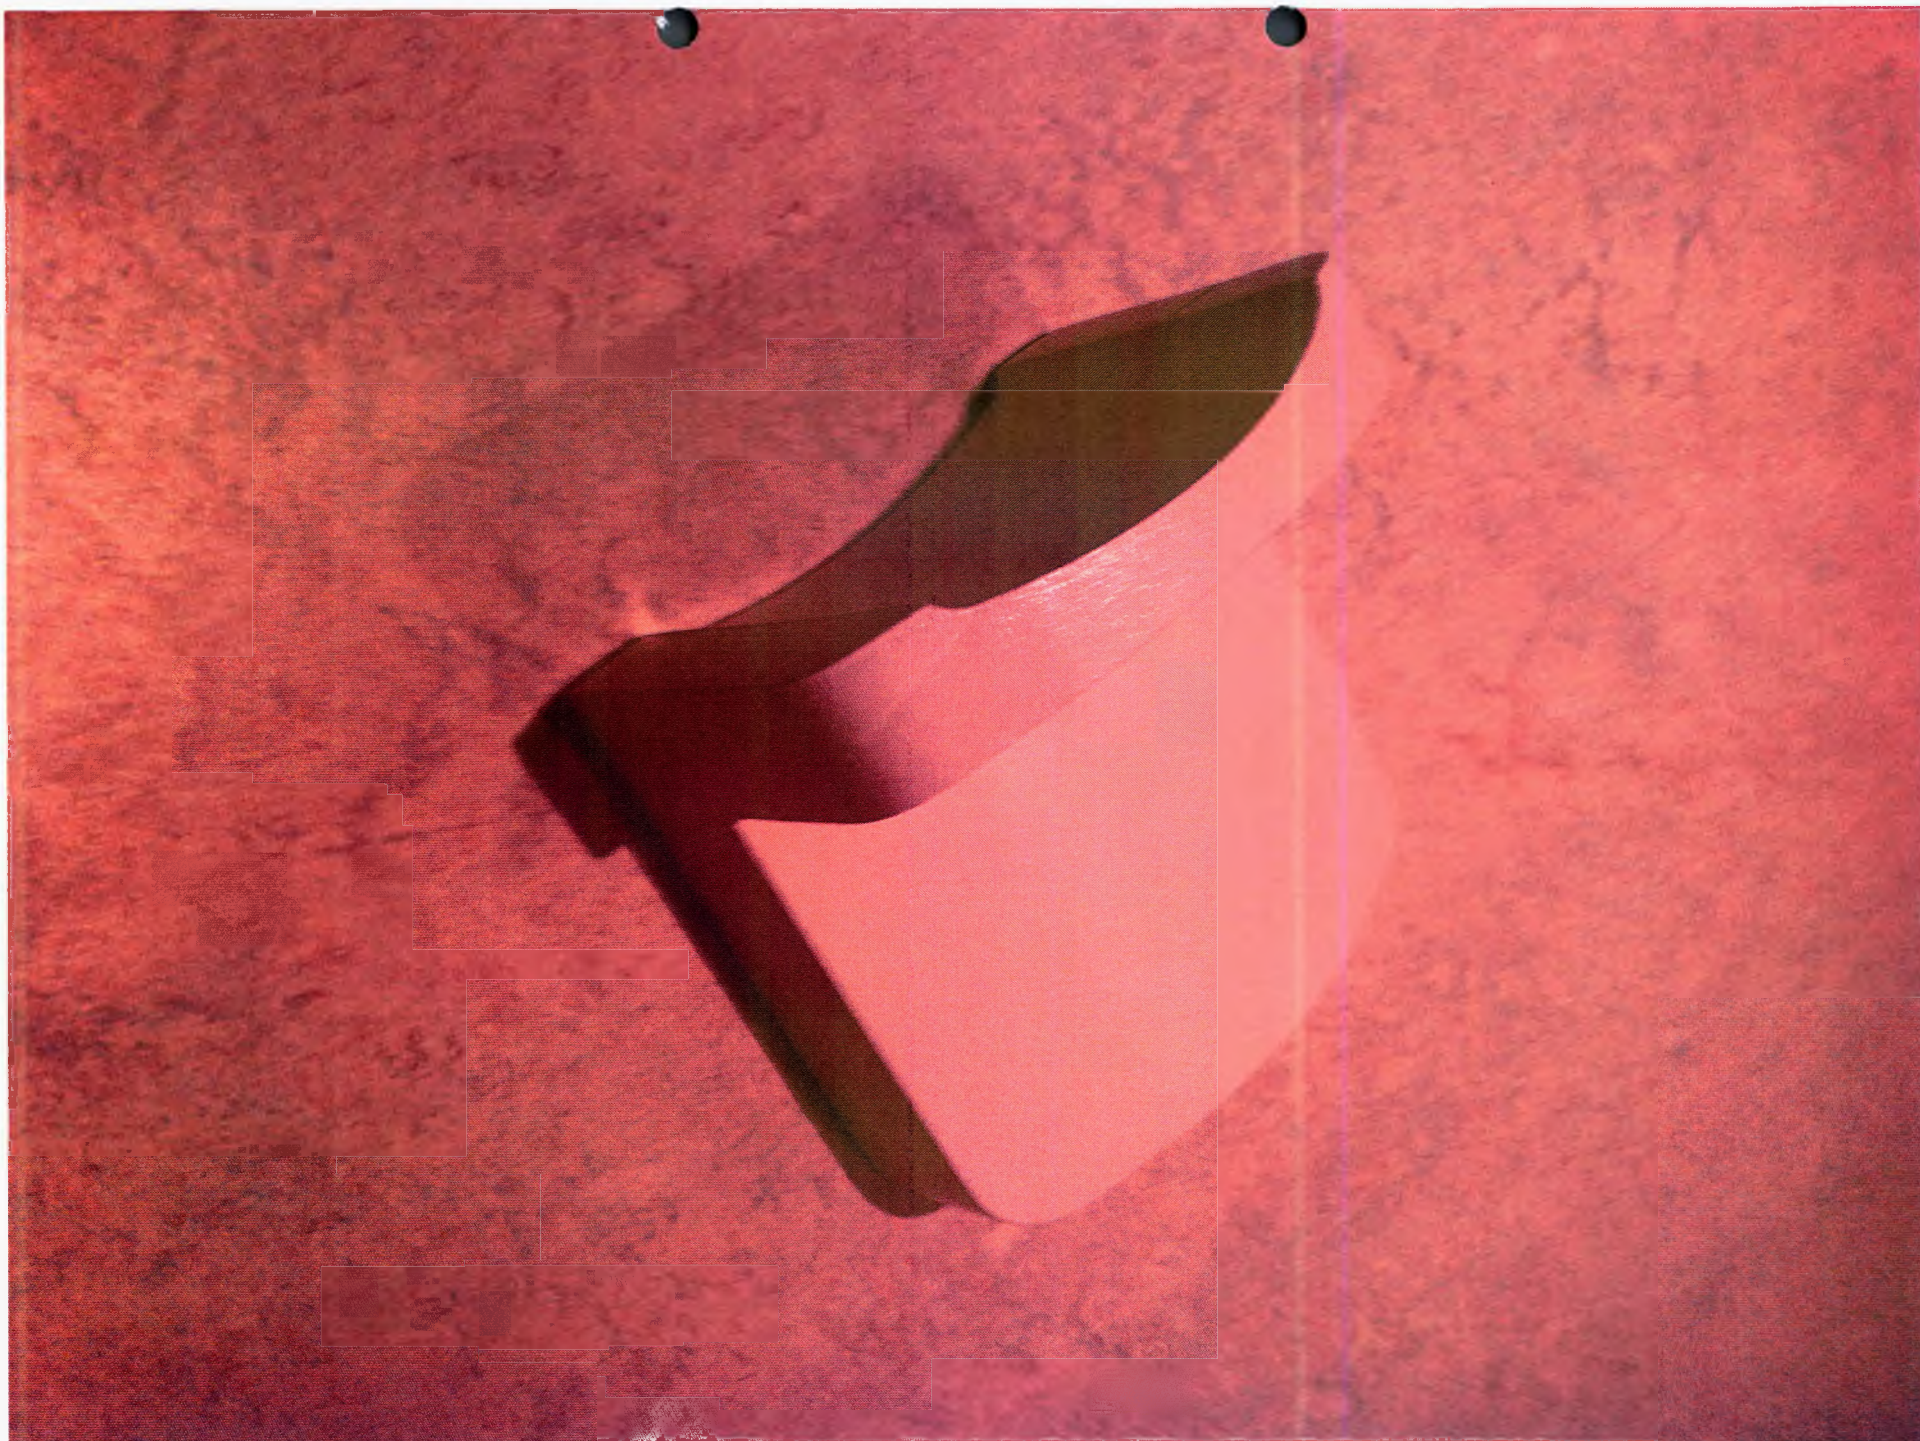




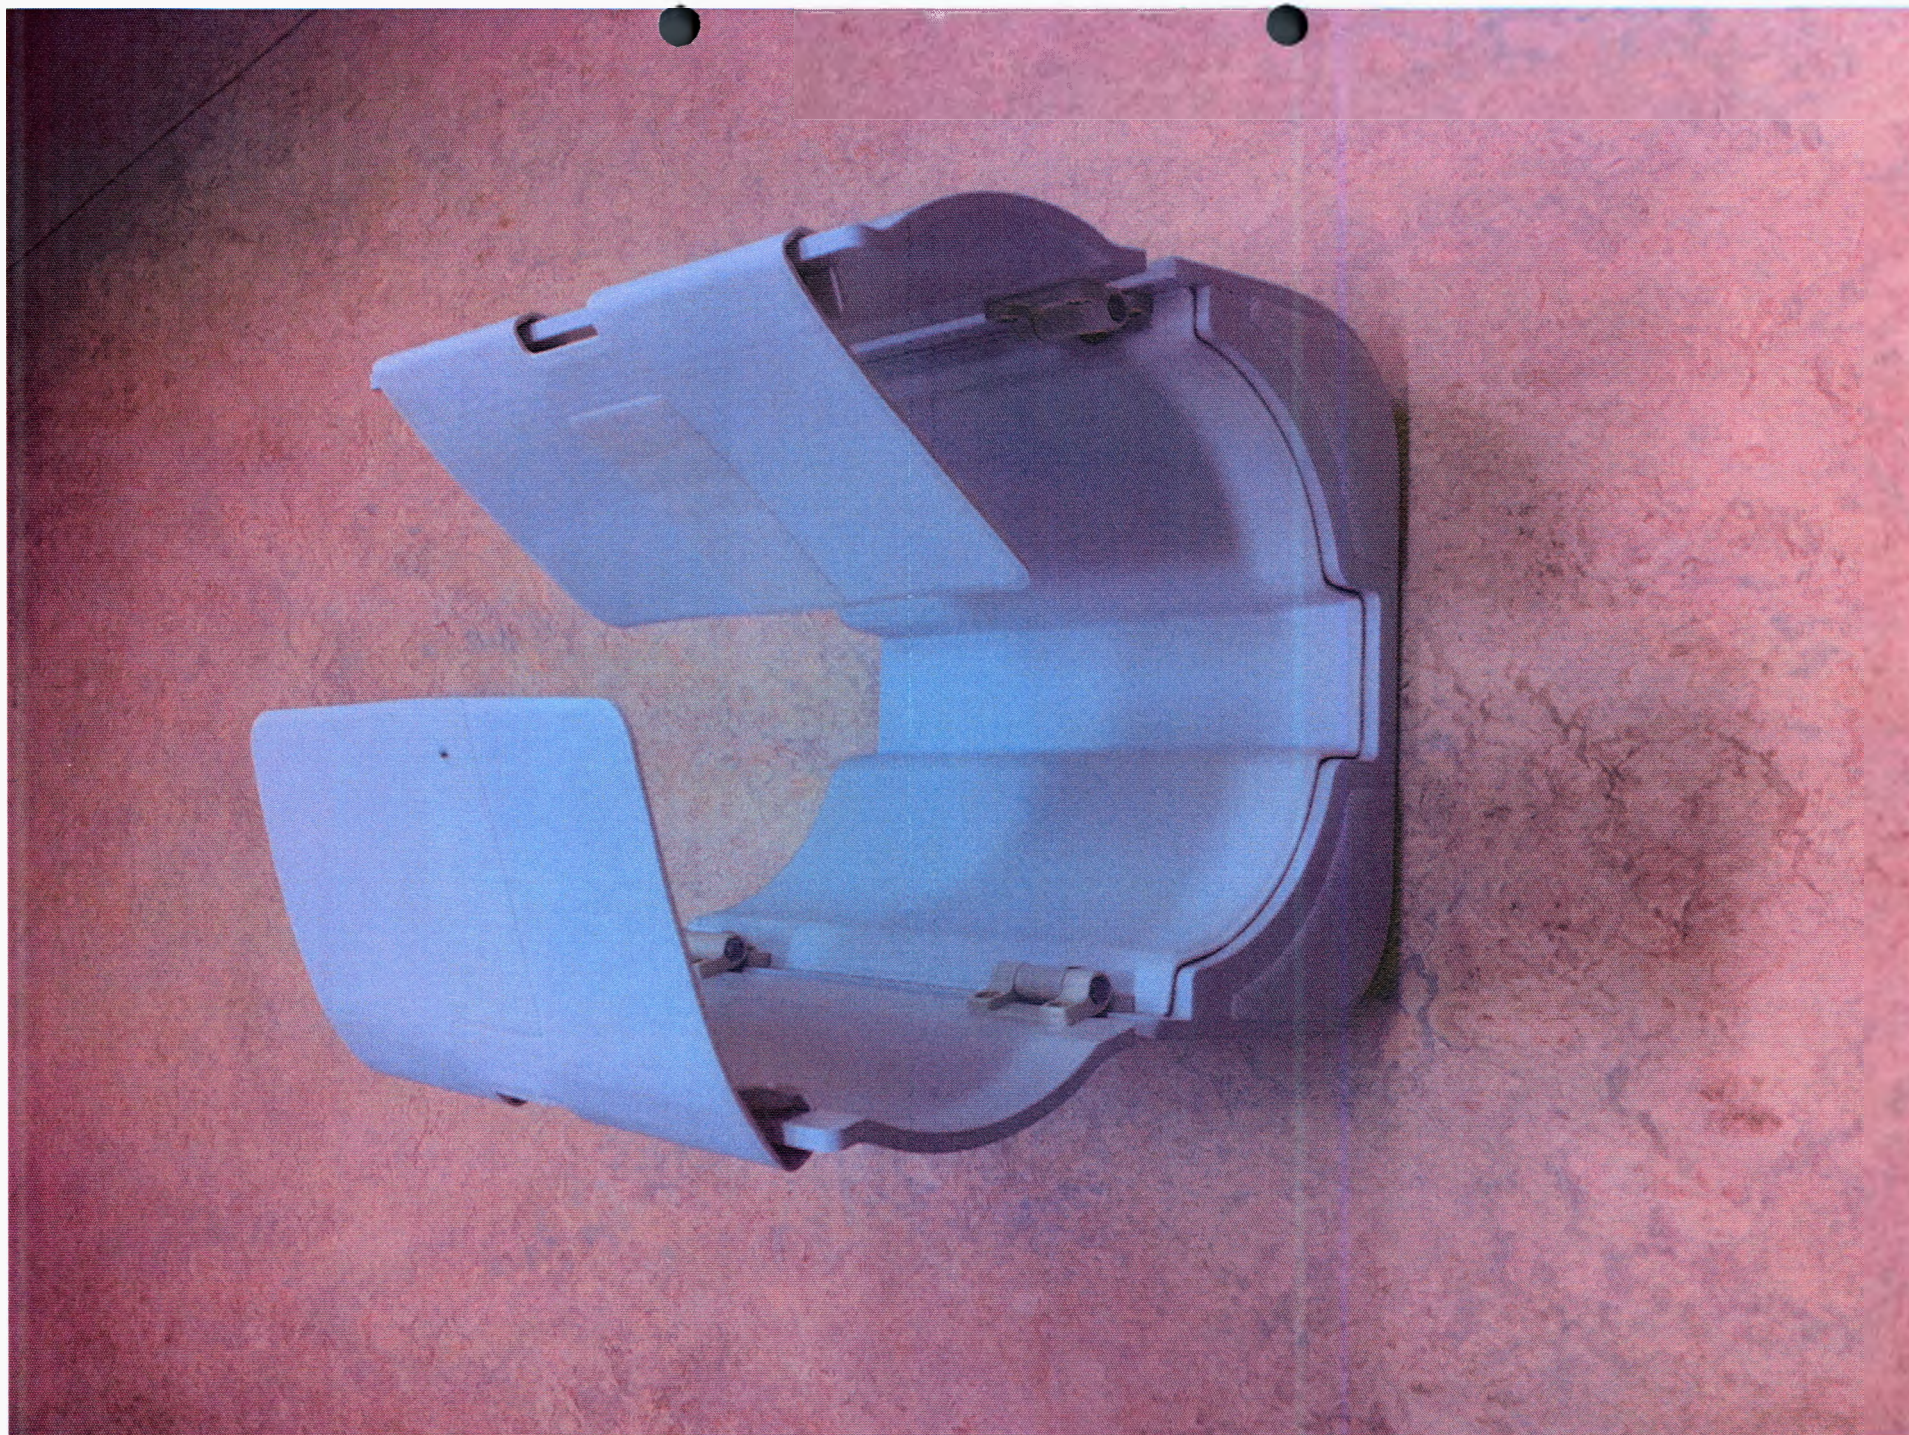

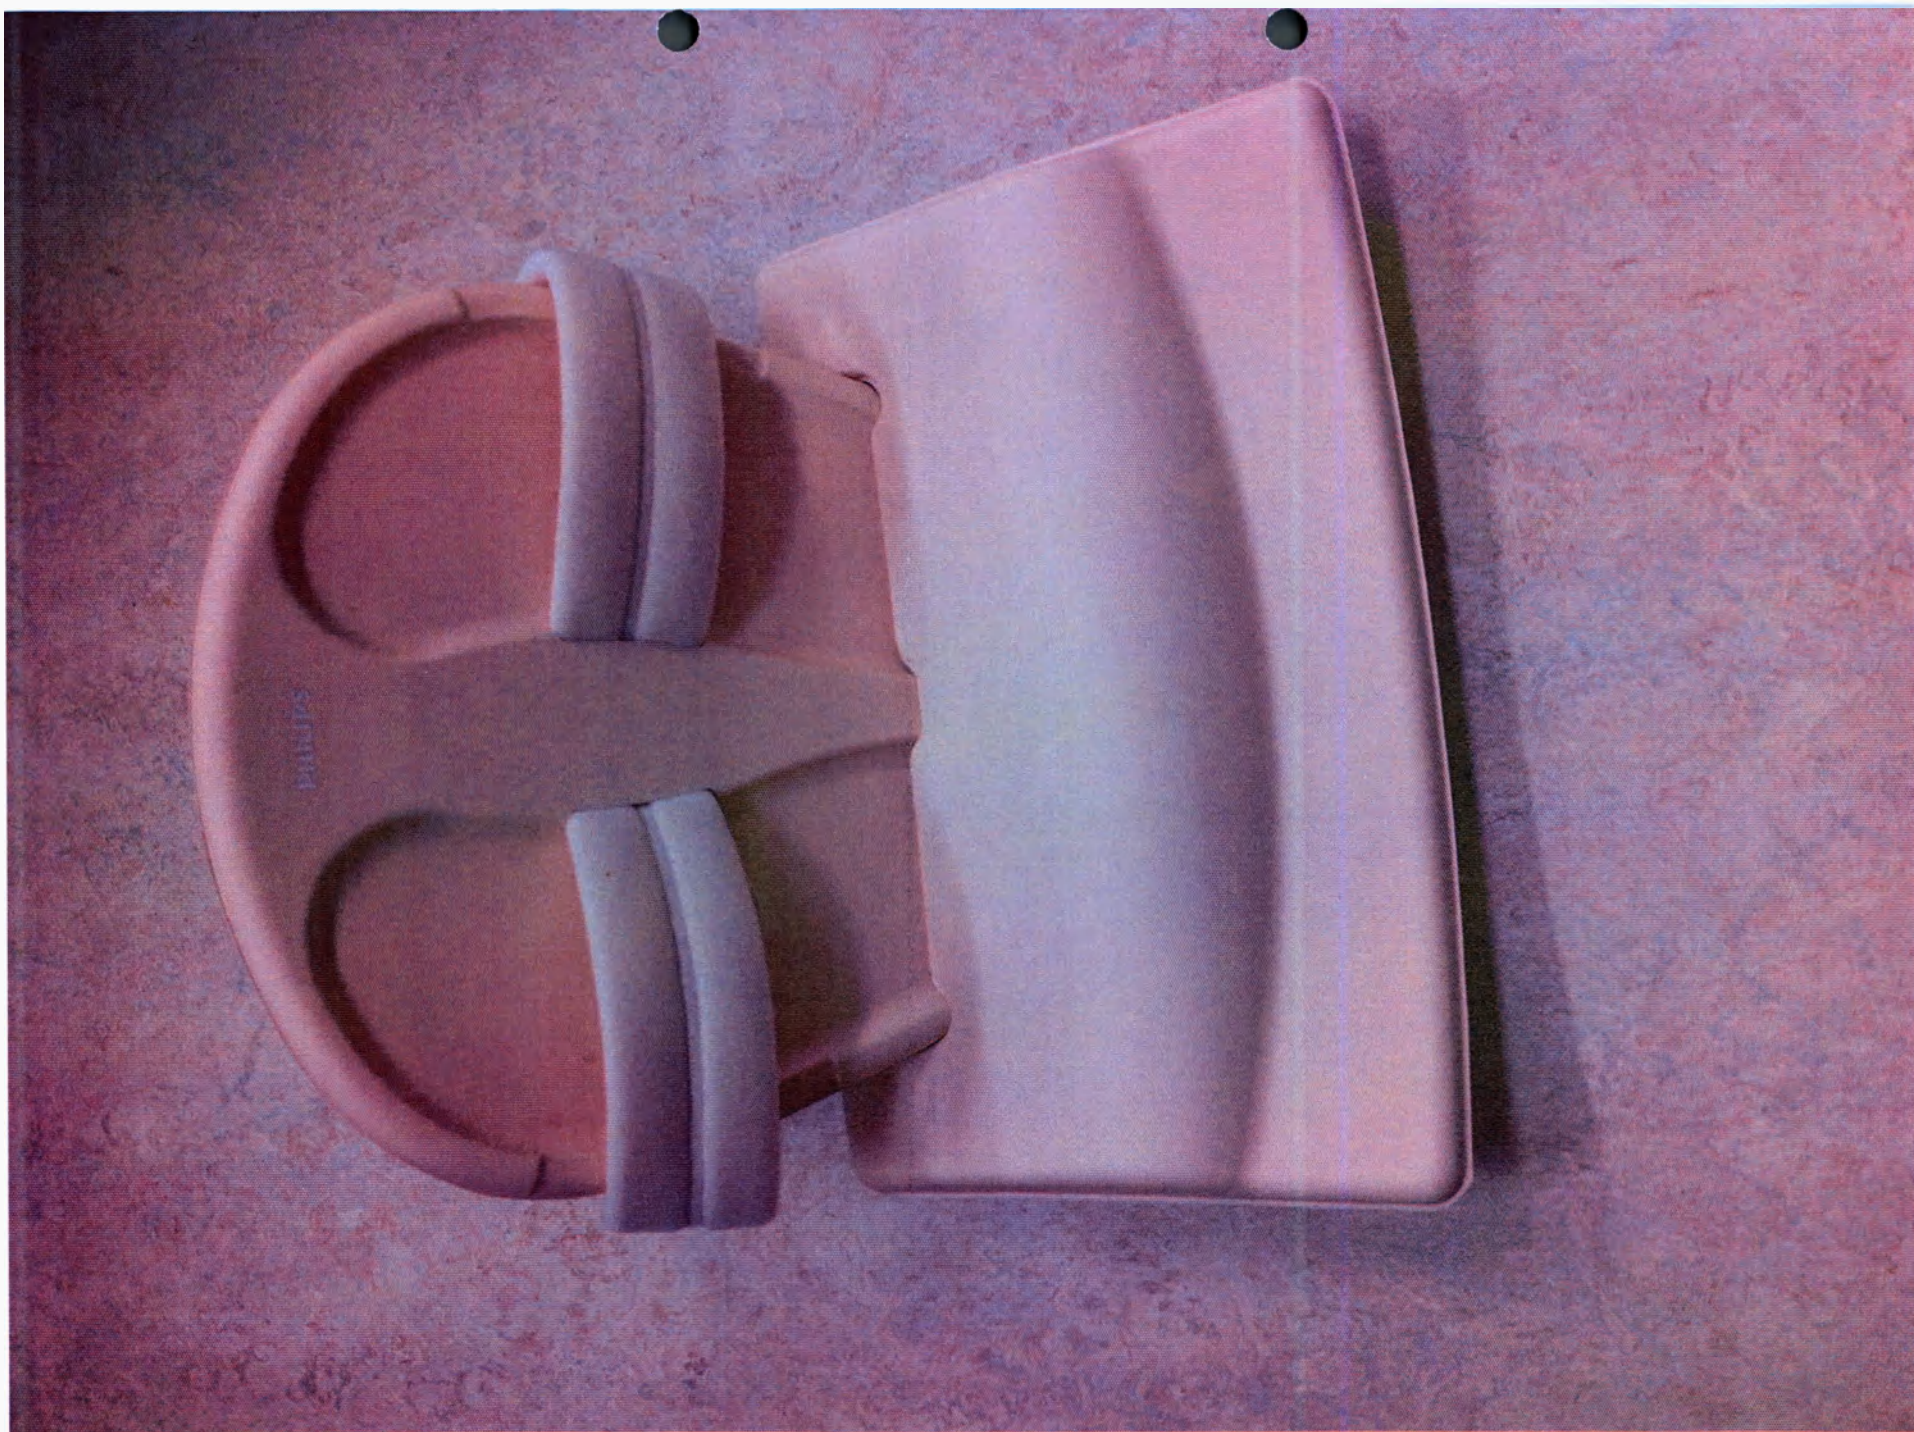

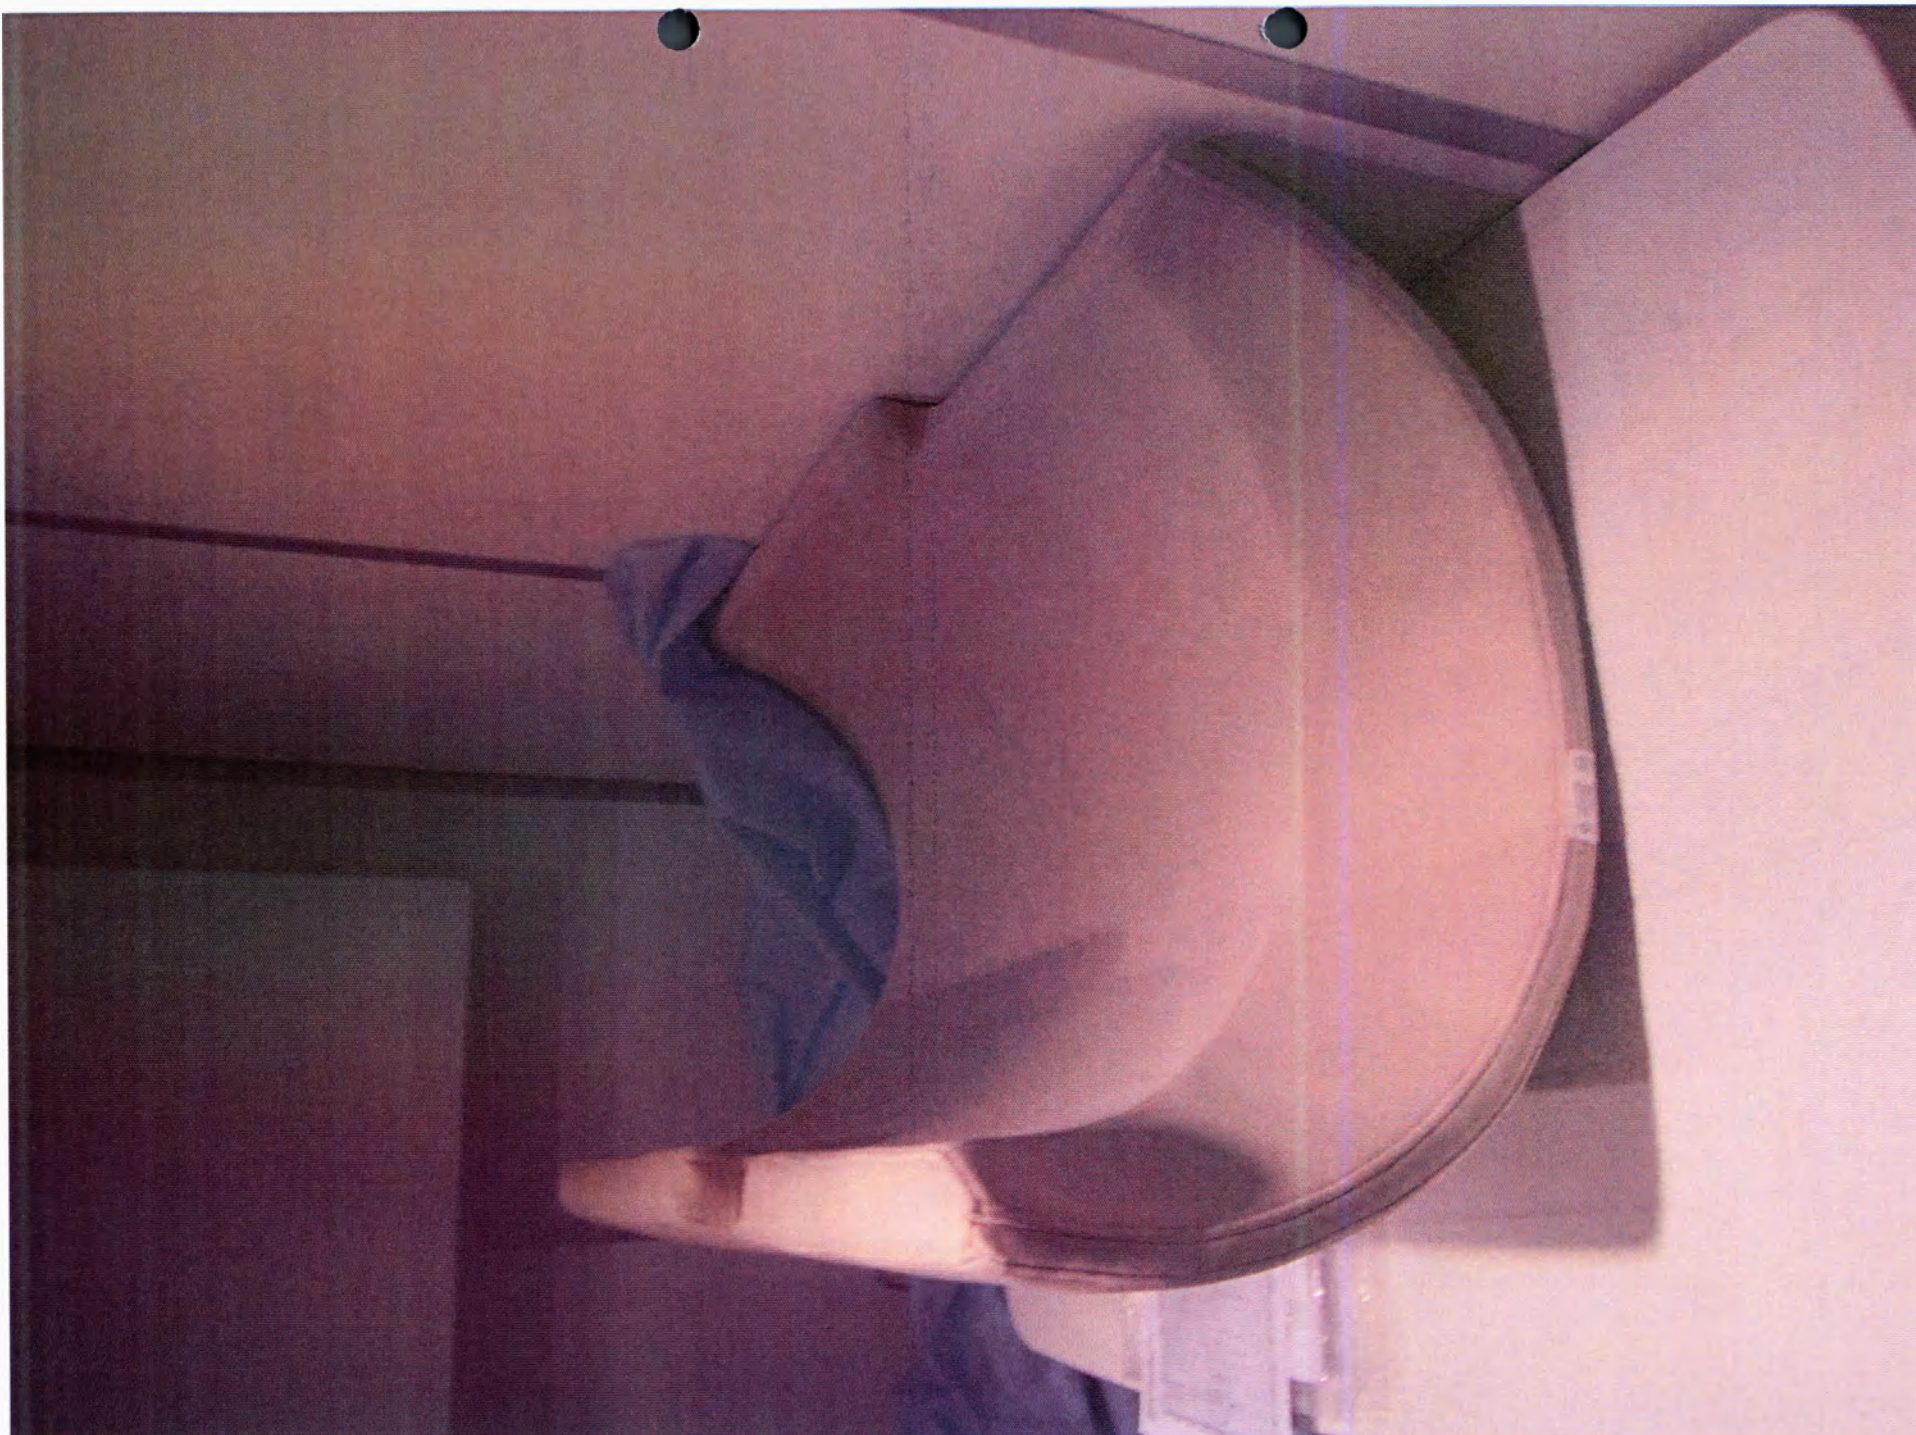

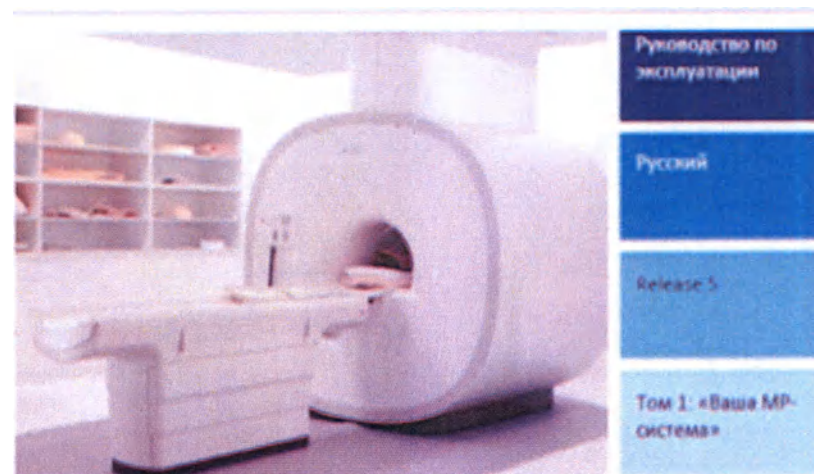

Multiva 1.5T/Omniva 1.5T

PHILIPS



ПРОШИТО
Листов 72/семьдесят два