

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «МедРег Консалтинг»



Ю. Н. Сергеева
2015 г.

Фотографические изображения
медицинского изделия:

**Тест-система BioTracer HIV ½
для иммунохроматографического выявления антител
к вирусу иммунодефицита человека 1 и/или 2 типа
в сыворотке (плазме) или цельной крови**

2015 г.

т-система BioTracer HIV 1/2 для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и/или 2
 типа в сыворотке (плазме) или цельной крови Состав №1:





Bio Tracer

HIV 1/2 Rapid Card

A qualitative screening test kit for the detection of antibodies to HIV 1/2 in human serum, plasma or whole blood.

- | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------|
| Contents | 1. Test devices in a foil pouch | 30 Tests |
| | 2. Bottle containing diluents | 1ea |
| | 3. Disposable pipette | 30ea |
| | 4. Lancets | 30ea |
| | 5. Alcohol swabs | 30ea |
| | 6. Instructions for use | 1ea |

REF 11112G

LOT 11112502

EXP 08.09.2016



Bio Focus Co., Ltd.
11, Tsim Sha Tsui Road
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2300 8888
Fax: +852 2300 8889
Email: info@biofocus.com

QC

PASSED
For Professional Use Only



Bio Tracer


HIV 1/2 Rapid Card

A qualitative screening test kit for the detection of antibodies to HIV 1/2 in human serum, plasma or whole blood.


For professional use only. Not for home use.
Store at 2-8°C. Do not freeze. Use within 12 months of opening.

REF: 11112G
LOT: 11112502
EXP: 08.09.2016


Тест-кассета: в герметичной упаковке из алюминиевой фольги

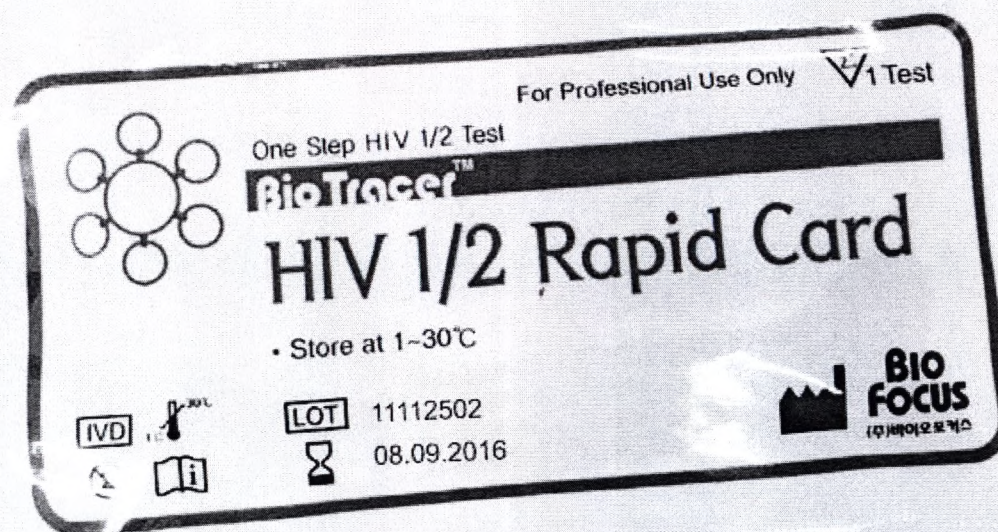


Тест-кассета: без упаковки

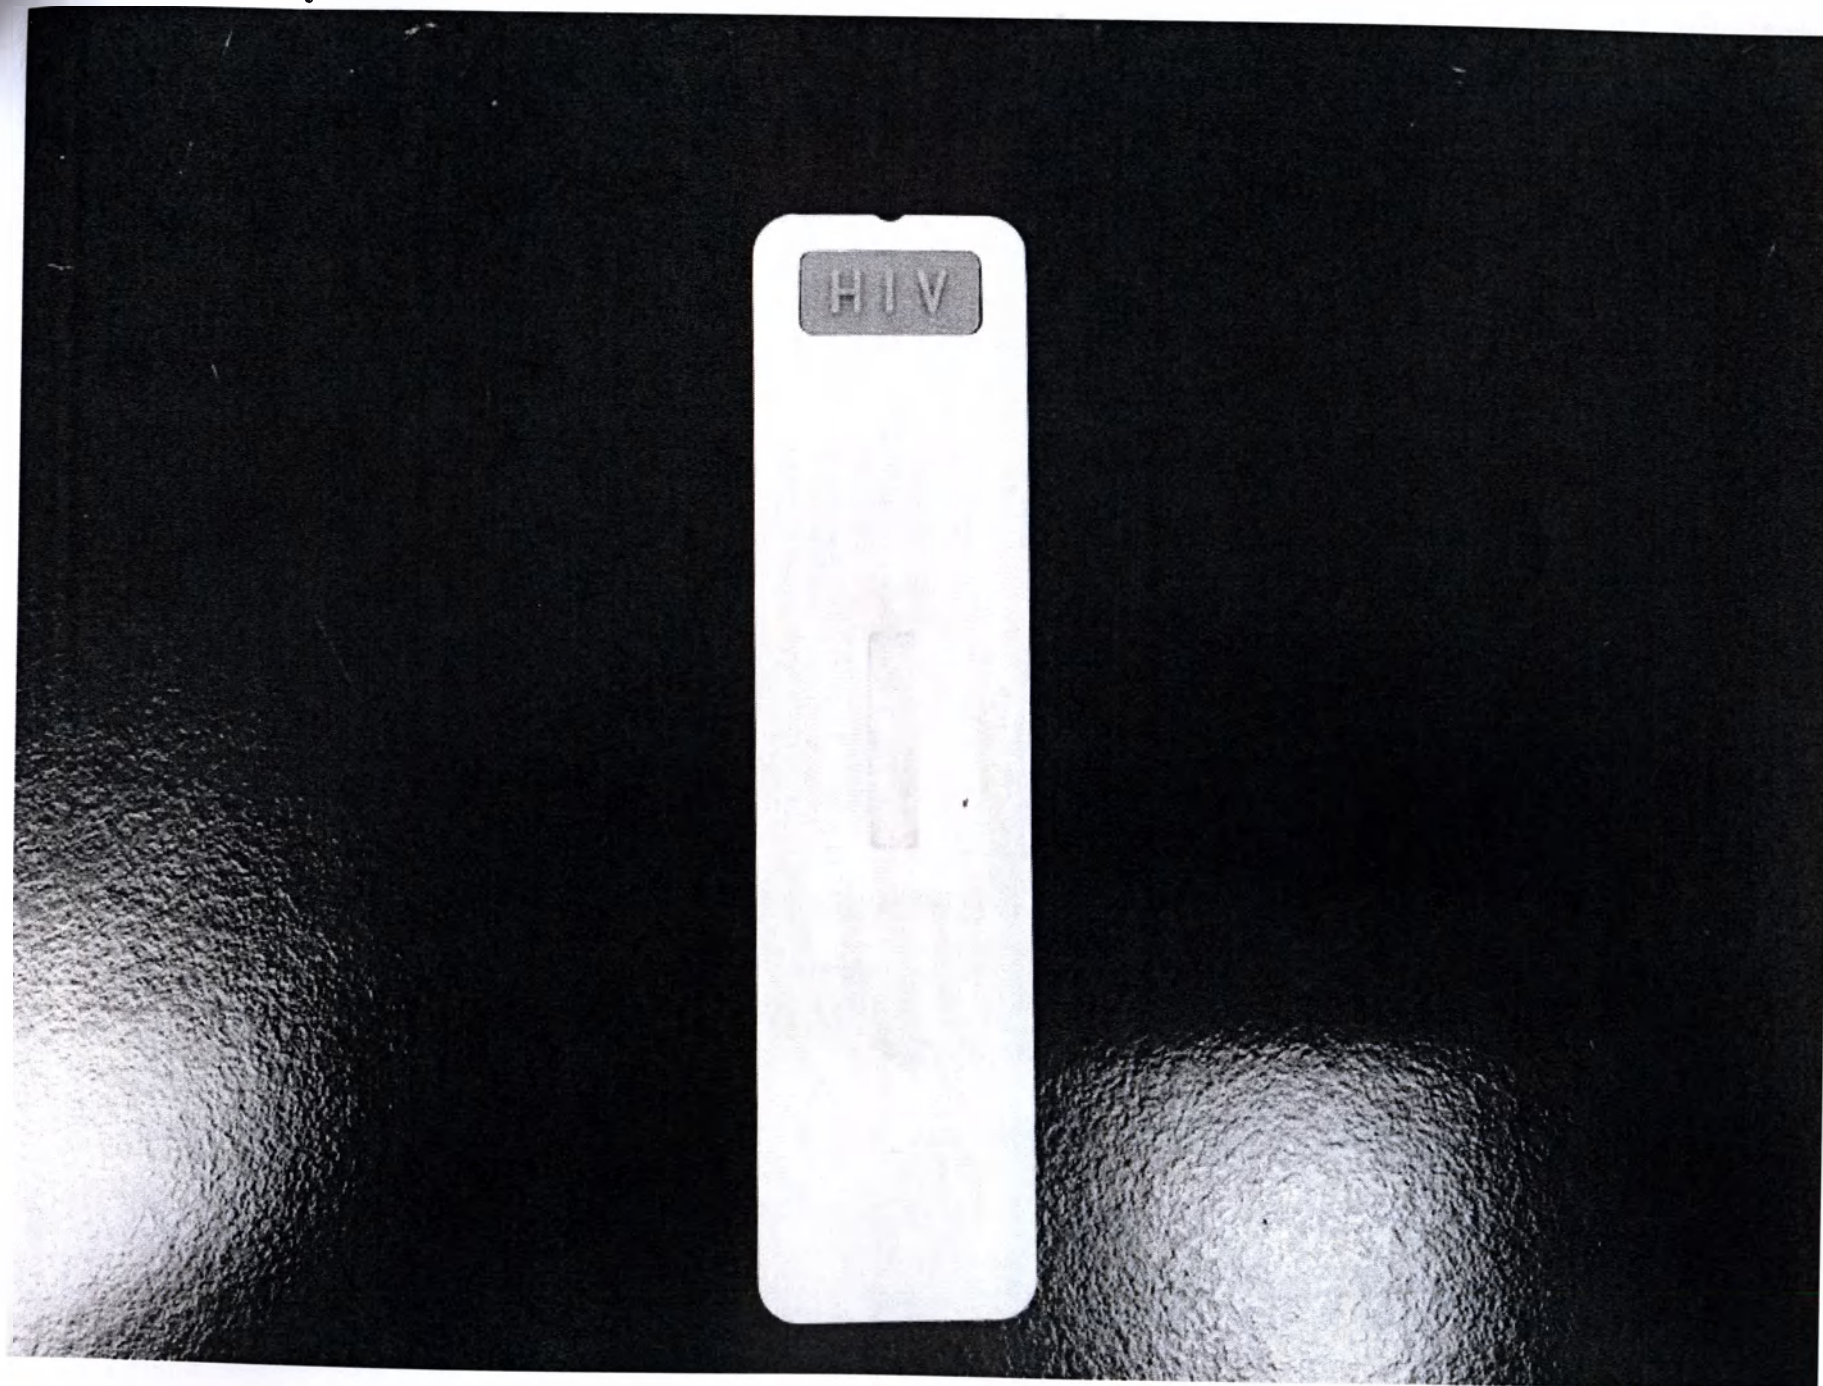


Буферный раствор:

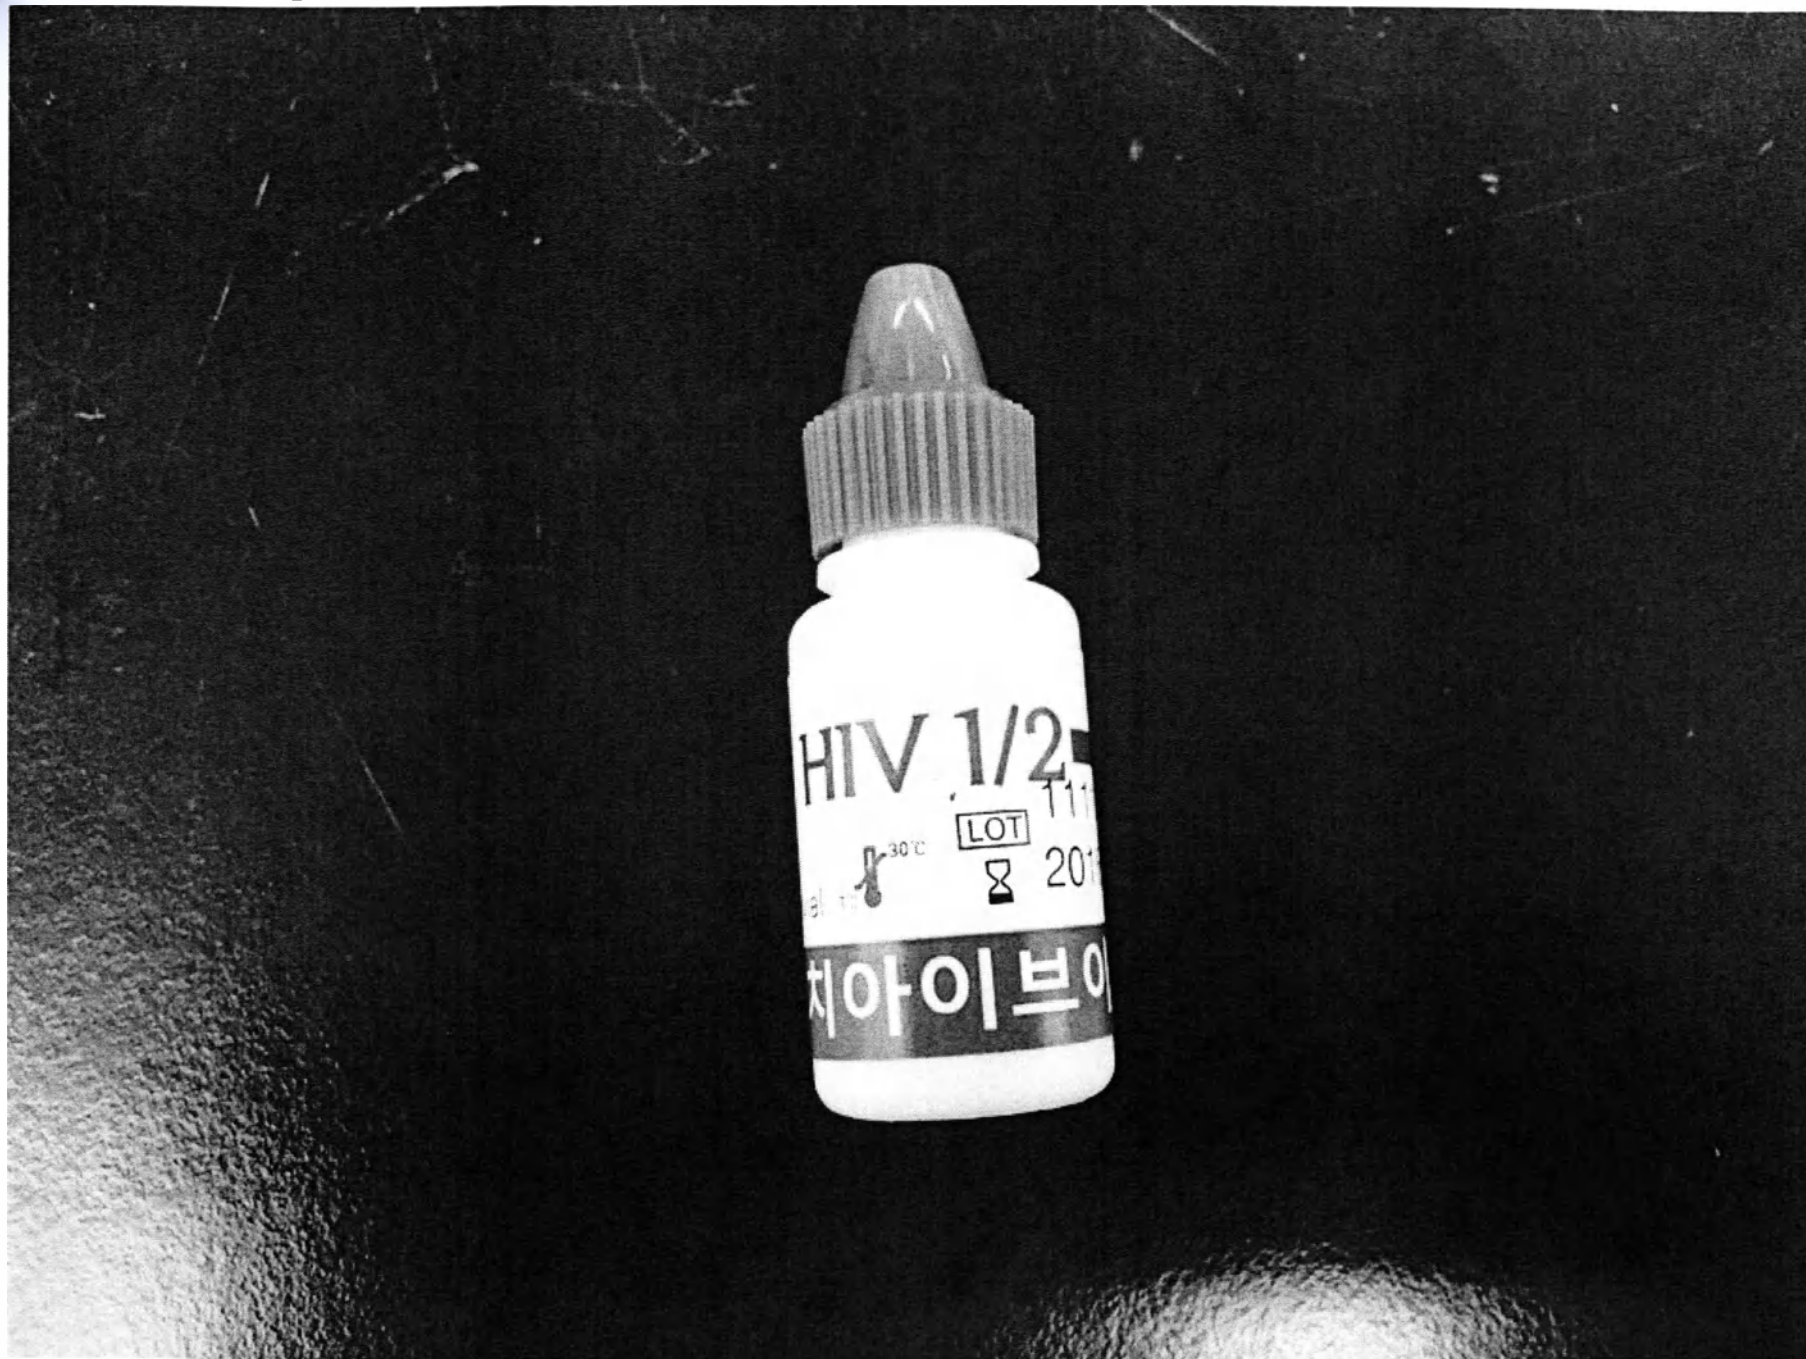

Пипетка:

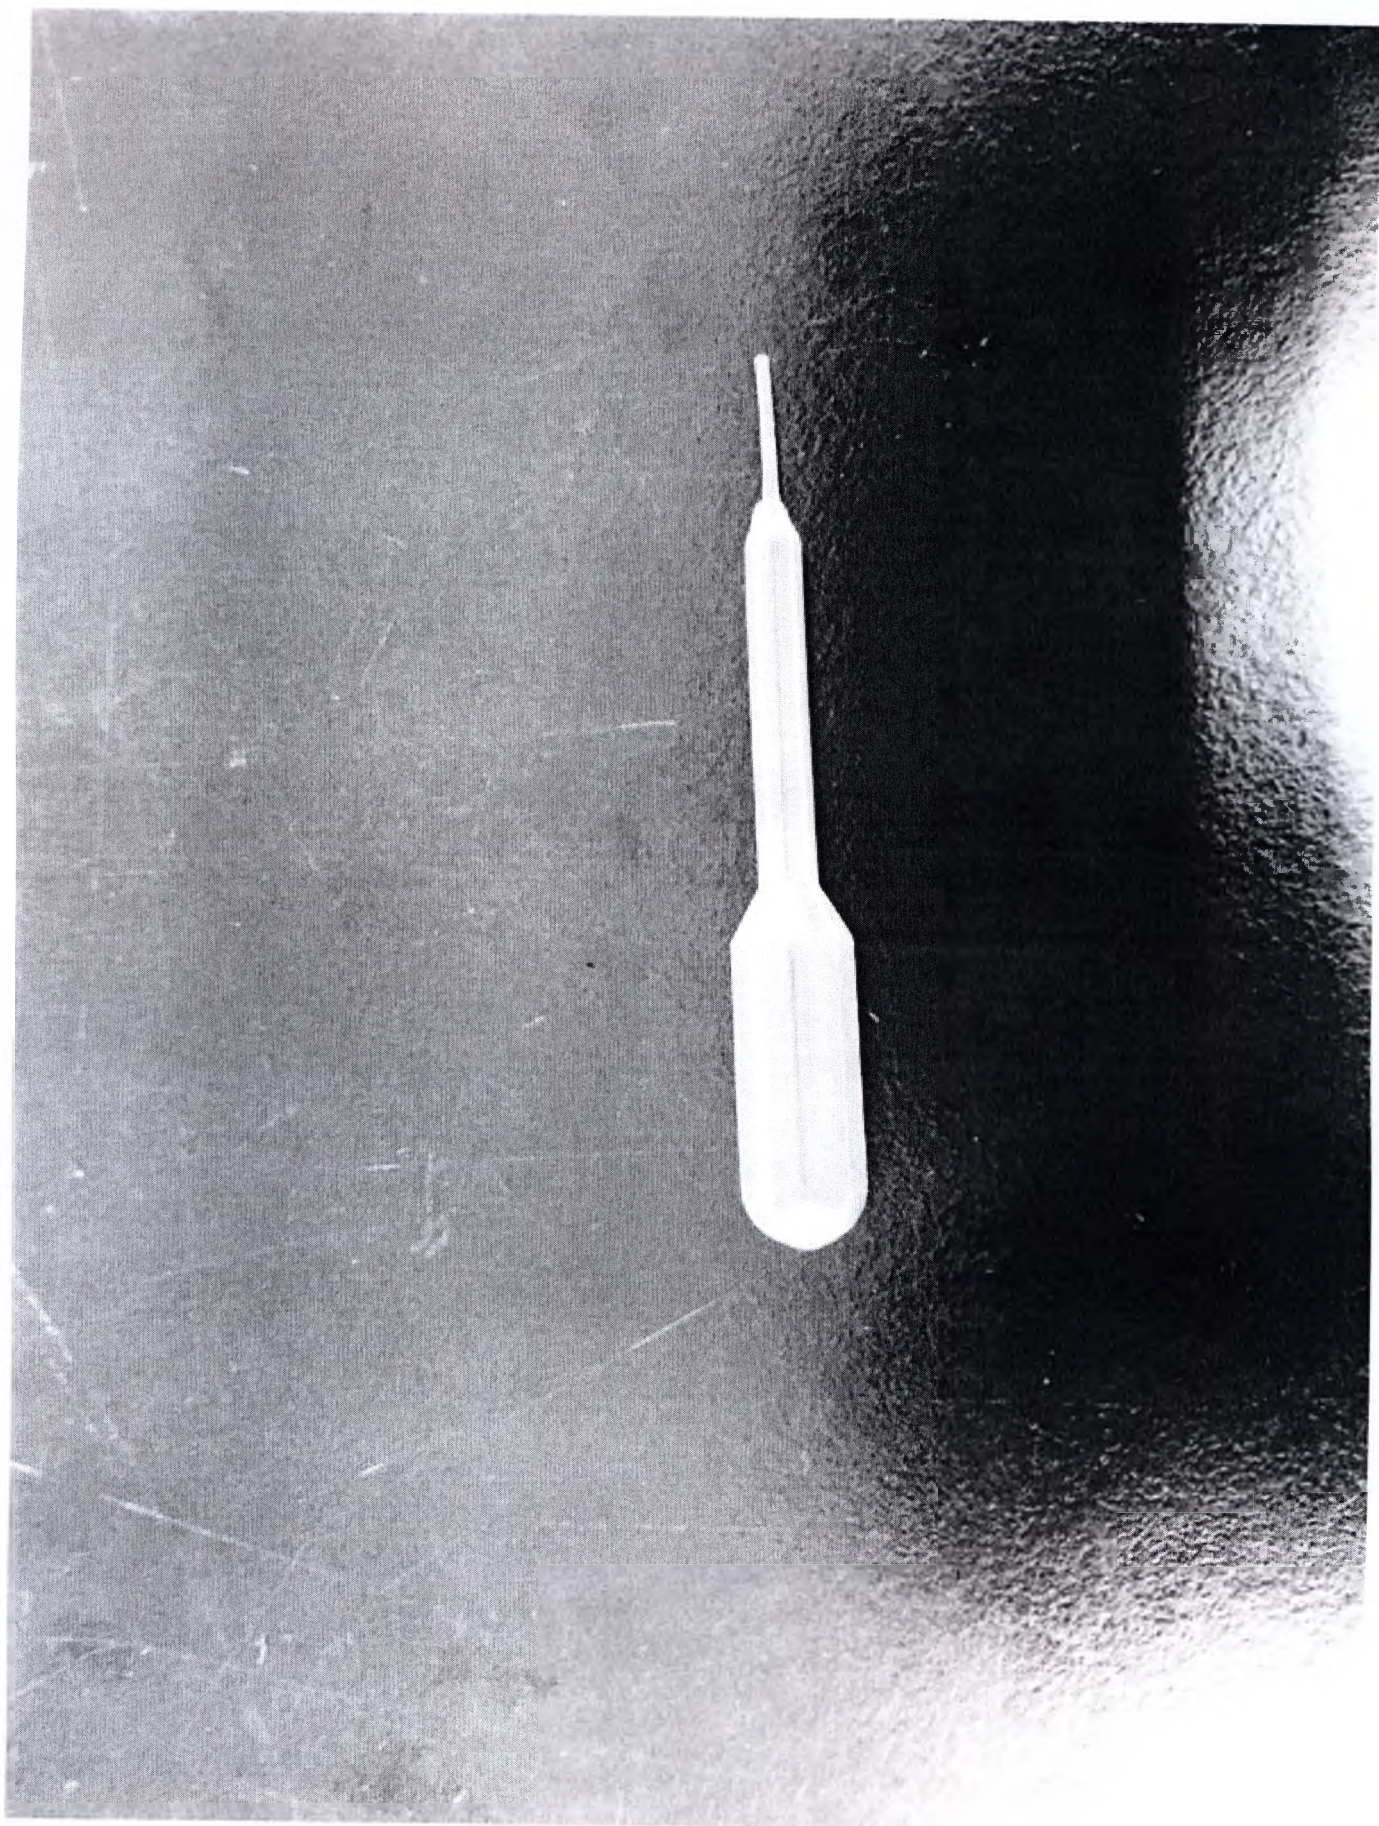

Ланцет-скарifikатор:

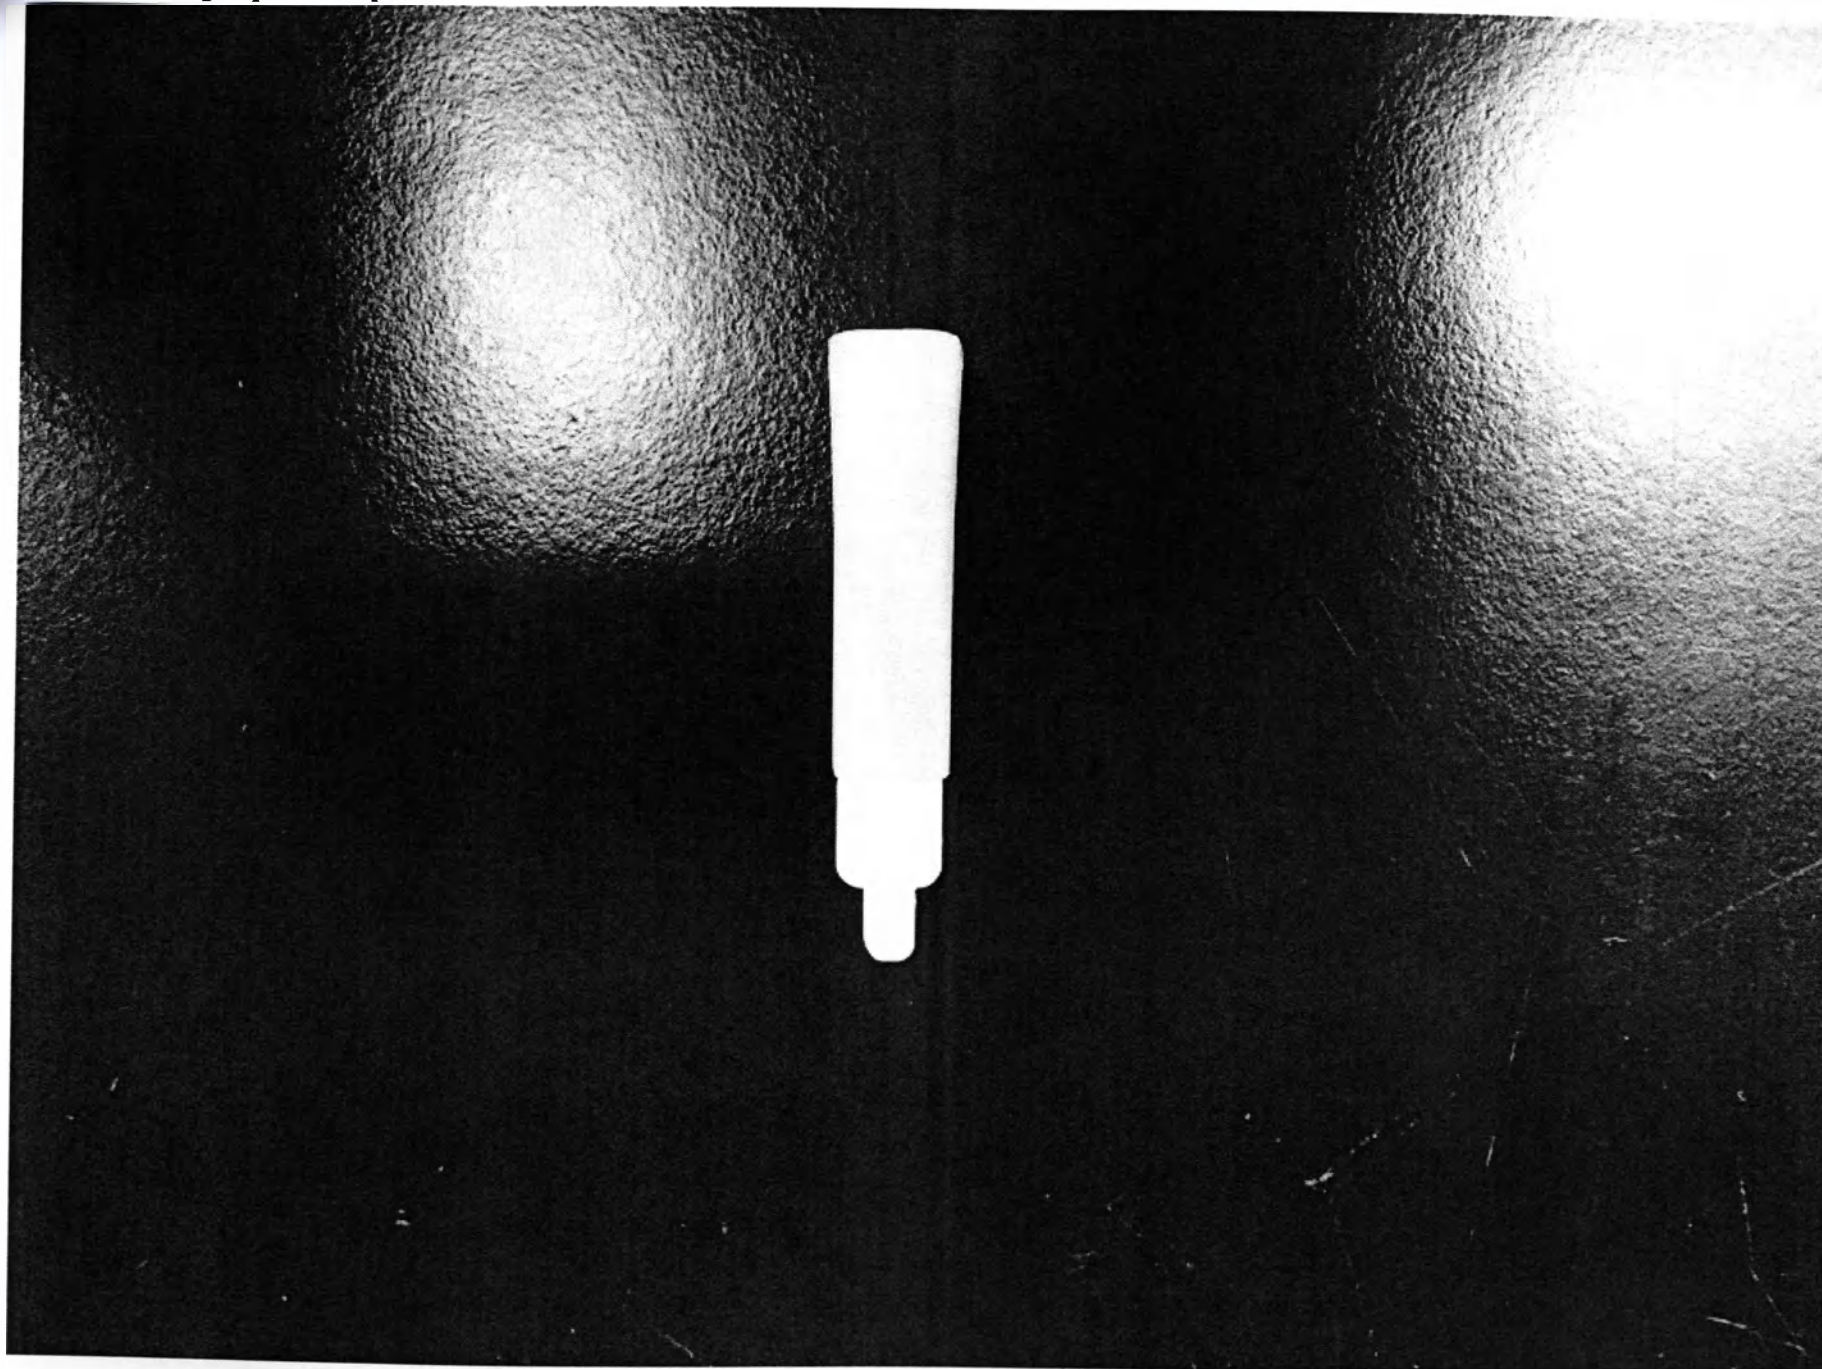

AIM Alcohol Prep Pad

FOR EXTERNAL USE ONLY

Saturated with 70%
Isopropyl Alcohol

 **LOT NO. : A1609**

 **MFG. DATE : 2013. 09. 23**

 **EXP. DATE : 2016. 09. 22**

For Disinfection Use
Do not re-use



Тест-система BioTracer HIV 1/2 для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и/или 2 типа в сыворотке (плазме) или цельной крови: Состав №2:





Bio Tracer

HIV 1/2 Rapid Card

A qualitative screening test kit for the detection of antibodies to HIV 1/2 in human serum, plasma or whole blood.

For in vitro diagnostic use only

Store at 1~30 °C


Please read 'Instructions for use' for complete directions

REF 11112

LOT 11112G401


22.01.2016

QC




Bio Focus Co., Ltd.
9F, Daehyun Technoworld,
19, Ojeonggongseop-gil, Ulsan-gu,
Gyeonggi-do, 437-753 Korea
<http://www.biofocus.co.kr>


Тест-кассета: в герметичной упаковке из алюминиевой фольги

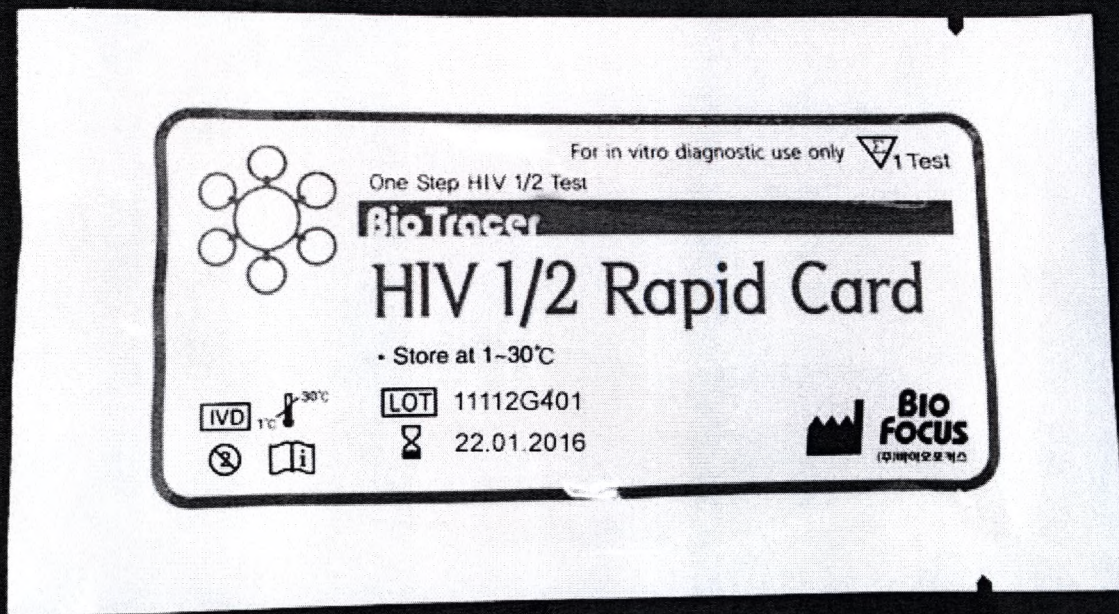

Тест-кассета: без упаковки

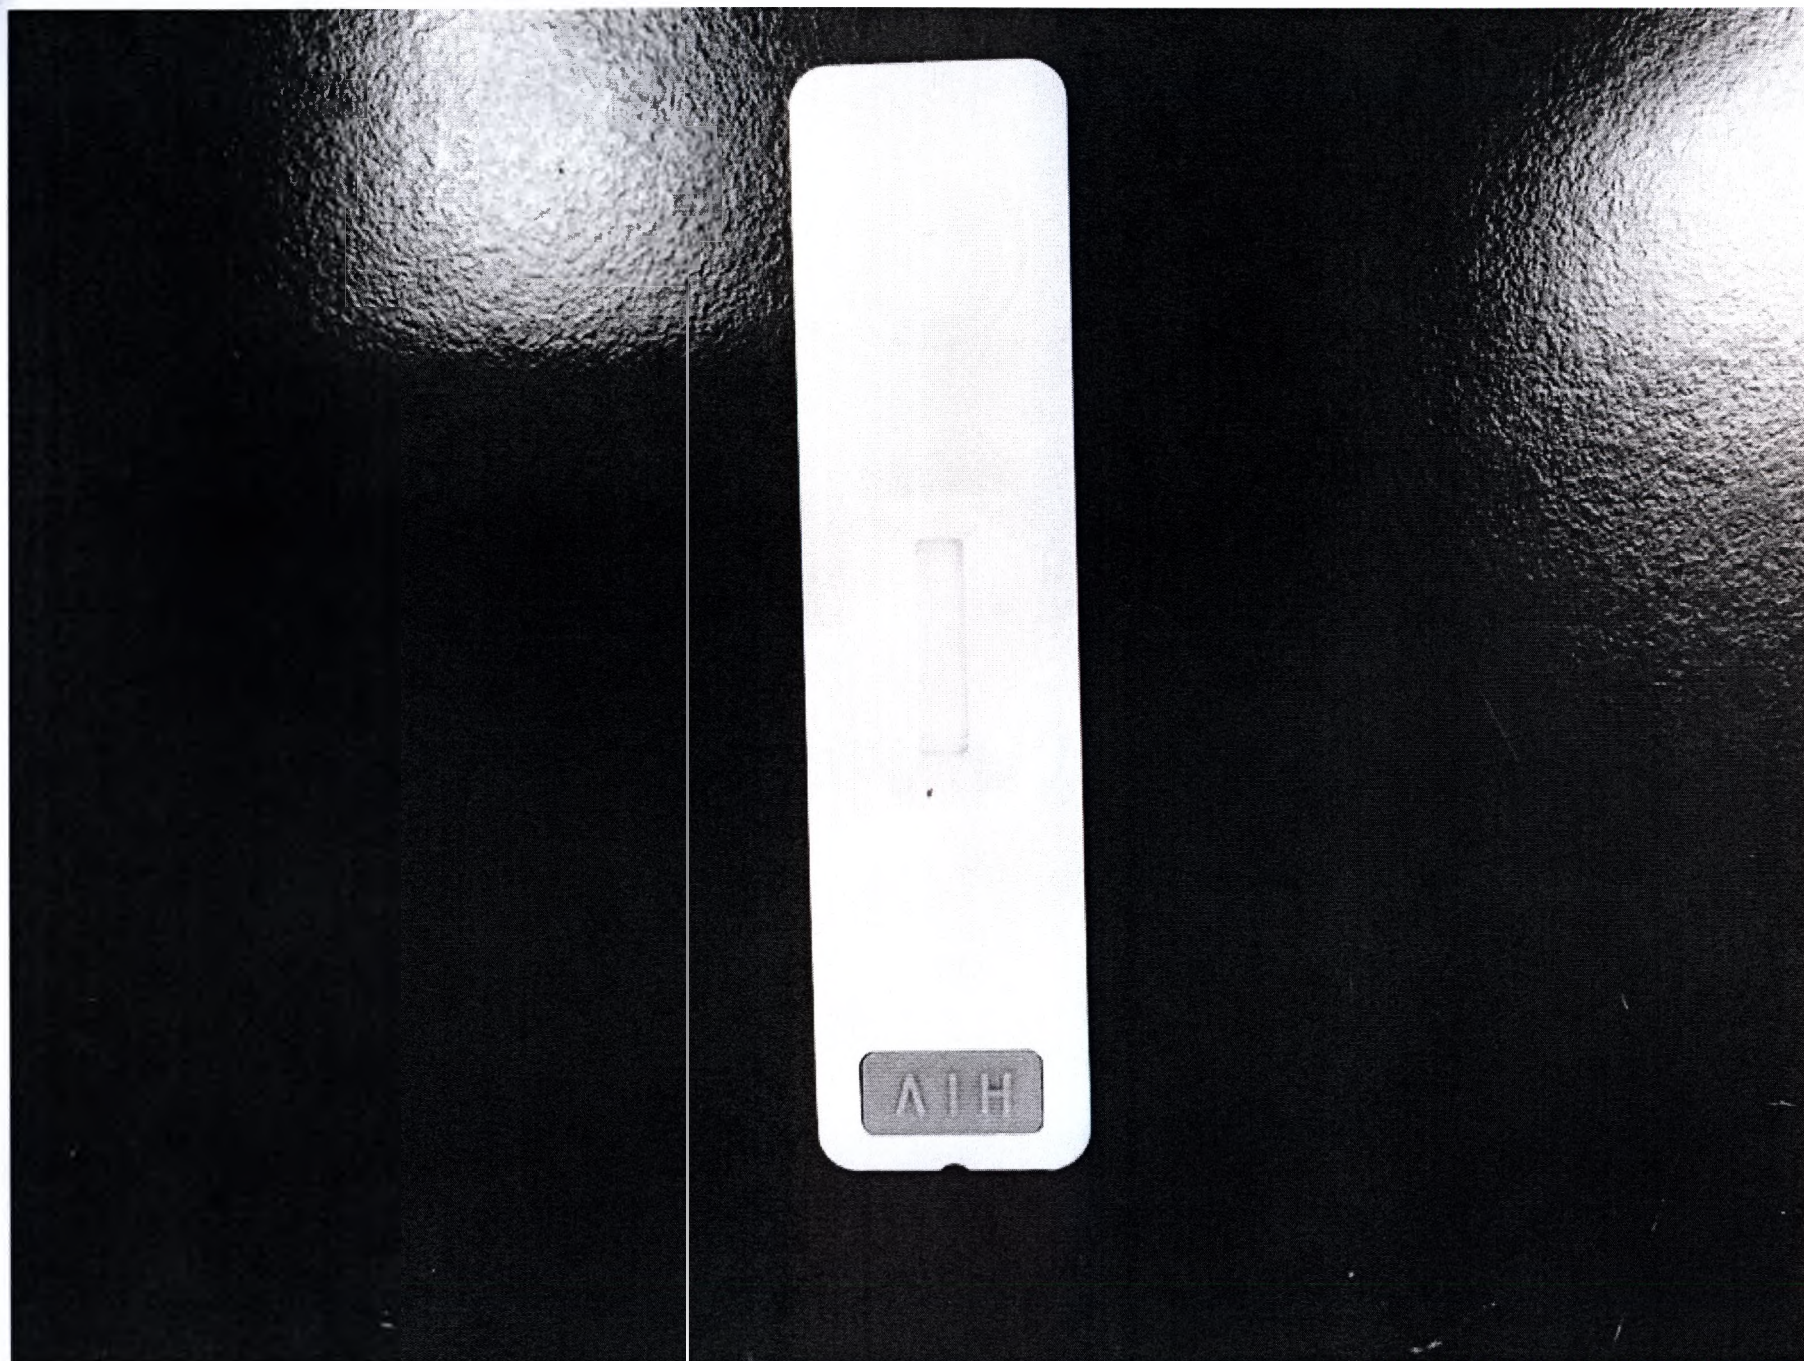

Буферный раствор:

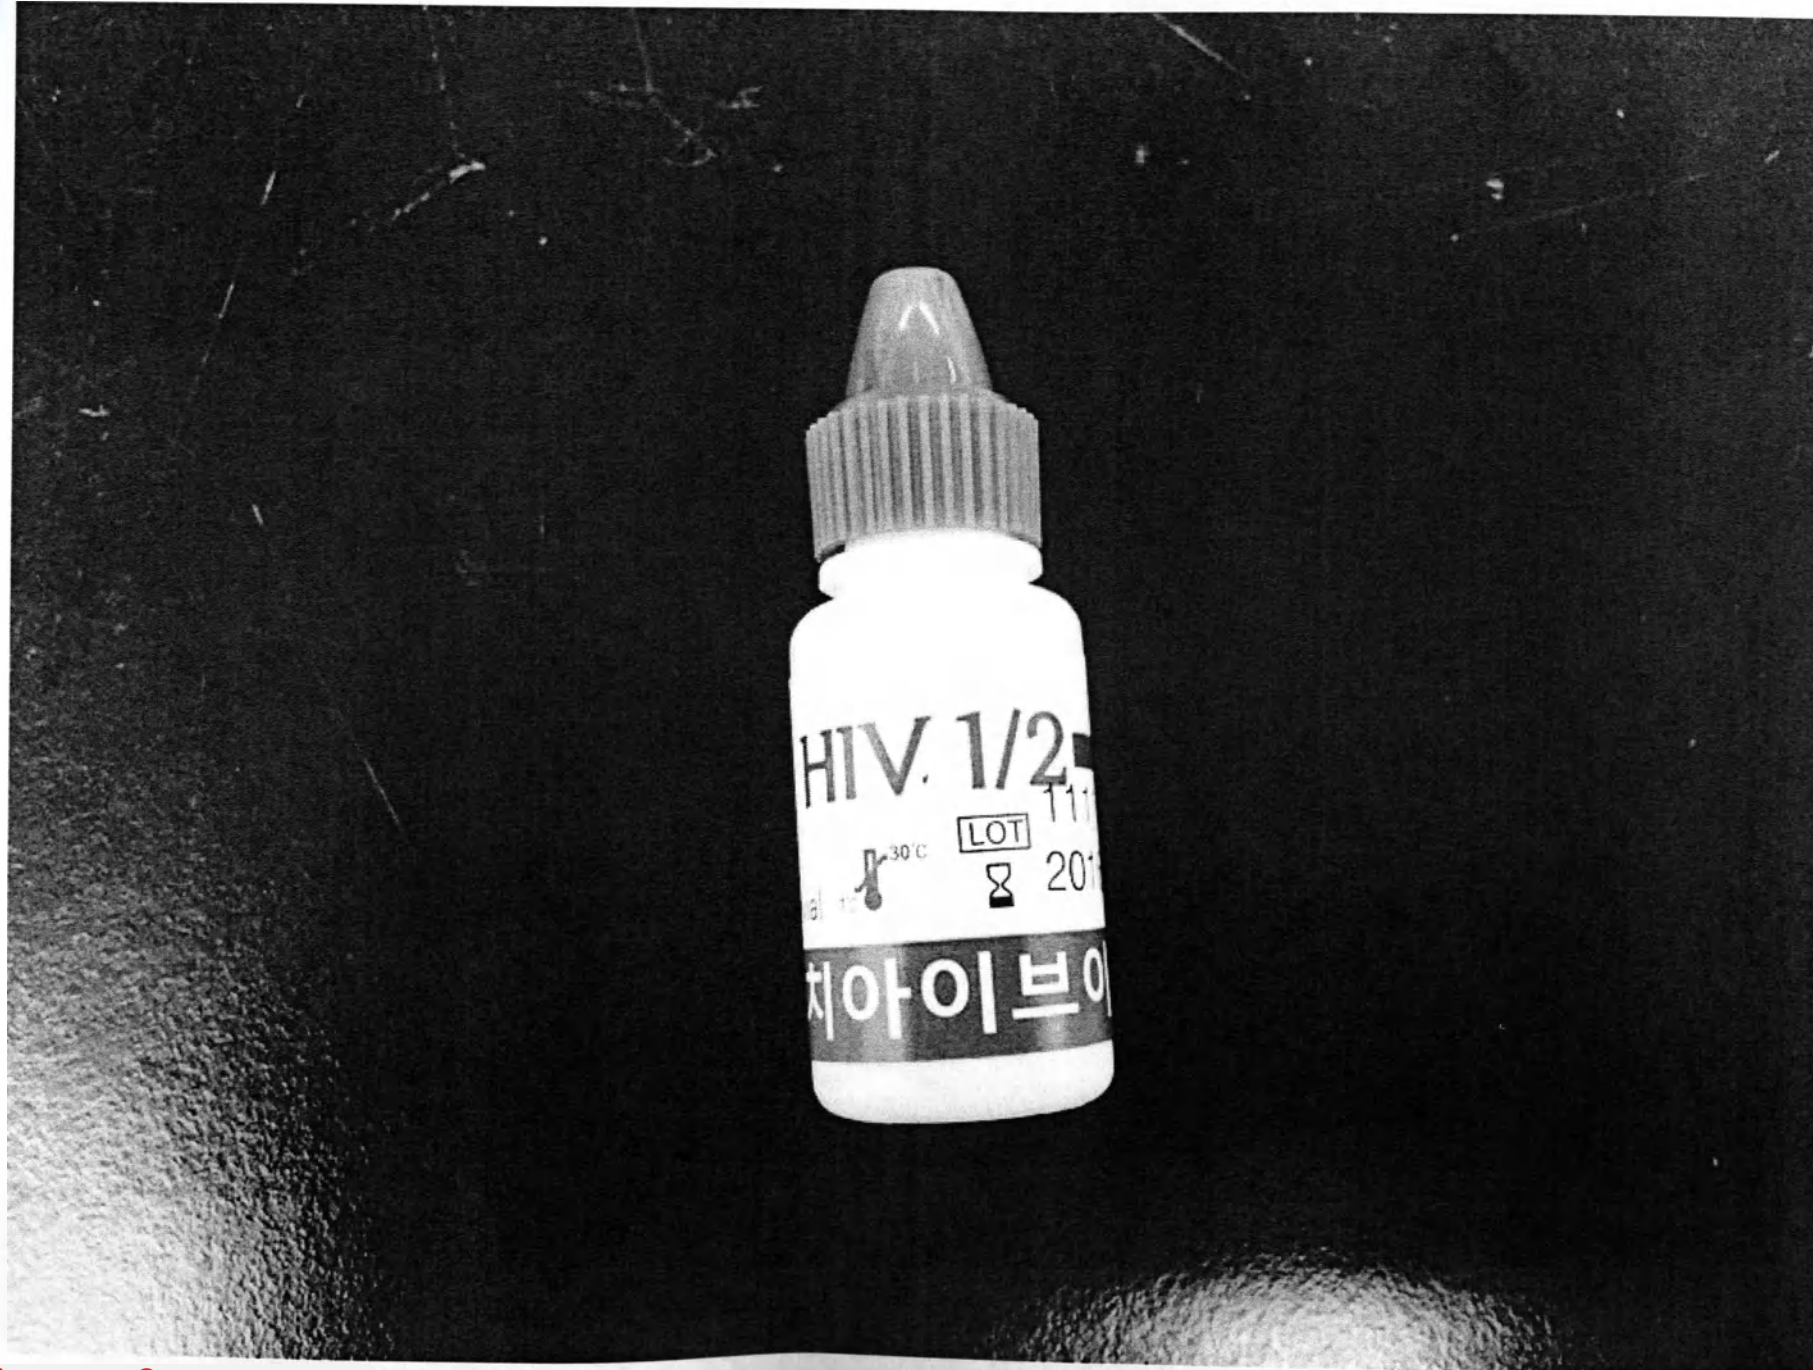

ООО «МедРег Консалтинг» ООО «МедРег Консалтинг» ООО
Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью: 14 (Четырнадцать) лист(а/ов)
Директор ООО «МедРег Консалтинг»
СЕРГЕЕВА ИРИНА РАМОНОВНА
ООО «МедРег Консалтинг» ИНН 50/06/48206

