

Рисунок 1 - Аппарат искусственной вентиляции лёгких неонатально-педиатрический «Прана» дА 2.931.018. Общий вид, где: 1 - блок вентиляции дА 2.931.019; 2 - неонатальный дыхательный контур опорного потока RT225 с камерой MR290; 3 - шнур питания; 4 - стойка дА 4.110.005; 5 - увлажнитель дыхательных смесей MR850; 6 - температурный датчик для увлажнителя, вариант исполнения 900MR869; 7 - кабель гибкого нагревателя, вариант исполнения 900MR805

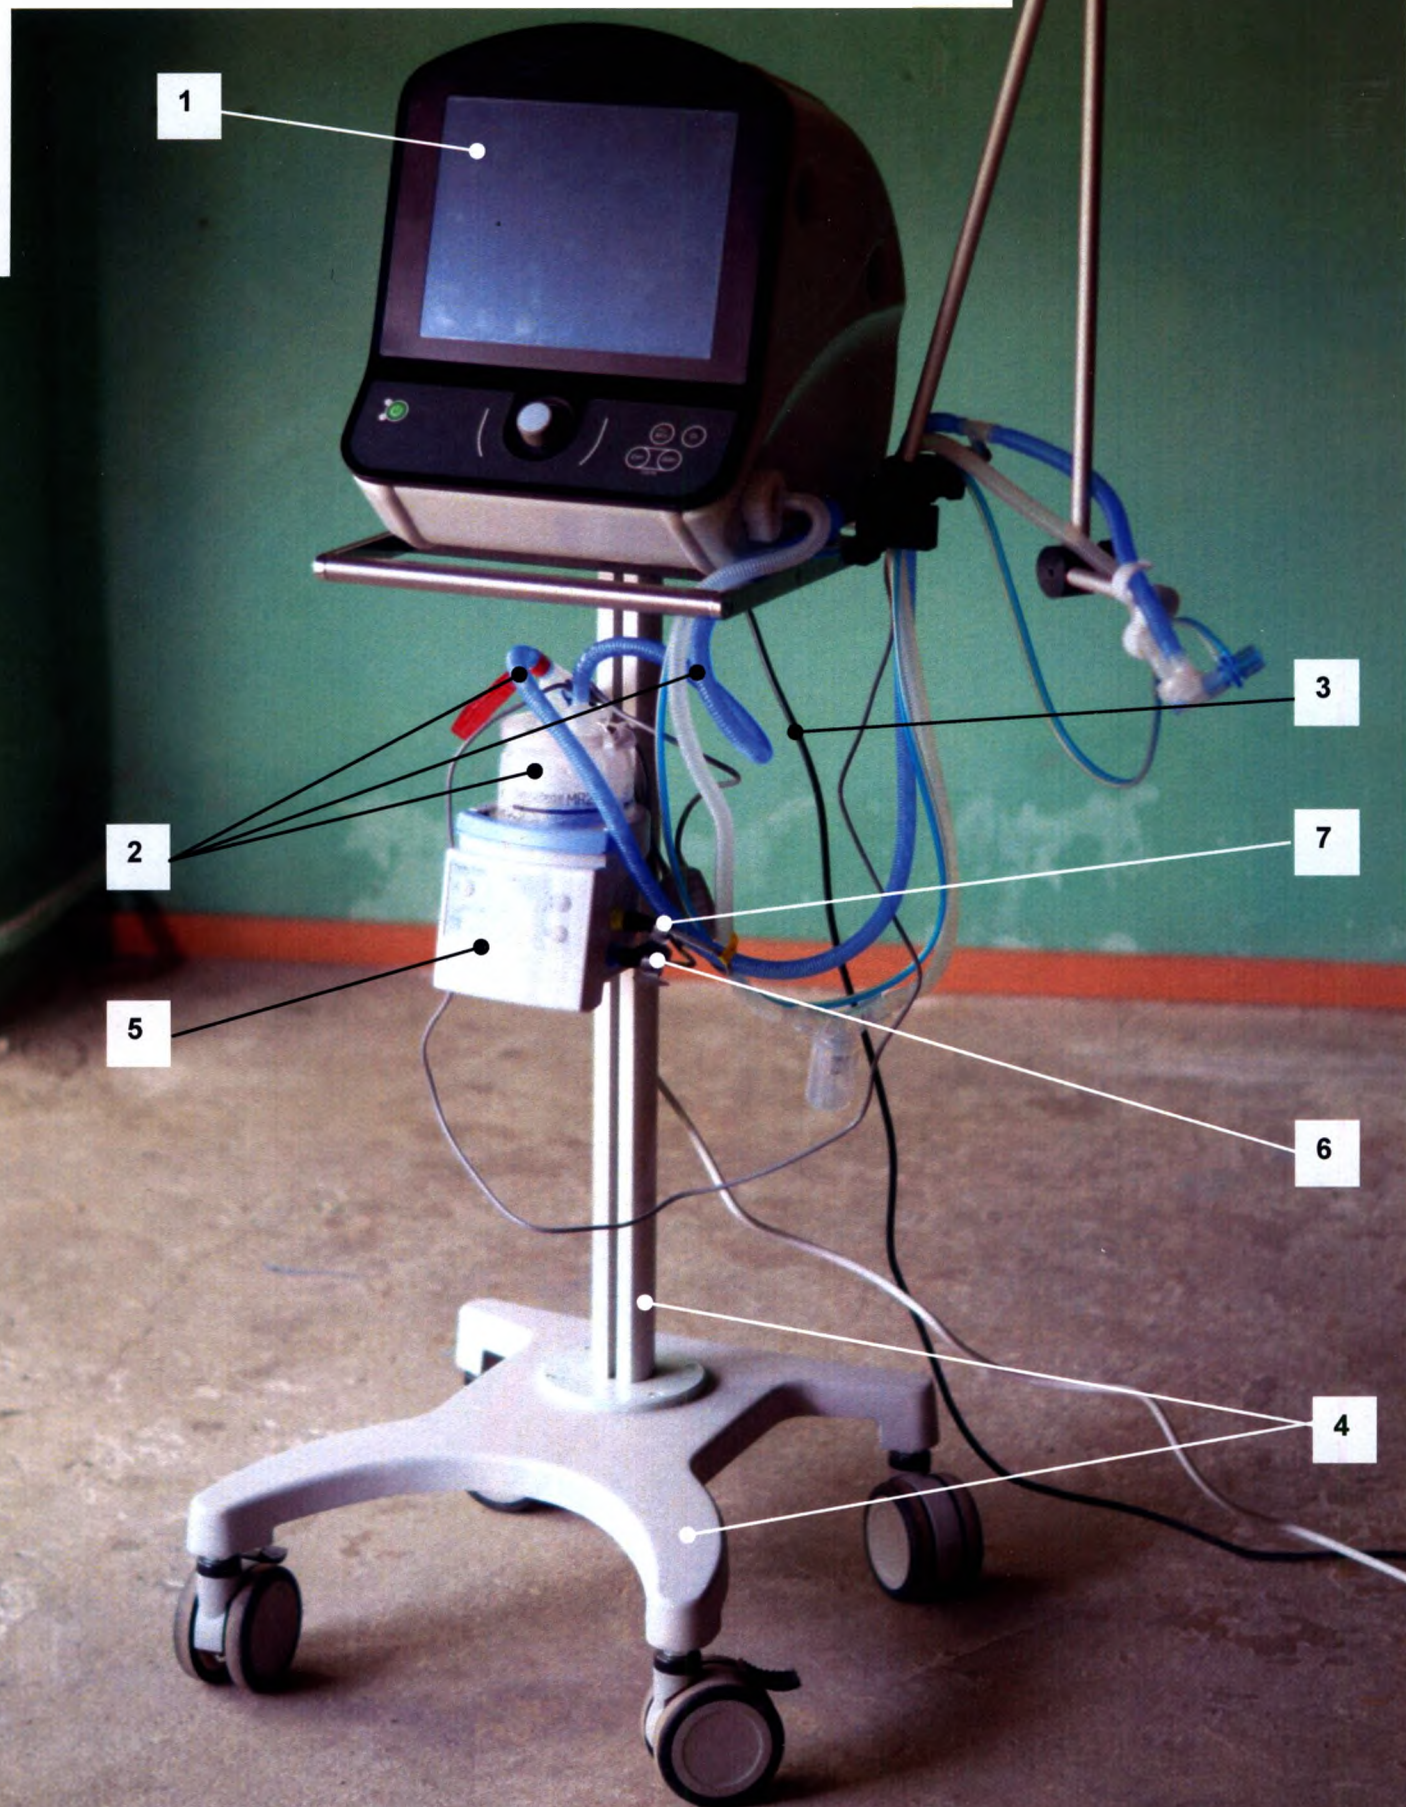


Рисунок 2 - Аппарат искусственной вентиляции лёгких неонатально-педиатрический «Прана» дА 2.931.018. Вид спереди, где: 1- блок вентиляции дА 2.931.019; 5 - увлажнитель дыхательных смесей MR850; 6 - температурный датчик для увлажнителя, вариант исполнения 900MR869; 7- кабель гибкого нагревателя, вариант исполнения 900MR805



Рисунок 3 - Увлажнитель дыхательных смесей MR850
с камерой MR290



Fisher & Paykel
HEALTHCARE

MR850ARU

LEGEZTETÉSI PÁRÁSÍTÓ
УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
NAPILZACZ RESPIRATOROWY

MANUFACTURER:
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LTD.
15 MAURICE PAYKEL PLACE,
EAST TAMAKI, AUCKLAND 2013,
NEW ZEALAND
TEL: +64-9-374 0100
FAX: +64-9-374 0188



2014-07



IPX 1



CE
0123

230 V~ 50/60 Hz
ENERGIAFELVÉTEL 220 VA
FŰTŐLAP 150 W
FŰTŐSZÁL 60 W MAX

СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В
НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛИТА 150 Вт
НАГРЕВАТЕЛЬ ШЛАНГА 60 Вт МАКС

ZASILANIE 220 VA
PŁYTA GRZEWCZA 150 W
GRZEJNIK DRENU 60 W MAX

исунок 4 - Комплект ЗИП (дА 4.078.011),

е: 8 - датчик потока неонатальный дА 5.899.017

влечён из упаковки); 9 - вставка ПДКВ дА 8.230.028;

- мембрана дА 7.010.012



[illegible][illegible]



Рисунок 7 - RT225 - неонатальный дыхательный контур опорного потока с камерой MR290 из комплекта ЗИП (дА 4.078.011)

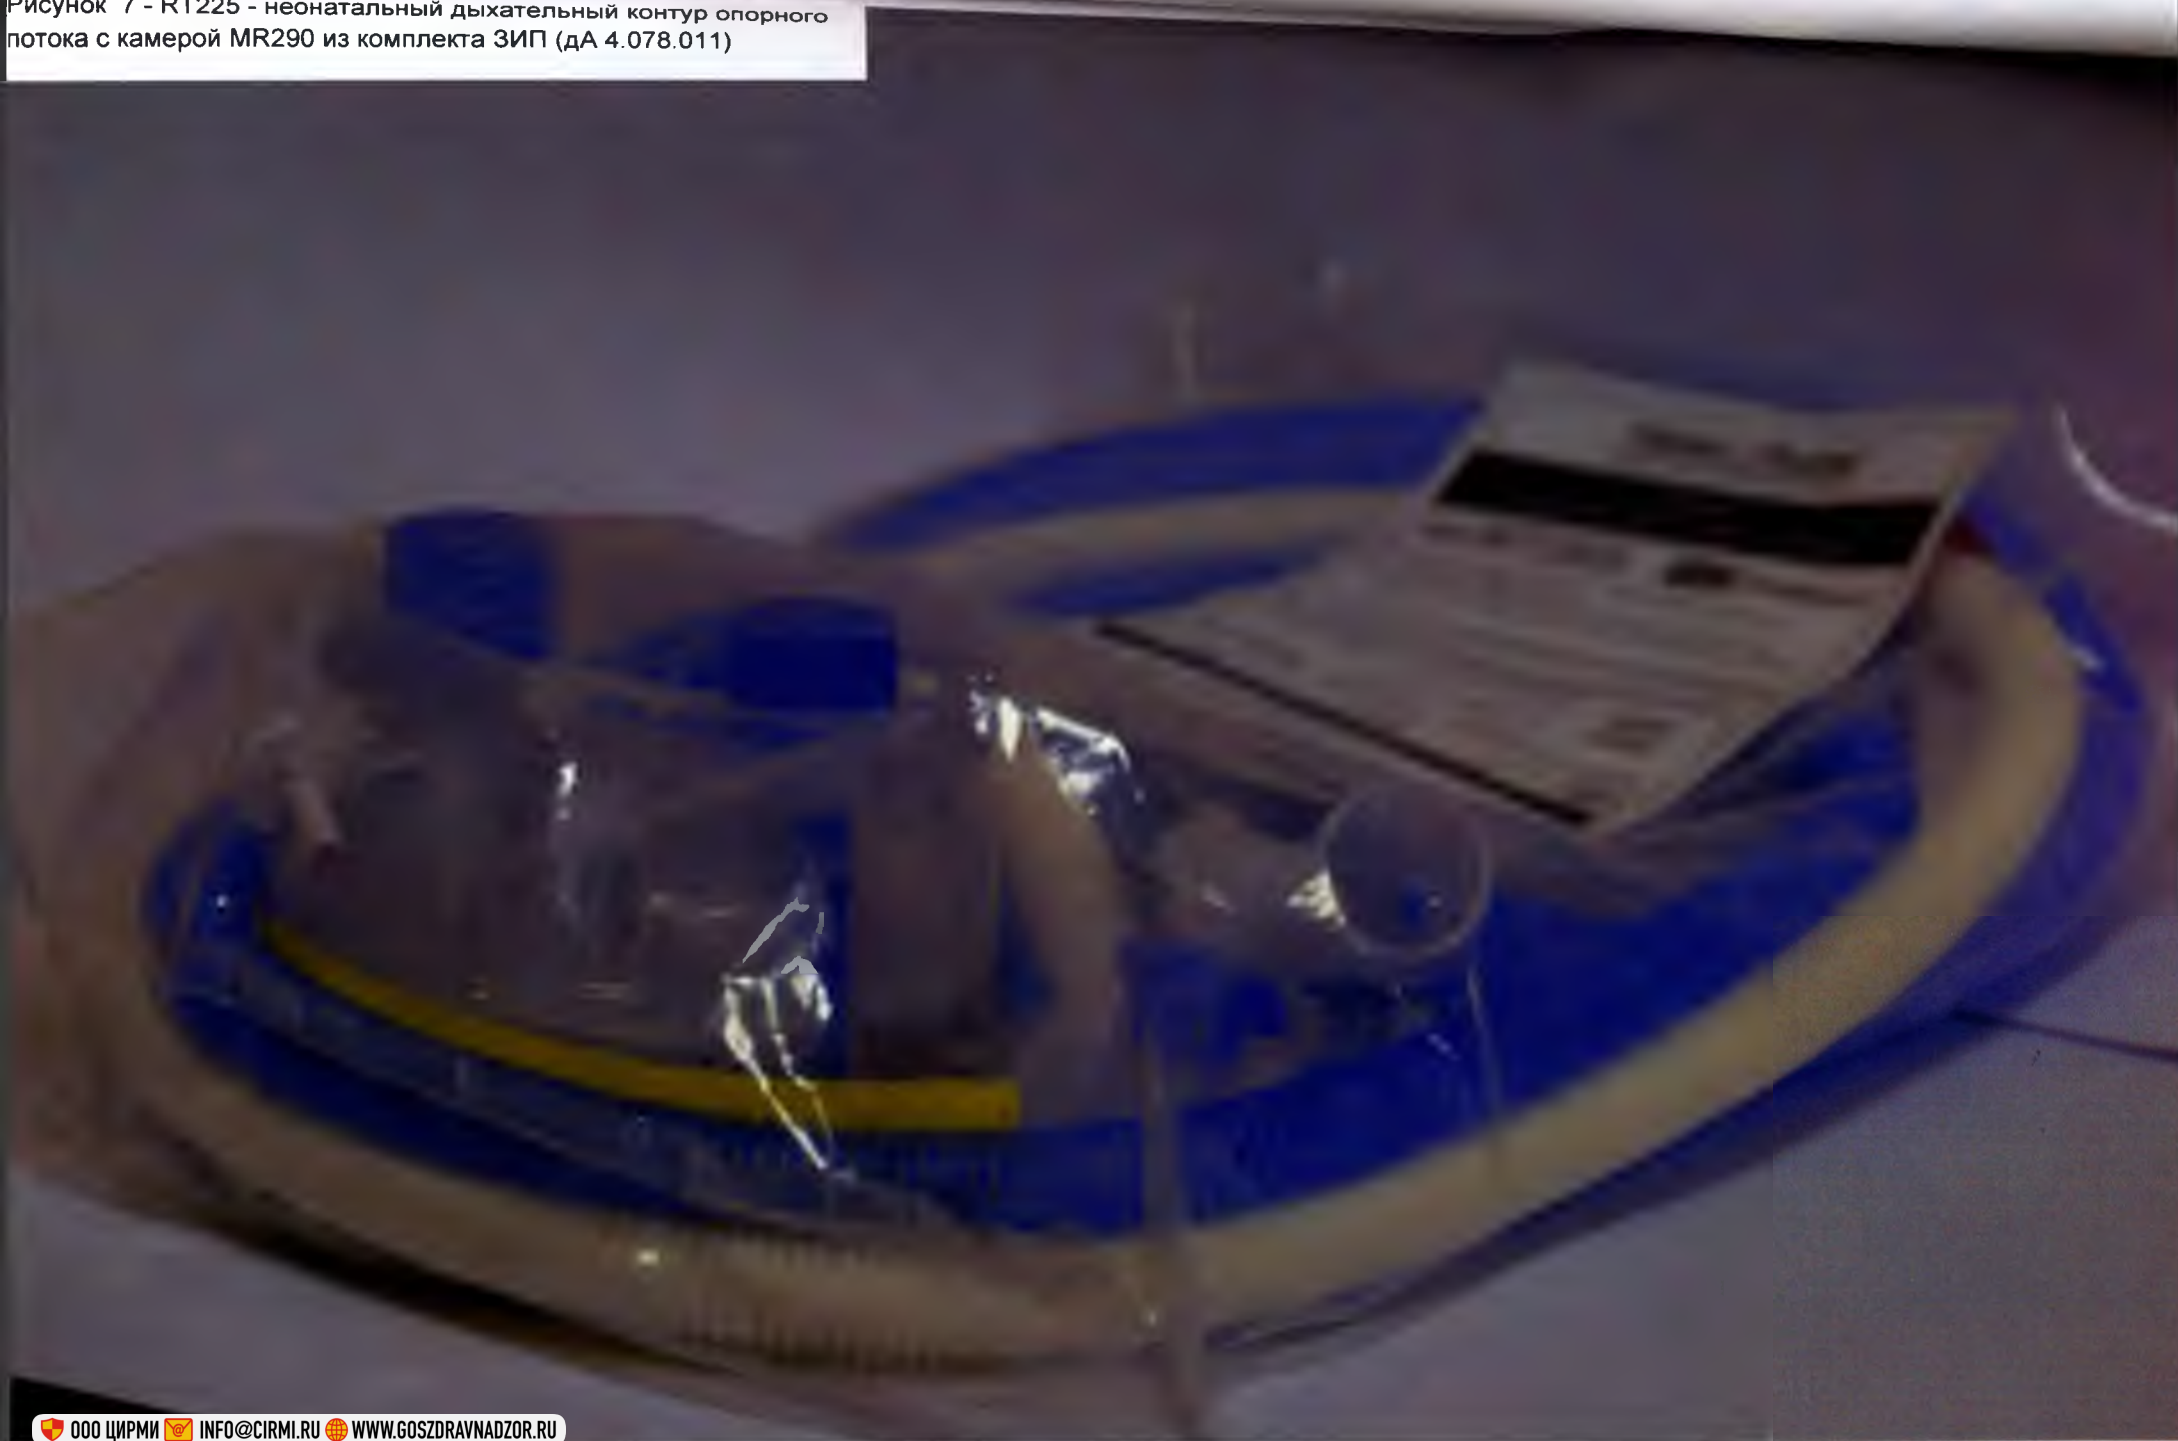


Рисунок 8 - Контур дыхательный КД-«МС»-1

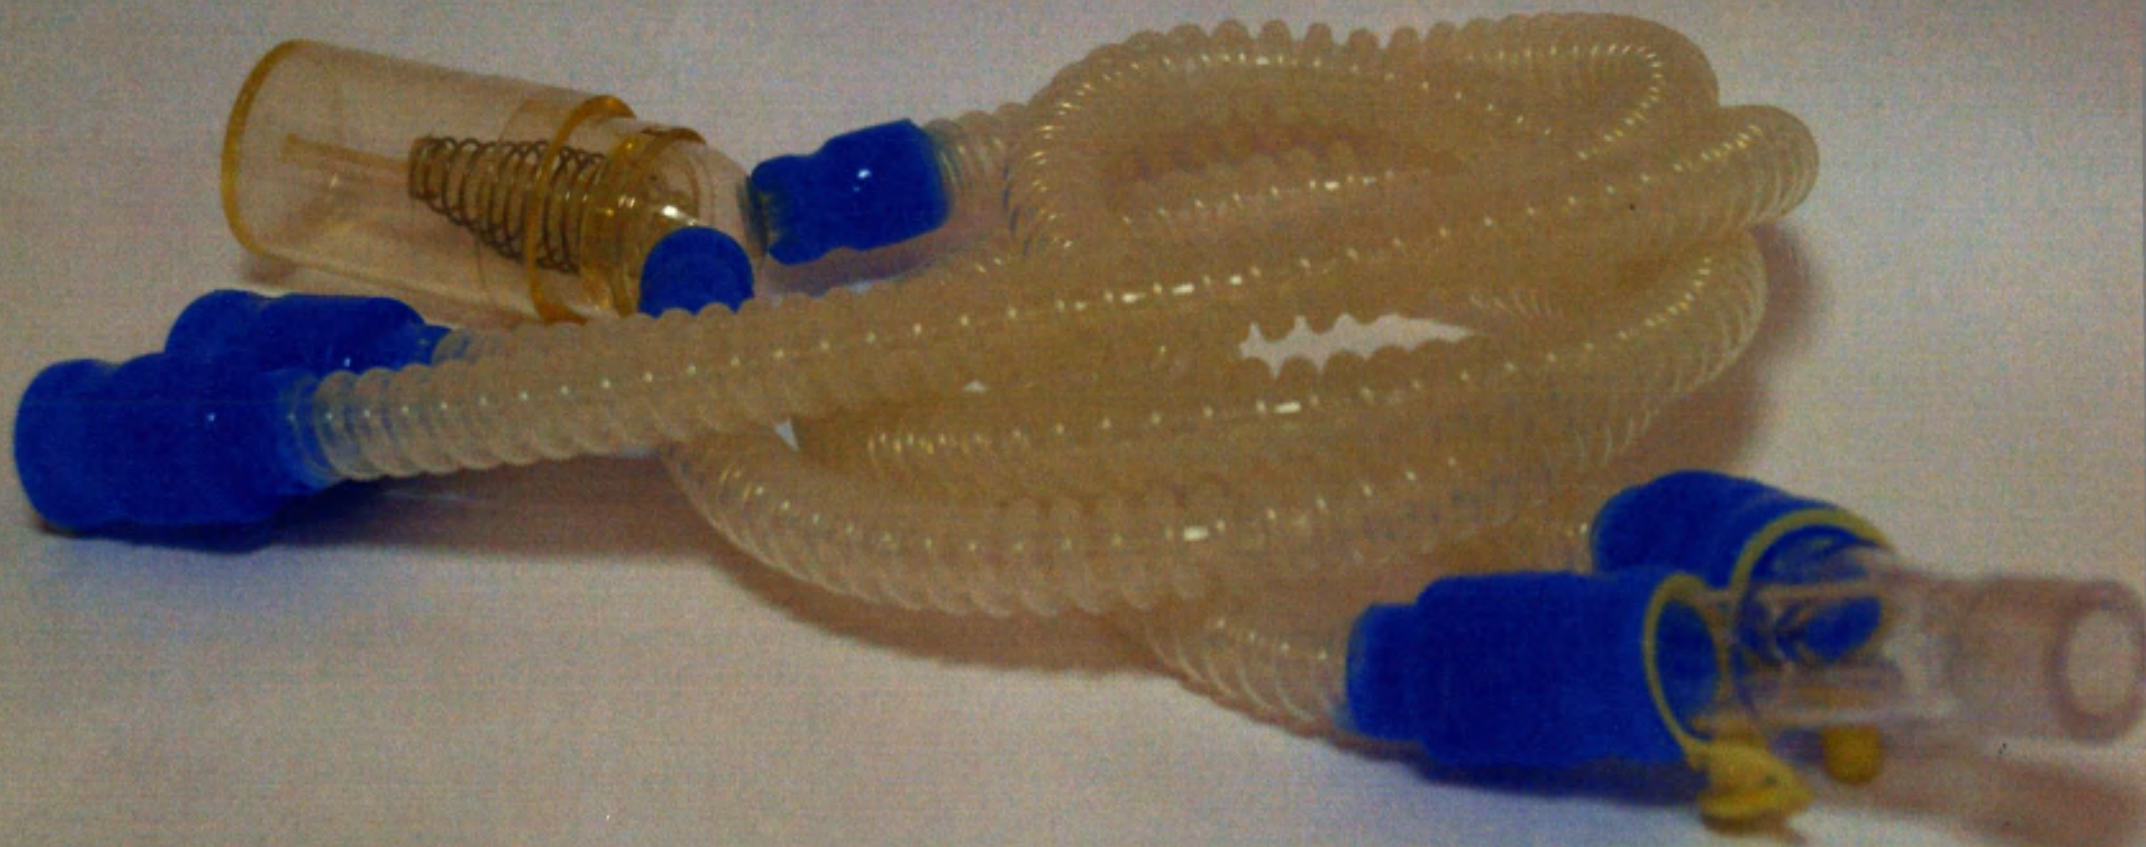


Рисунок 9 - Одноразовая линия для капнографии с соединителем (взрослая, детская), типоразмер Philips: Filterline H Set m 1921a





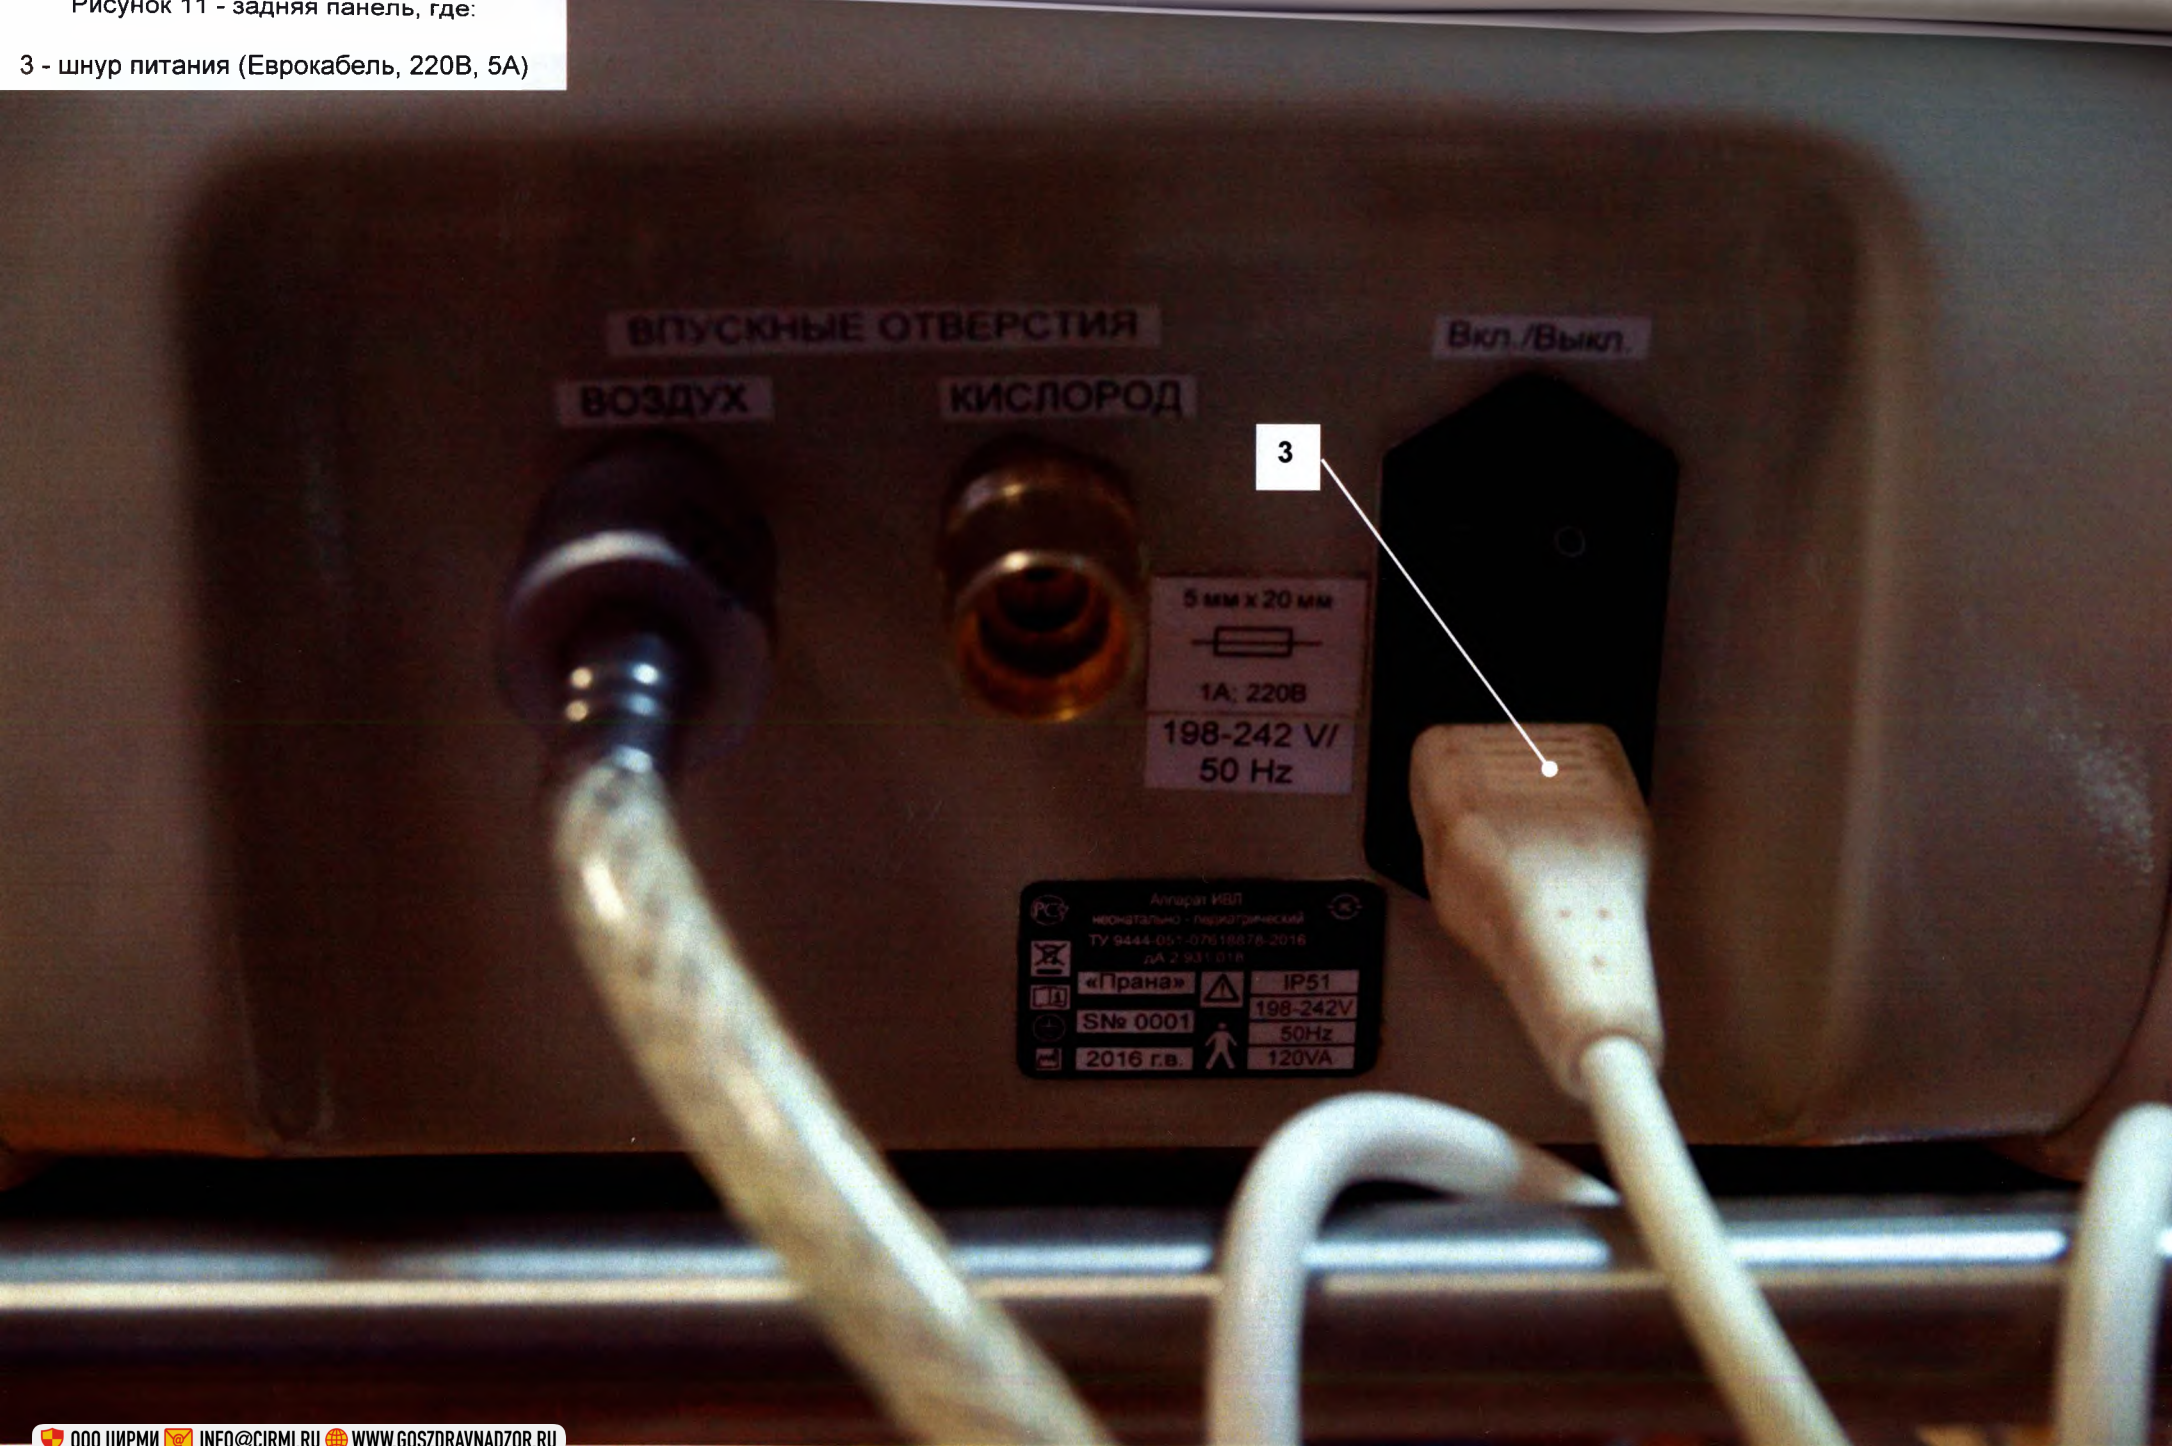


Рисунок 12 - Вид сбоку. Панель подключения





Рисунок 14 - Кювета капнографа IRMA Airway Adapter
Adult/Pediatric CAT.NO.106220 «ФАЗЕИН АБ»/
«Массимо», («PHASEIN AB»/ «Massimo», Швеция

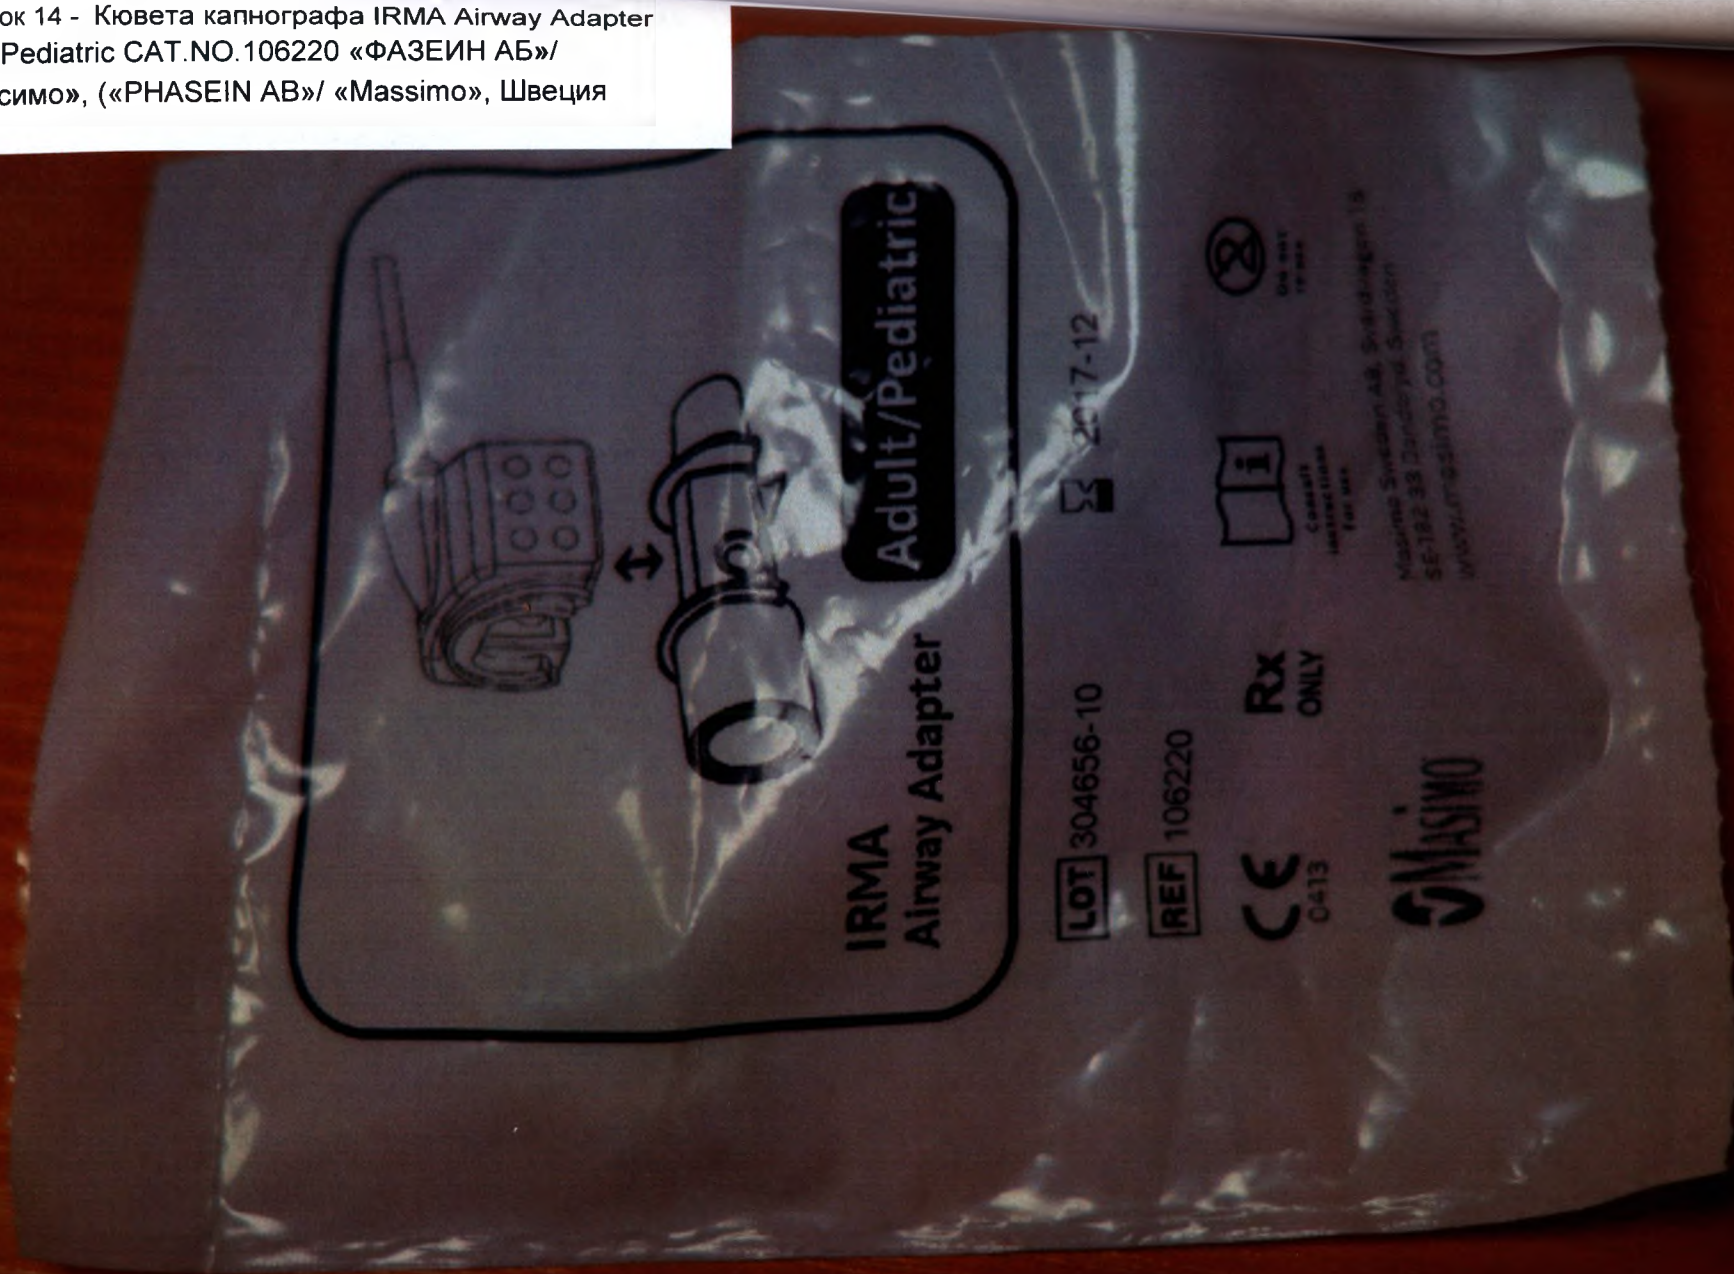


Рисунок 15 - Кювета капнографа для детей (infant) IRMA
Airway Adapter Infant CAT.NO. 106260 «ФАЗЕИН АБ»/
«Массимо», («PHASEIN AB»/ «Massimo», Швеция



LOT 304656-10
REF 106260
2017-12



Consult
instructions
for use

Rx
ONLY

CE
0413

MASSIMO

Massimo System AB, Sölvegatan 19
SE-142 38 Danderyd, Sweden
www.massimo.se

Прошито и пронумеровано

Всего 16(шестнадцать)

Генеральный директор ПАО «Красногвардейск»

Н.А. Карпова

