



МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МО «Отдел медицинской техники»


А.Ю. Цикин

20 18 г.




Фотографии изделия медицинского назначения


Микроскопы биологические с принадлежностями по
ТУ 26.70.22-001-55796184-2016

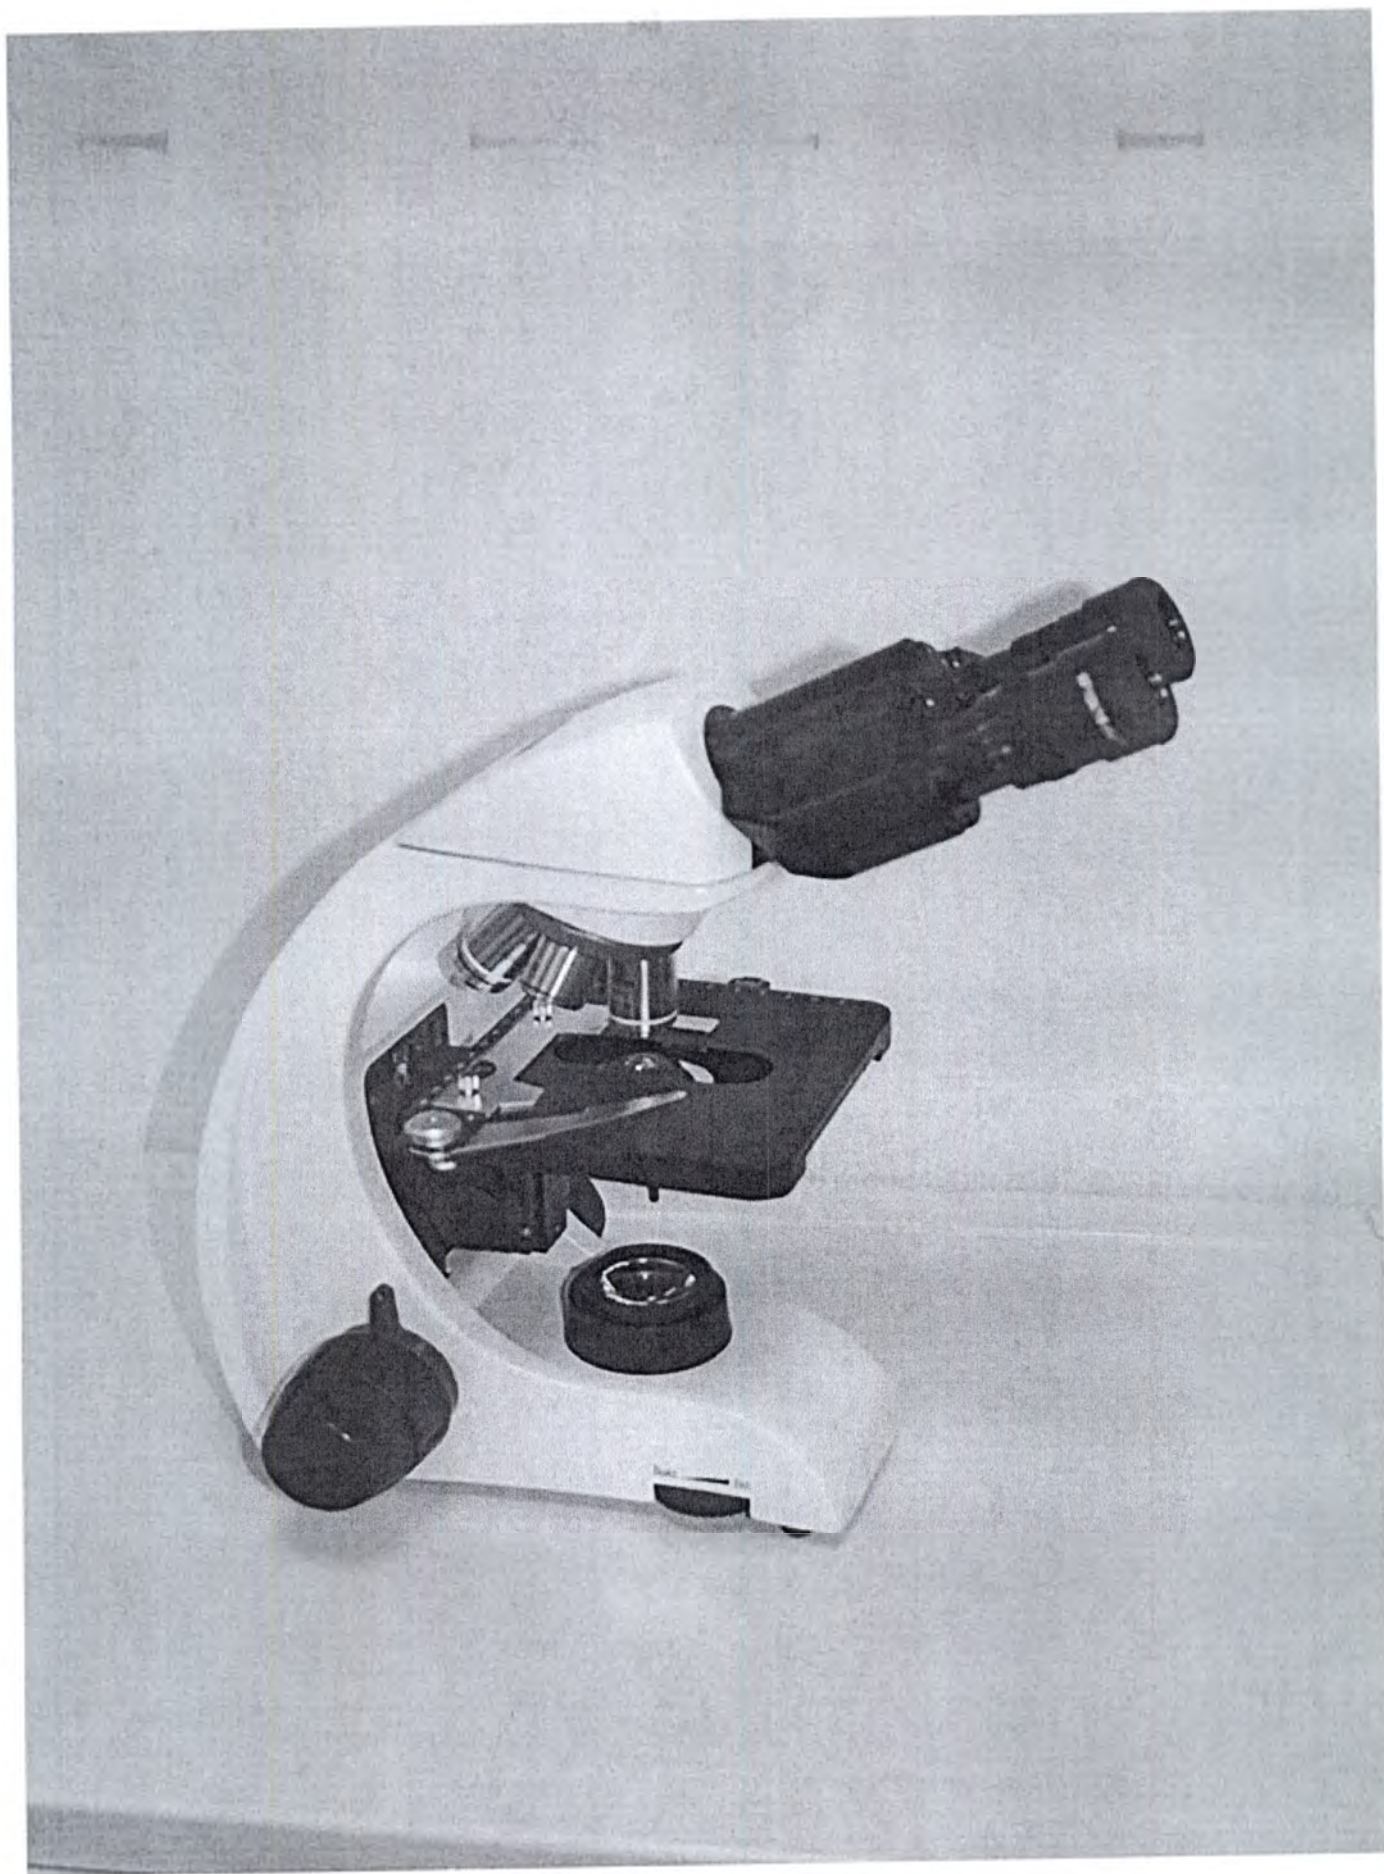


Микроскоп биологический исполнение М10

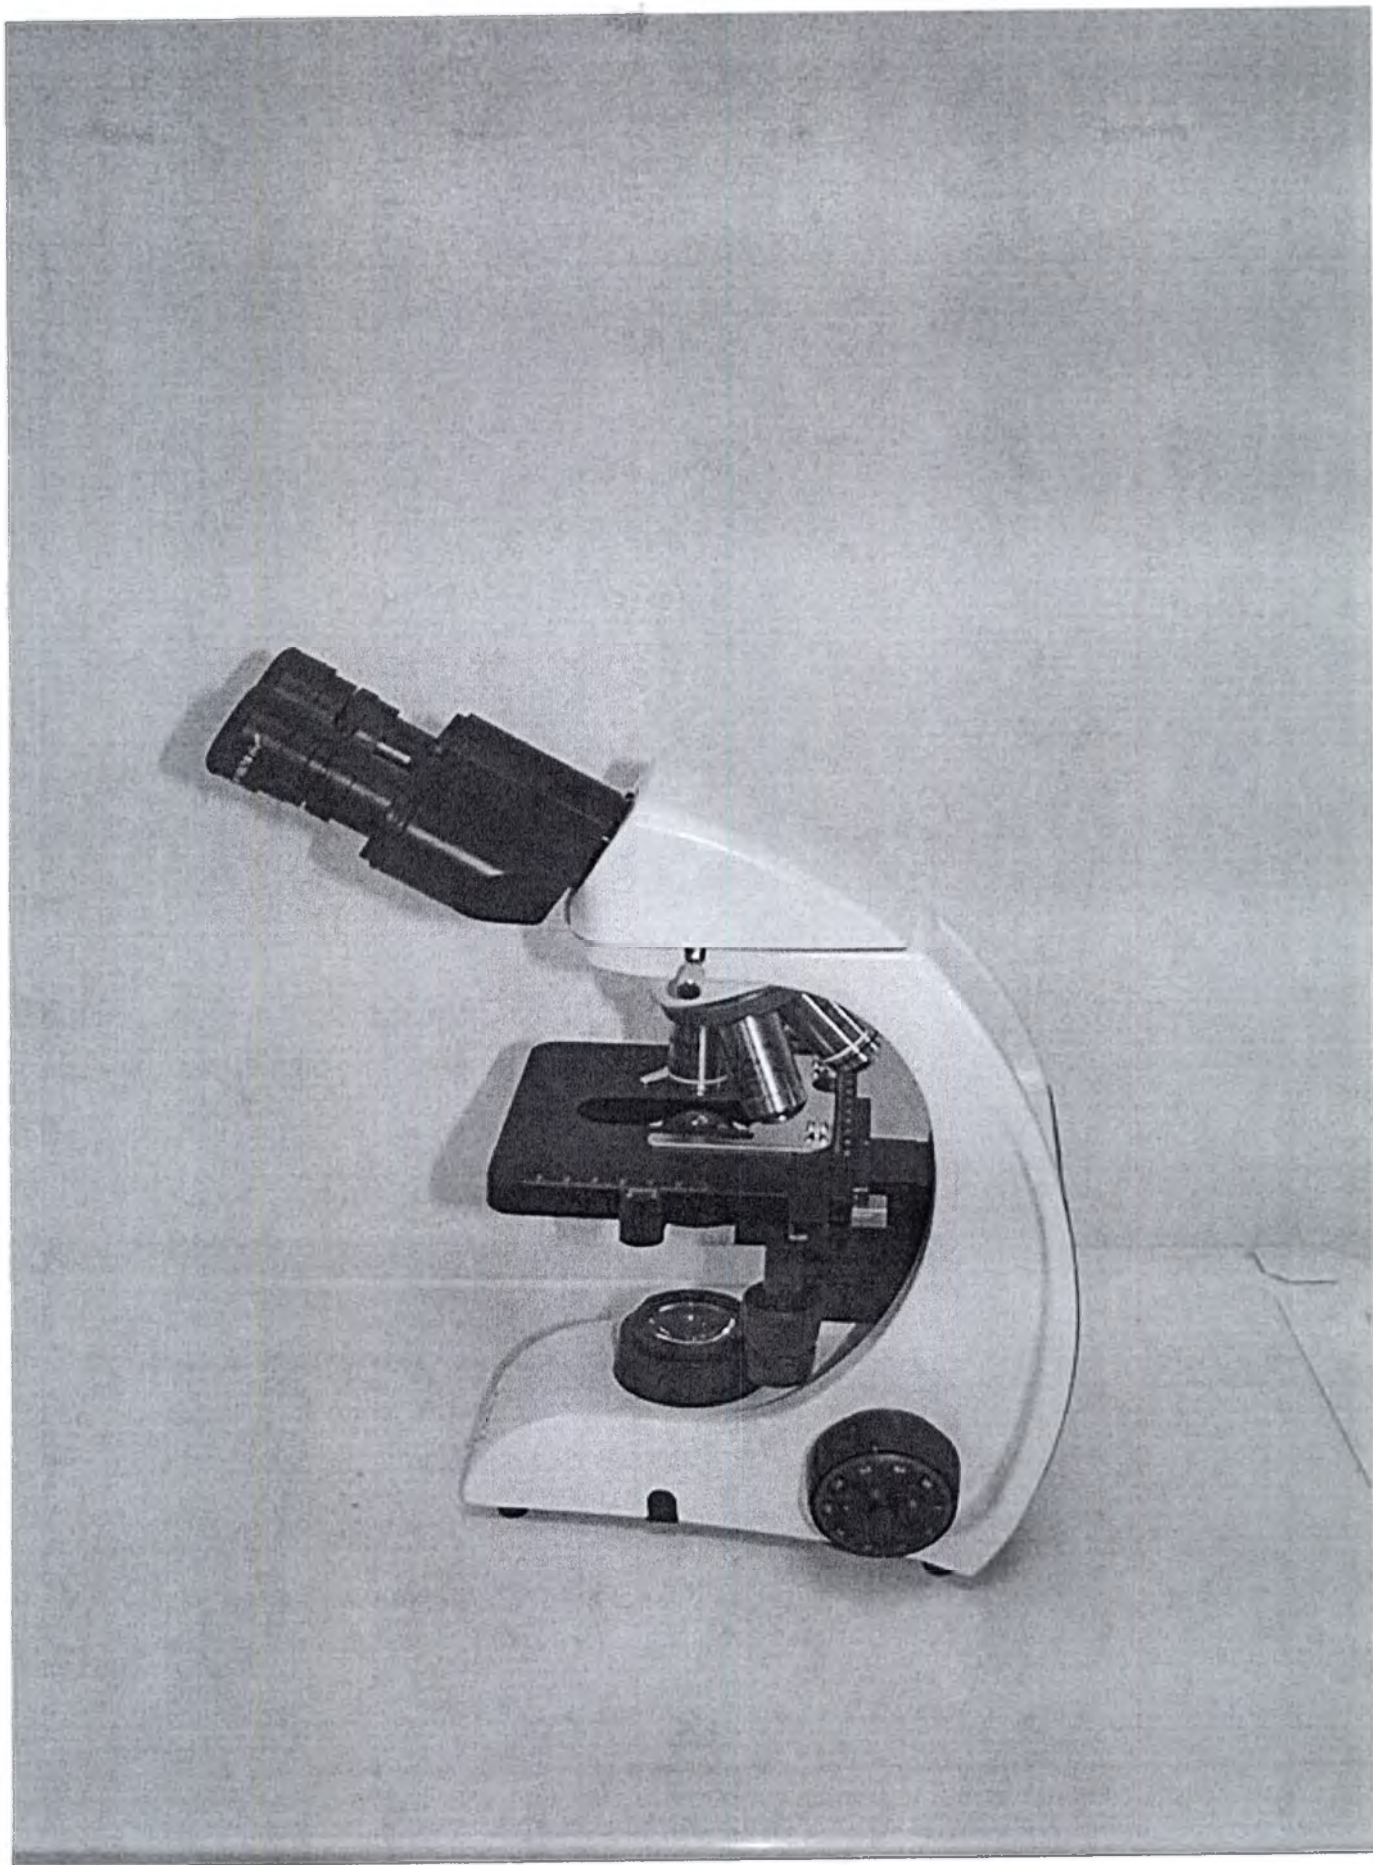


Микроскоп биологический исполнение M10 LED

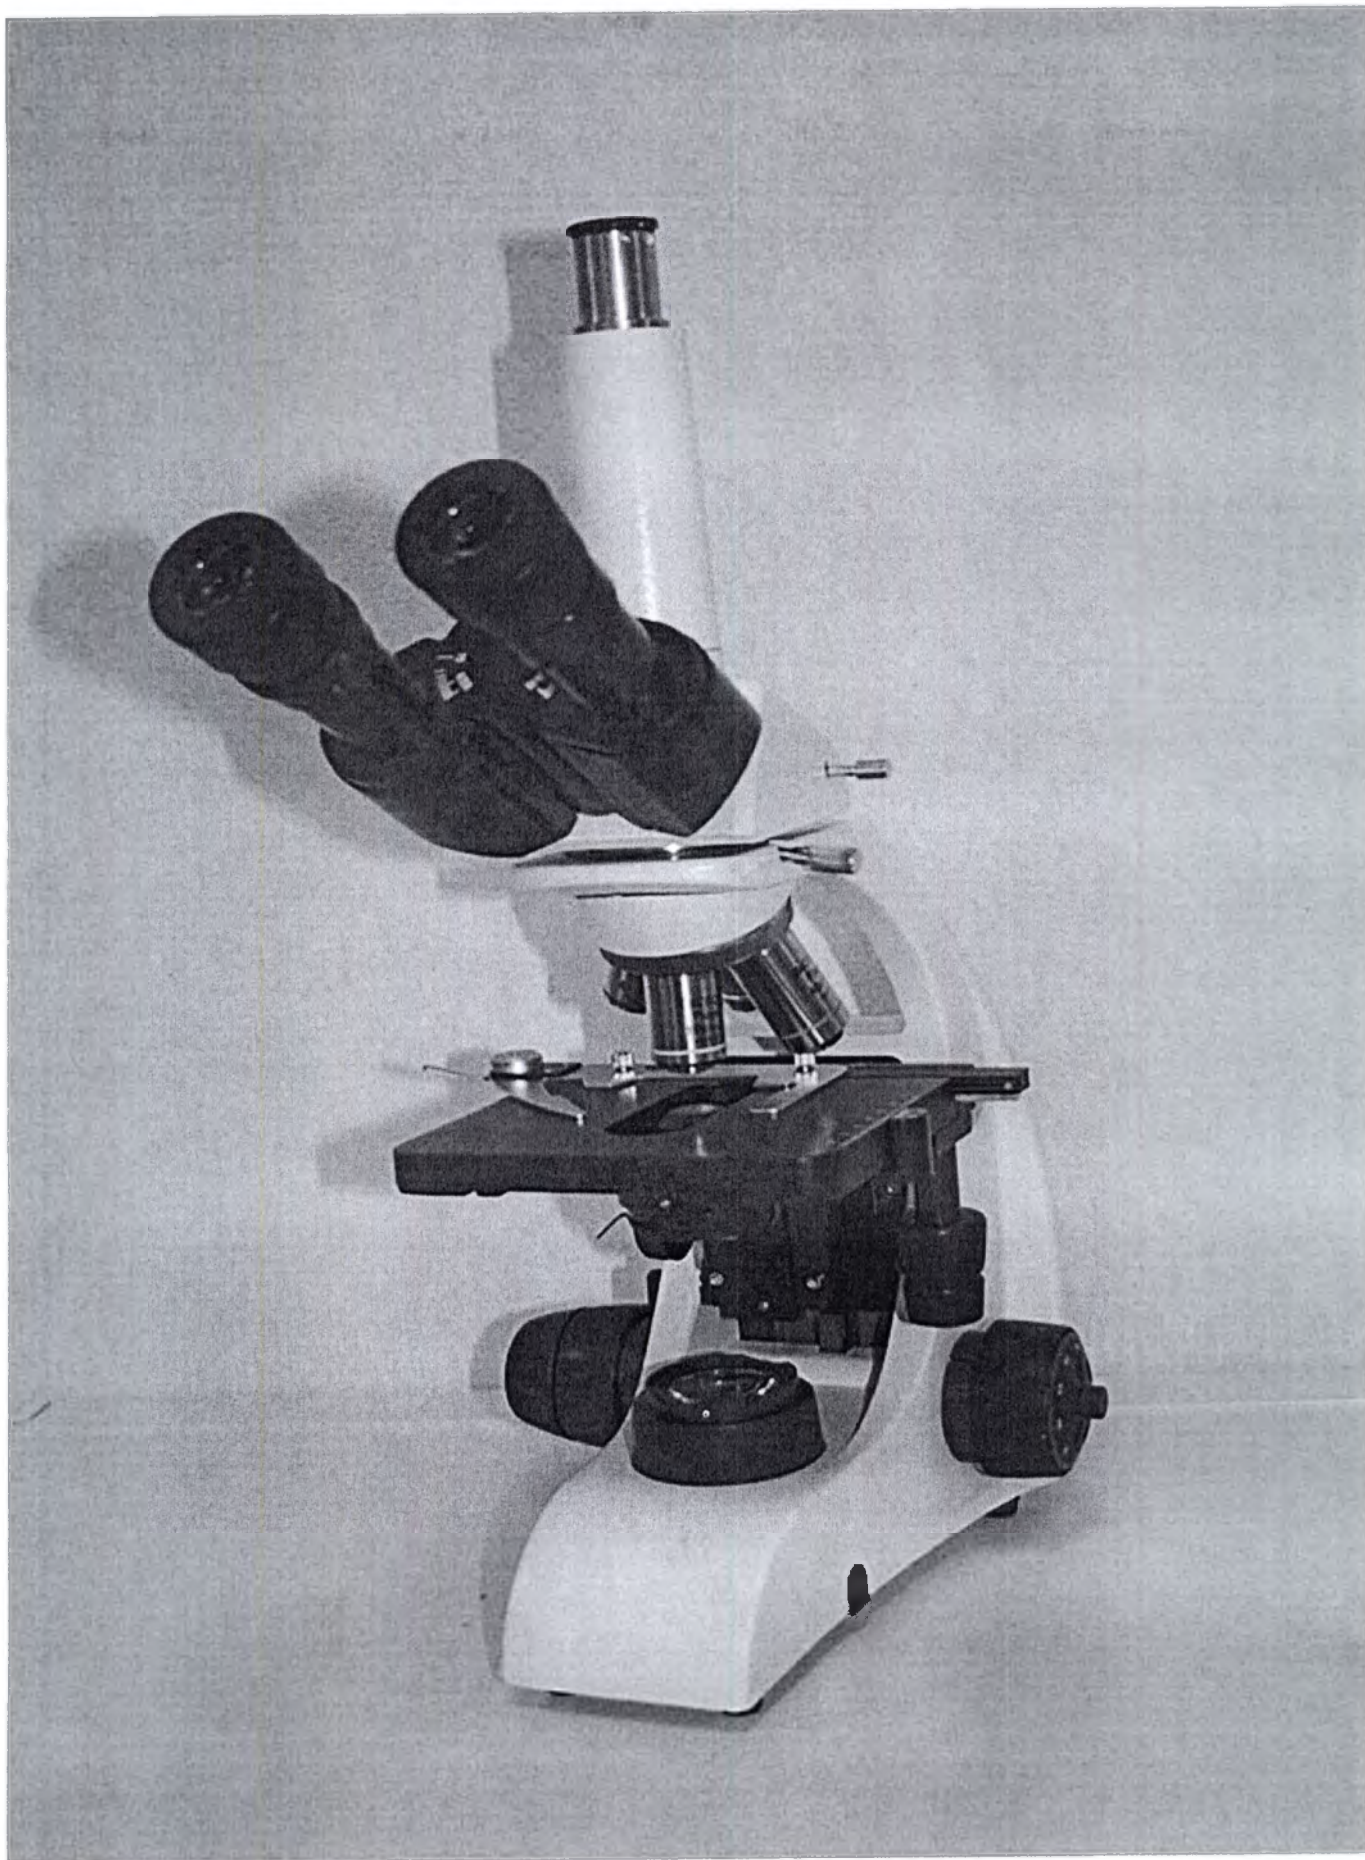


Микроскоп биологический исполнение M10-1 LED

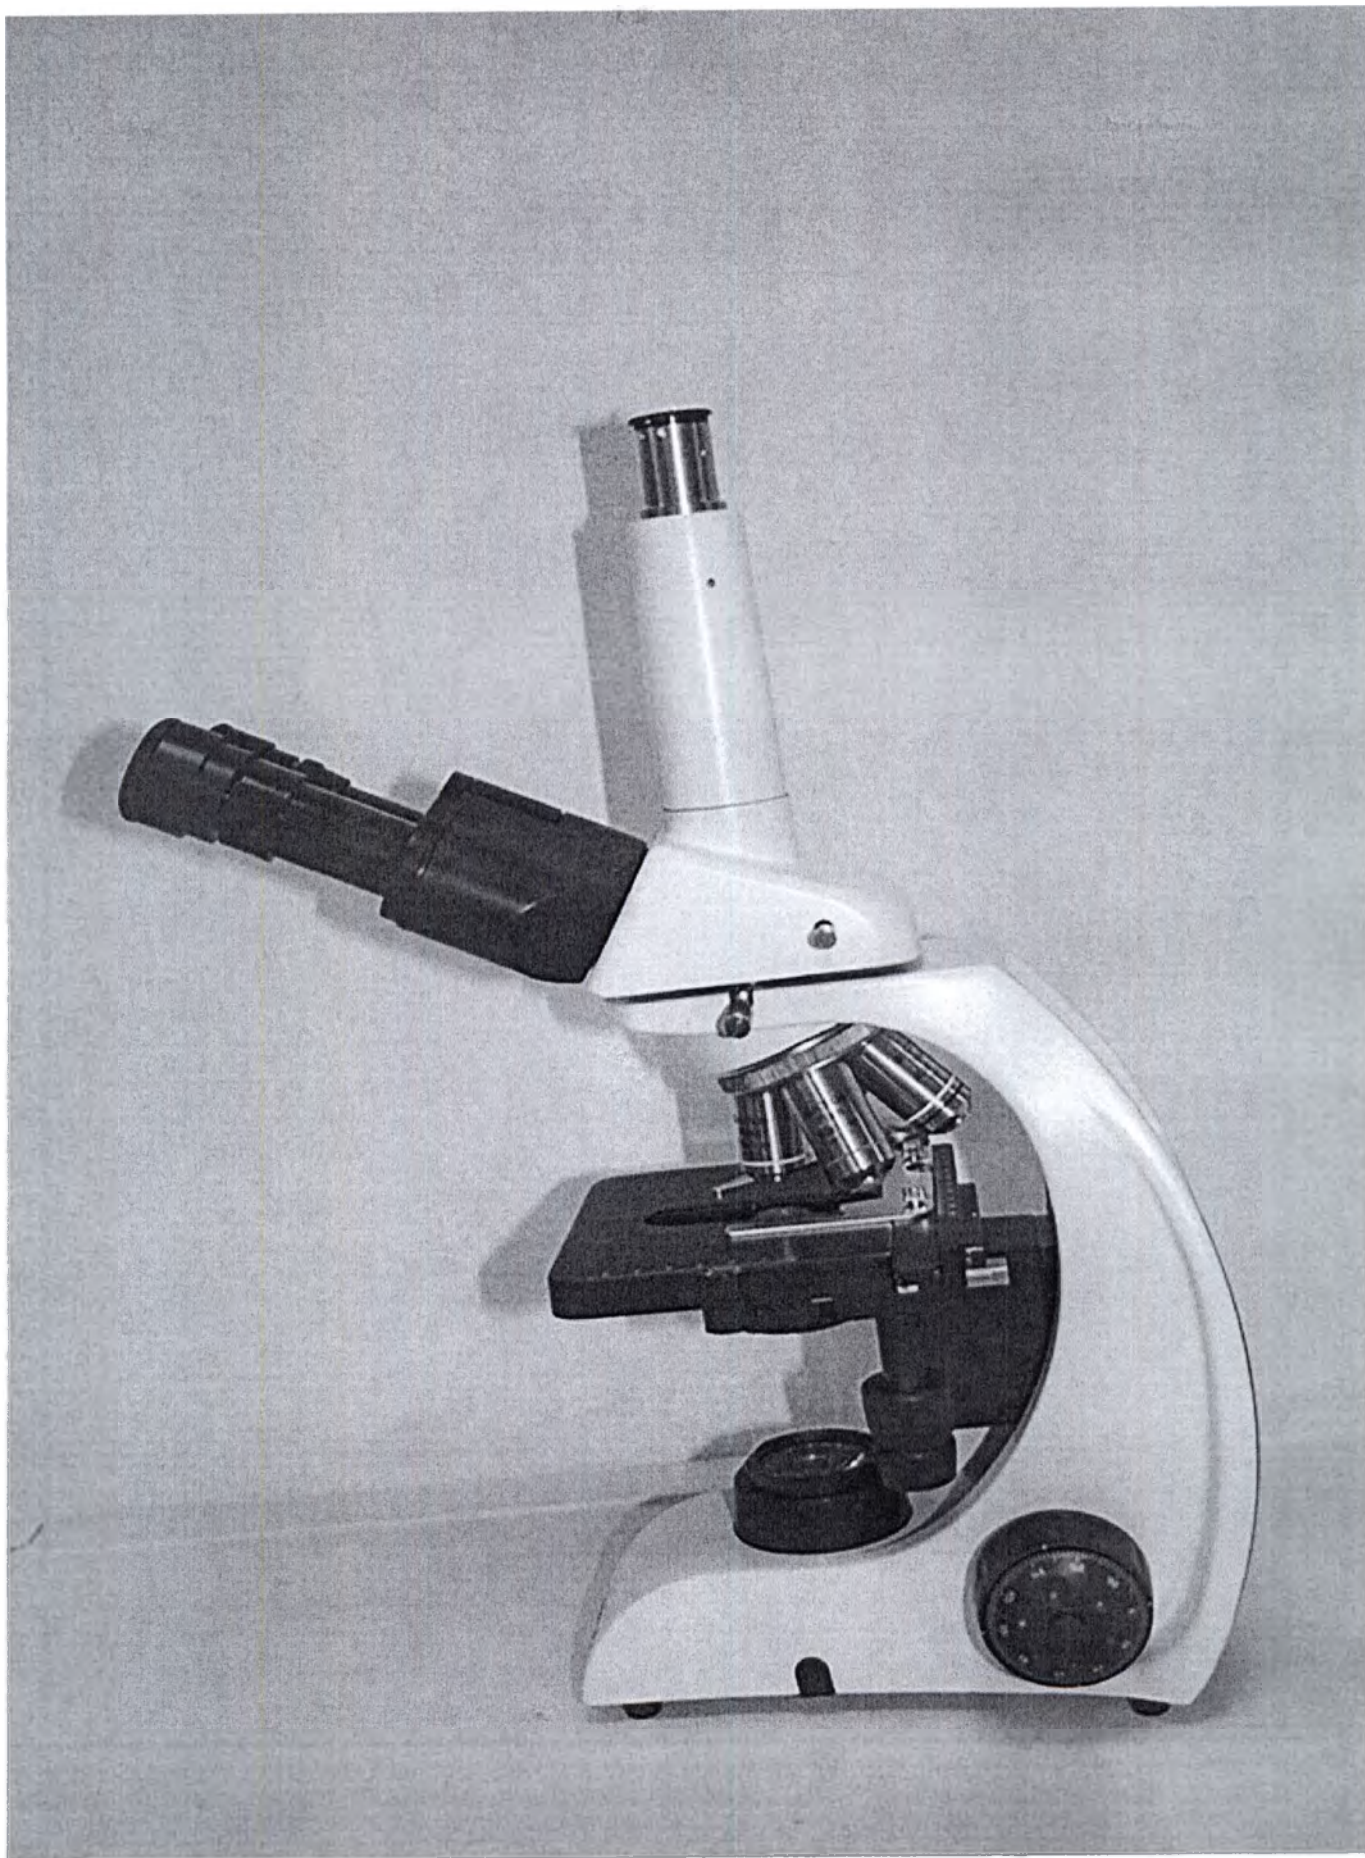


Микроскоп биологический исполнение М10-1

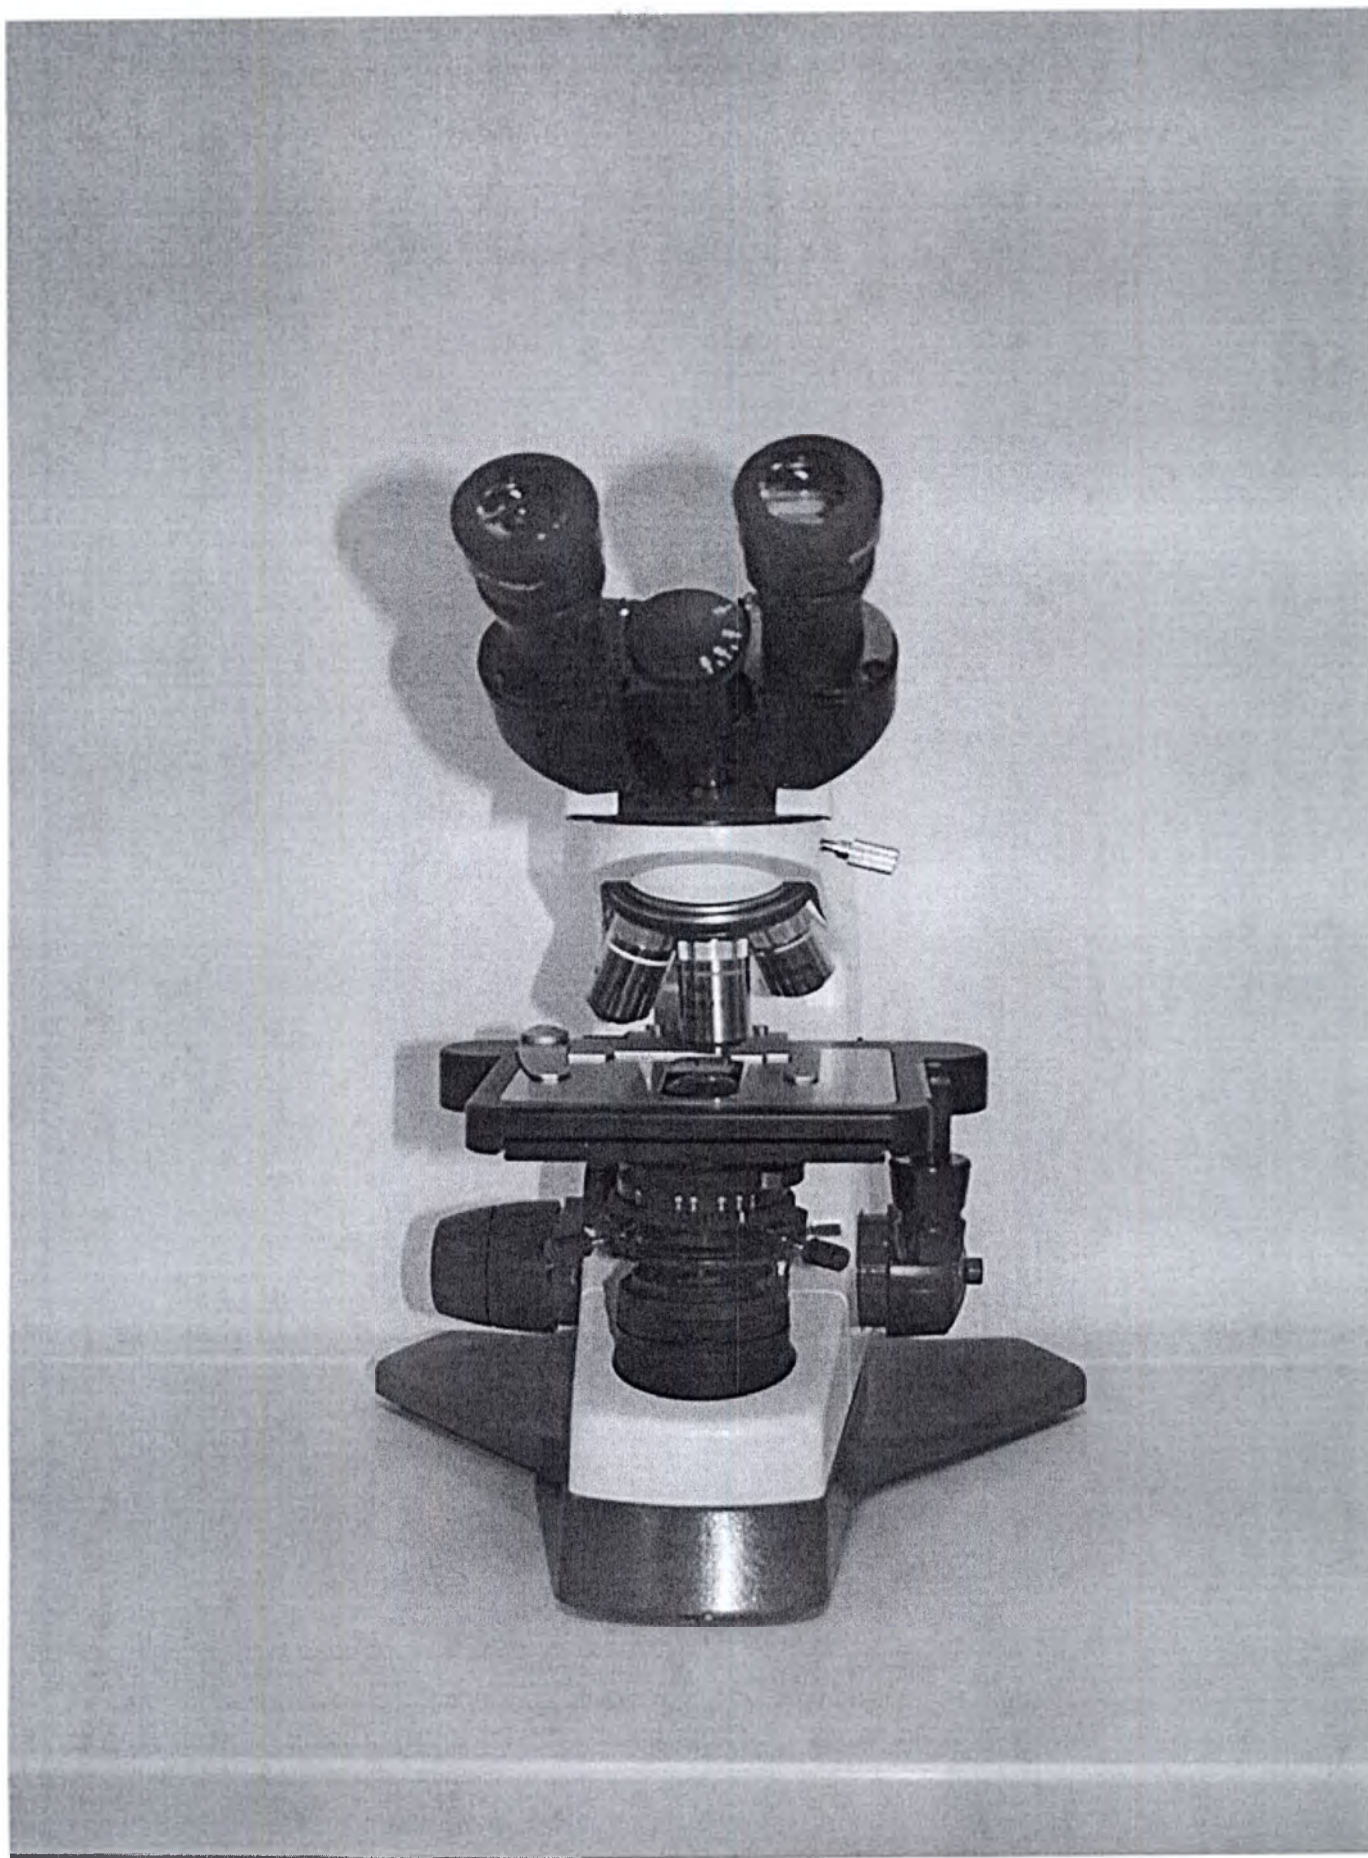


Микроскоп биологический исполнение М20

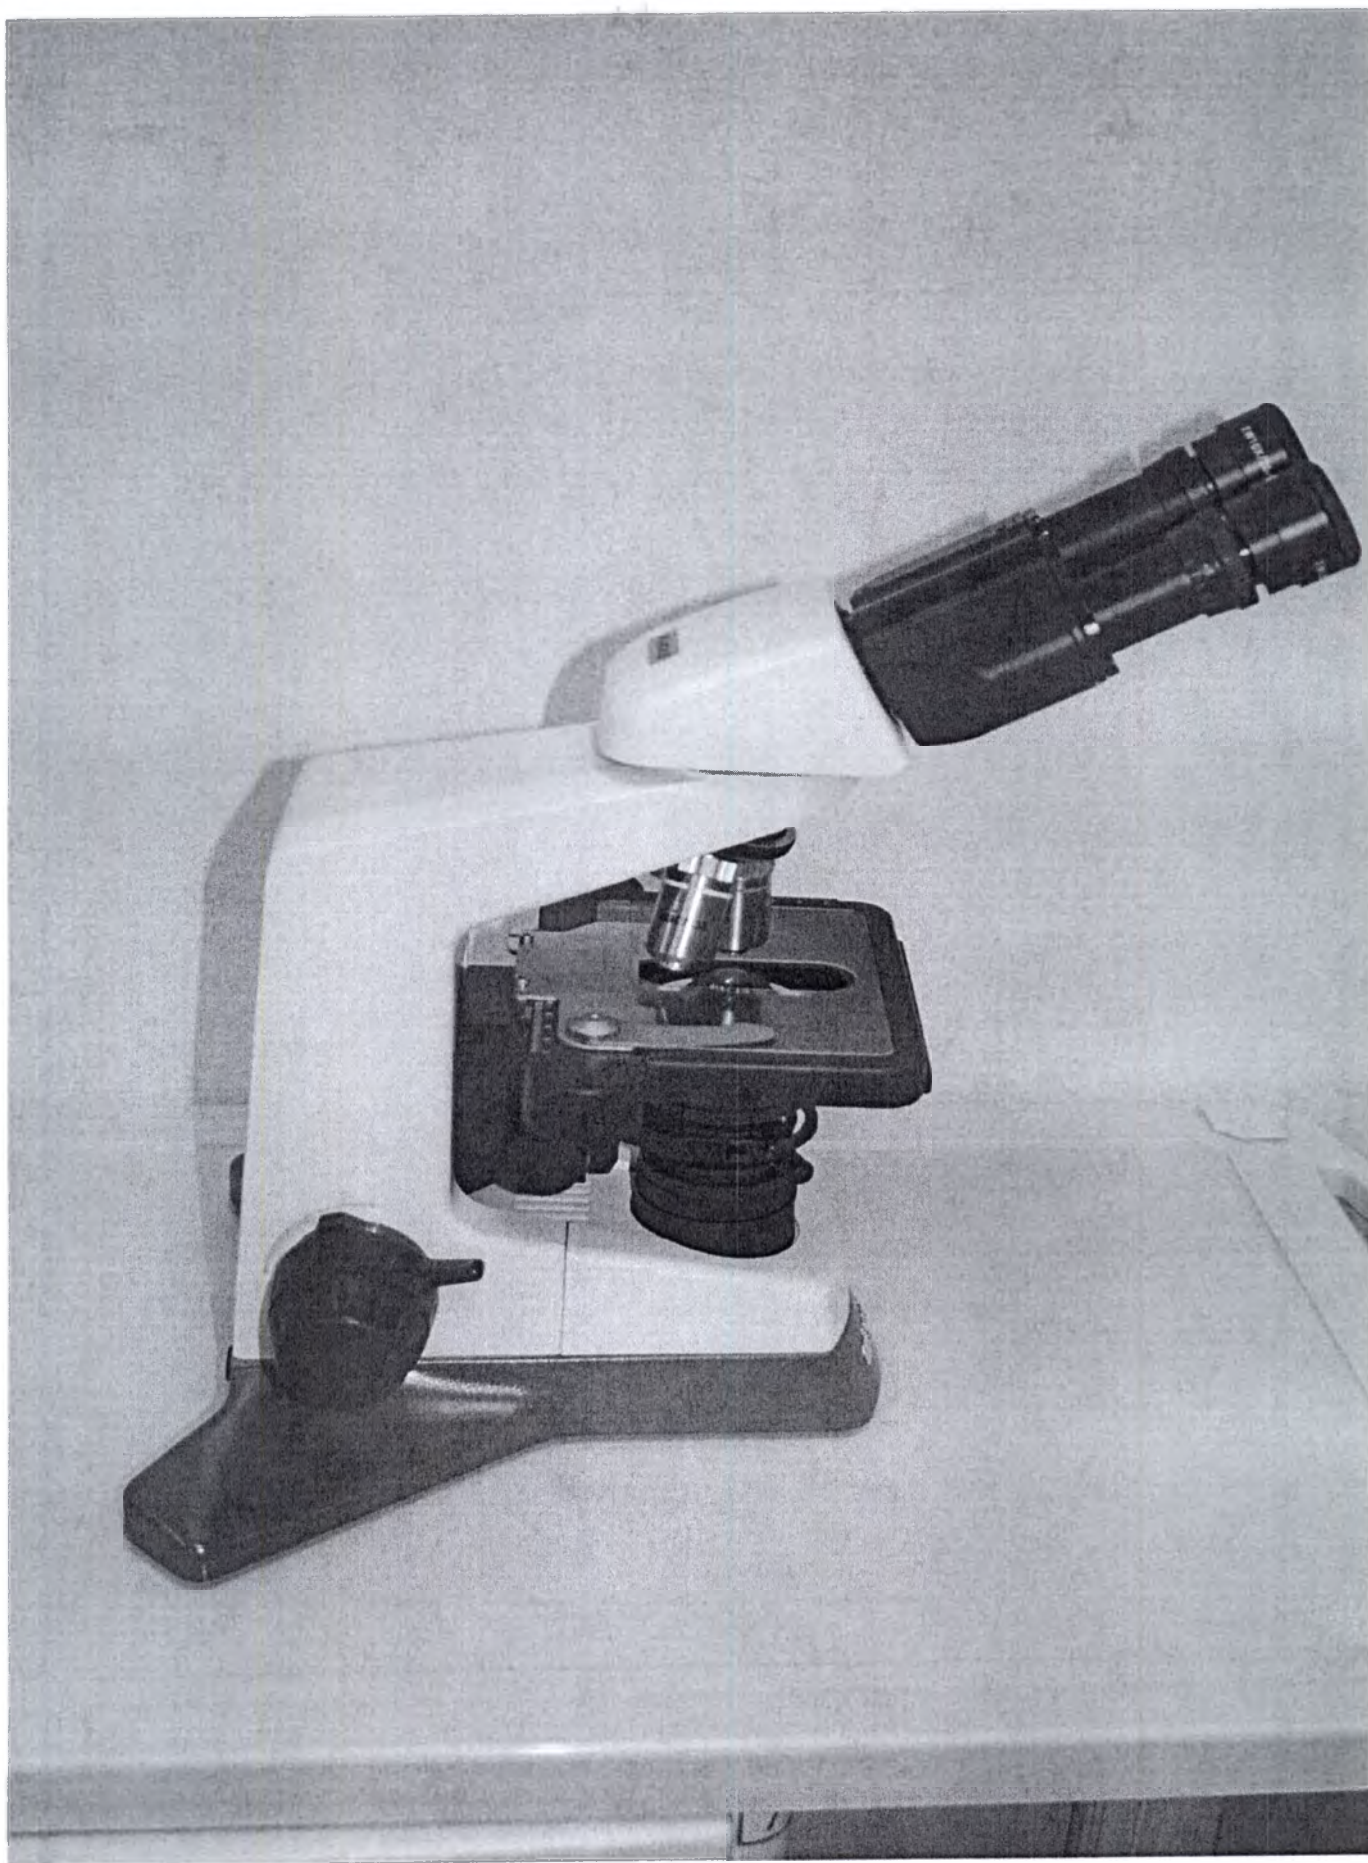


Микроскоп биологический исполнение M20 LED

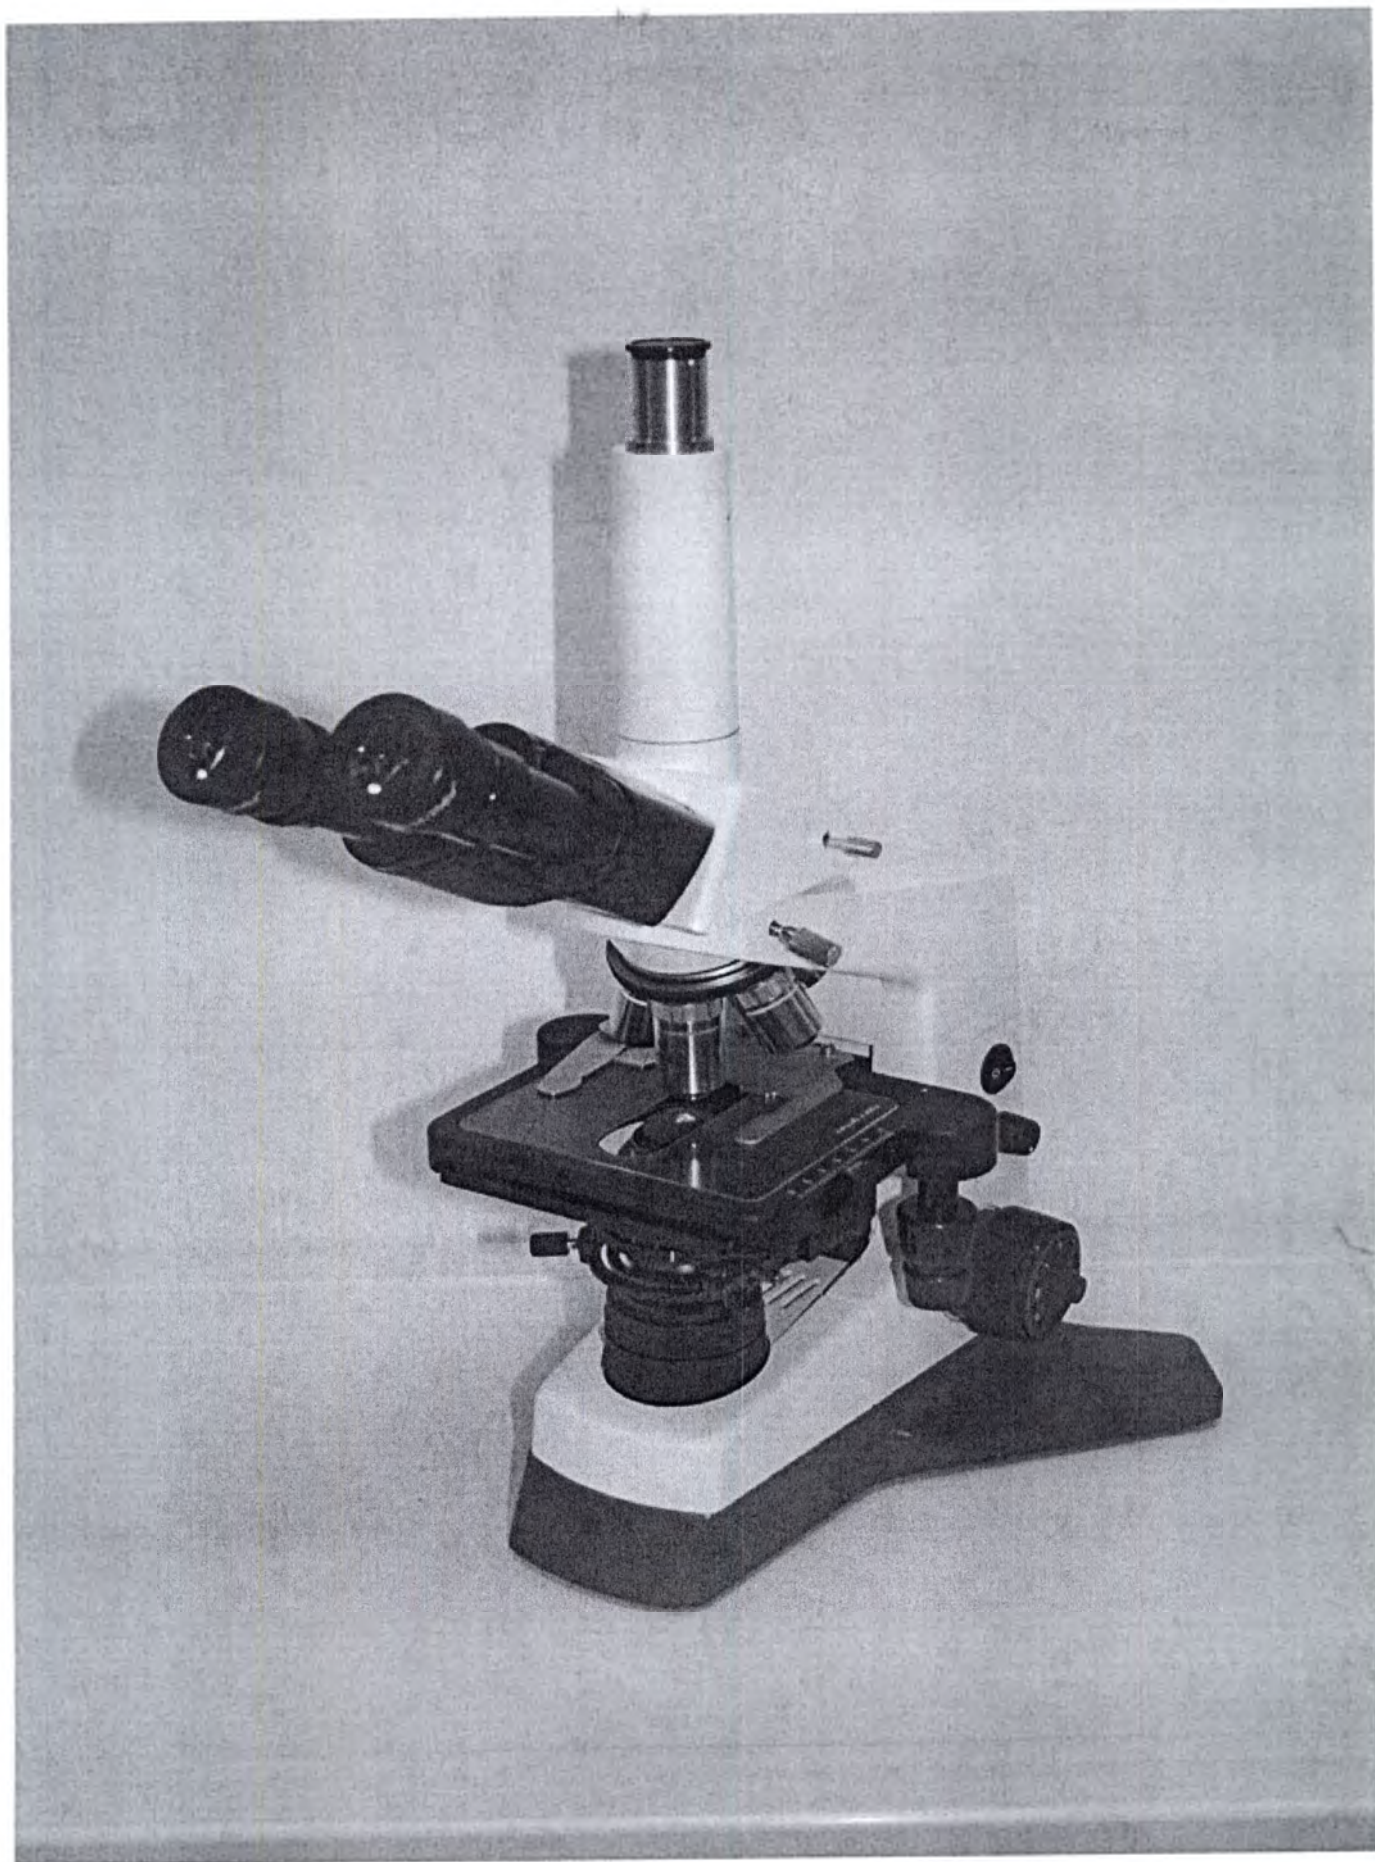


Микроскоп биологический исполнение М20-1

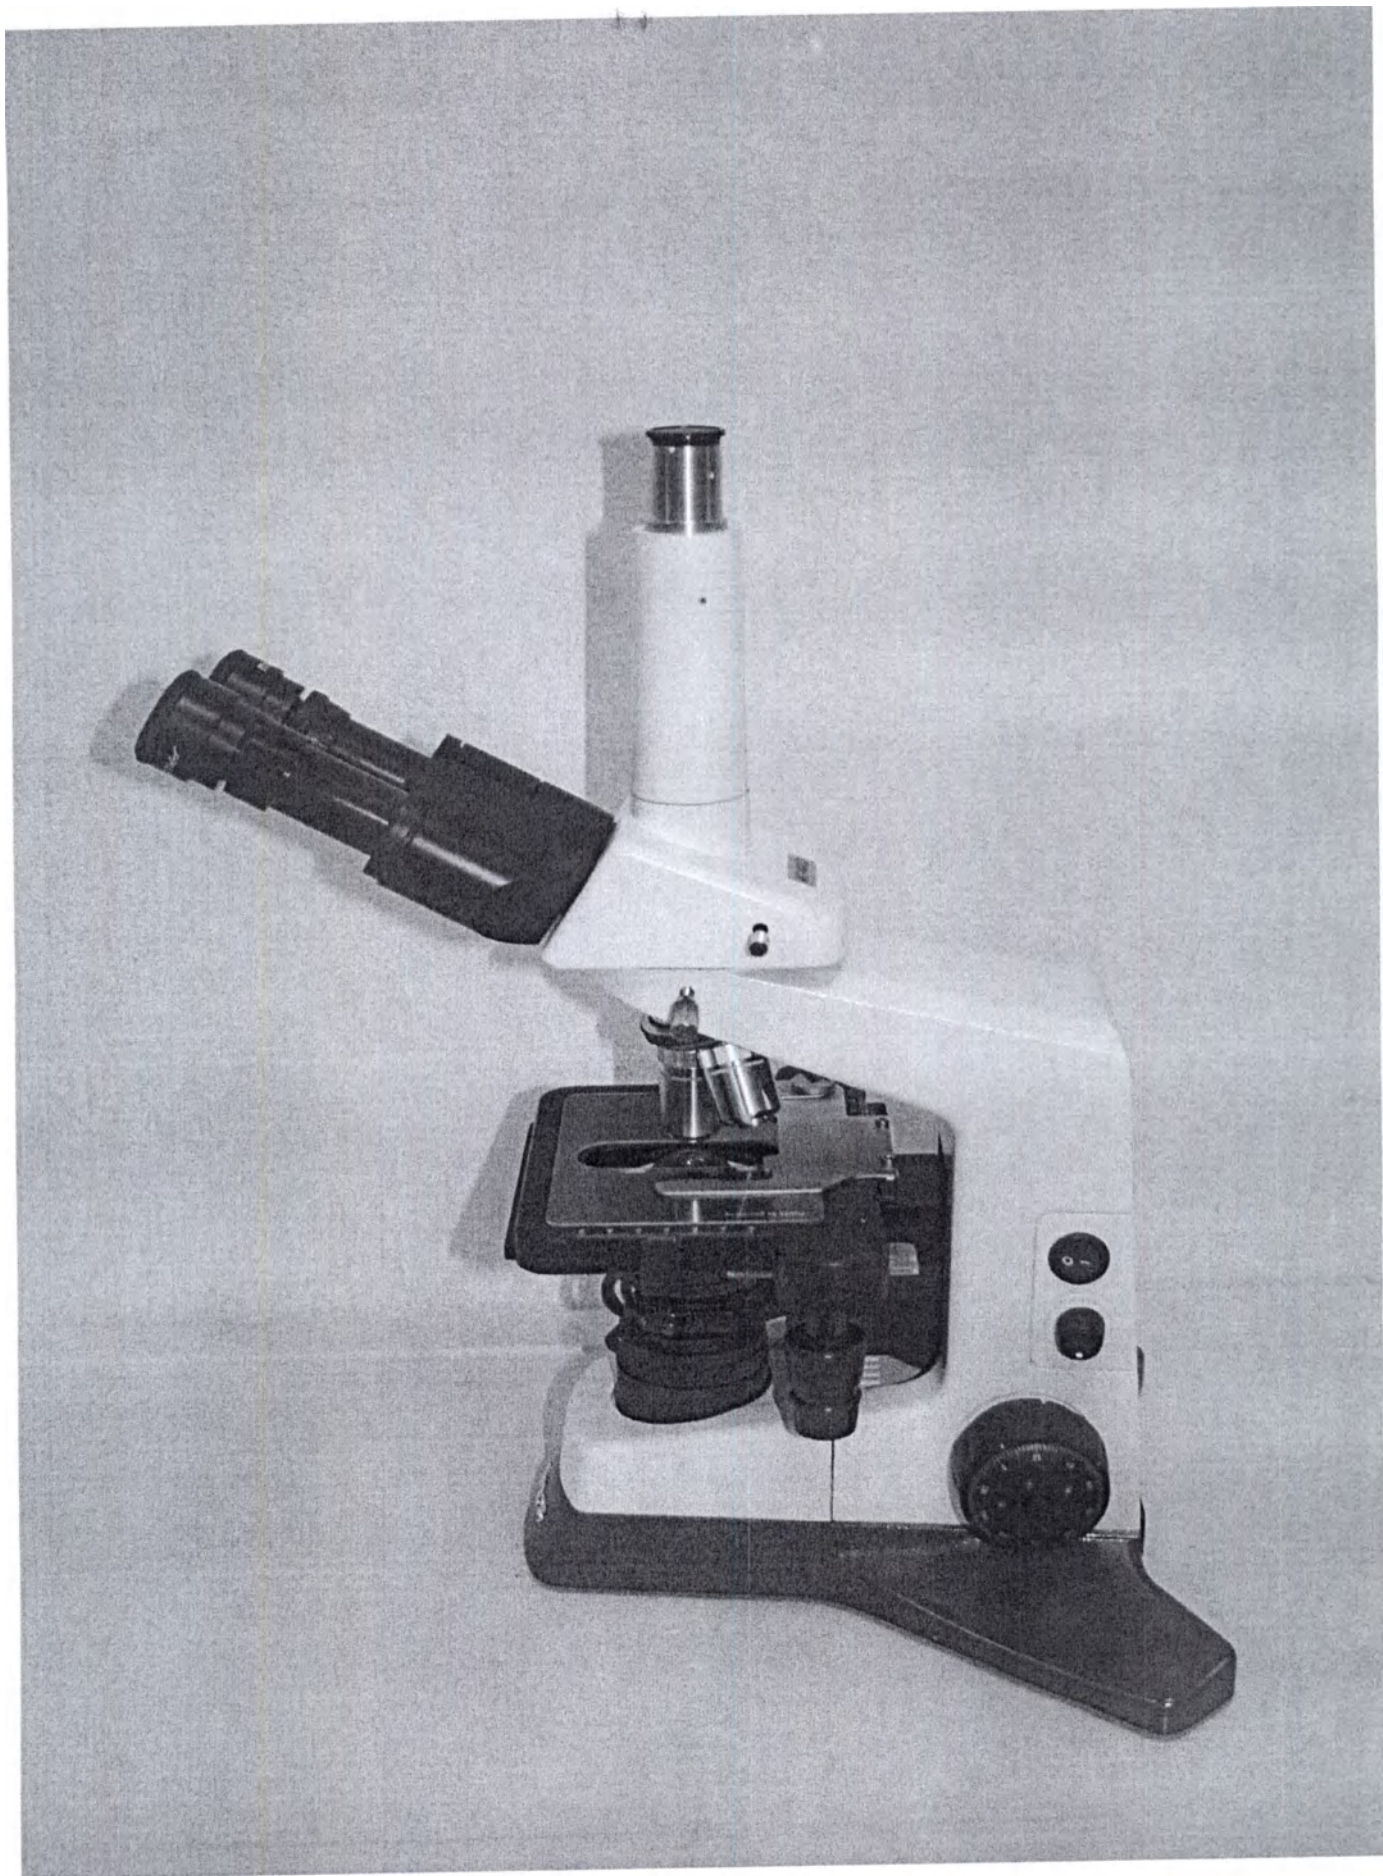


Микроскоп биологический исполнение M20-1 LED

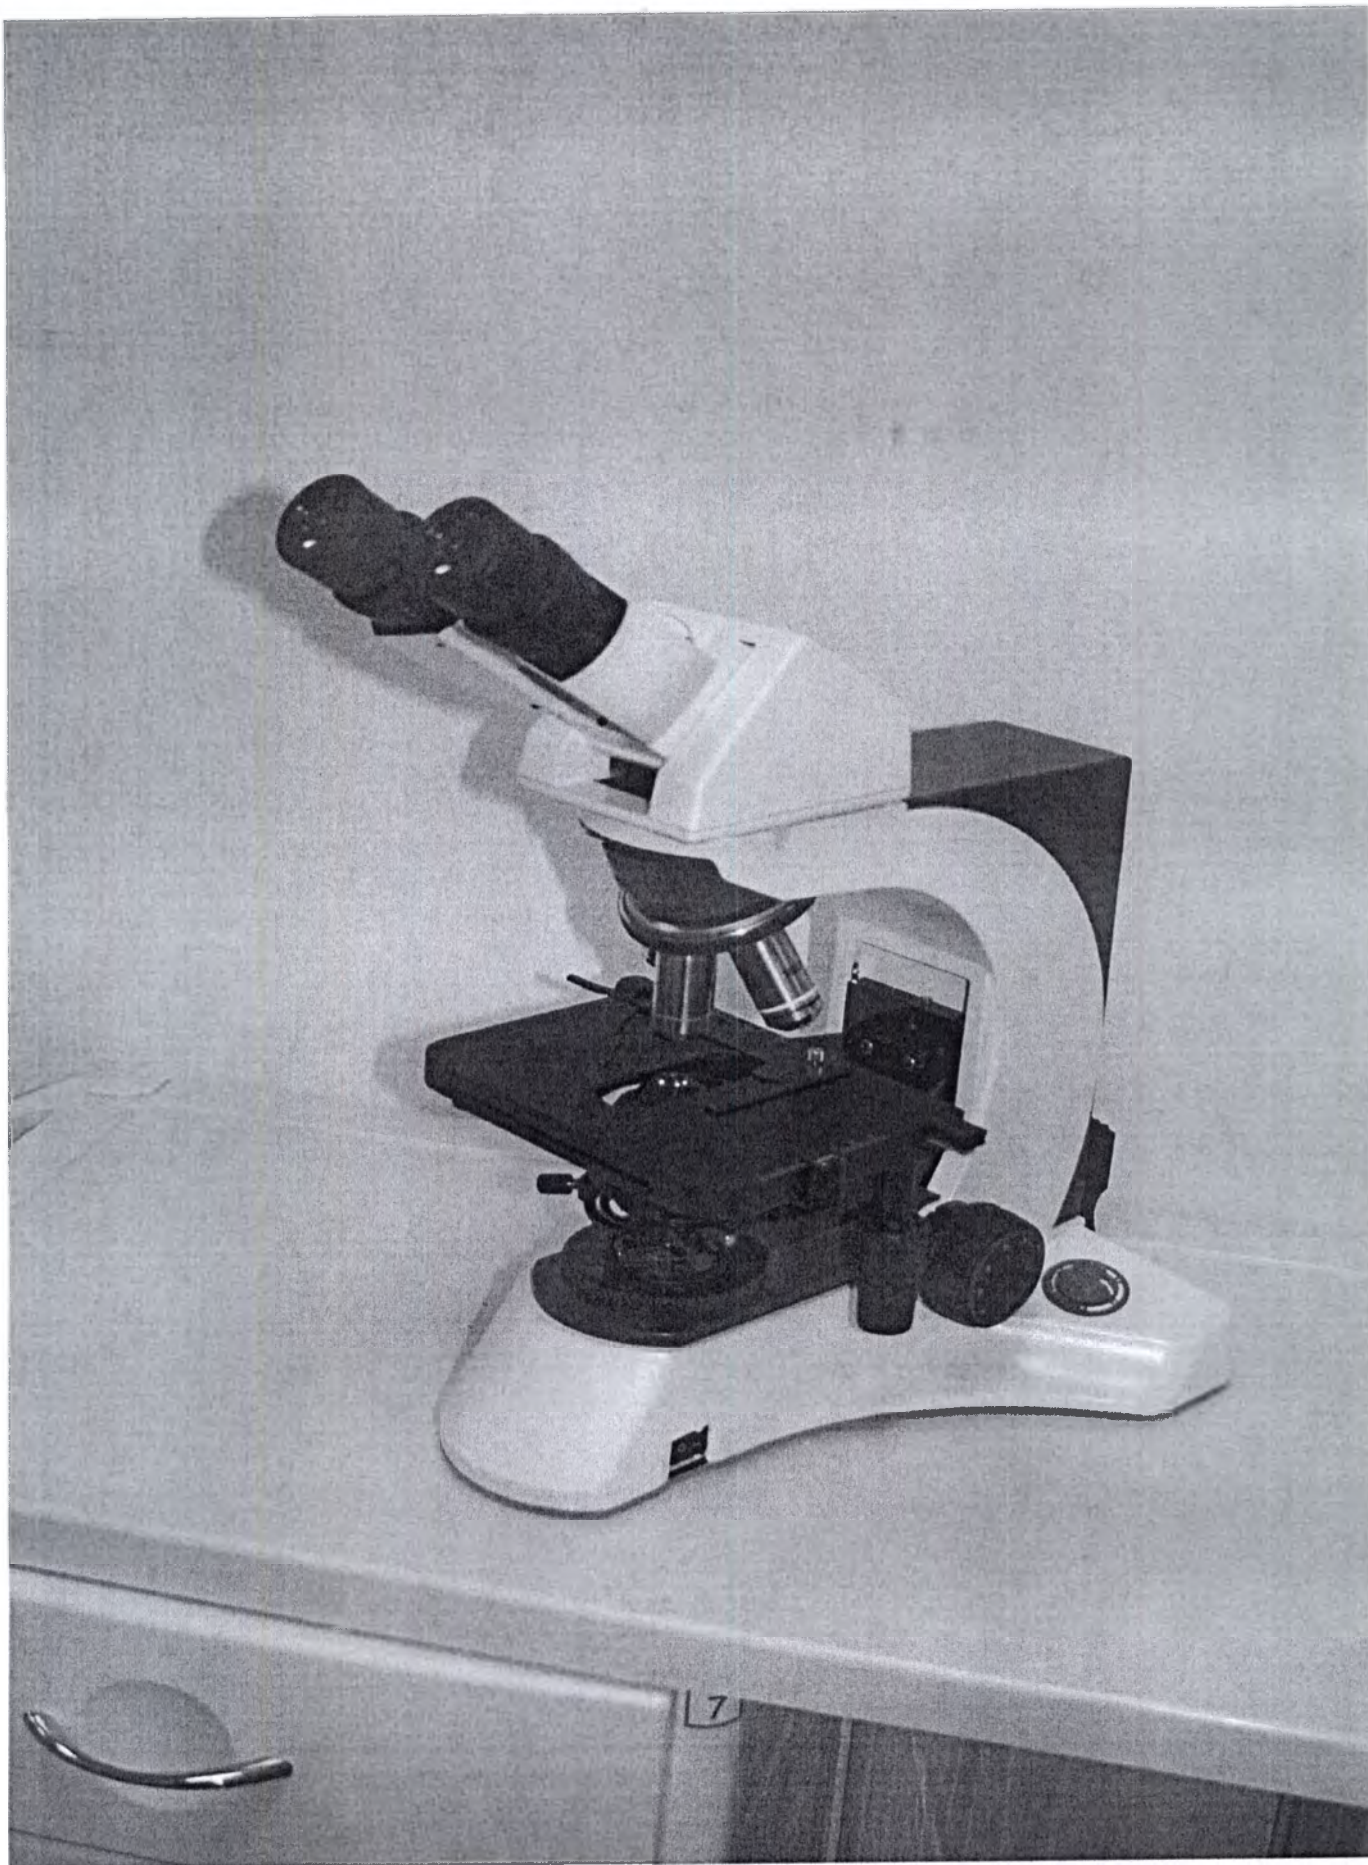


Микроскоп биологический исполнение М30

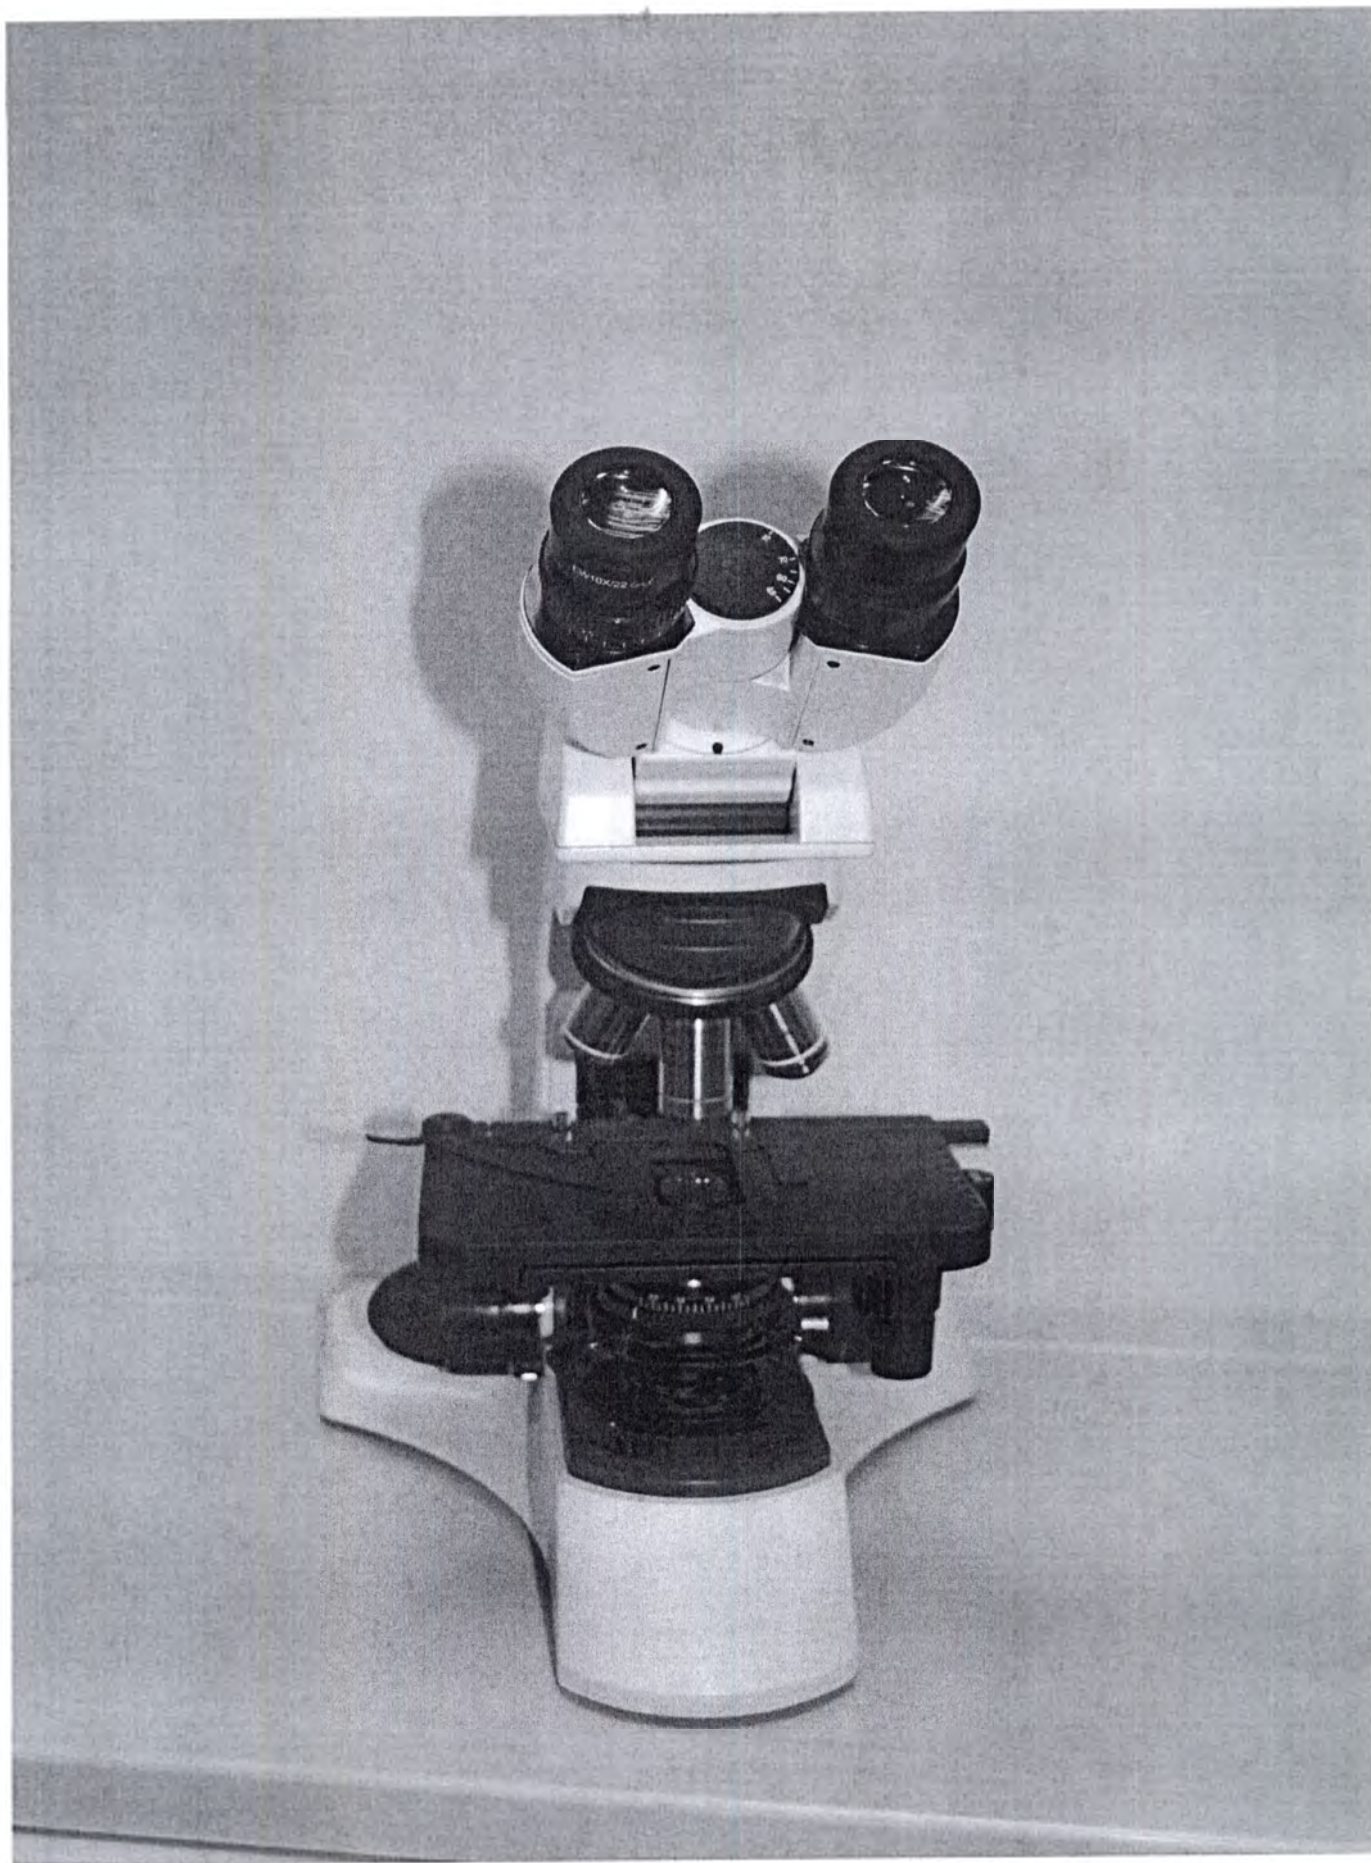


Микроскоп биологический исполнение M30 LED

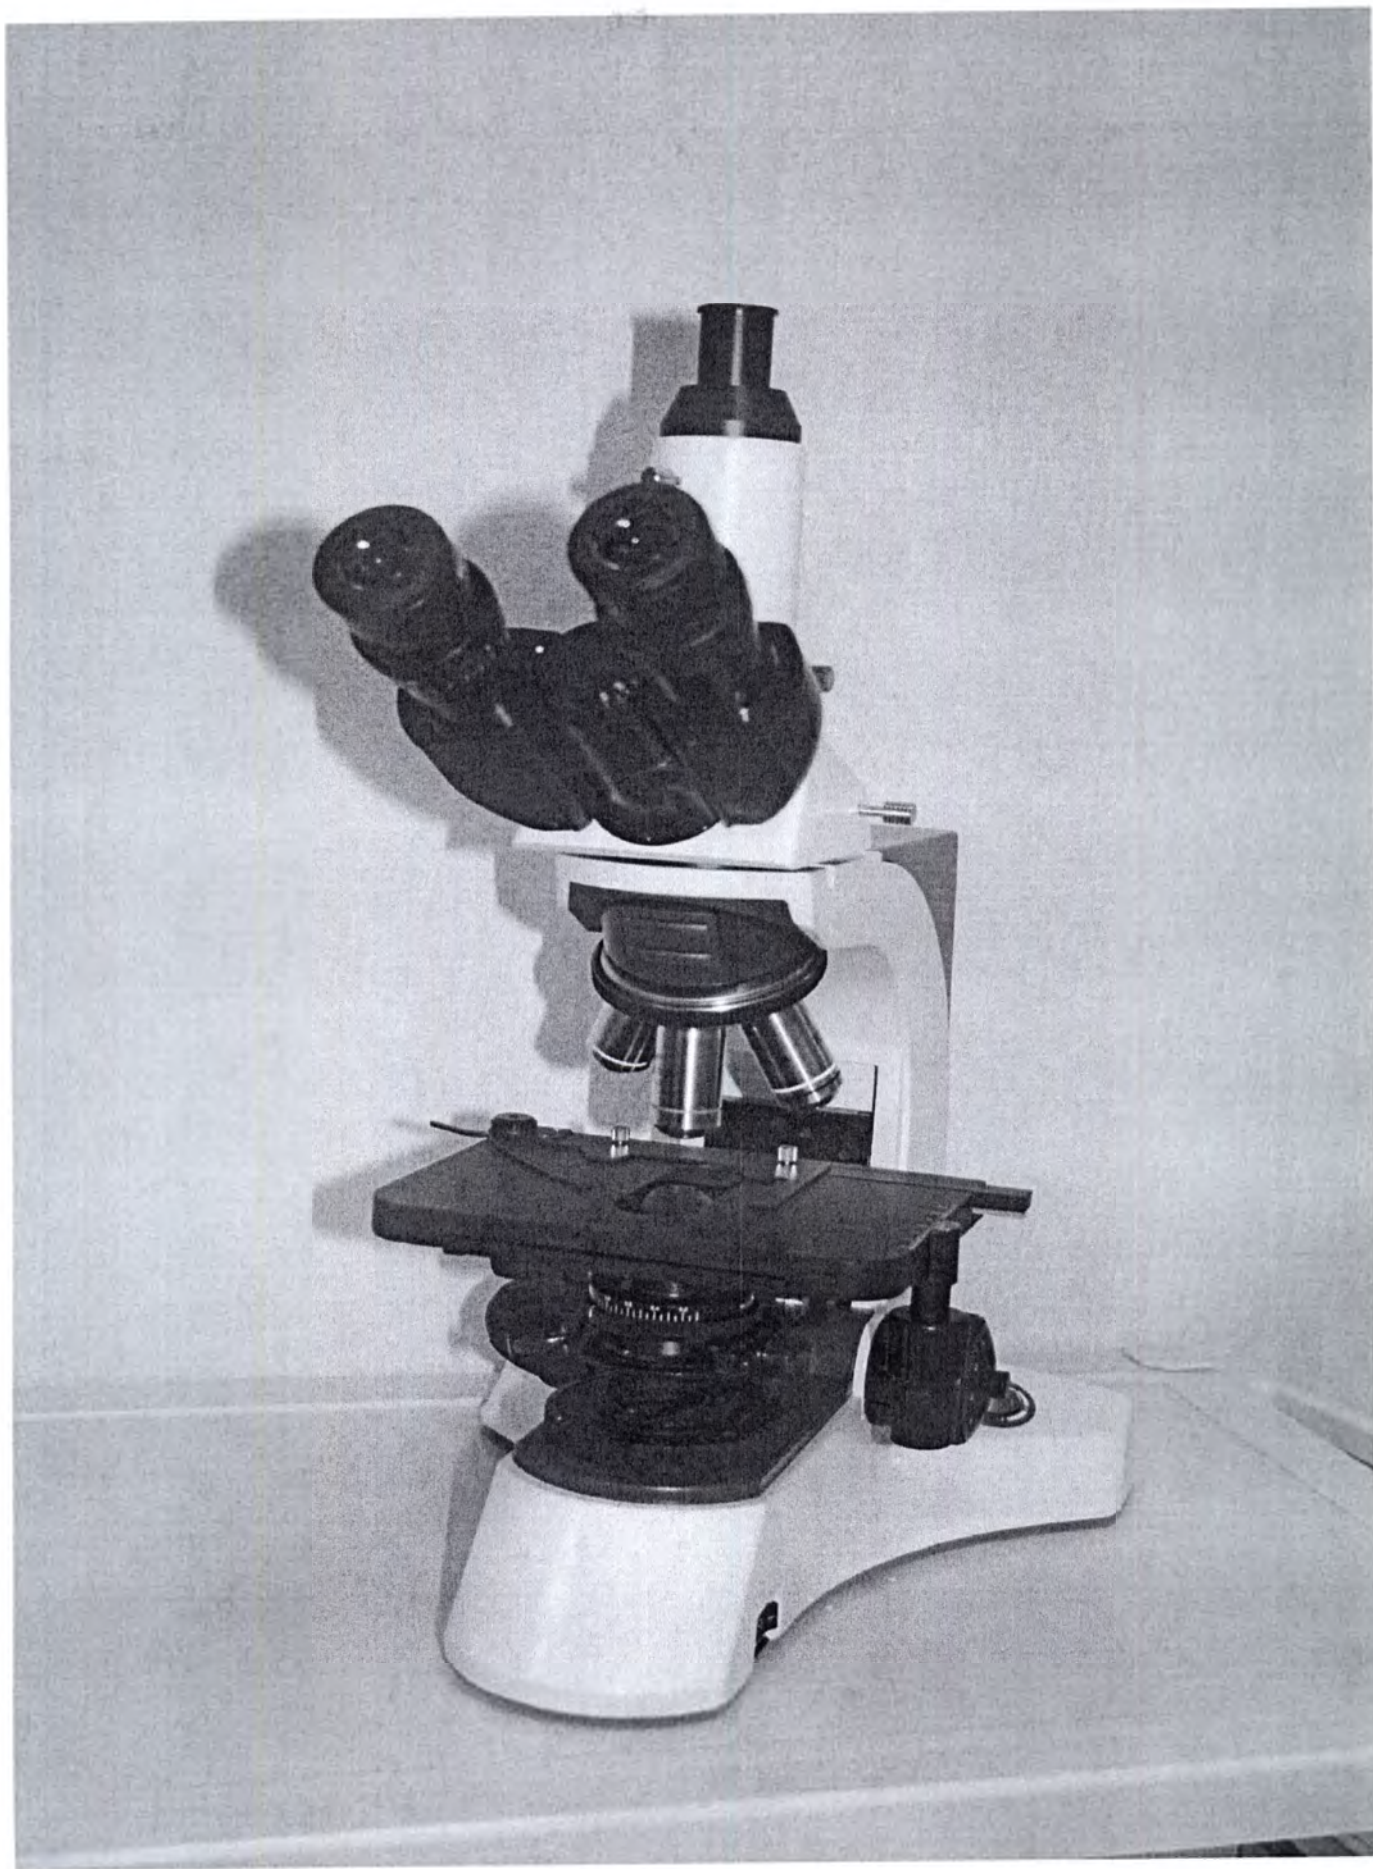


Микроскоп биологический исполнение М30-1

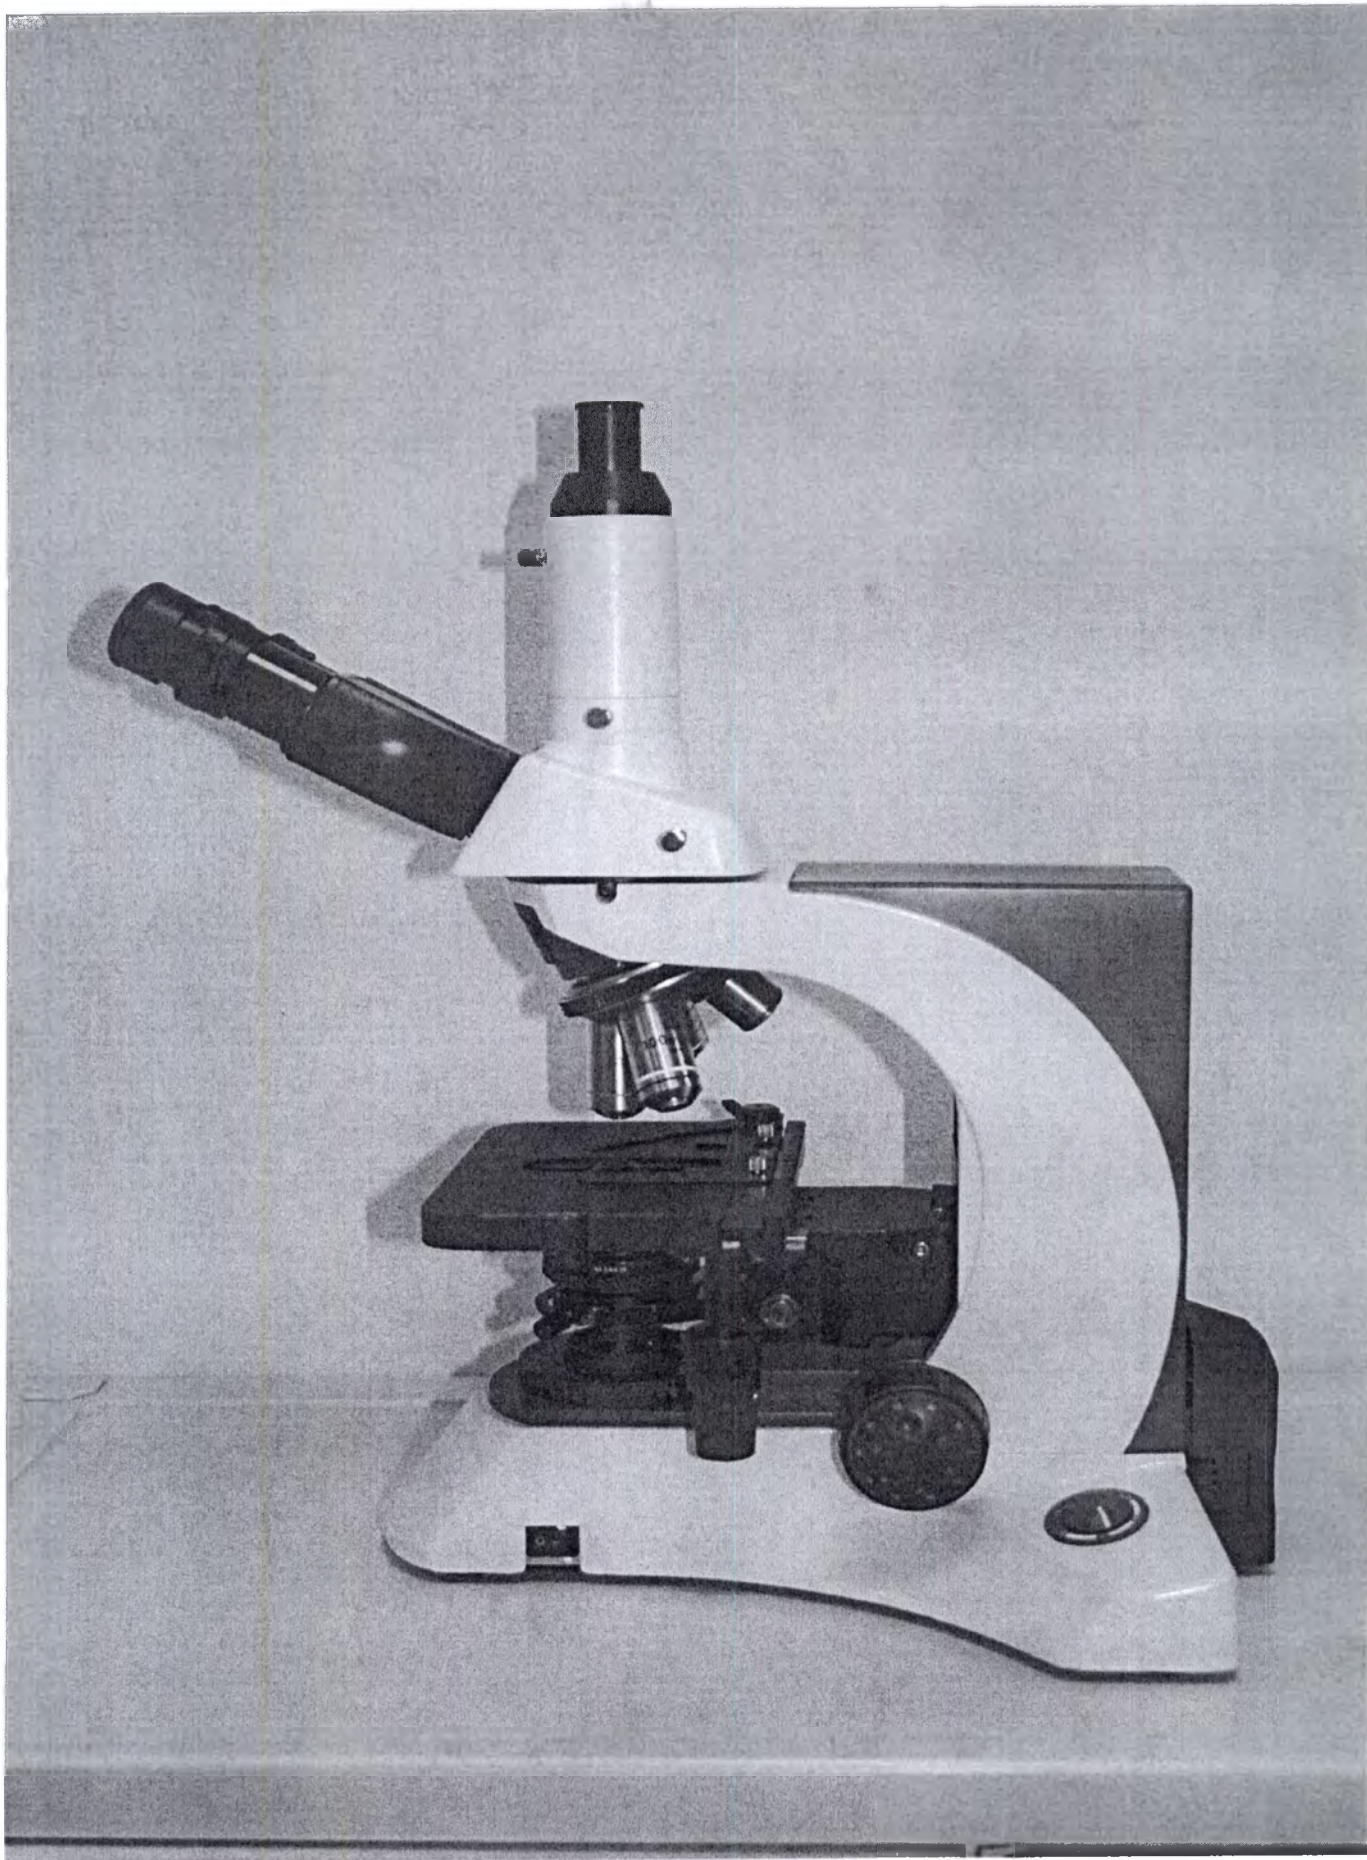


Микроскоп биологический исполнение М30-1 LED

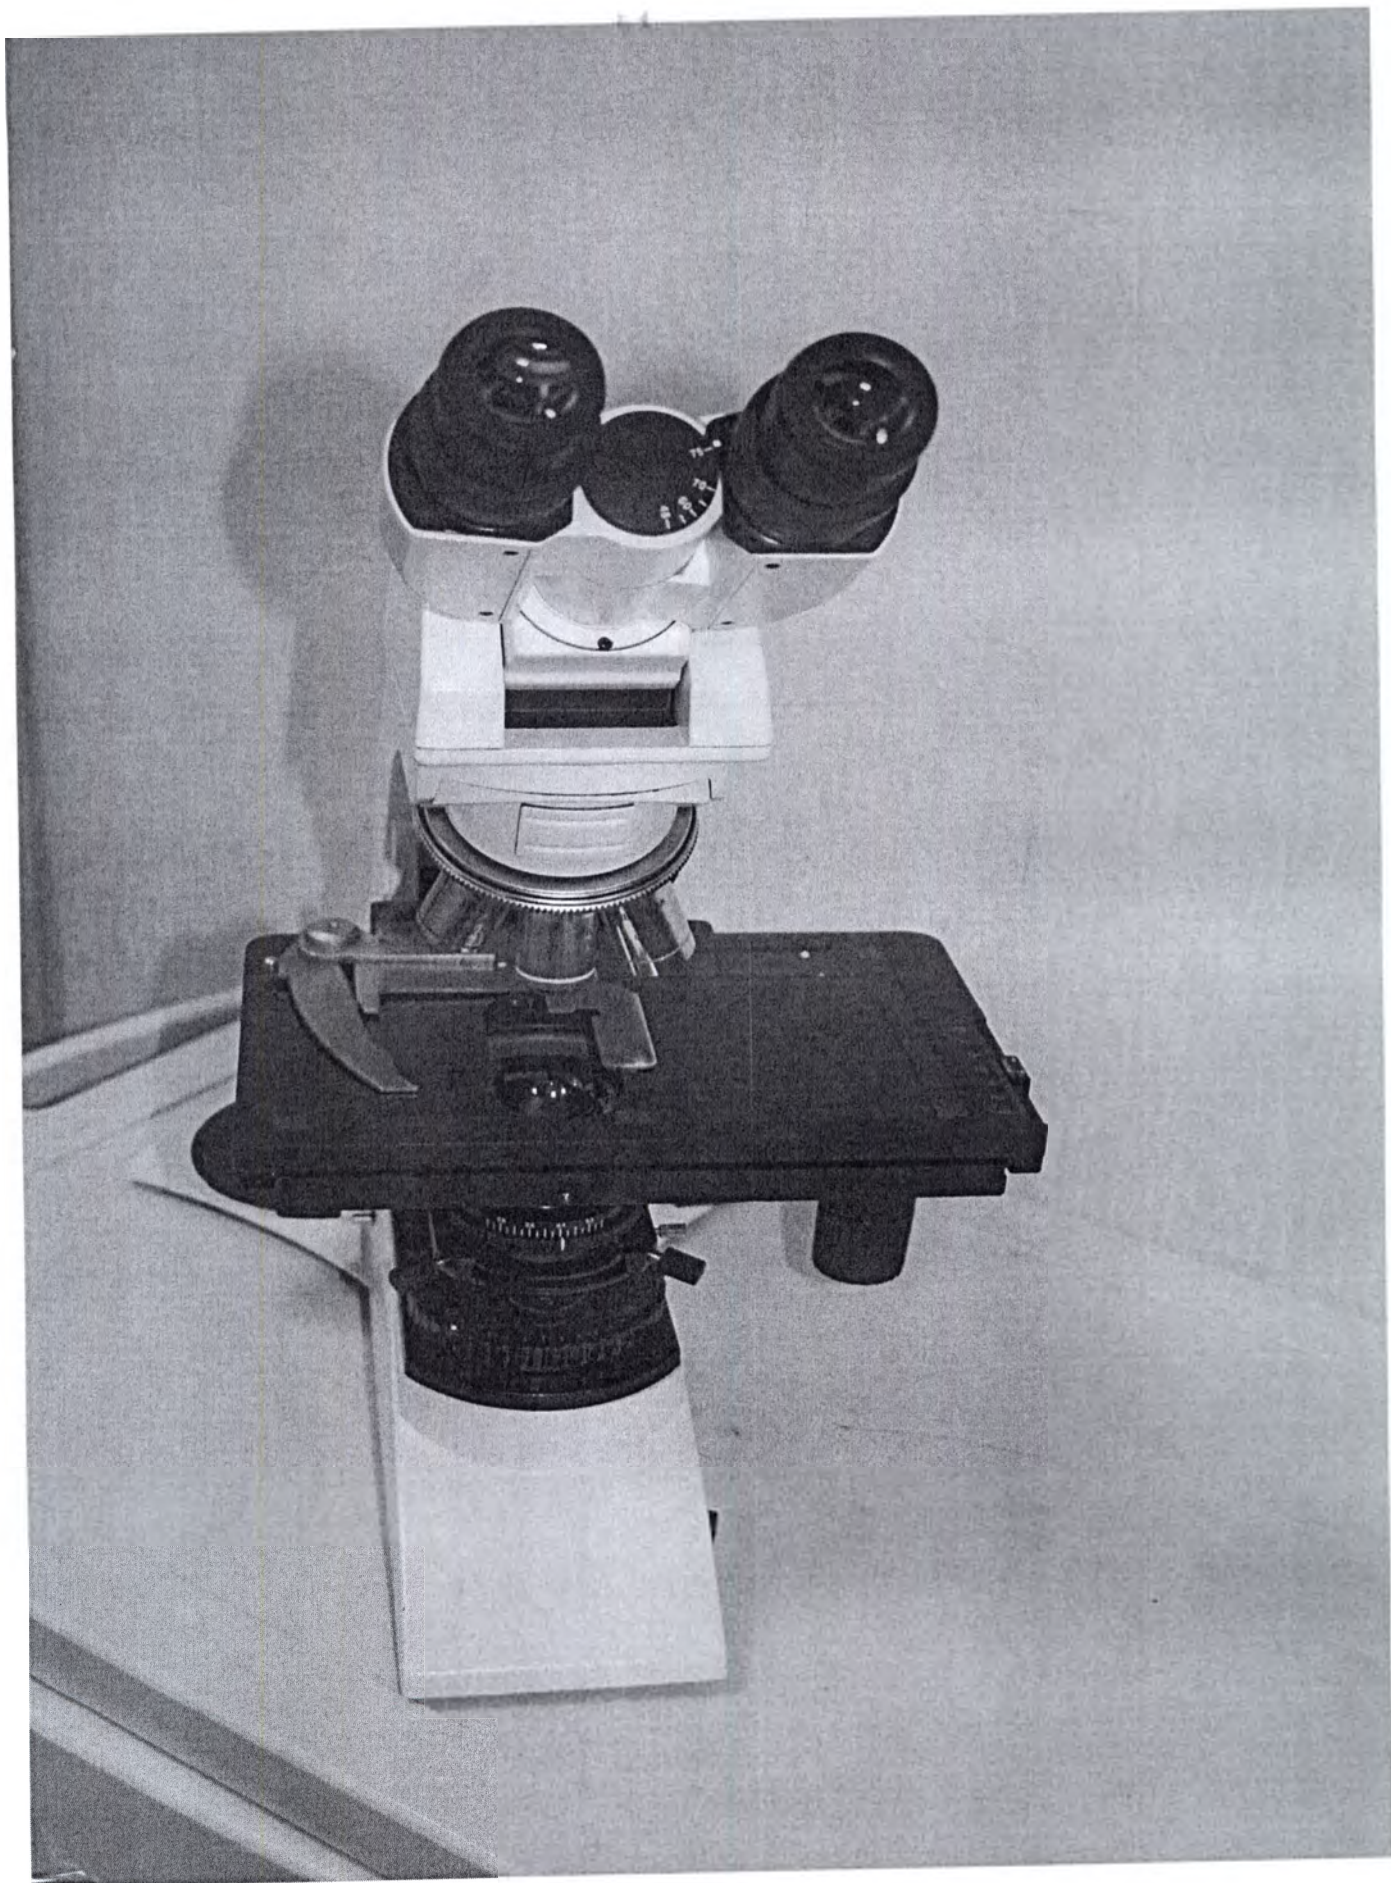


Микроскоп биологический исполнение М30-2

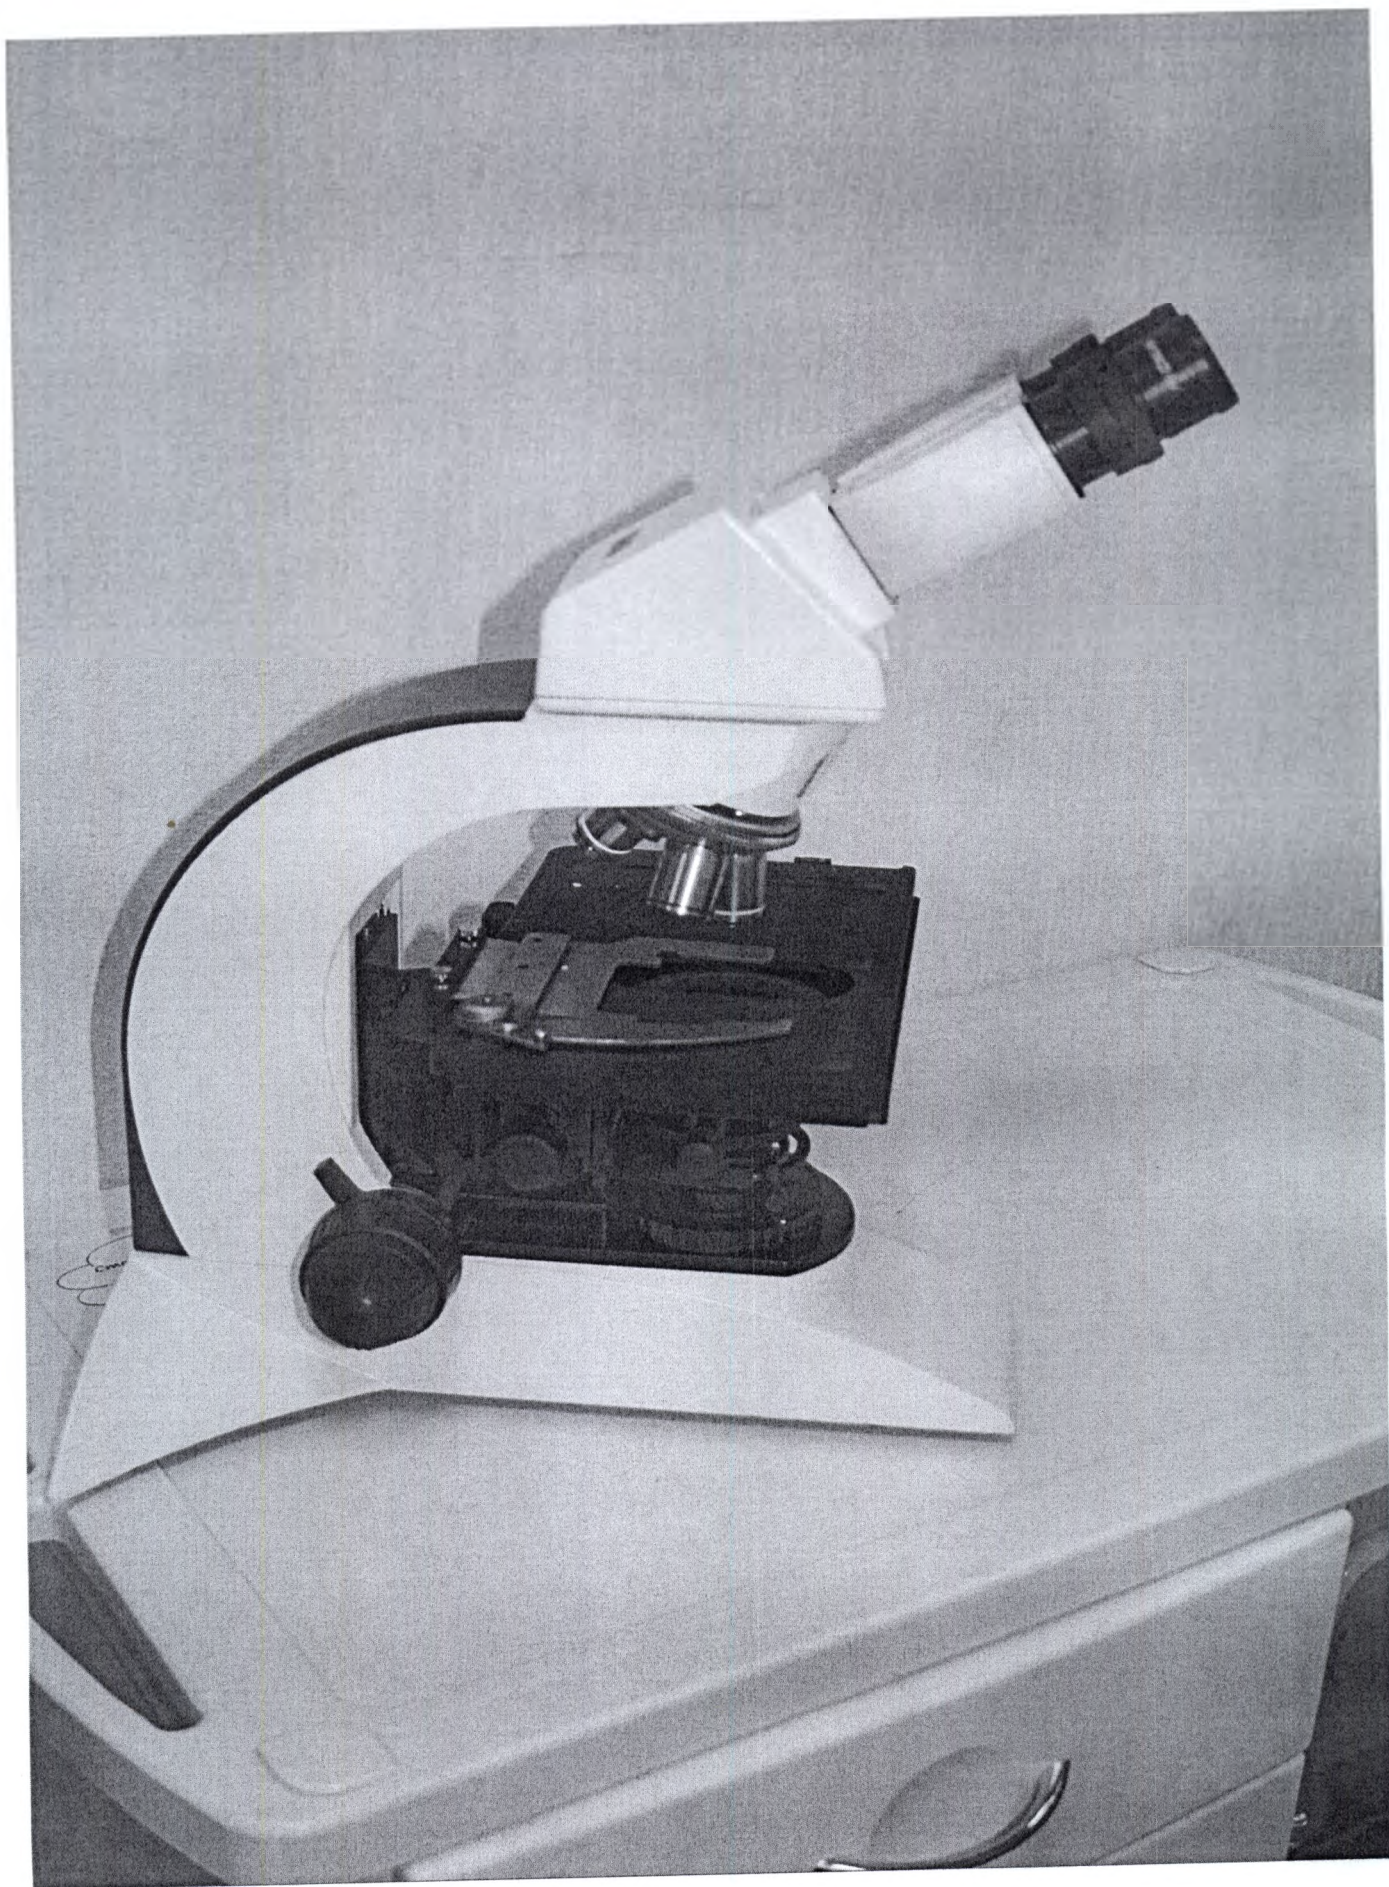


Микроскоп биологический исполнение М30-2 LED

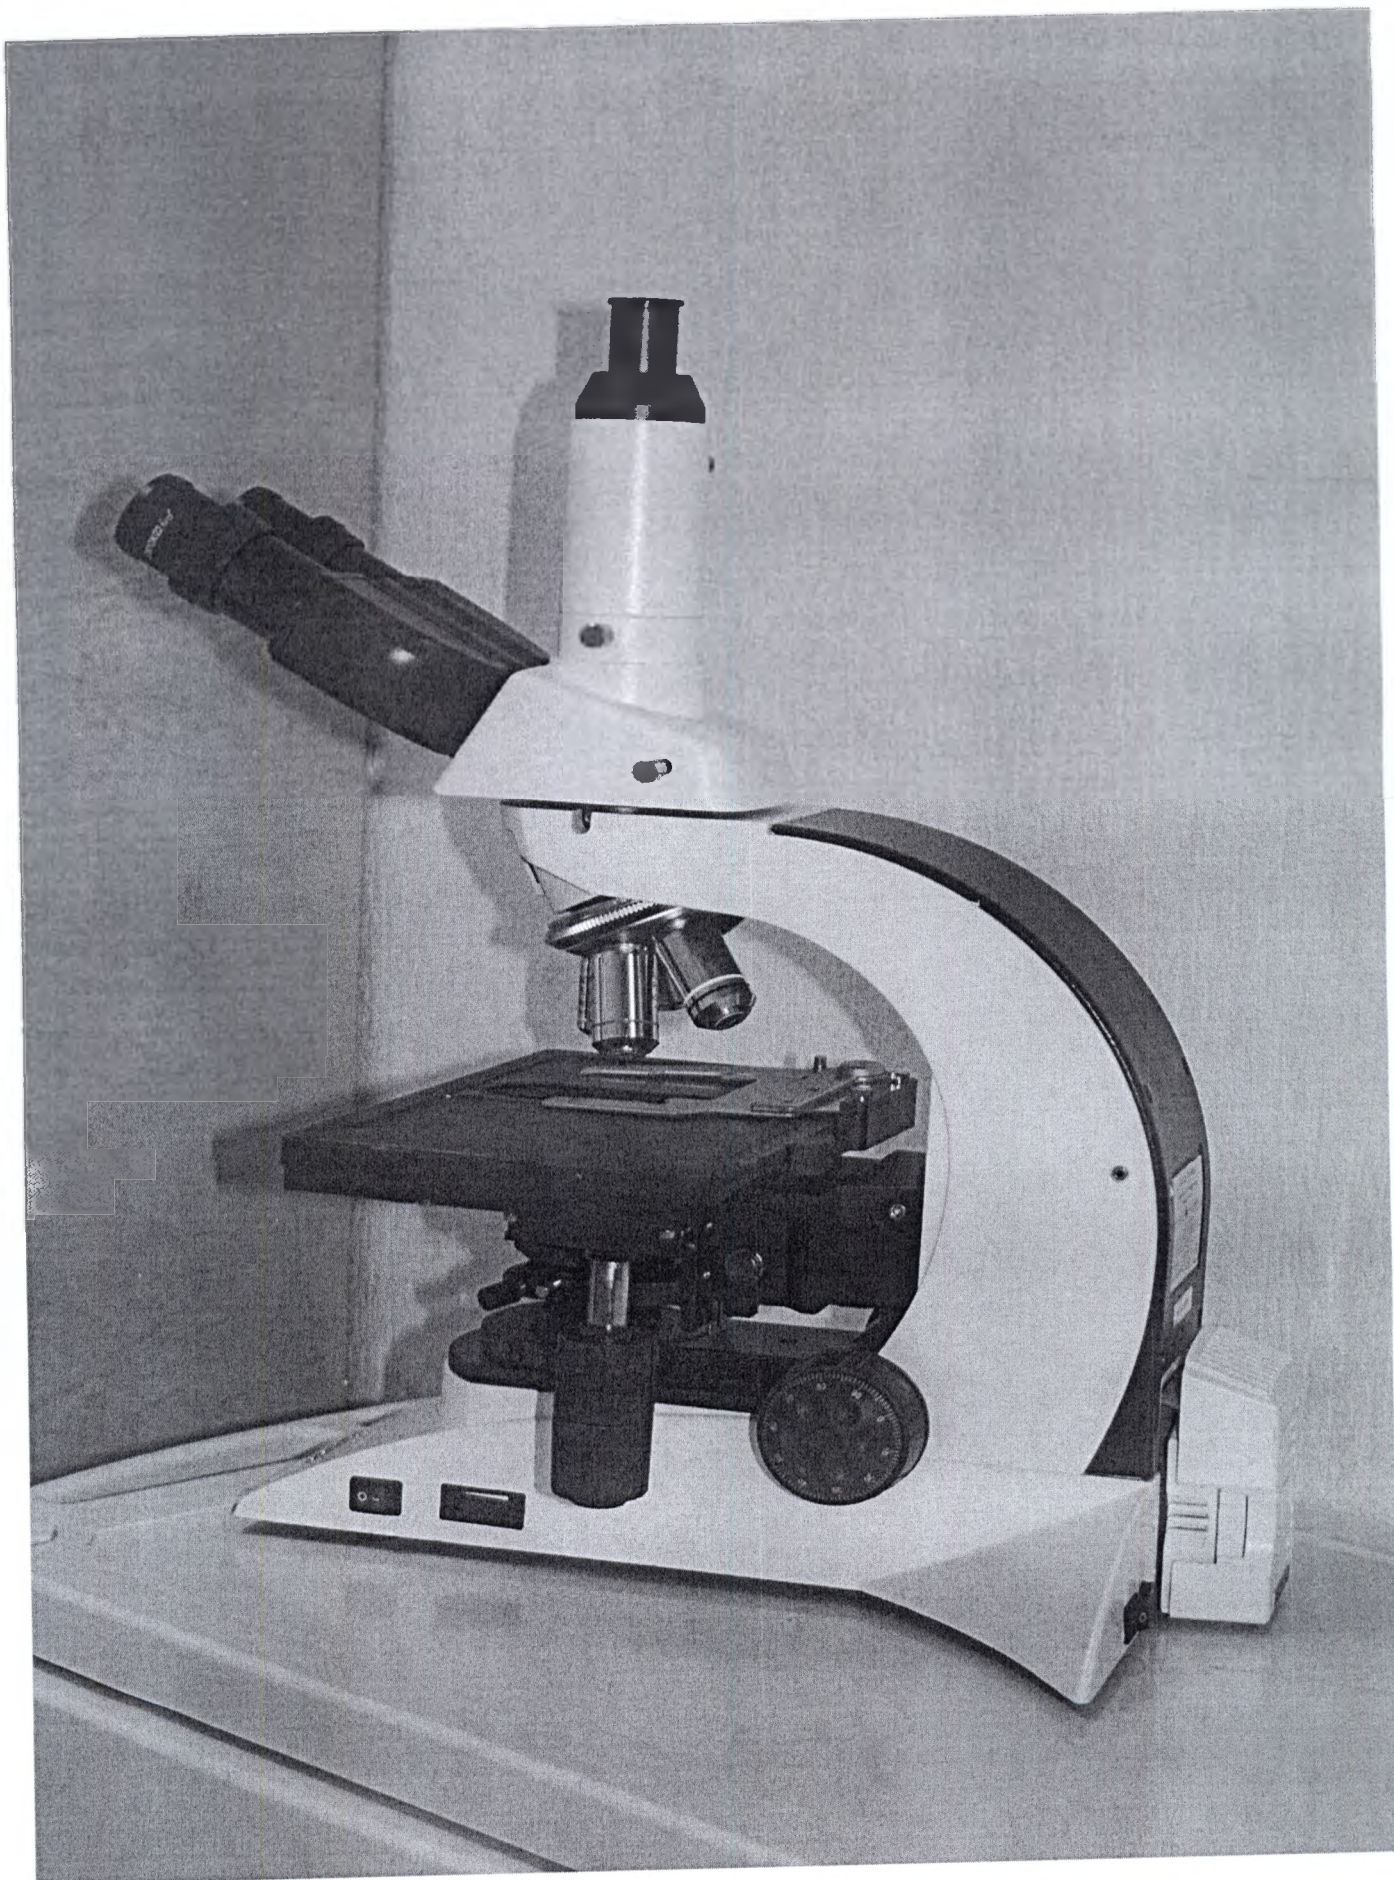


Микроскоп биологический исполнение М30-1-2

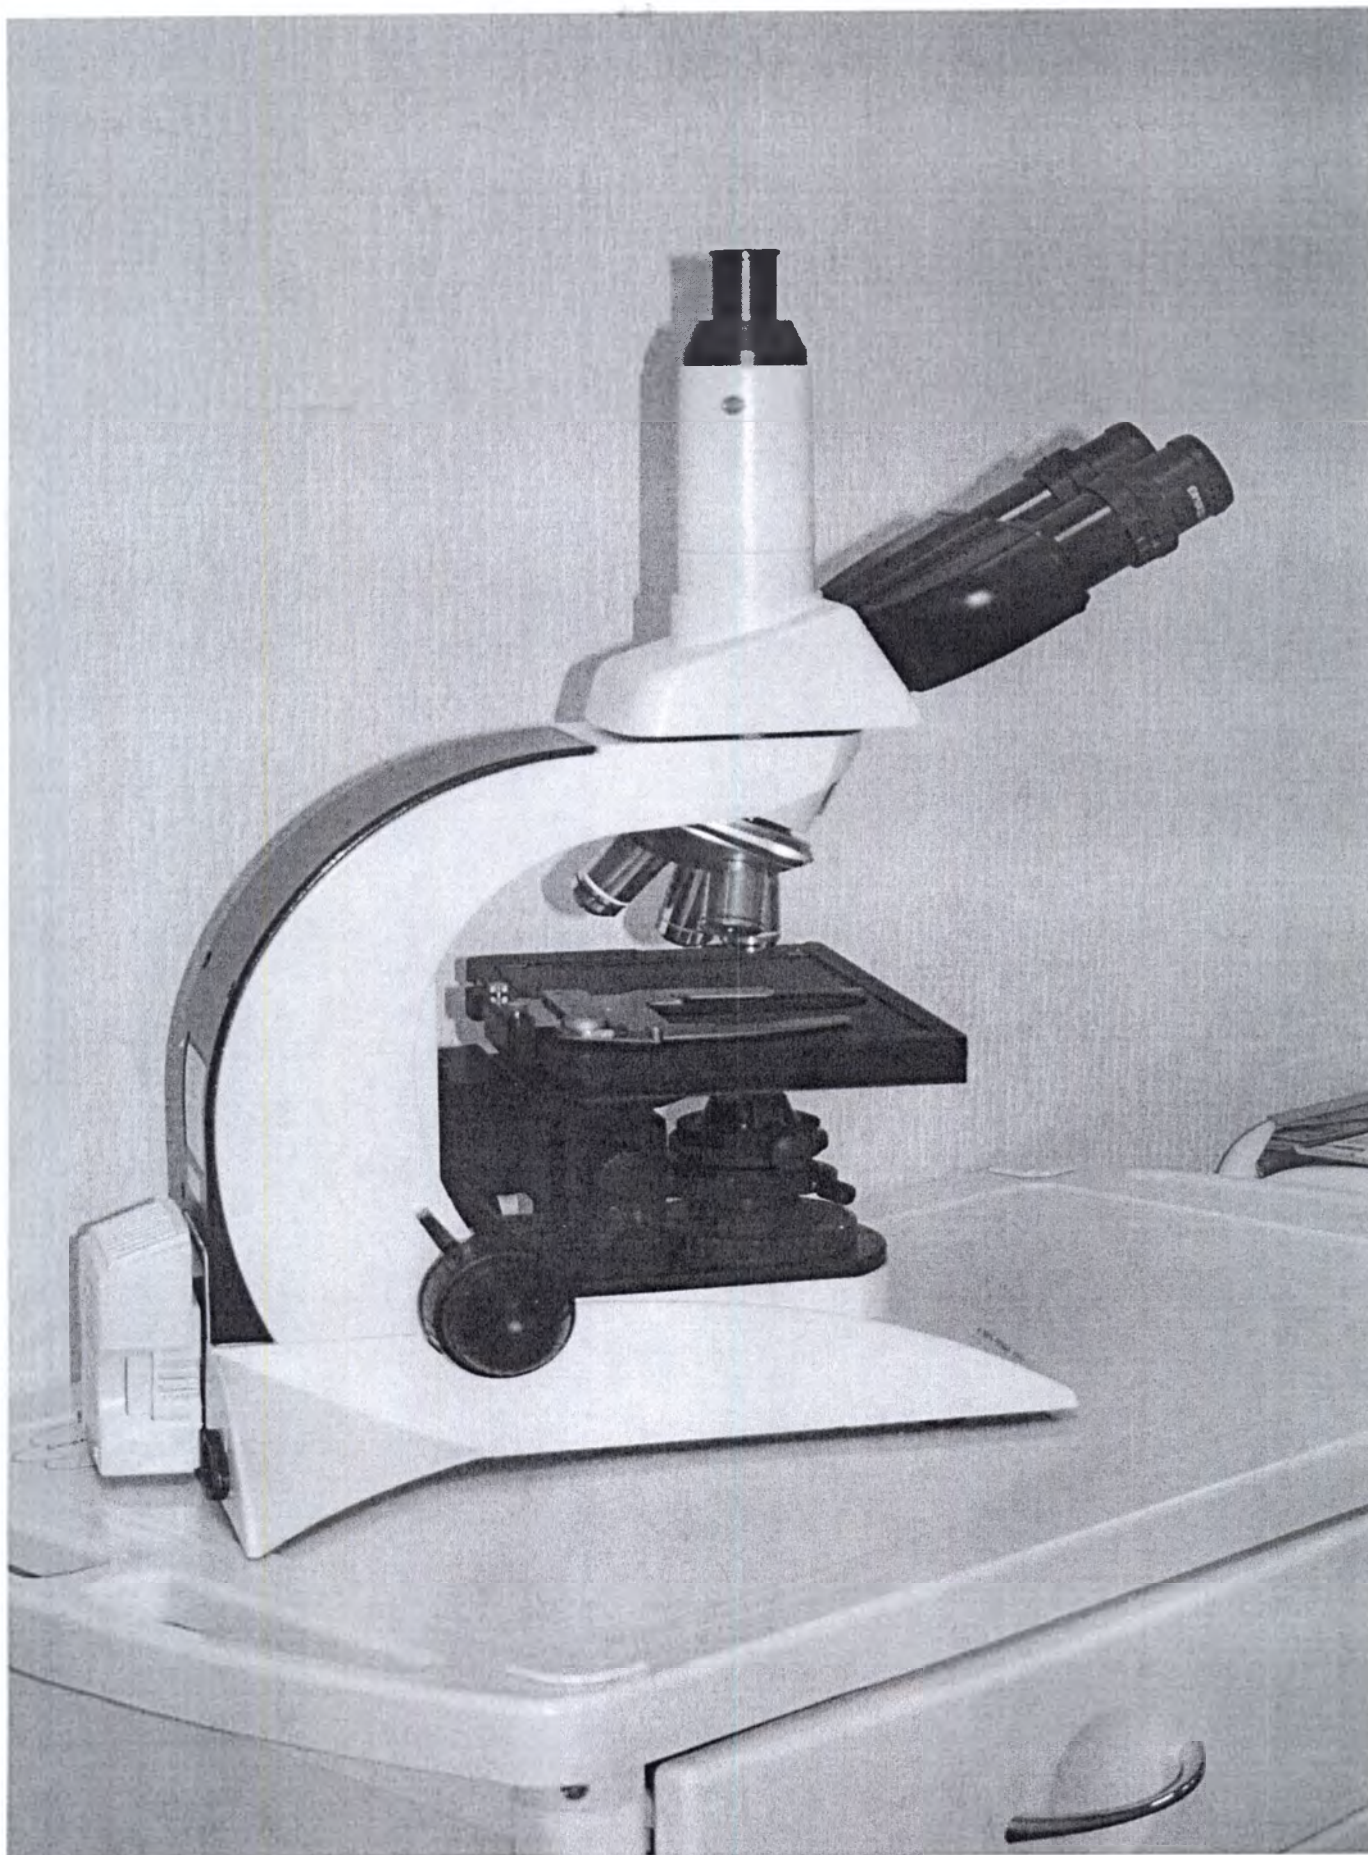


Микроскоп биологический исполнение M30-1-2LED

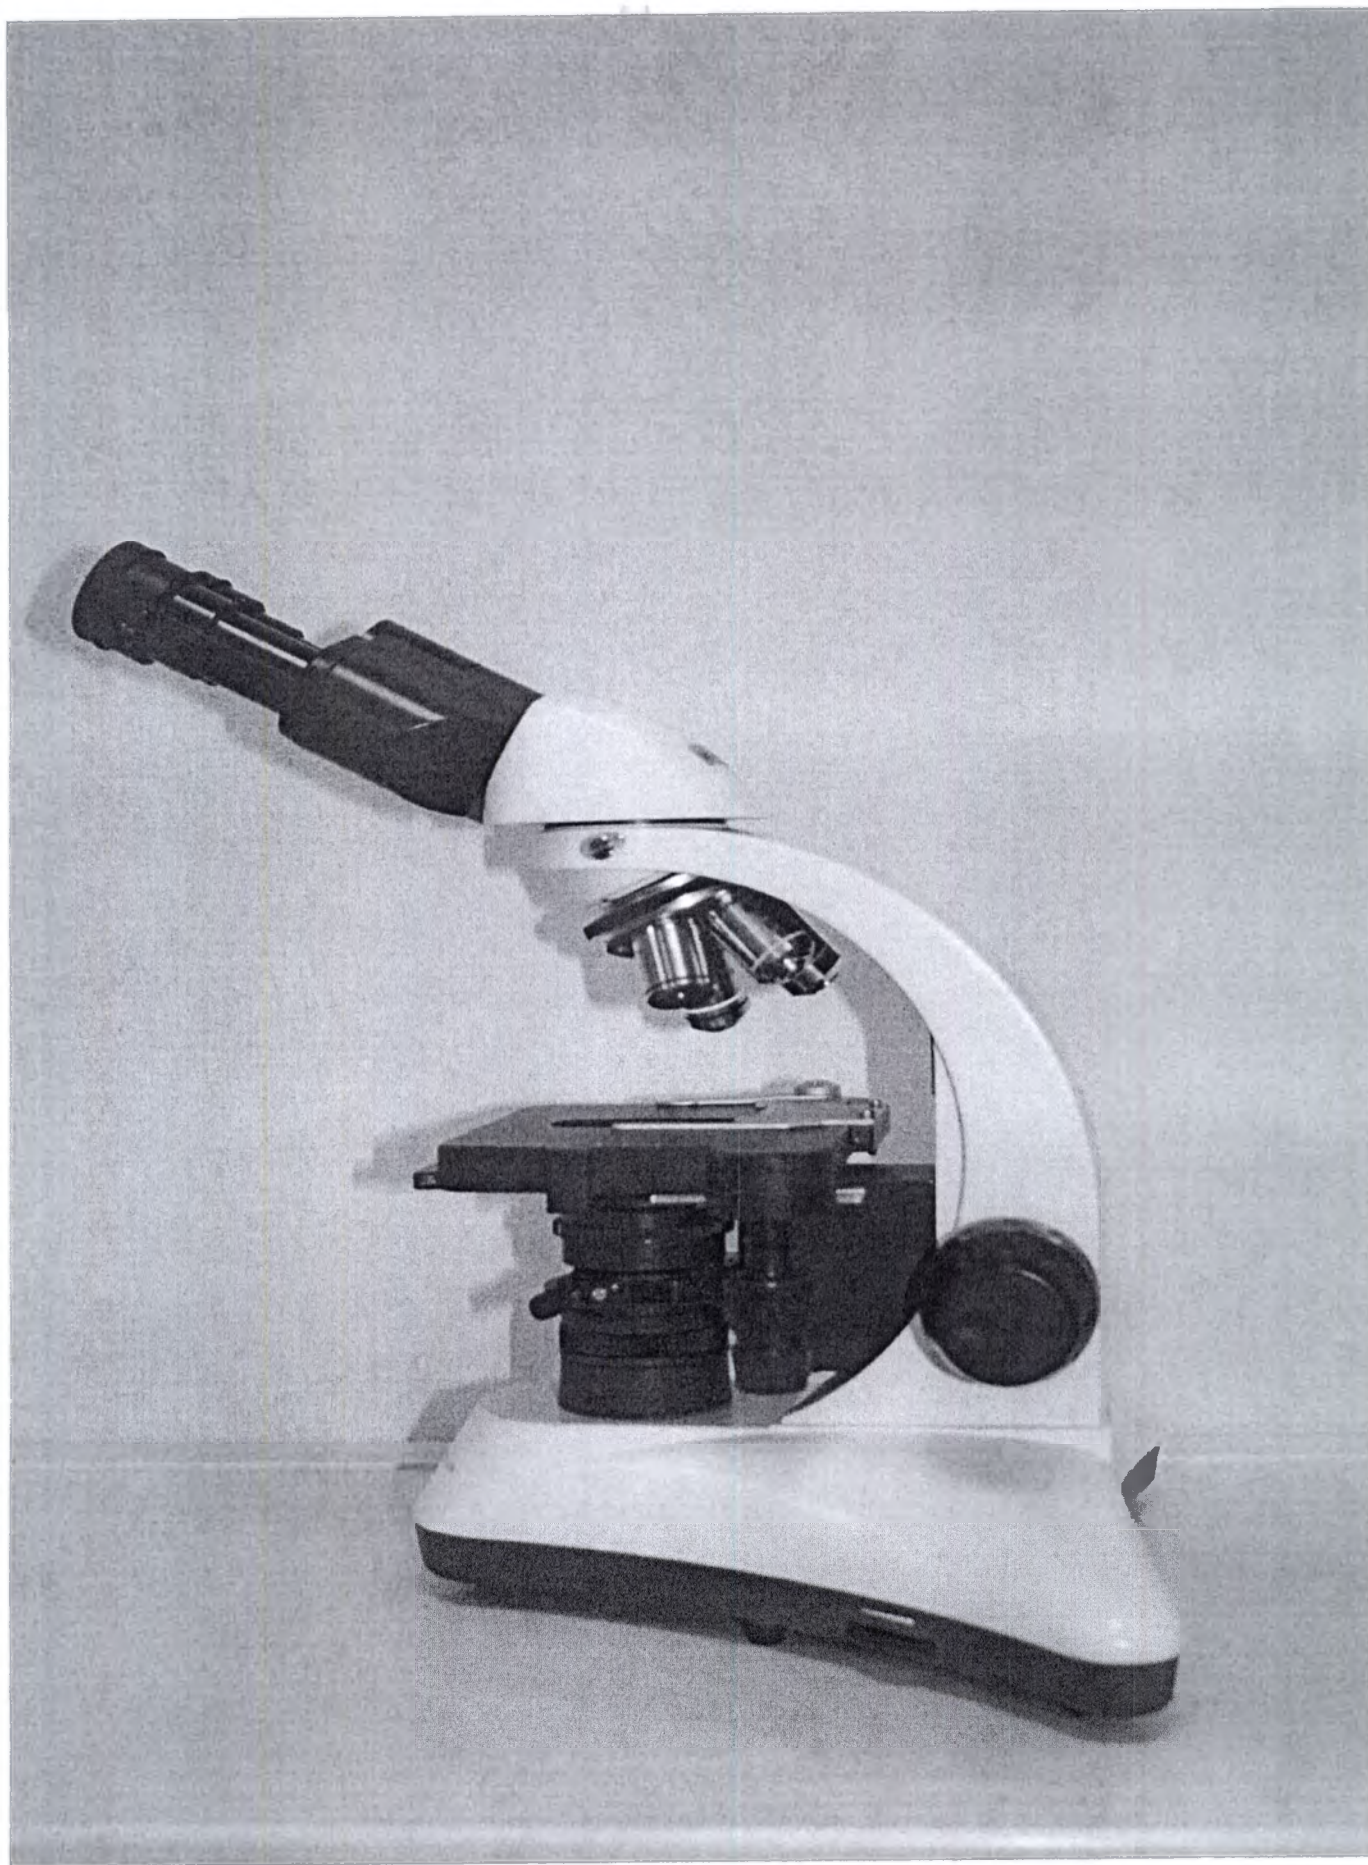


Микроскоп биологический исполнение М40

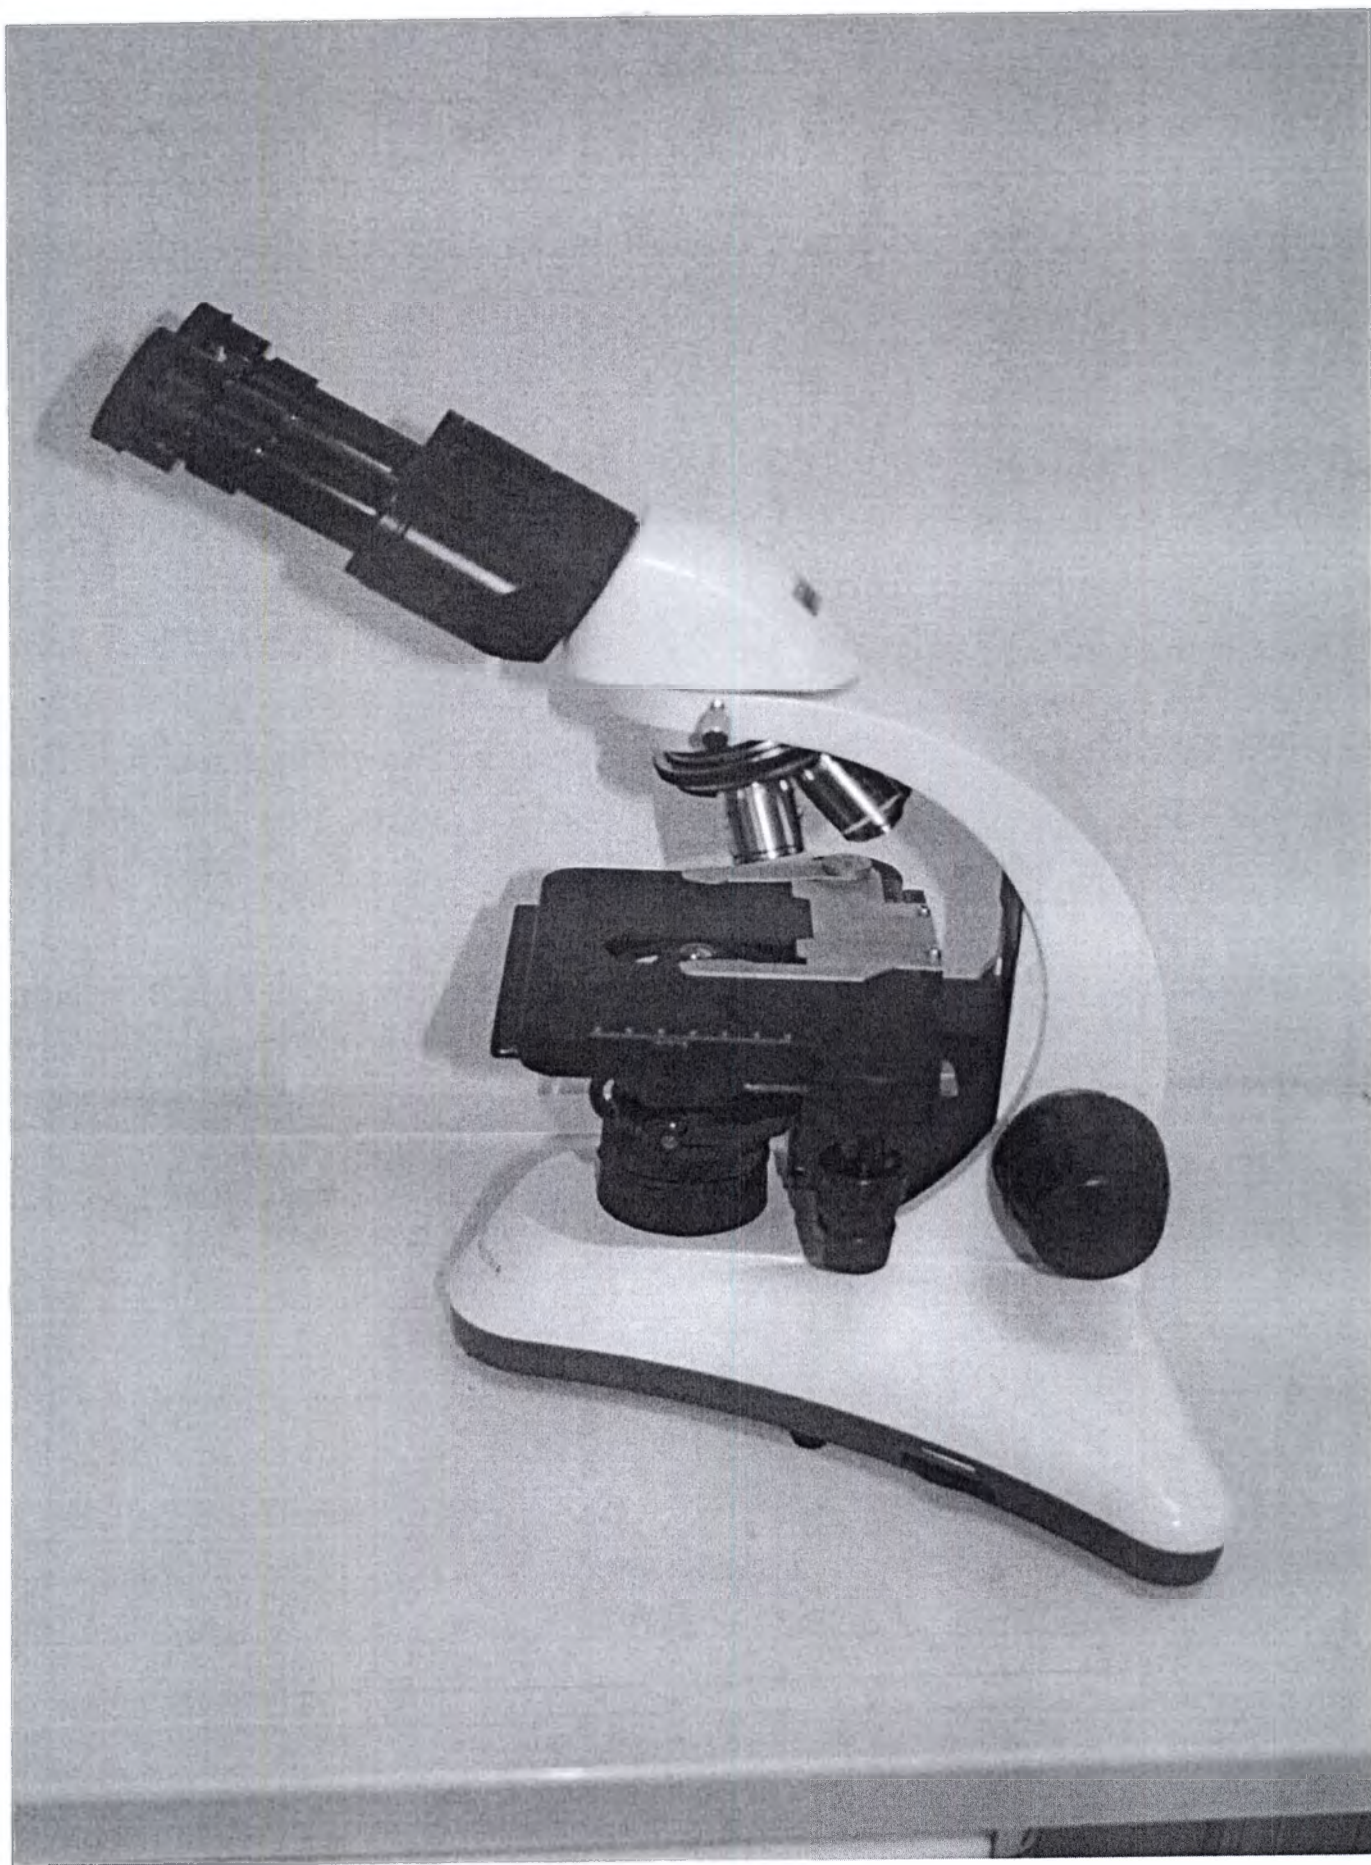

Микроскоп биологический исполнение M40 LED

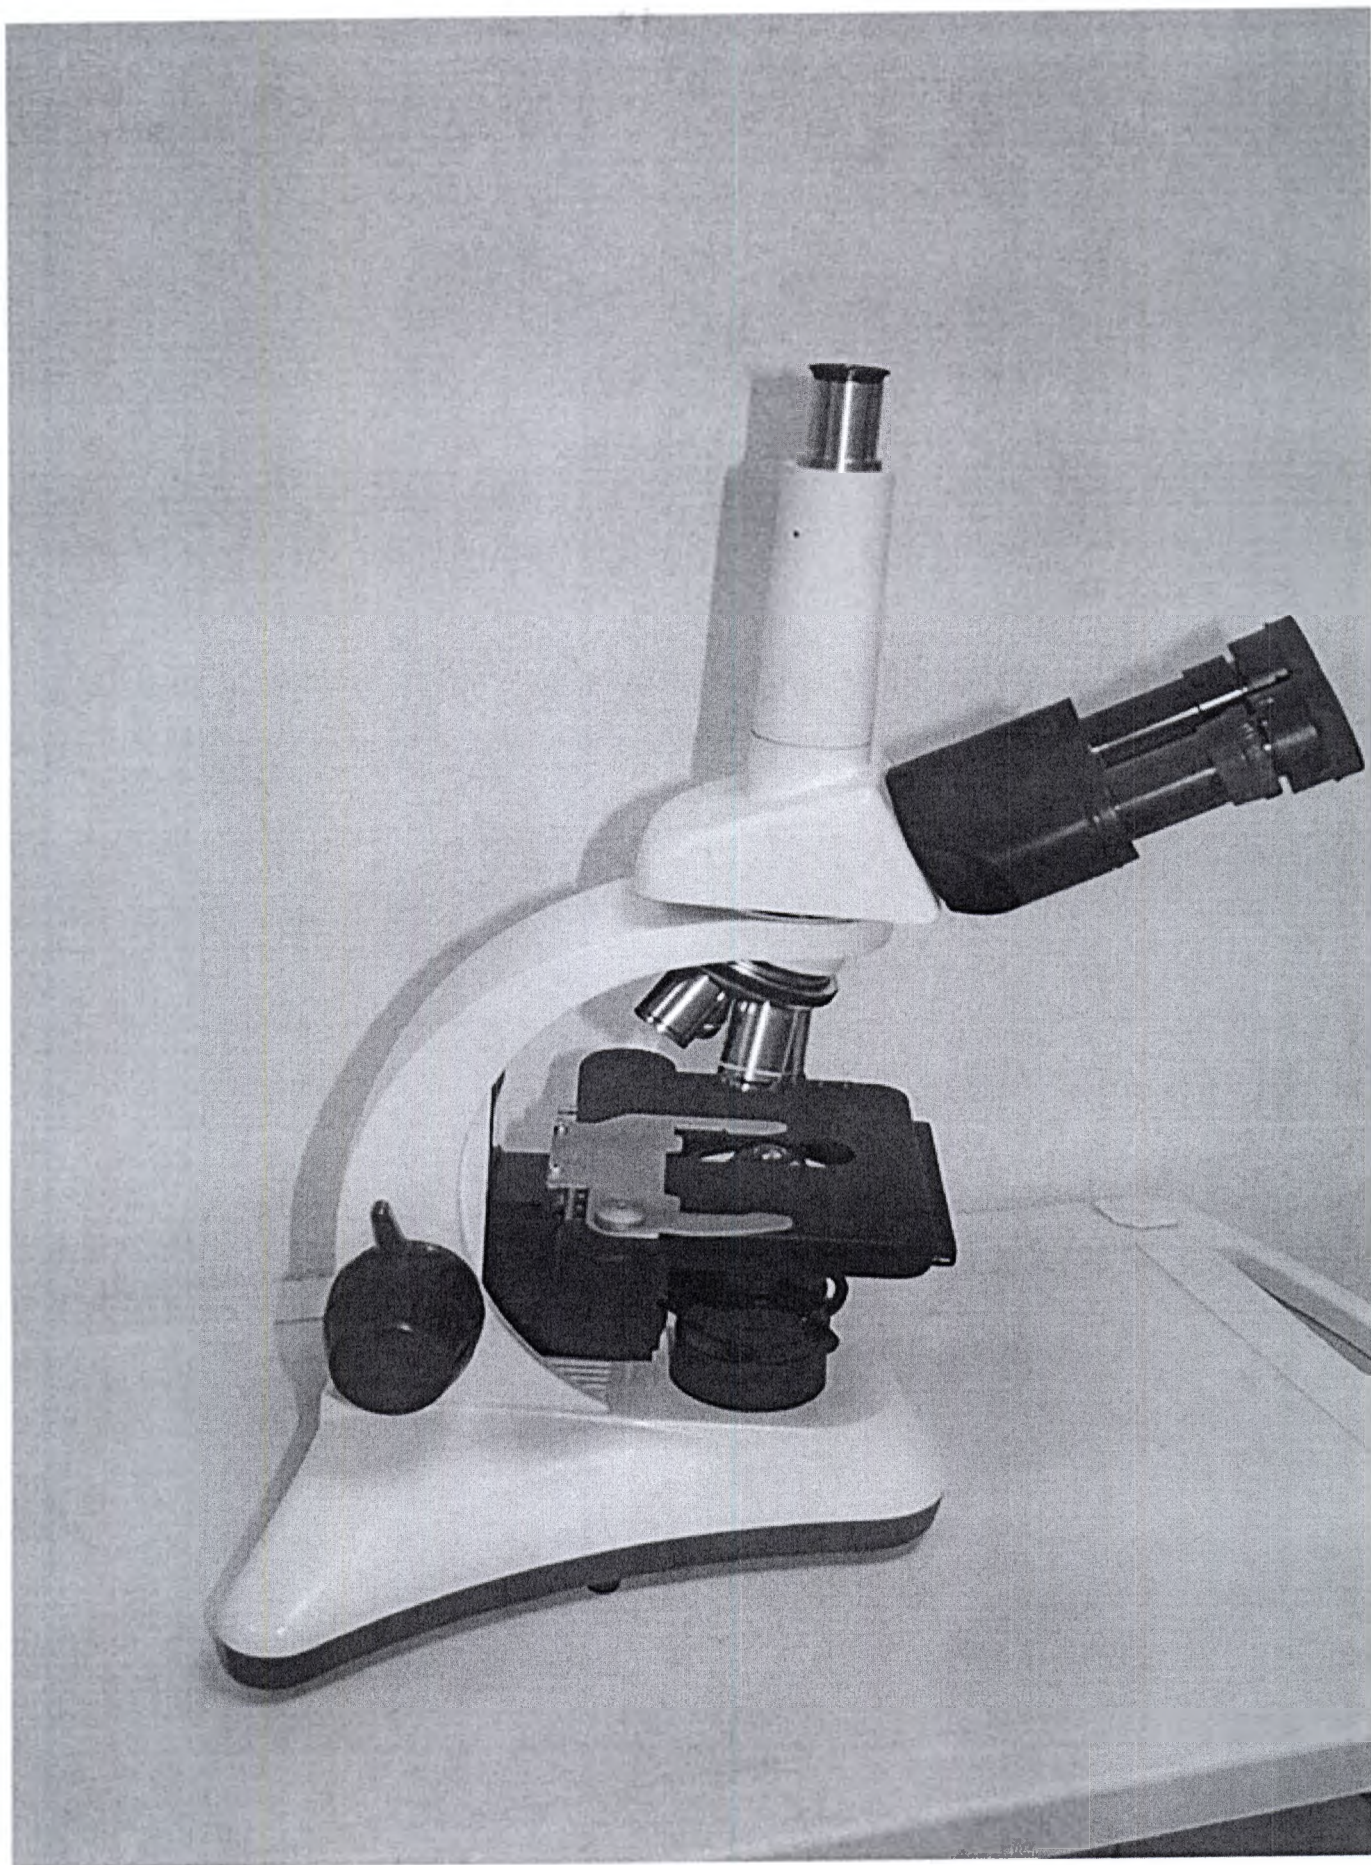

Микроскоп биологический исполнение М40-1

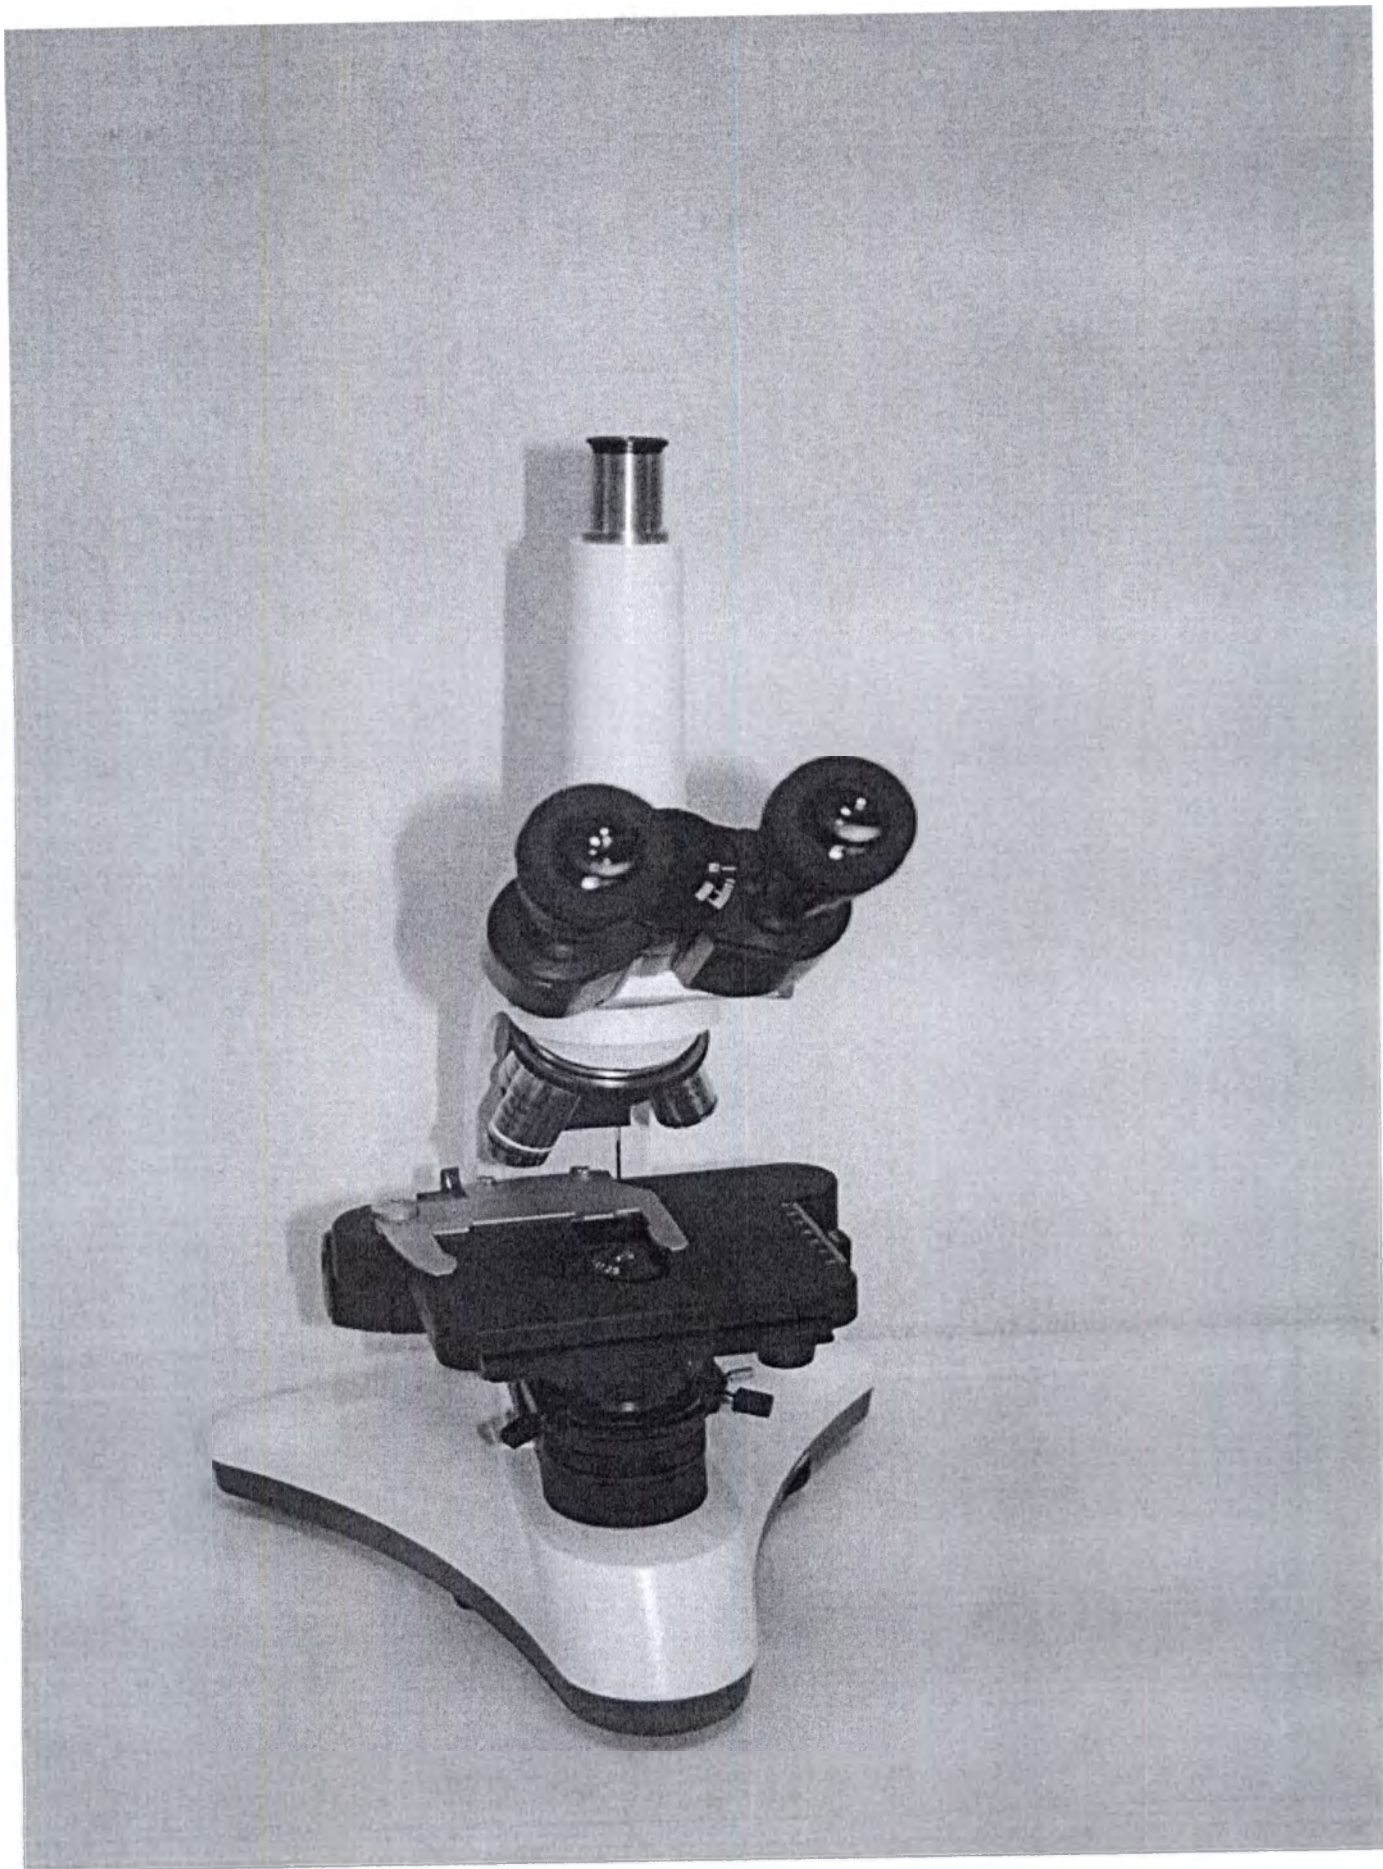

Микроскоп биологический исполнение М40-1 LED

ООО «МО «Отдел медицинской техники»
Микроскоп биологический с принадлежностями
по

ТУ 26.70.22-001-55796184-2016

Микроскоп биологический М40-1


Питание: ~ 220В, 50 Гц

Год выпуска: 2016


Потребляемая мощность: 50 ВА

Серийный номер 3 - 2 0 0 4 2 1


Сделано в России




Маркировка

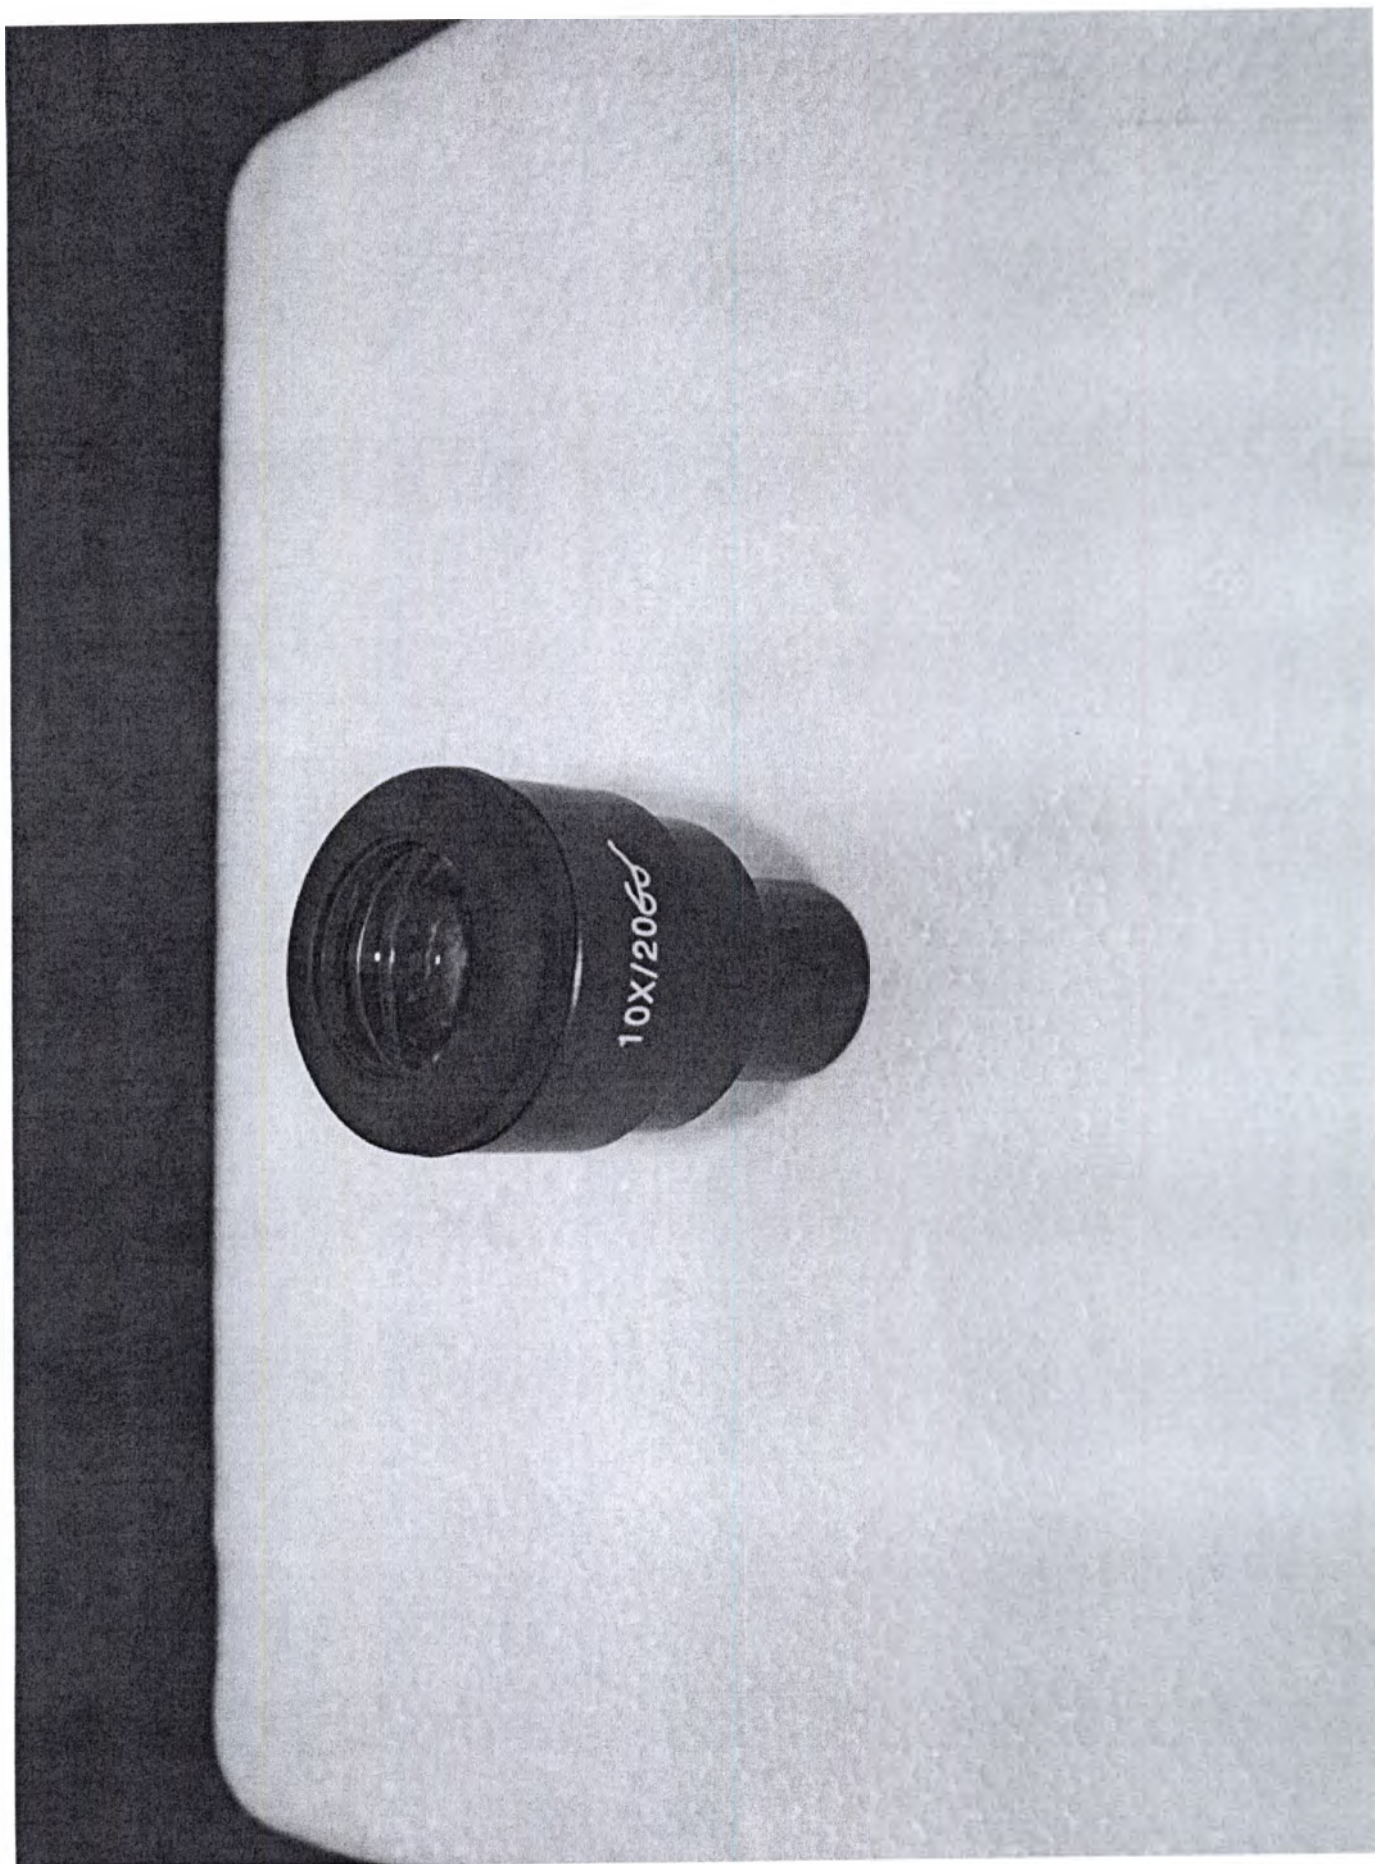


Окуляр 10х/20

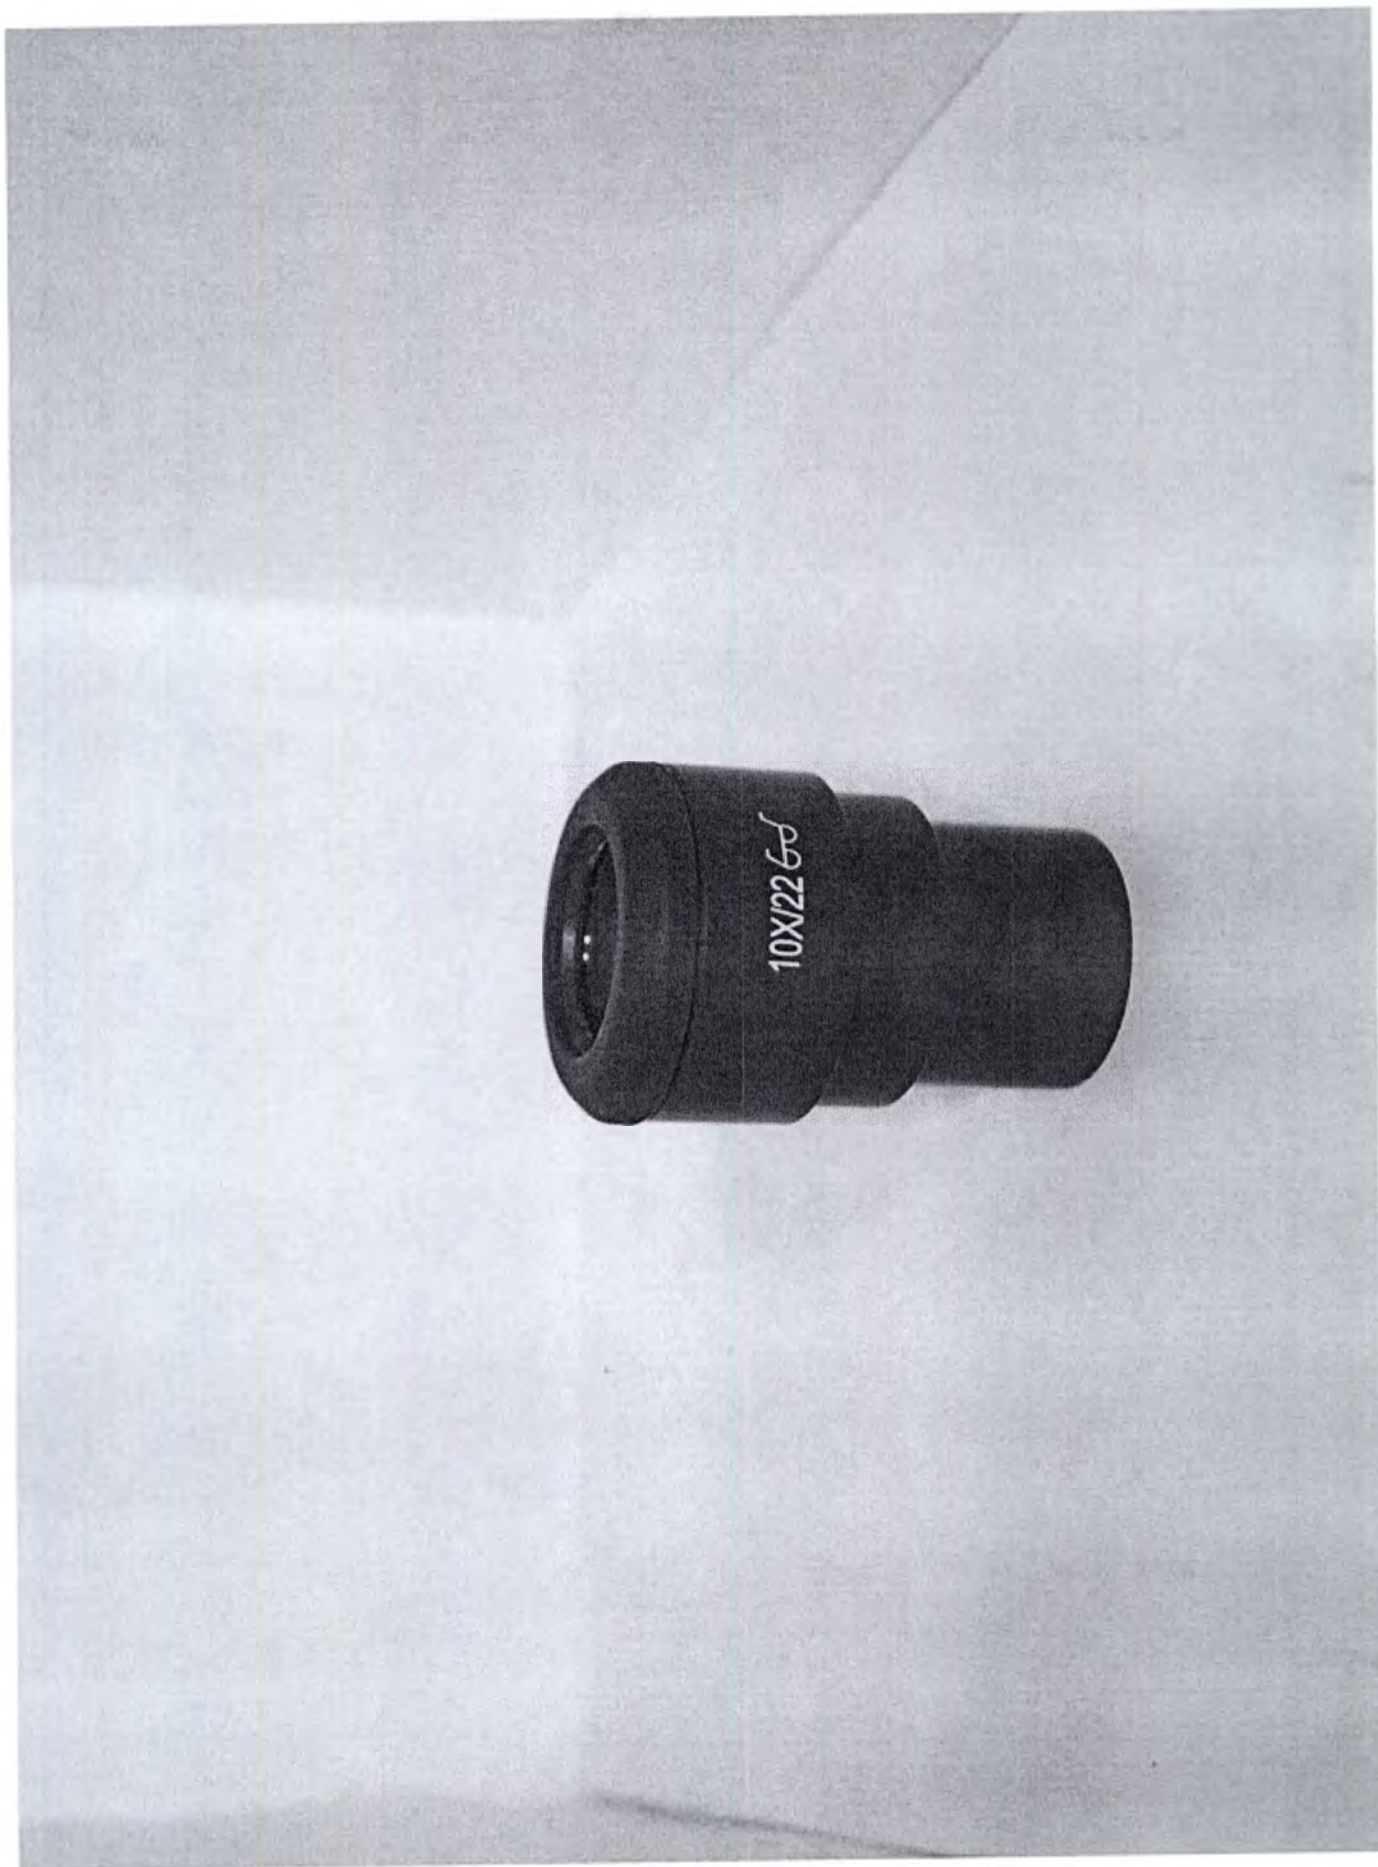


Окуляр 10х/22

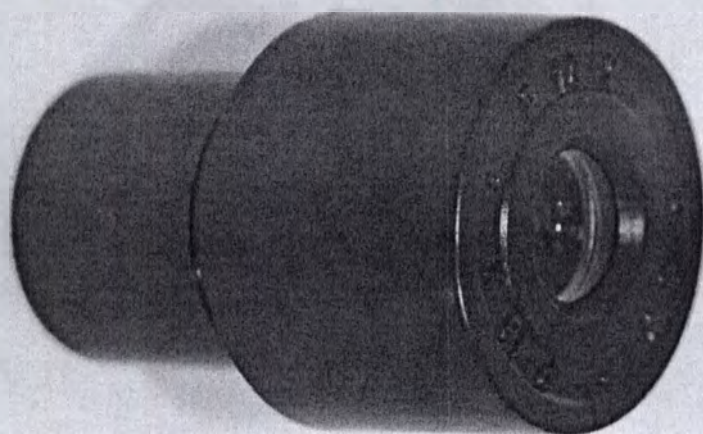


Окуляр 16х/12

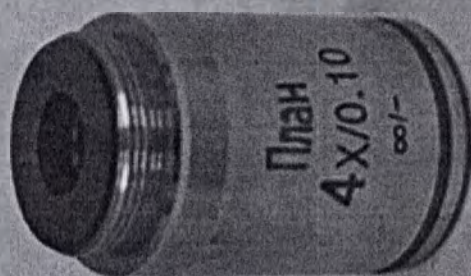


Объектив планхроматический 4х

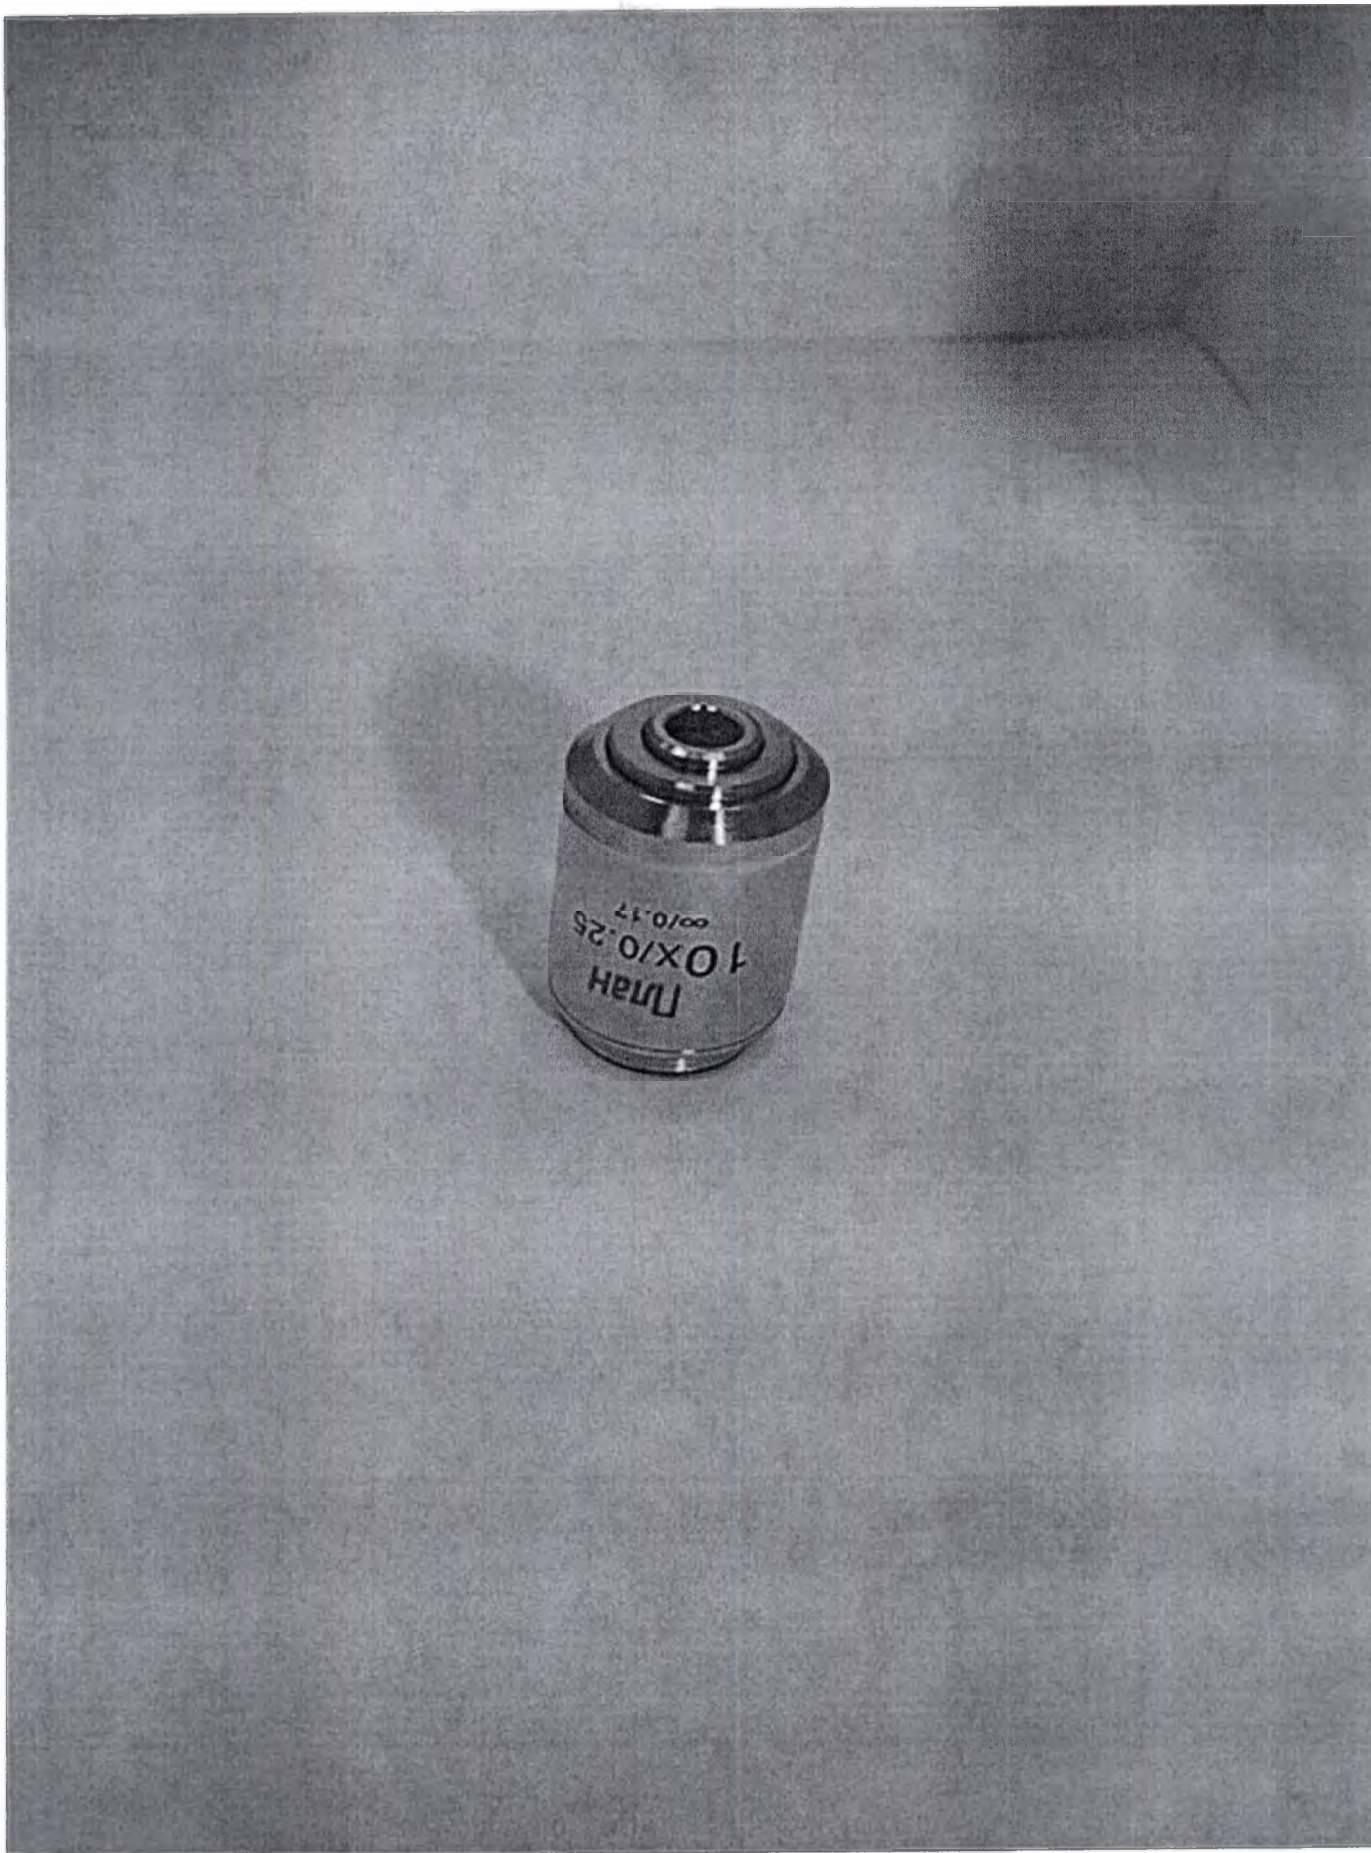


Объектив планахроматический 10х

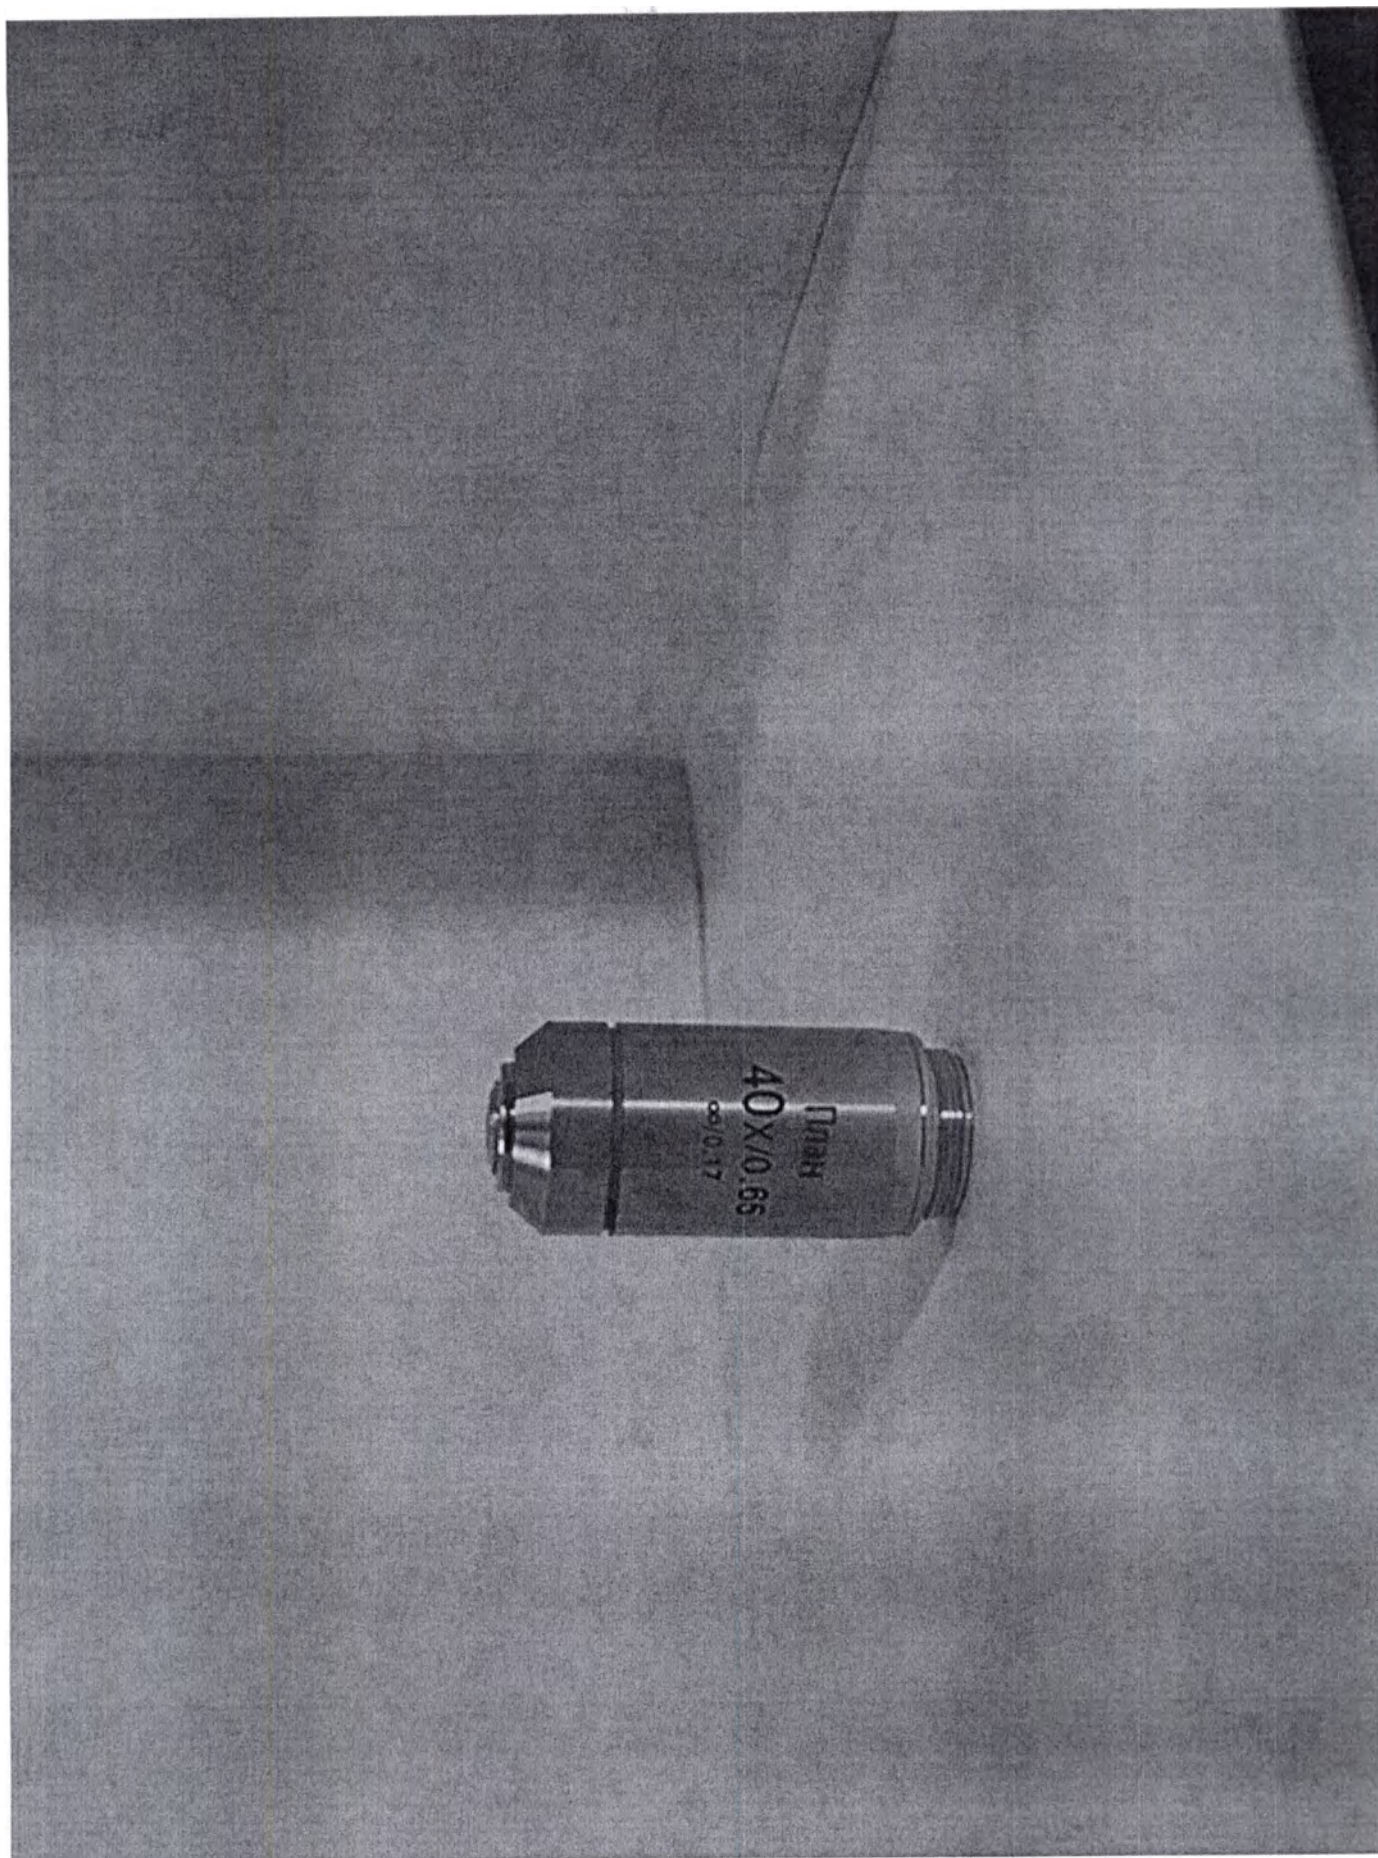


Объектив планахроматический 40х

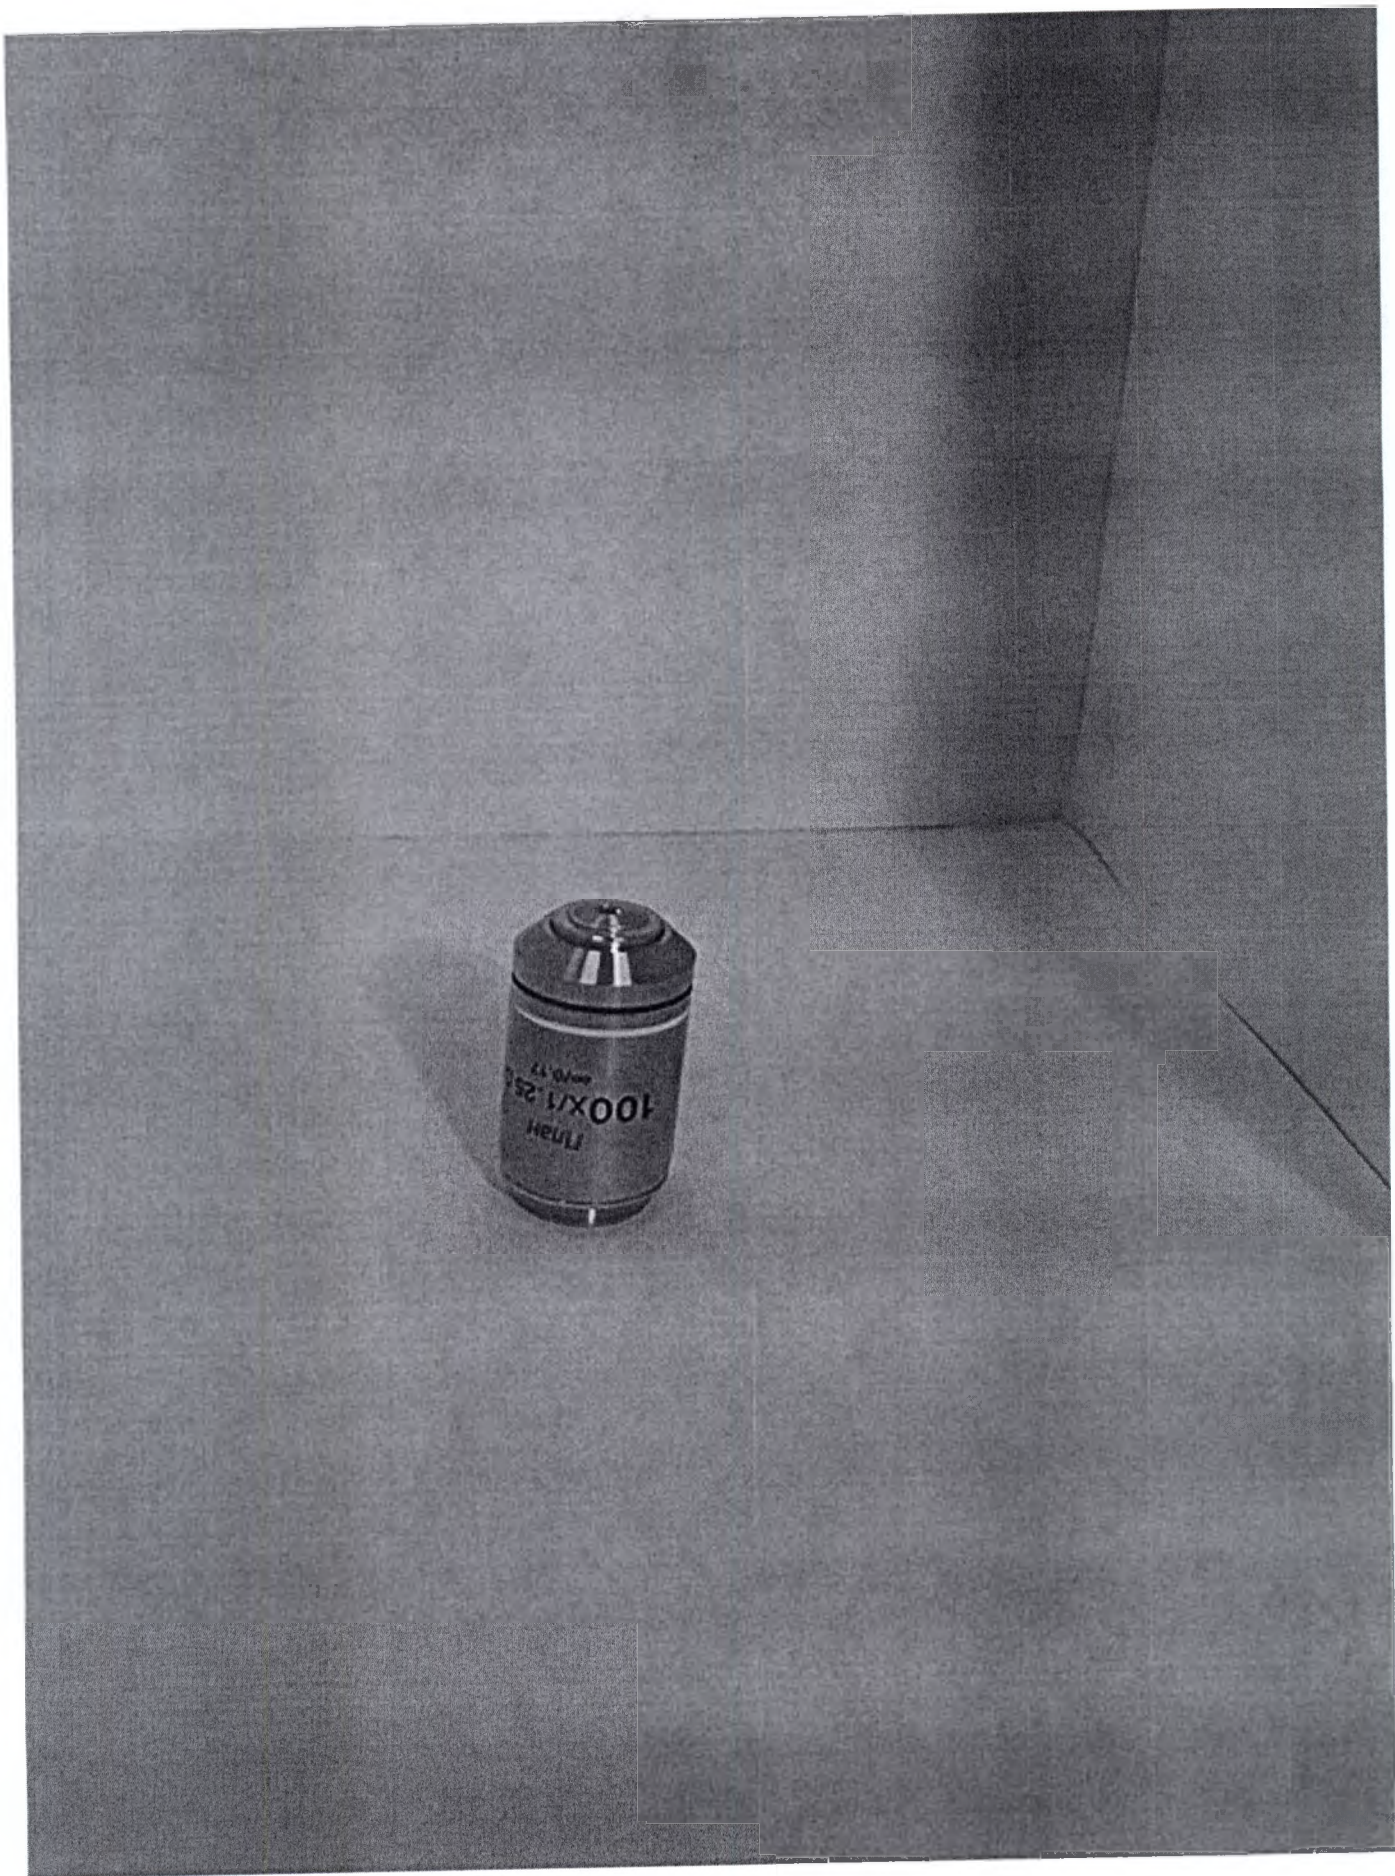


Объектив планхроматический 100x

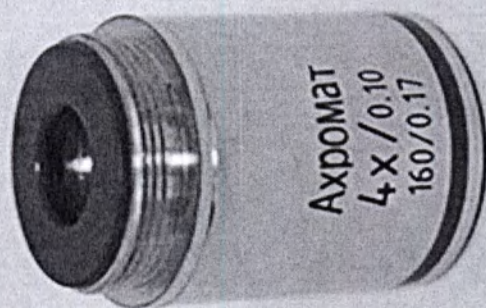


Объектив ахроматический 4х

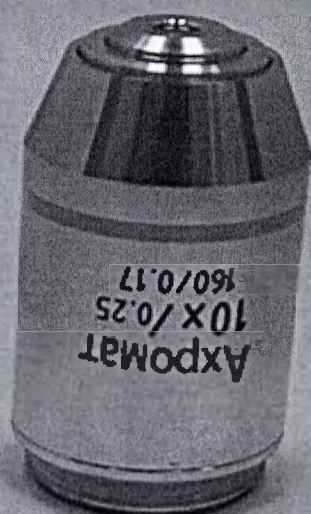


Объектив ахроматический 10х

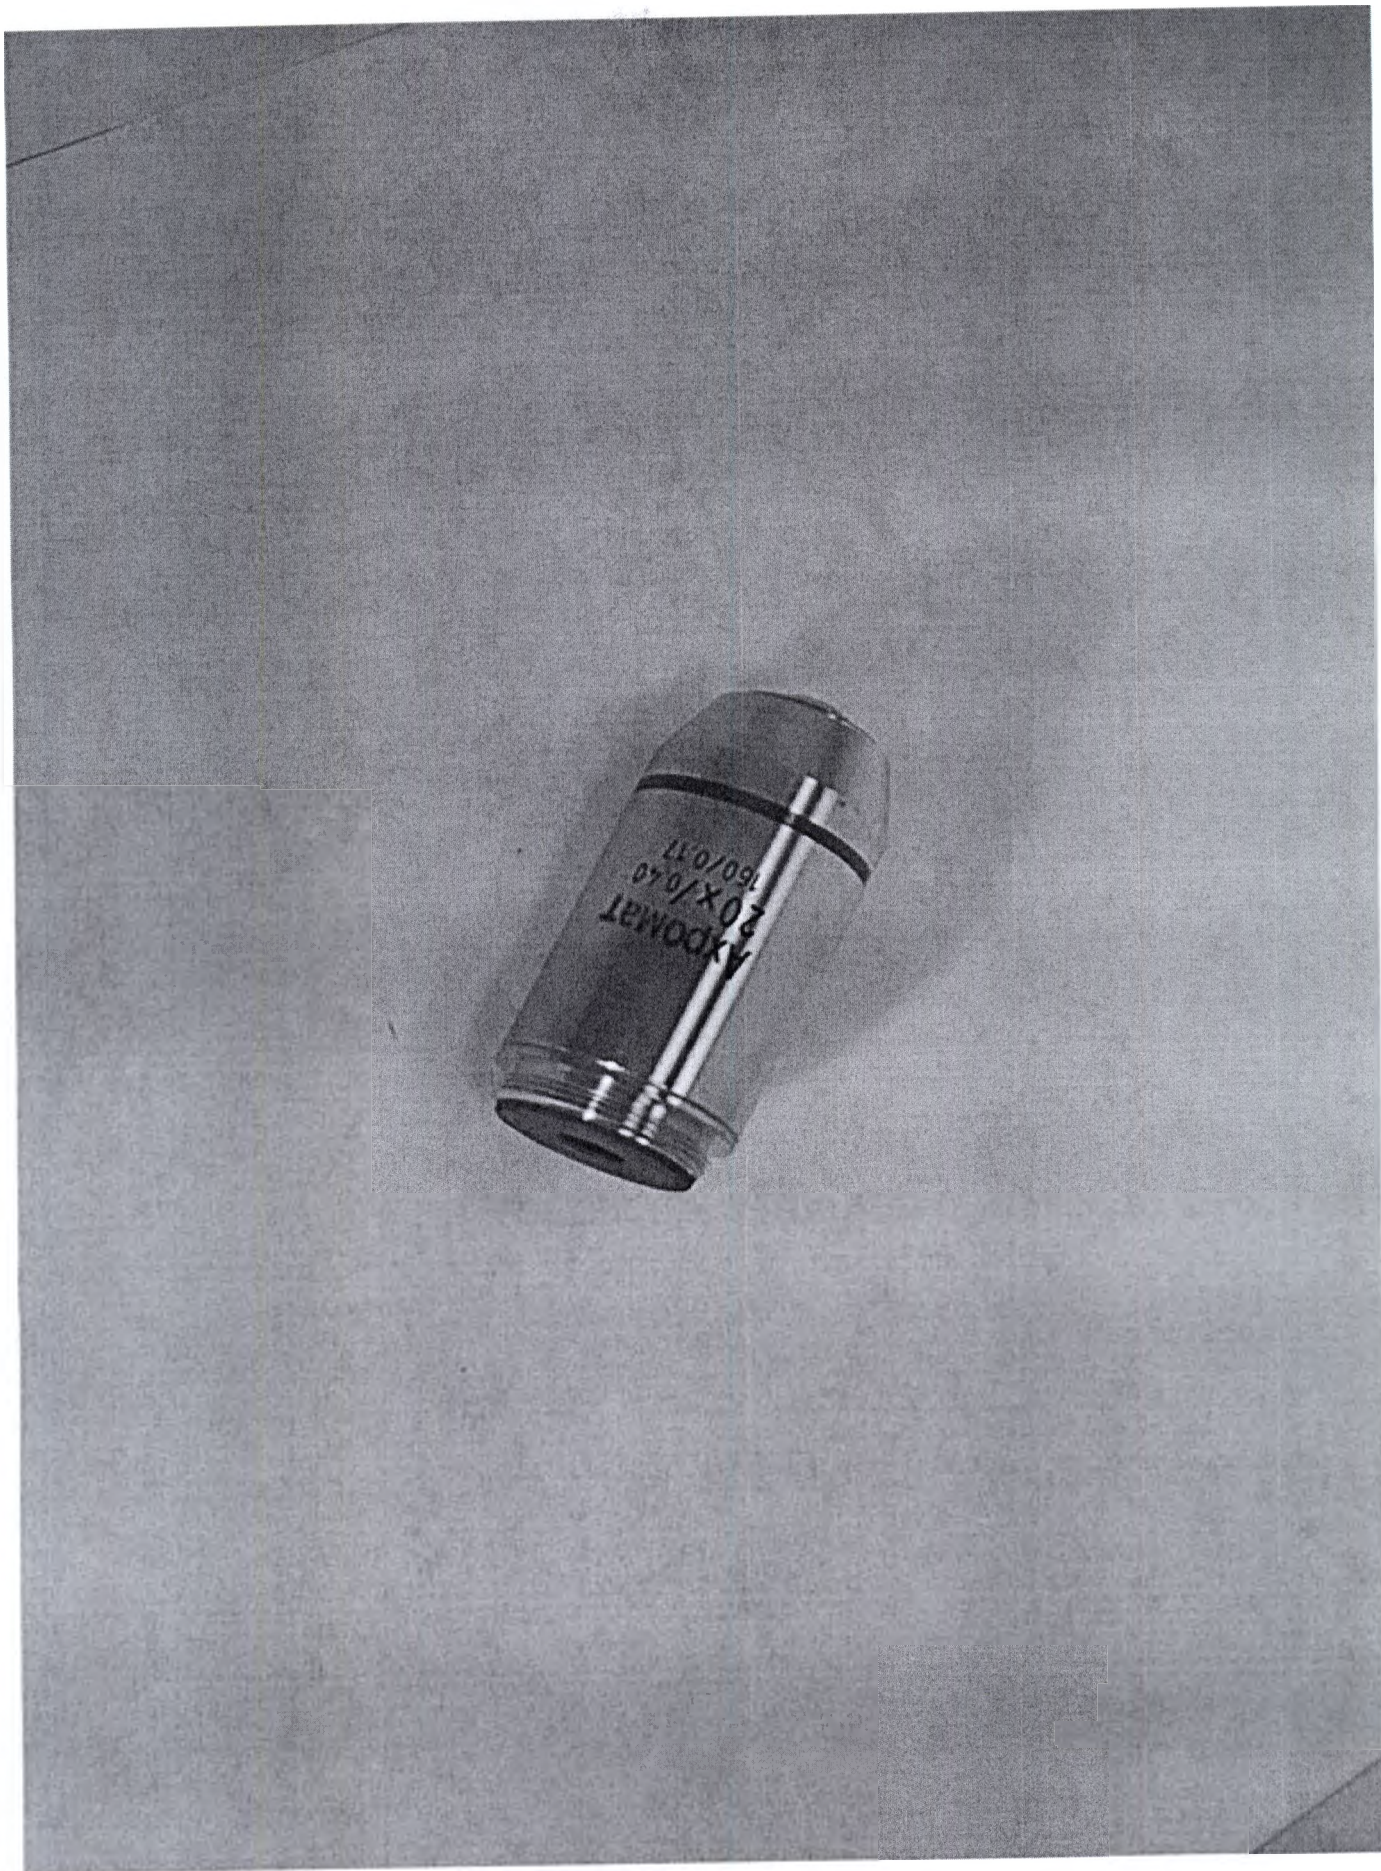


Объектив ахроматический 20х

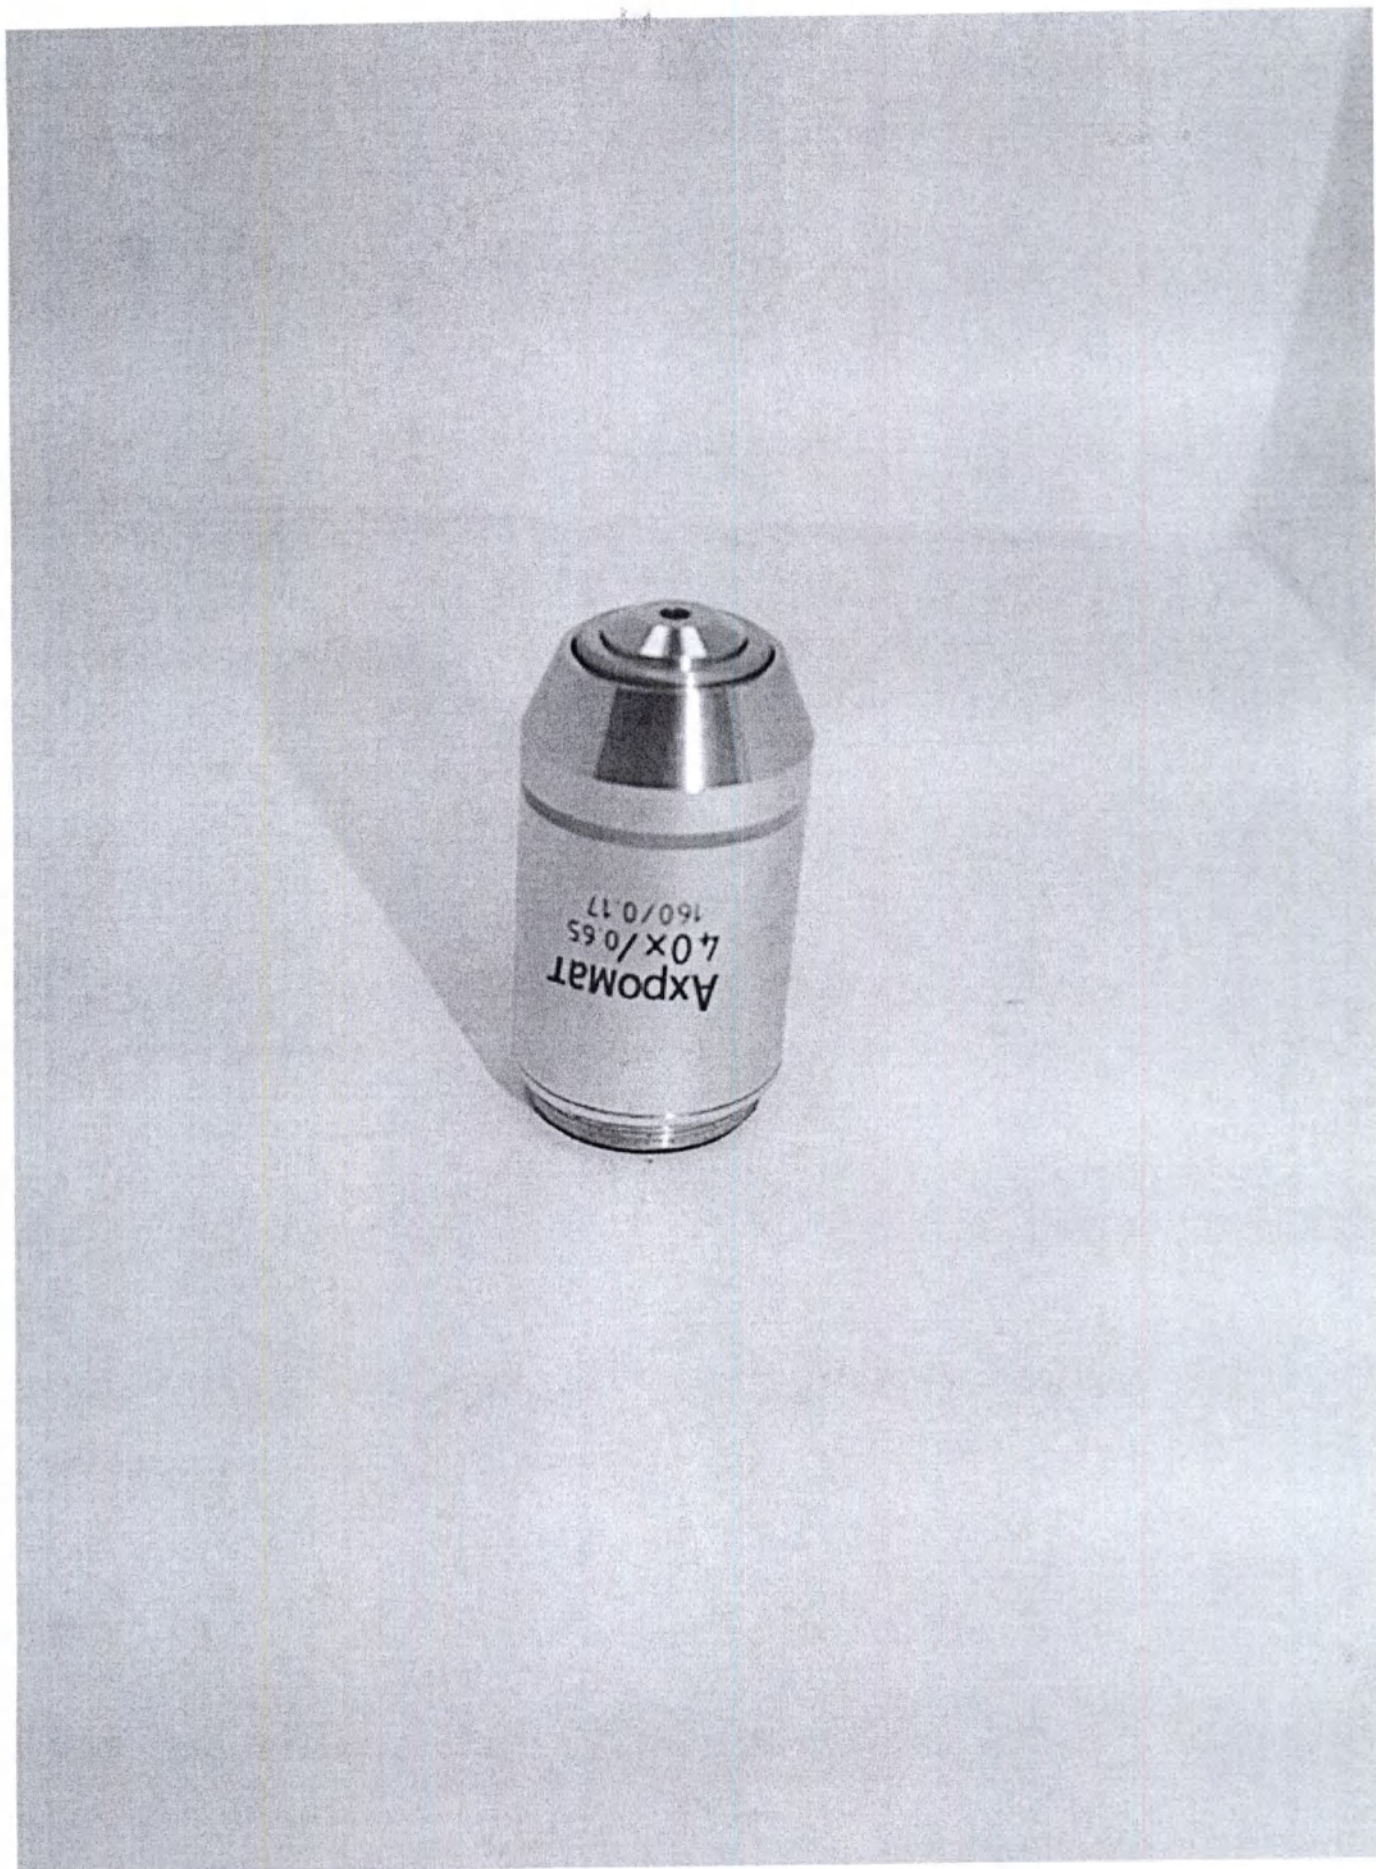

Объектив ахроматический 40х

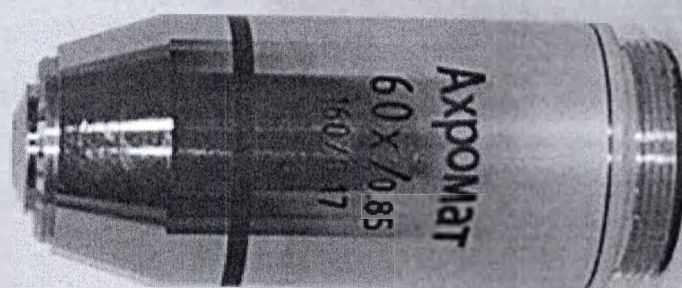


Объектив ахроматический 60х

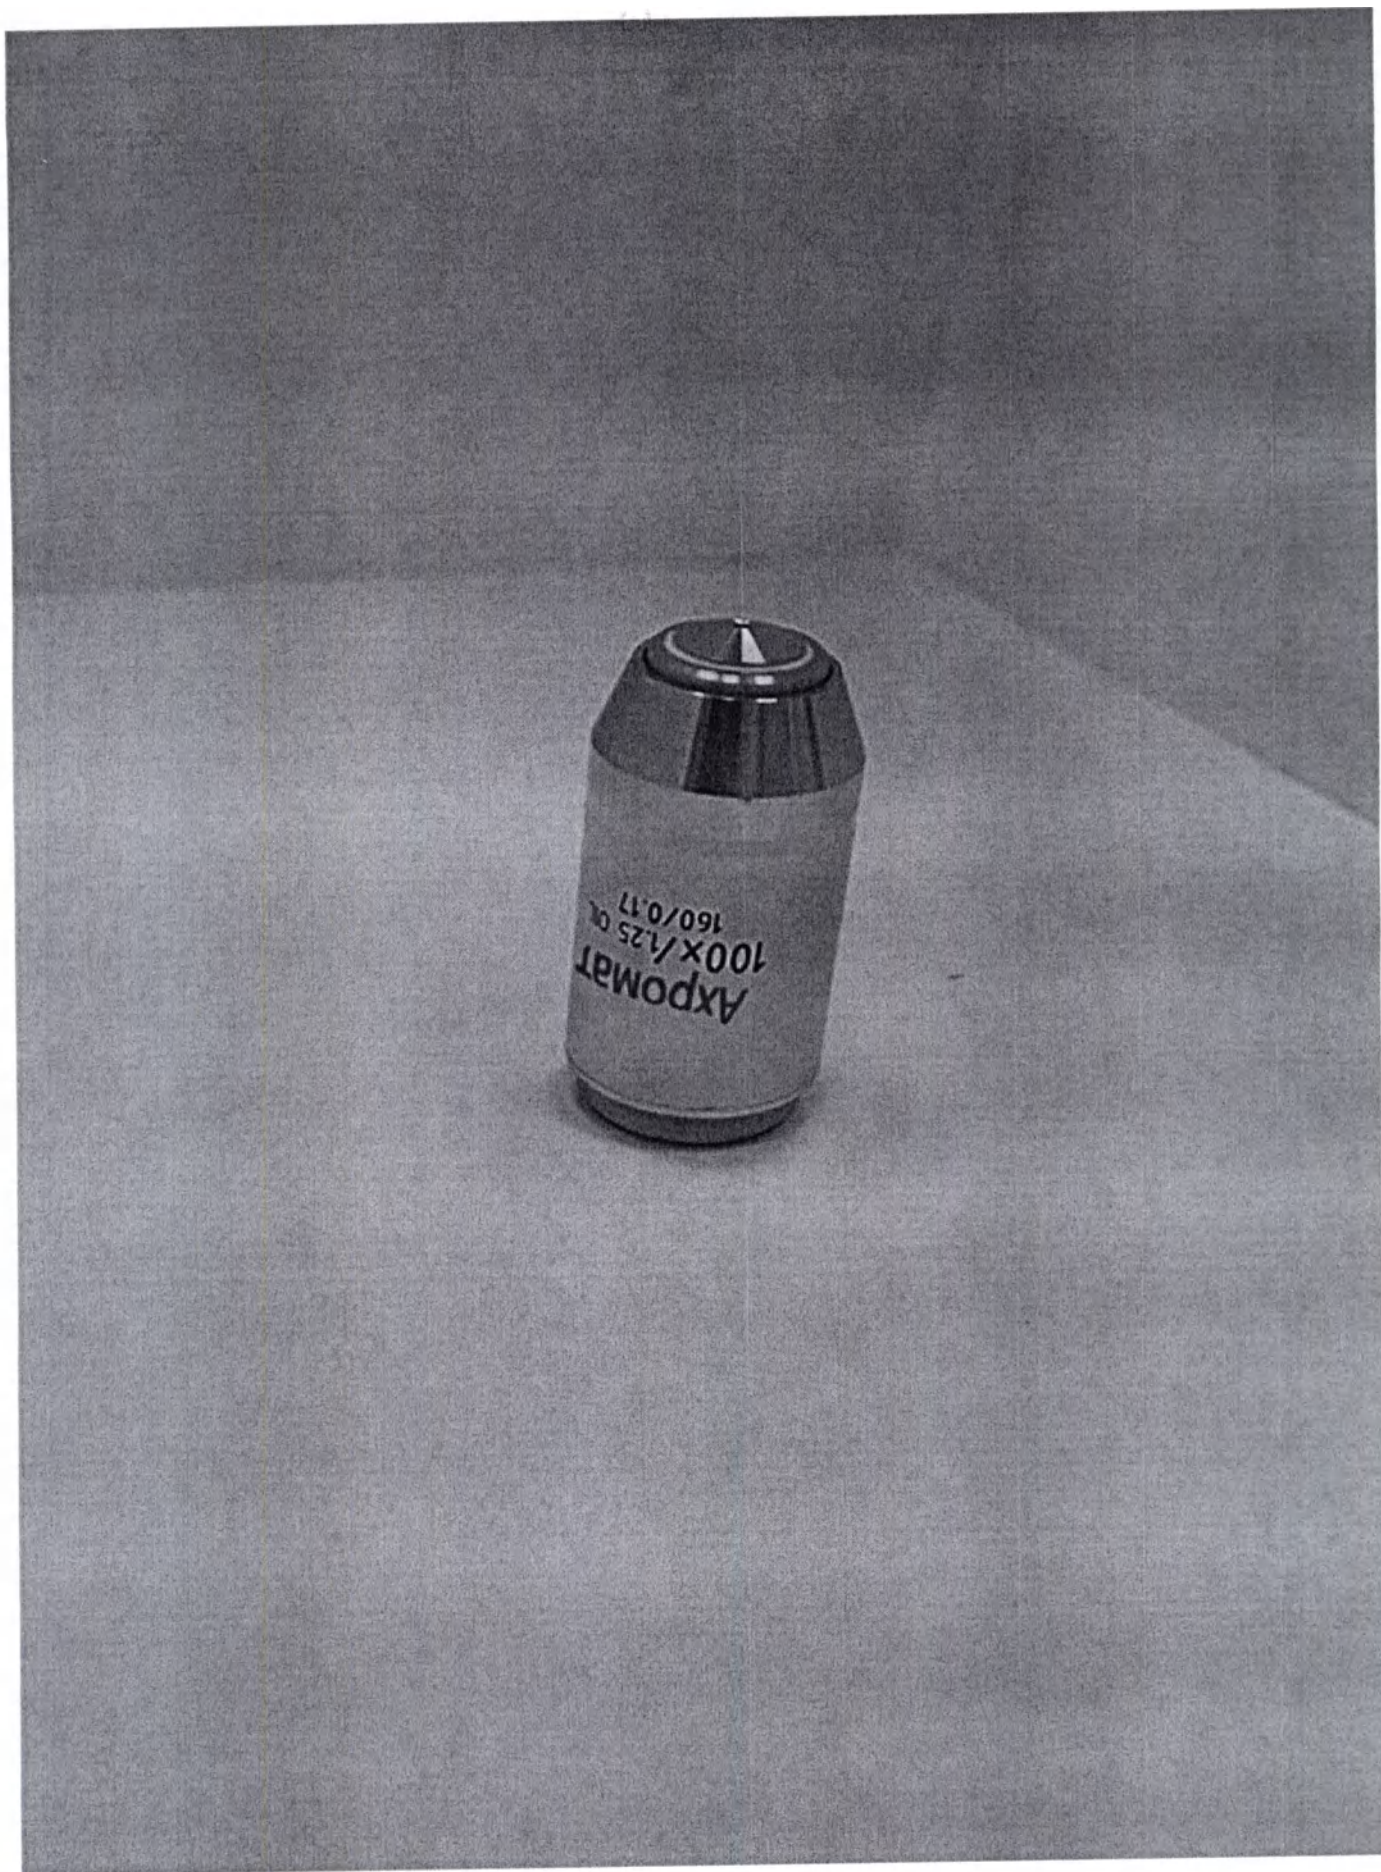

Объектив ахроматический 100x



Конденсор 1.25

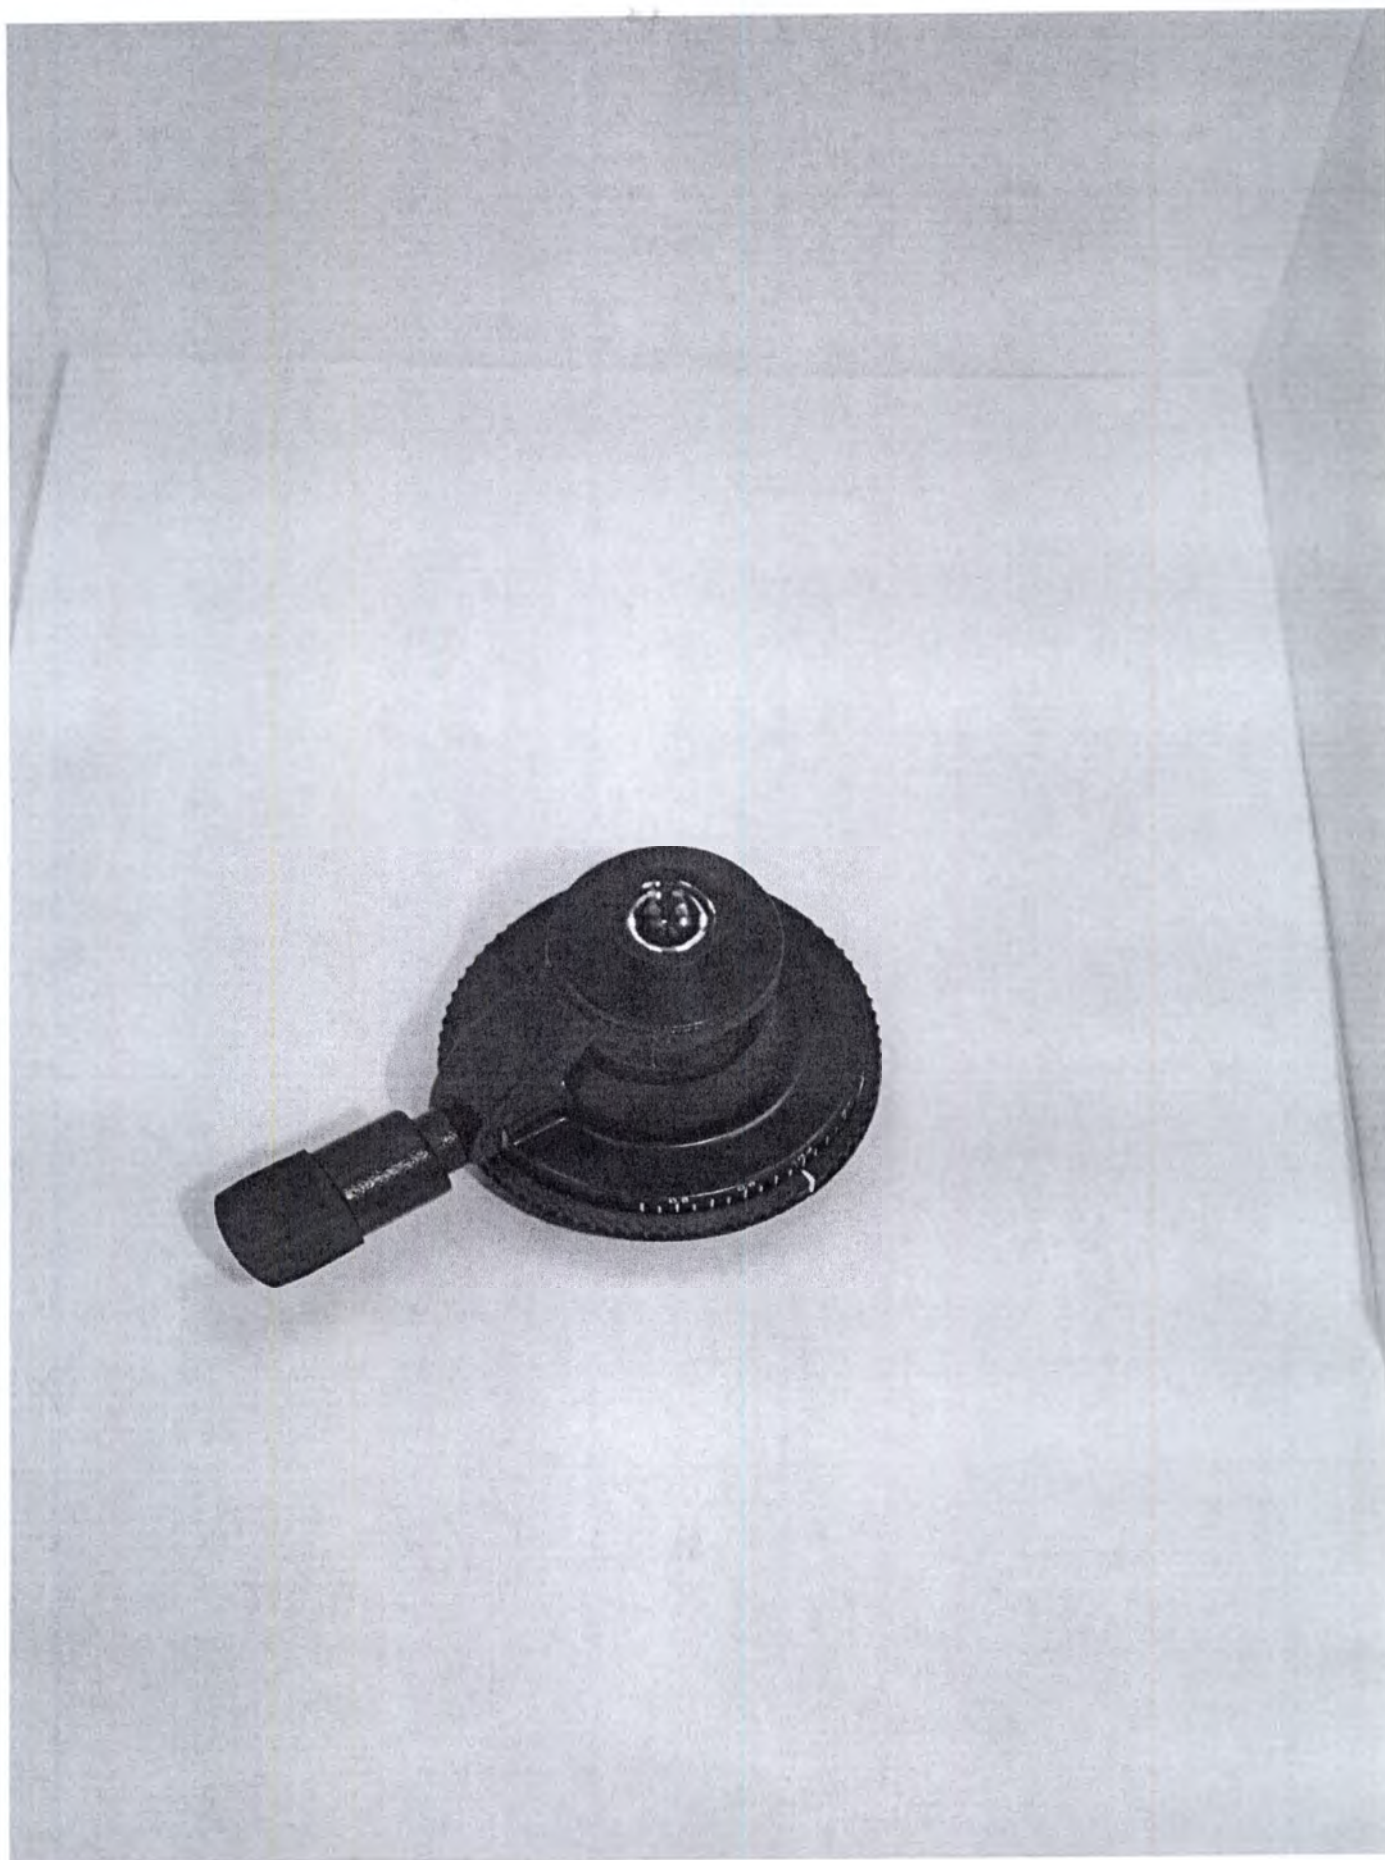


Конденсор 0,9/1,25




Конденсор темного поля 0,9




Конденсор темного поля 1,25-1,36

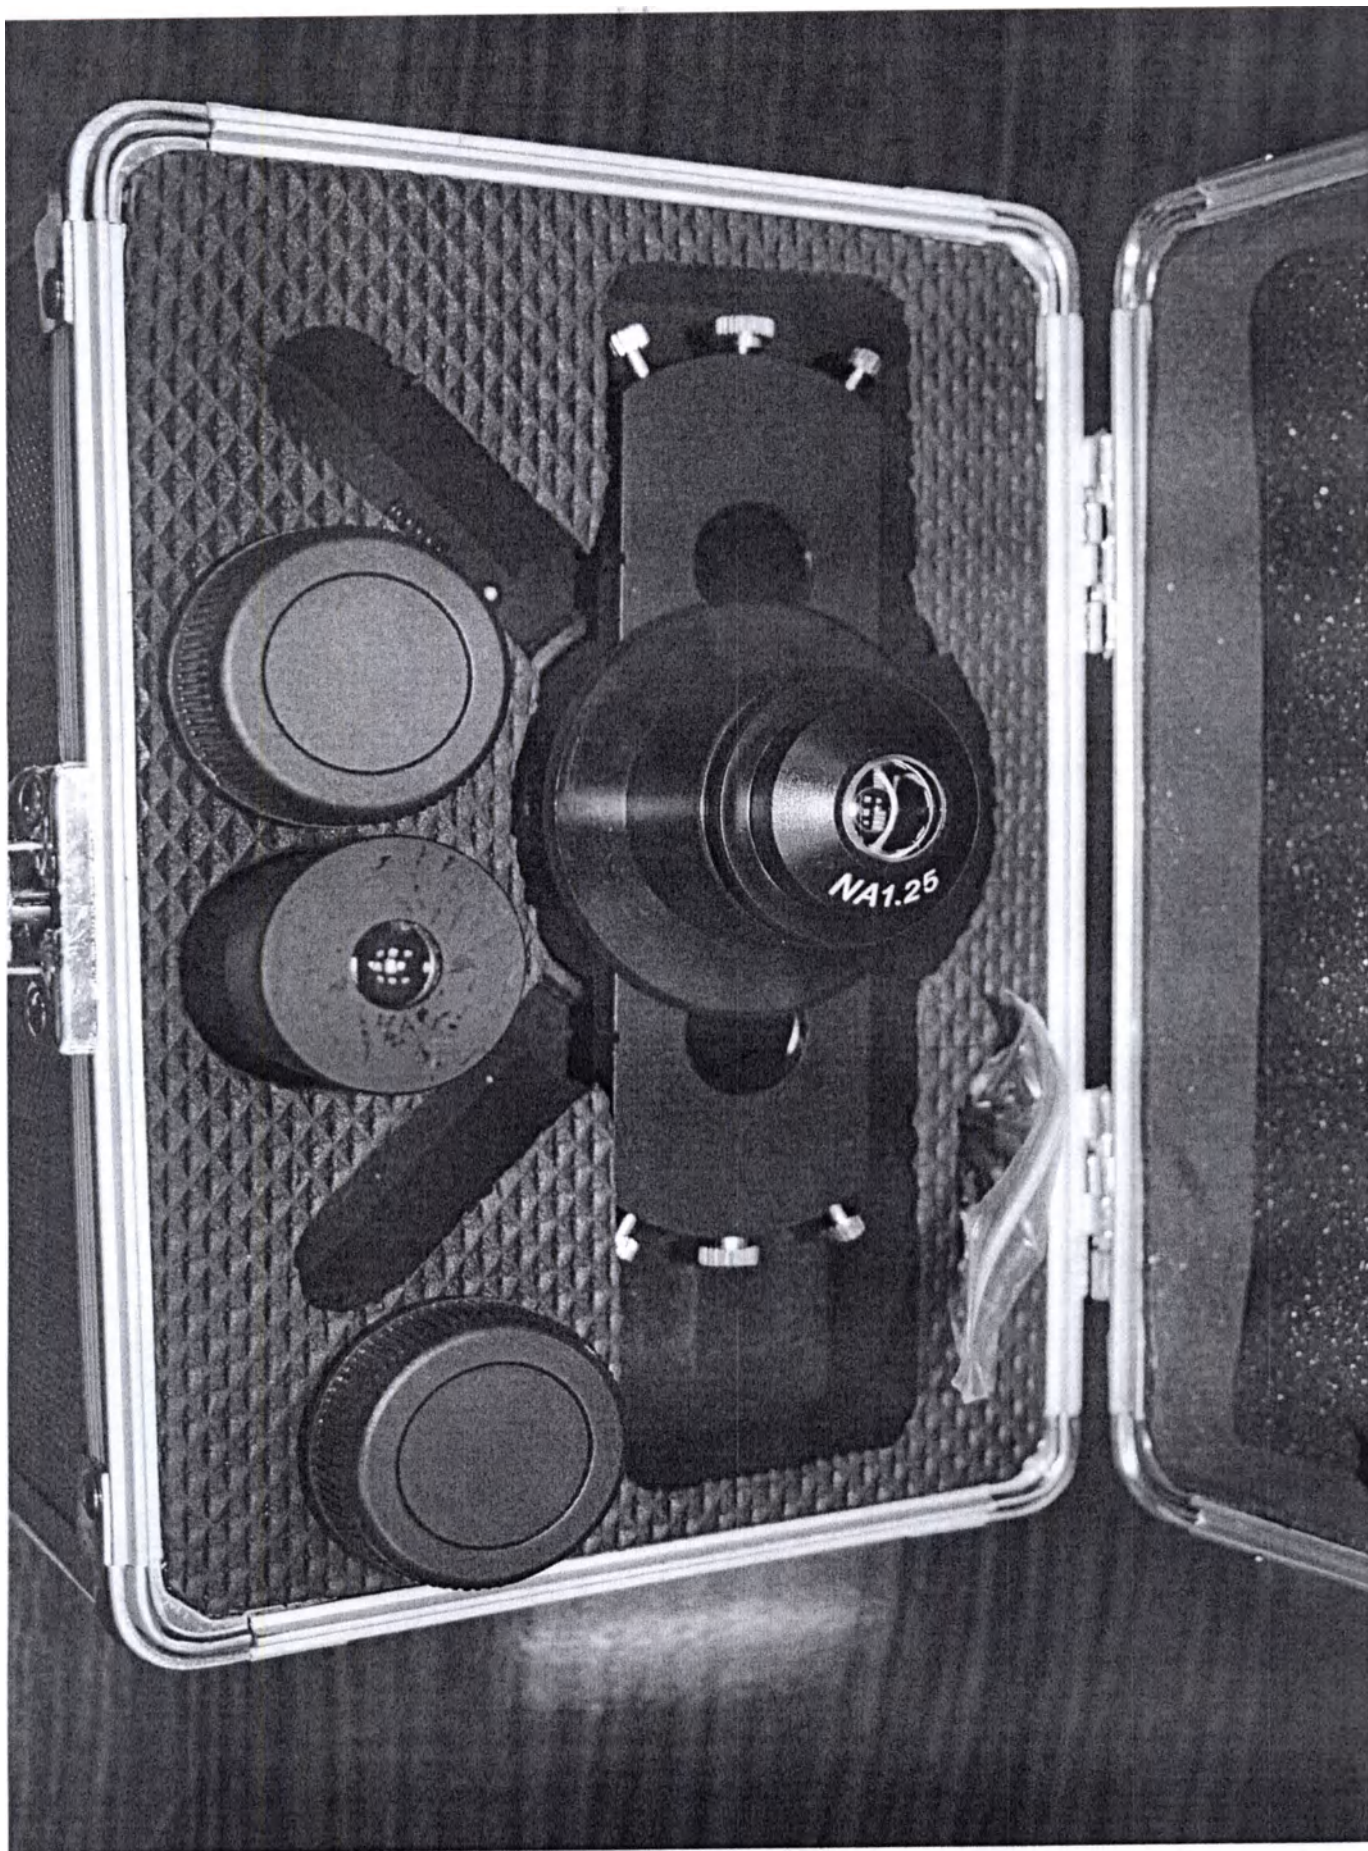


Фазово-контрастный набор

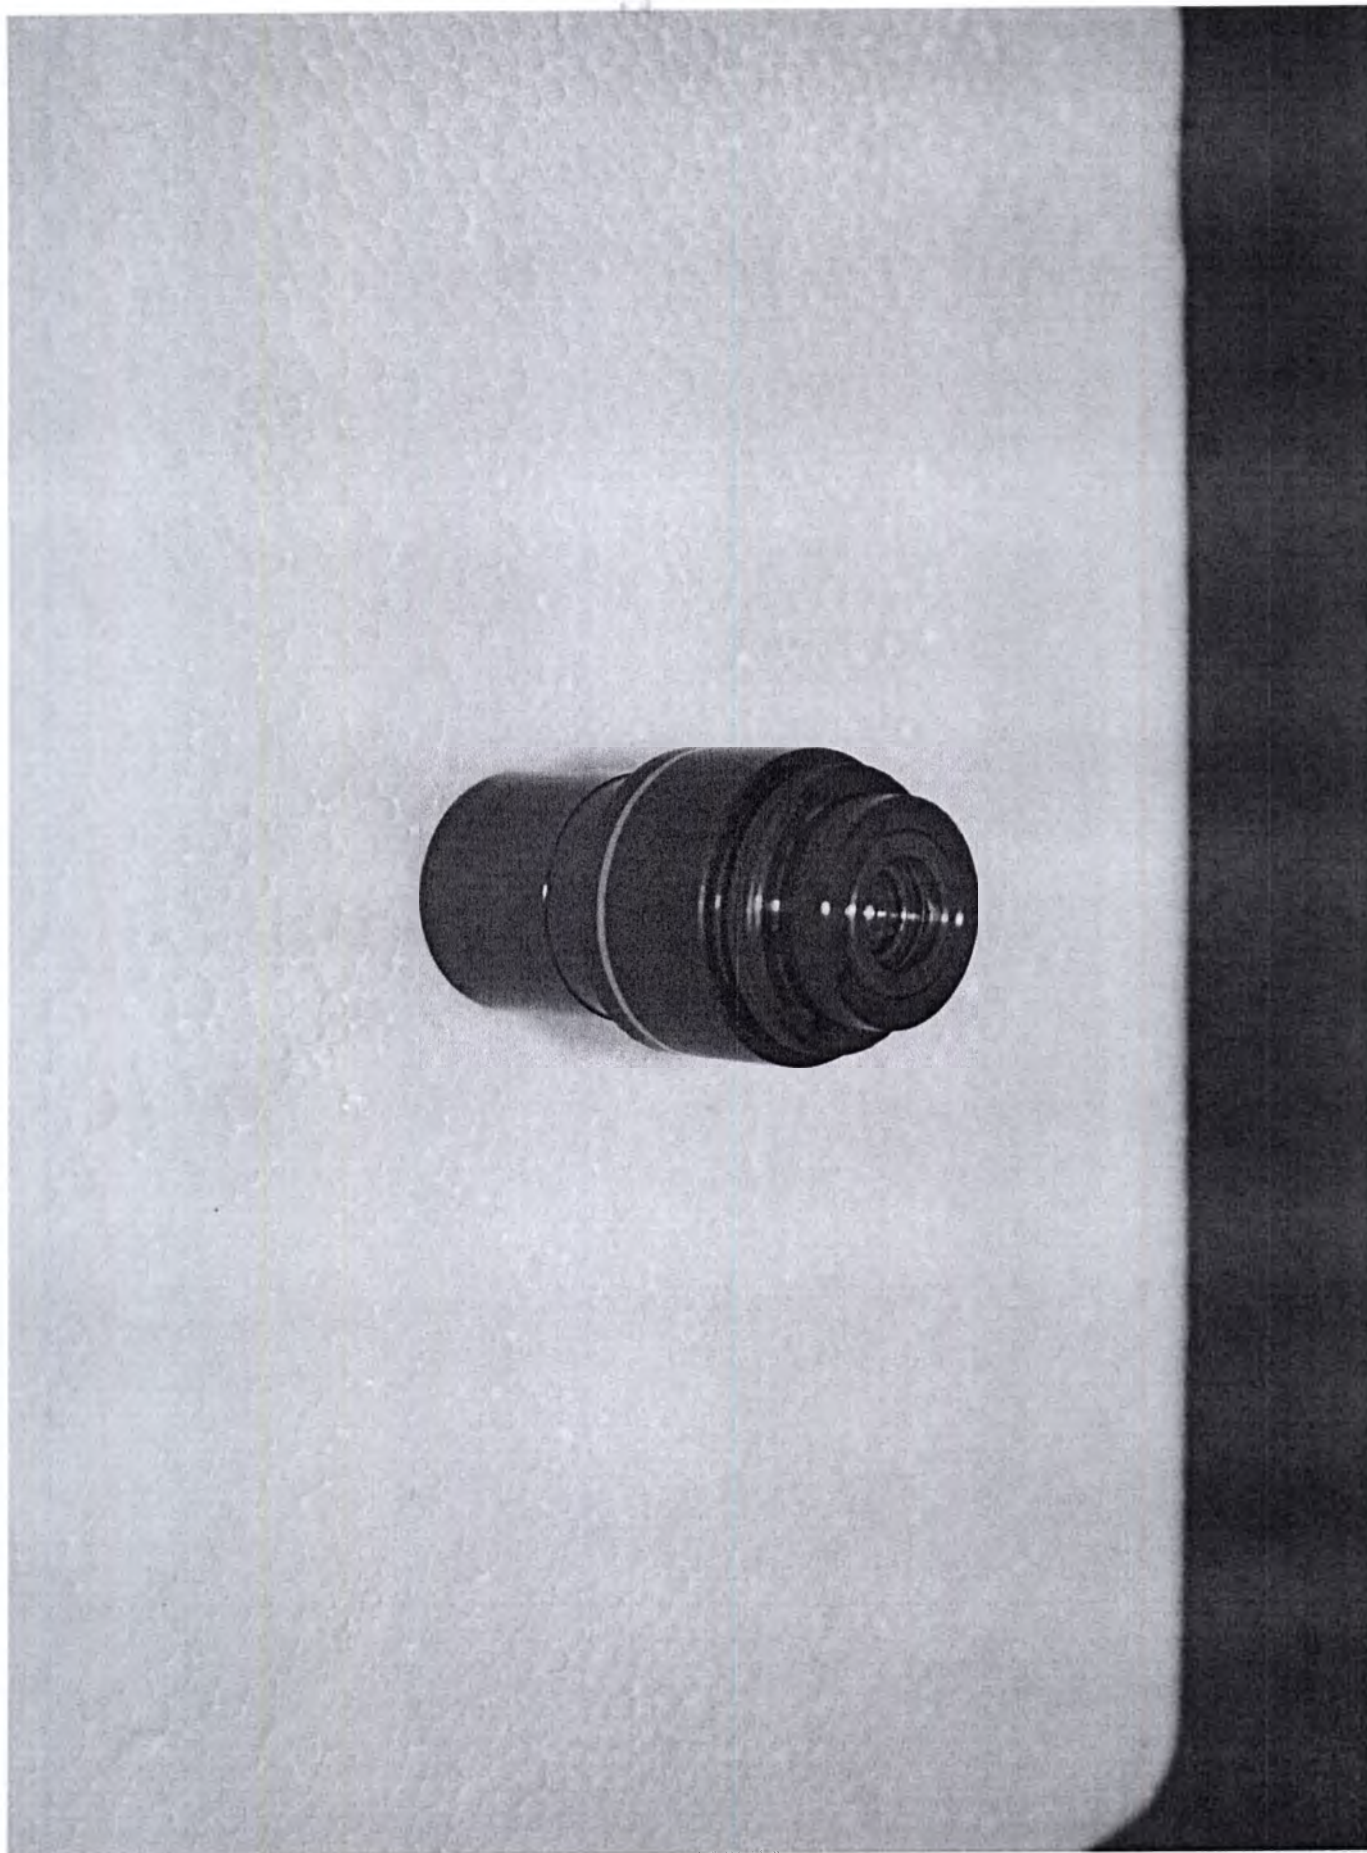


Адаптер для фото/видео устройств

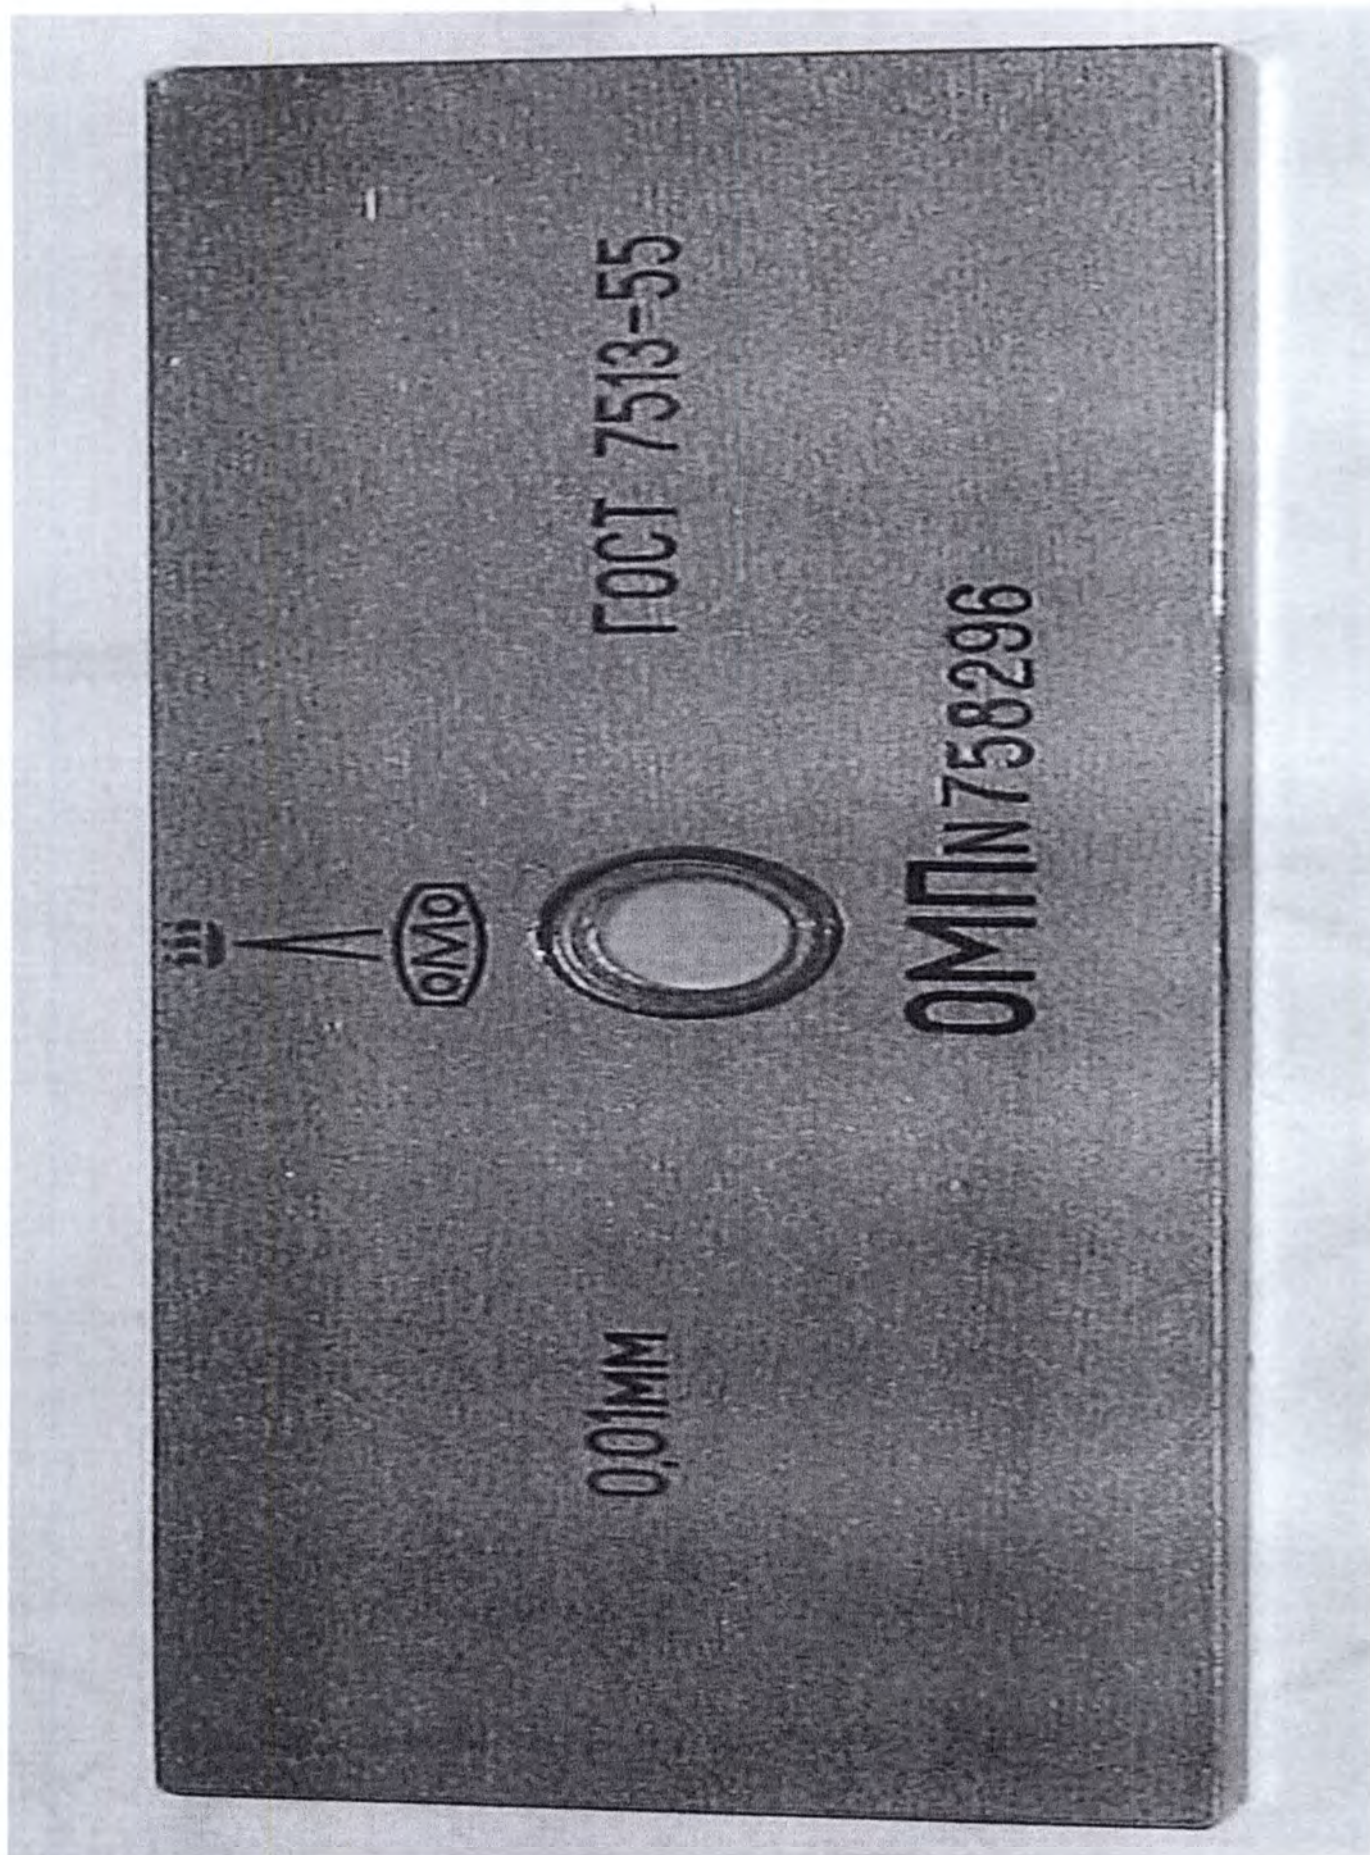


Объект микрометр

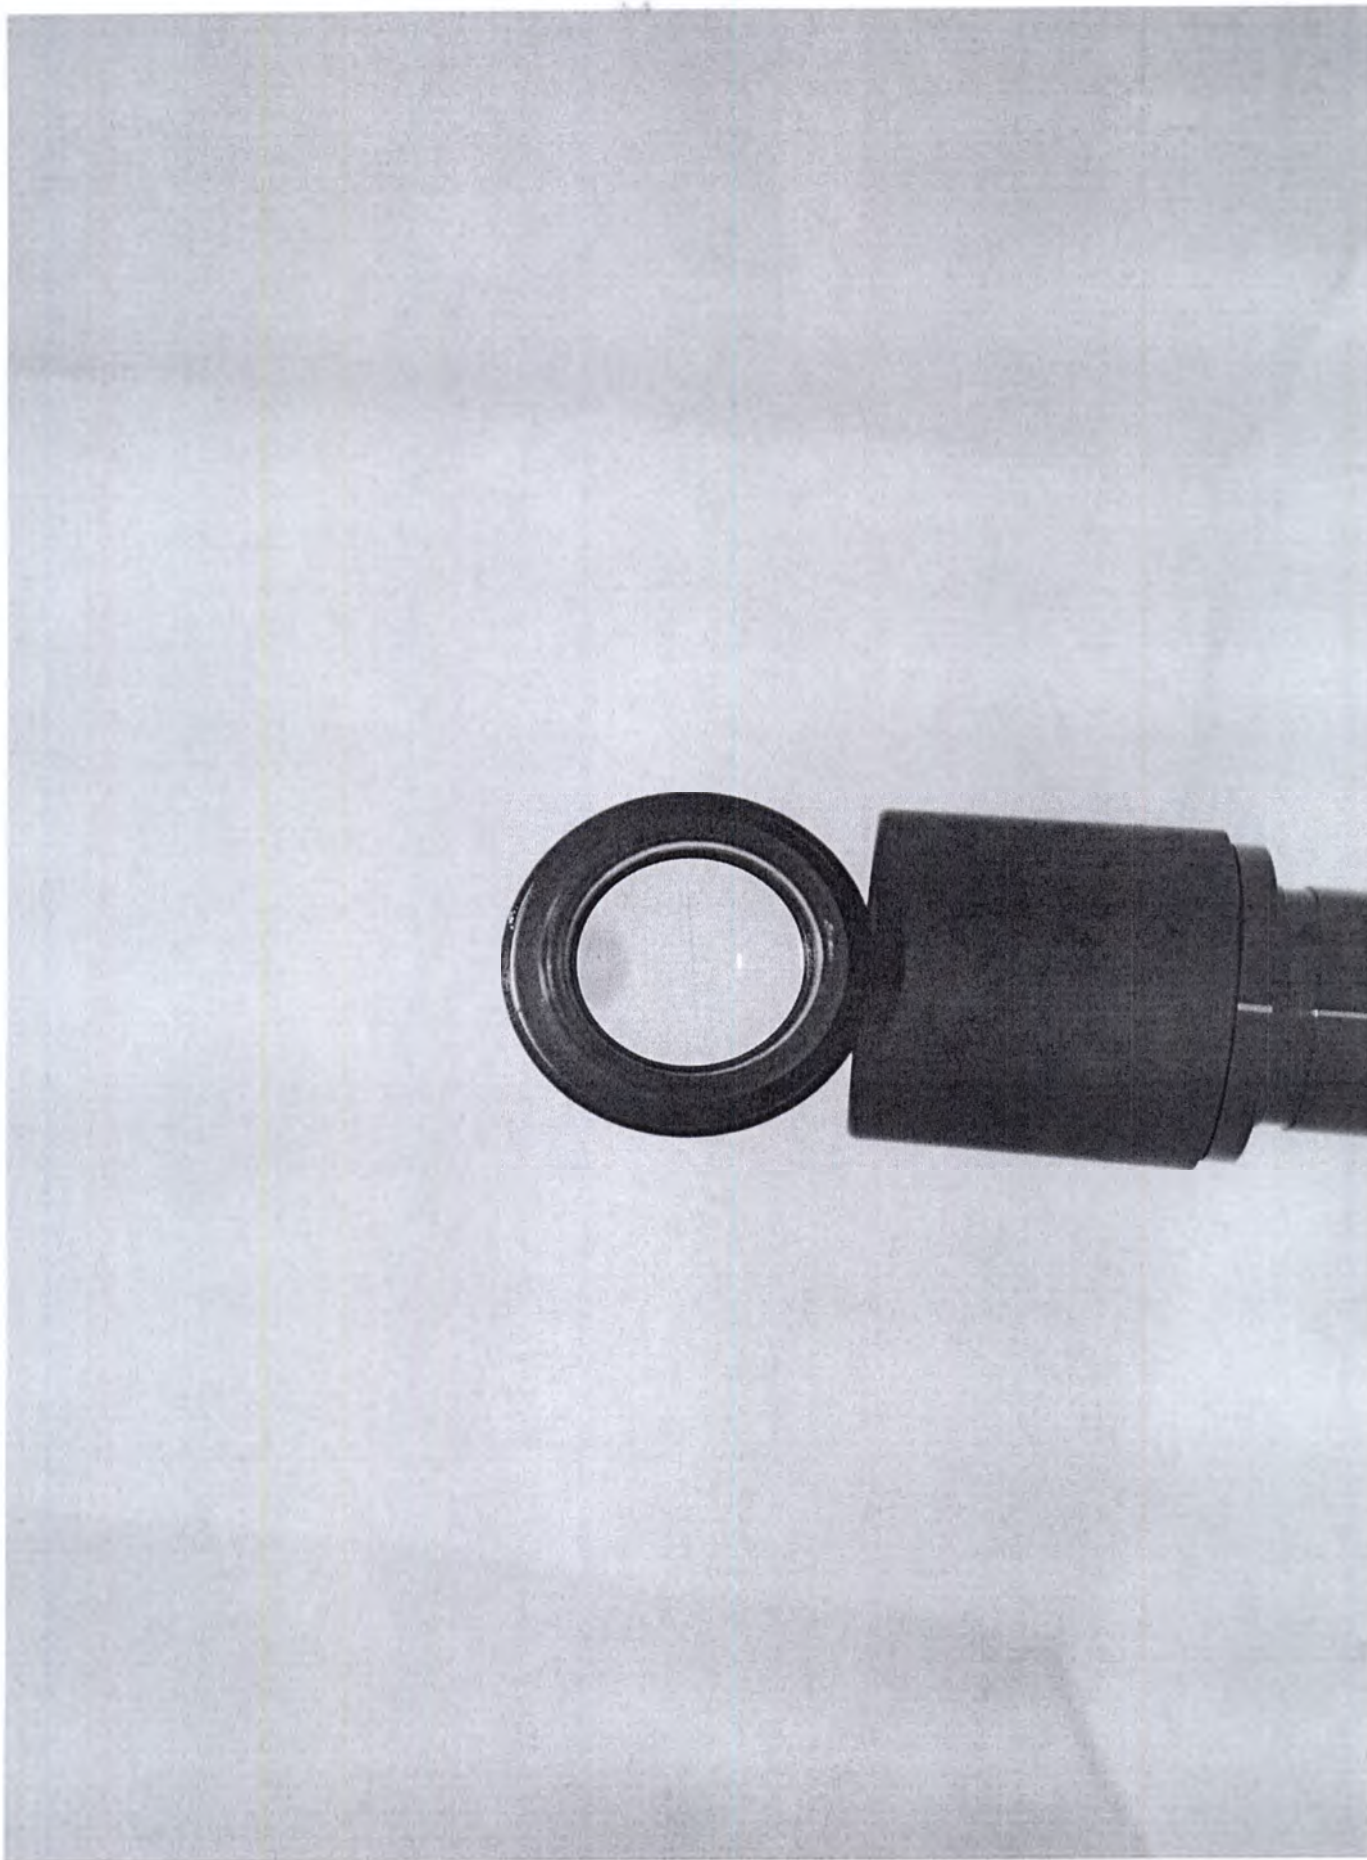


Окуляр микрометр

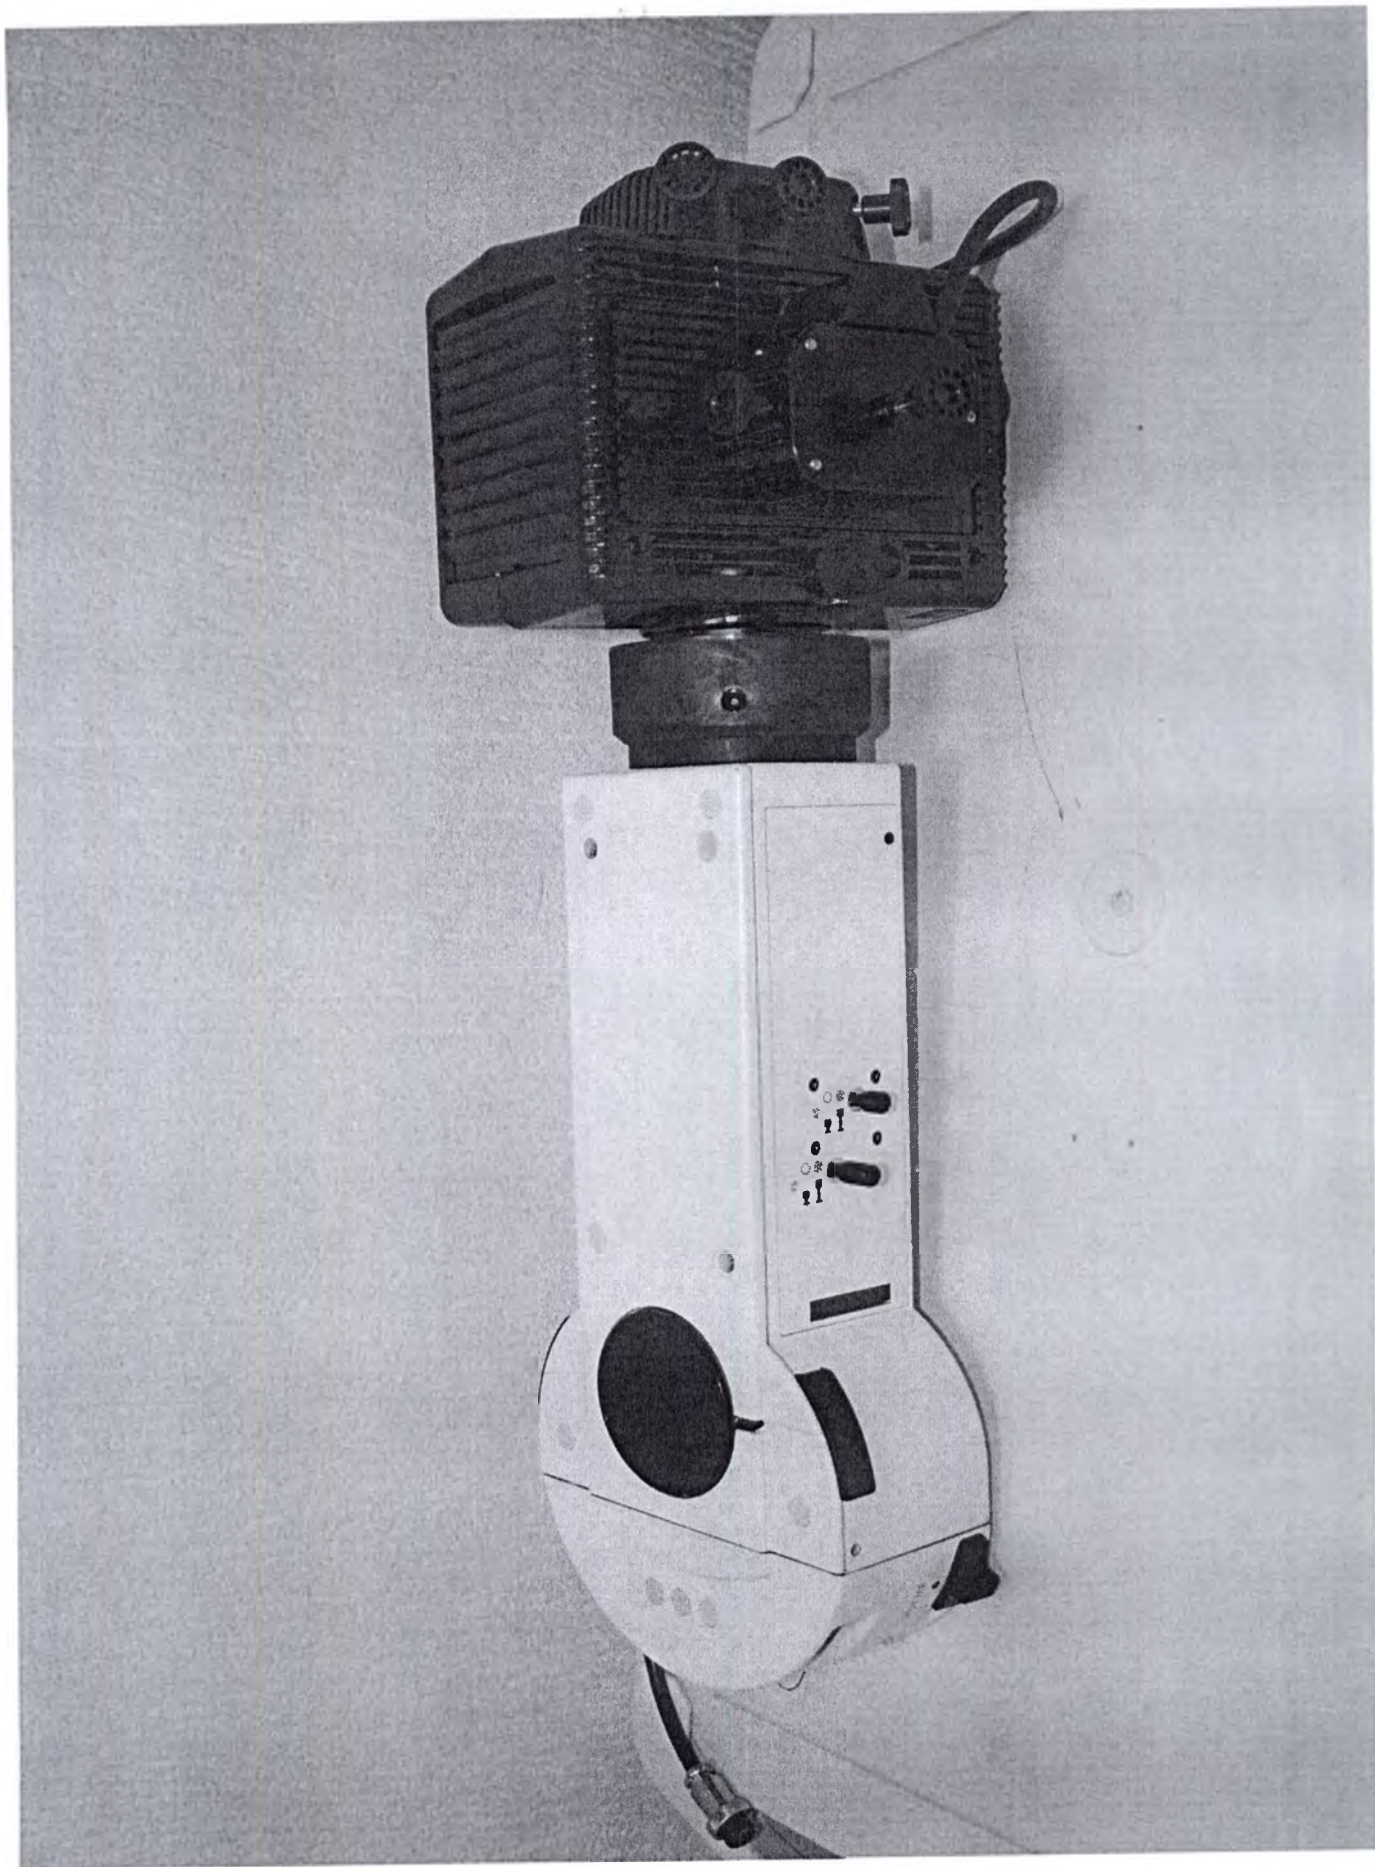


Флуоресцентный блок

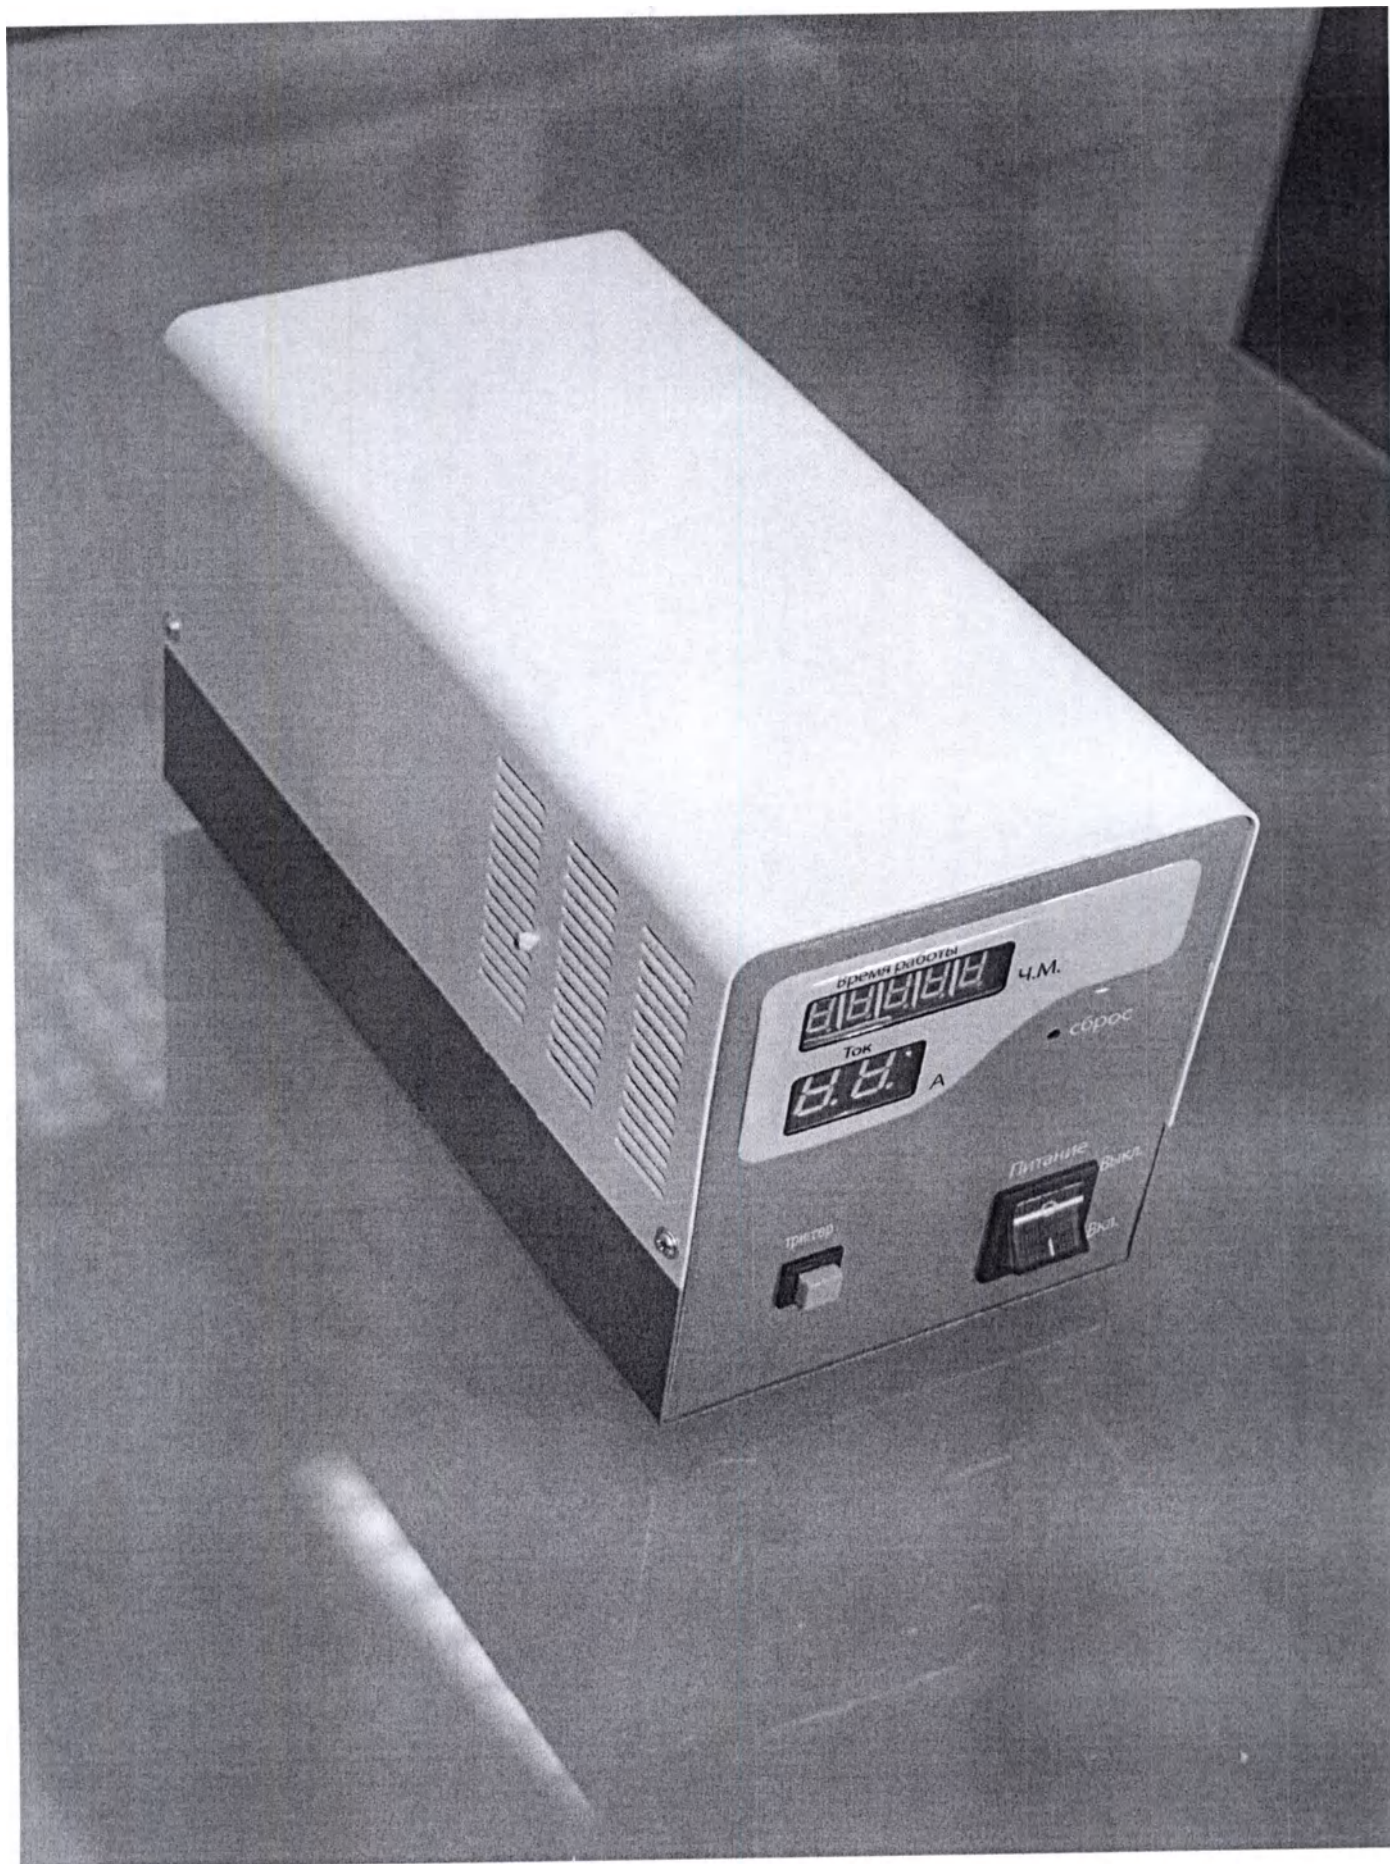


Блок питания флуоресцентного блока

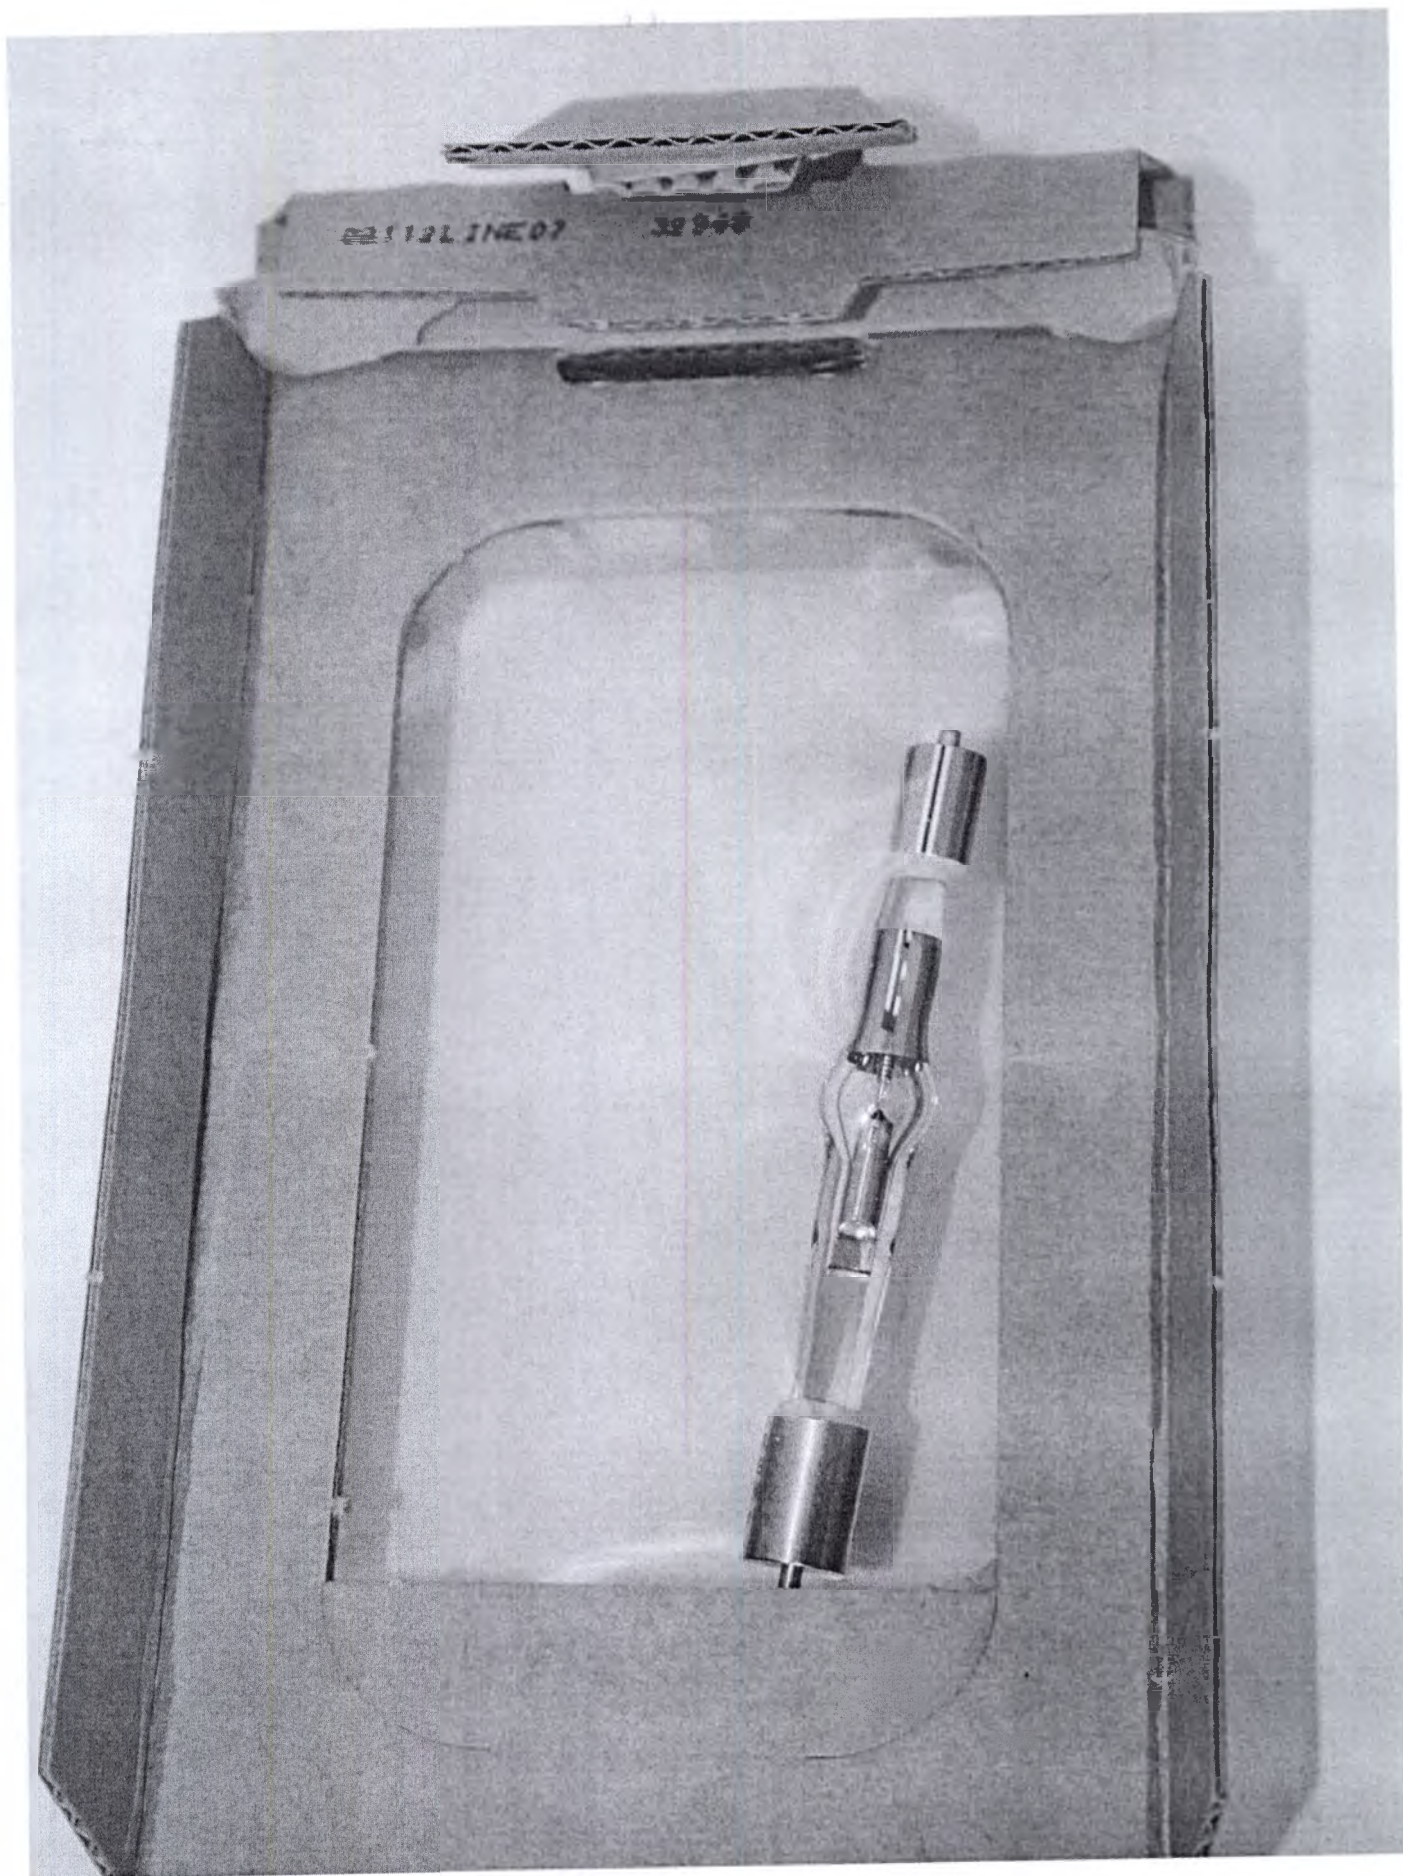


Ртутная лампа

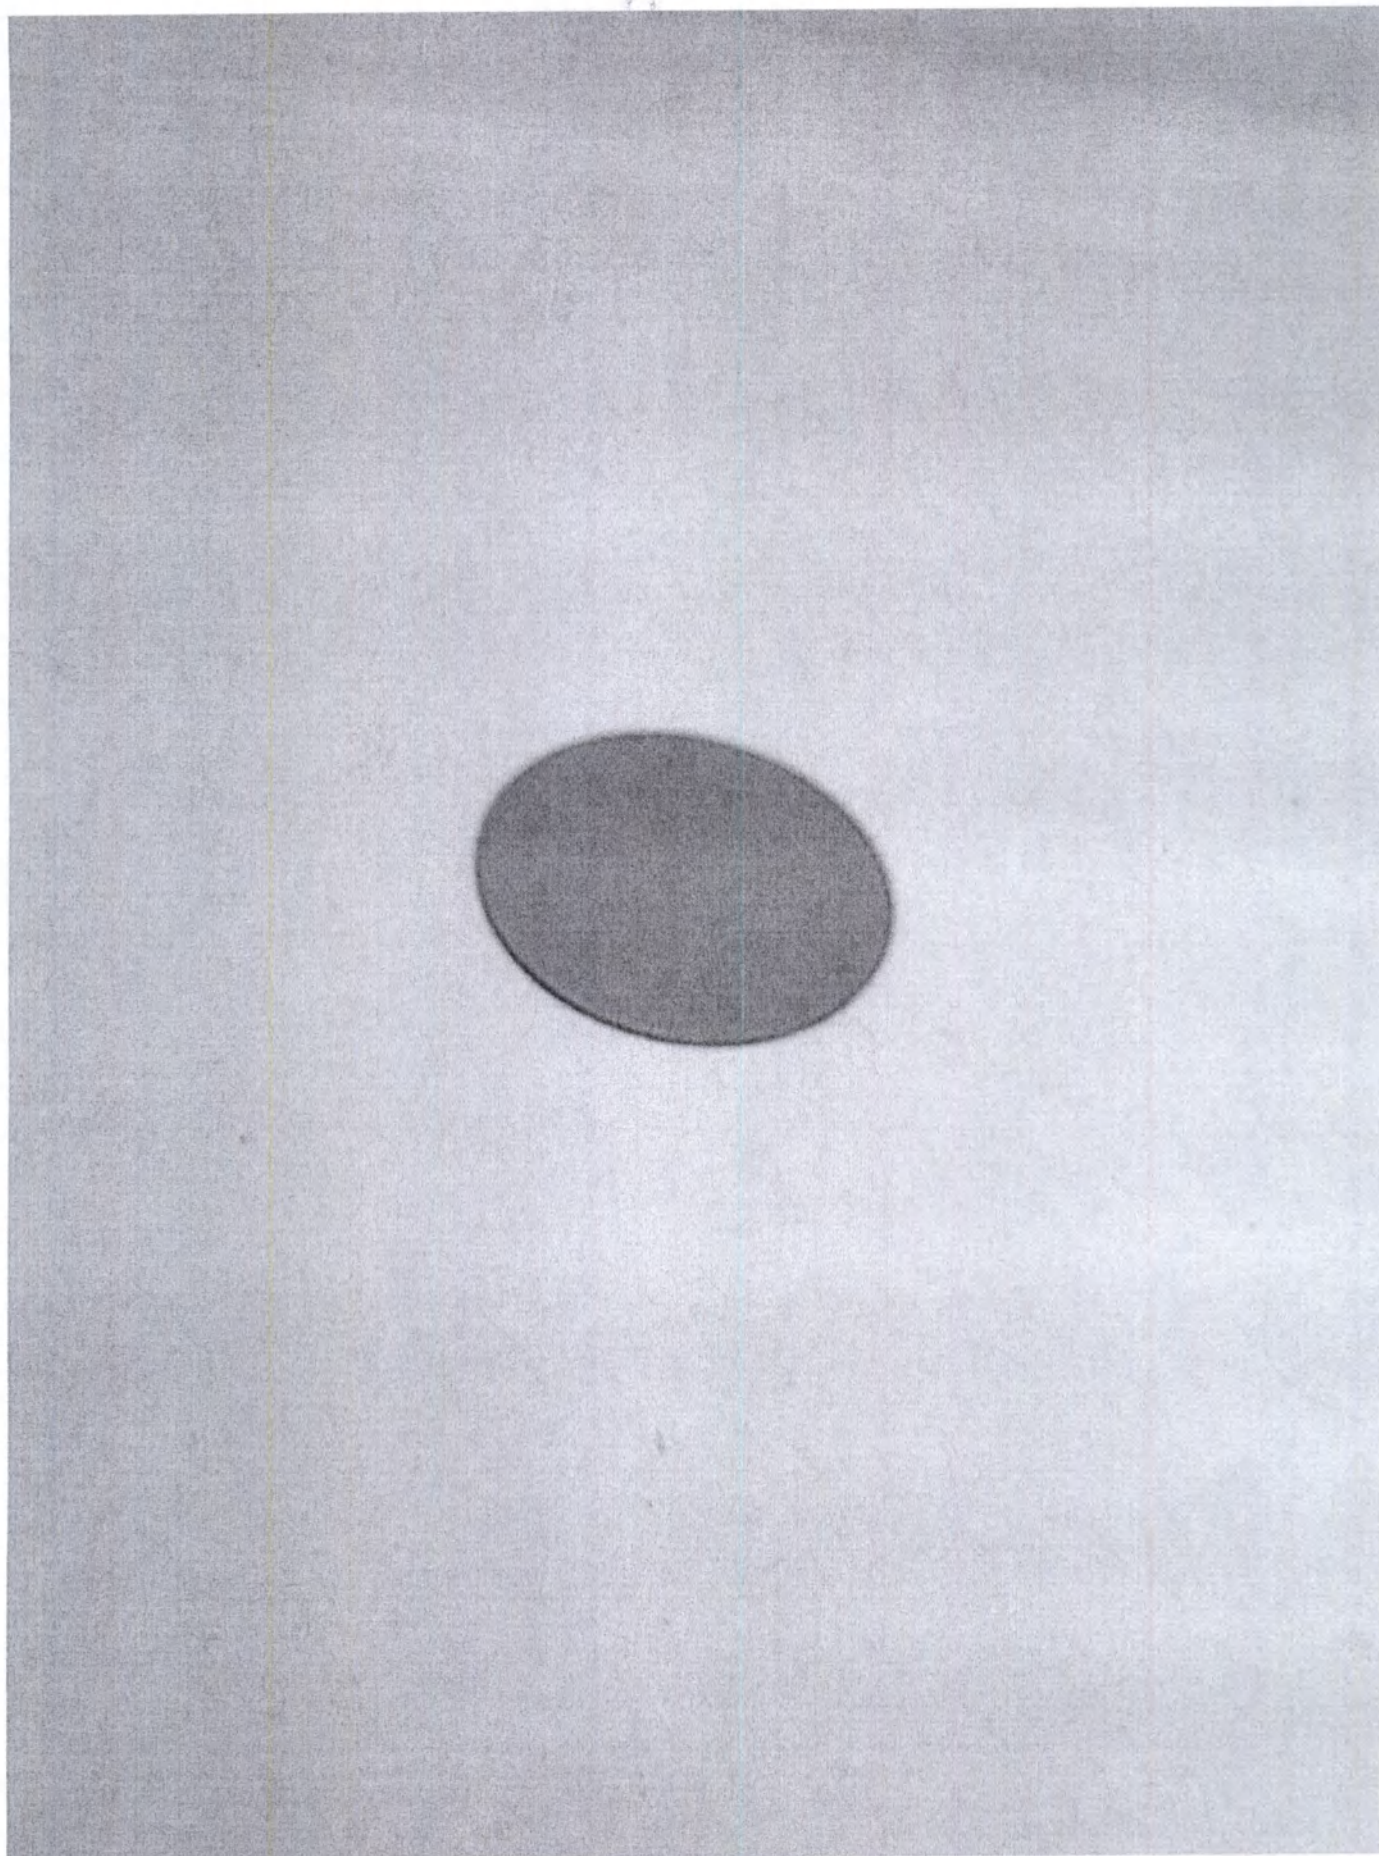


Светофильтр синий

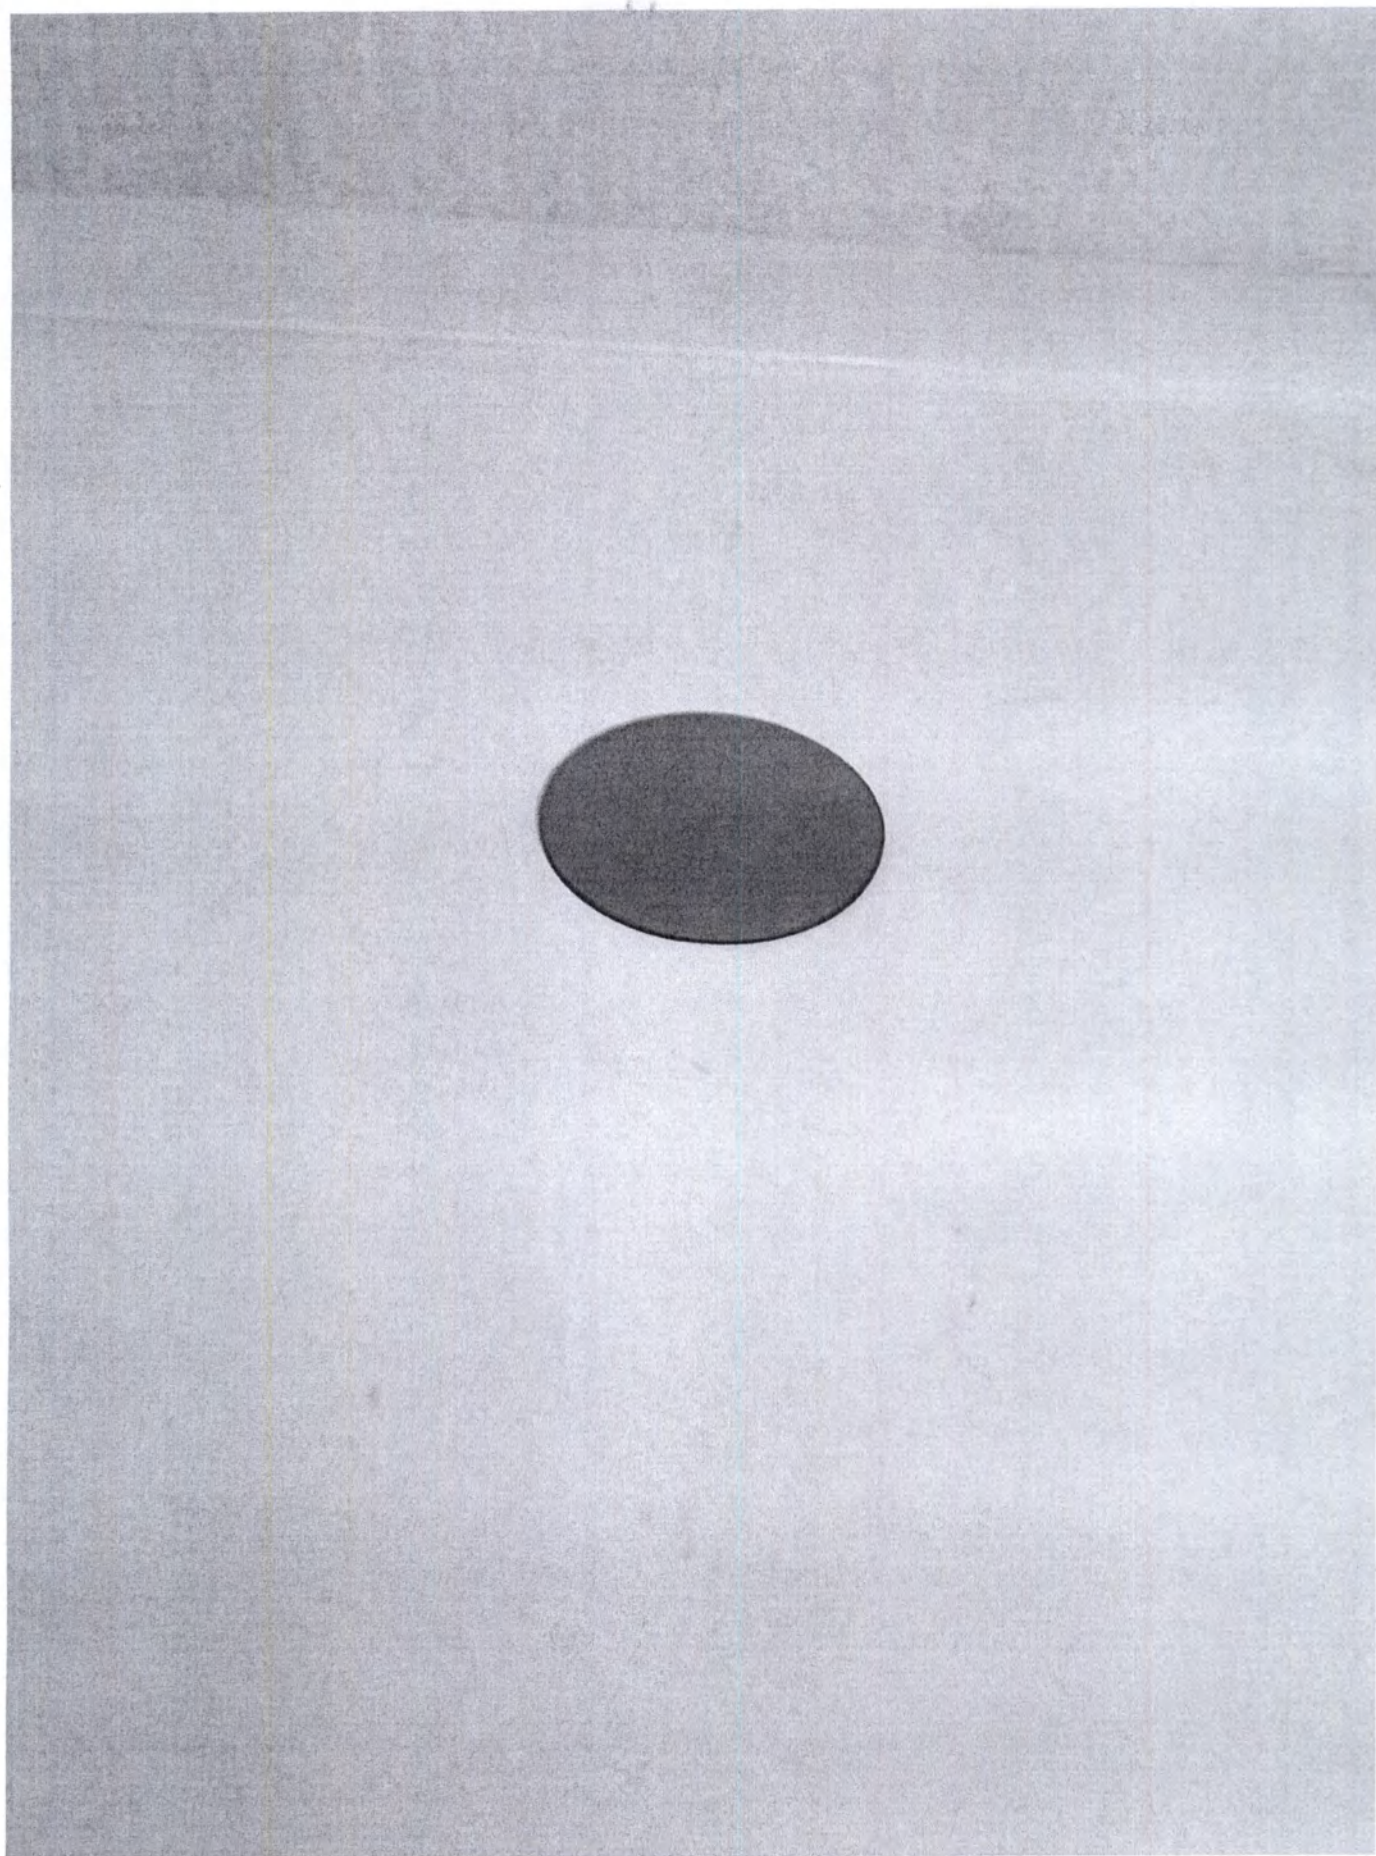


Светофильтр зеленый

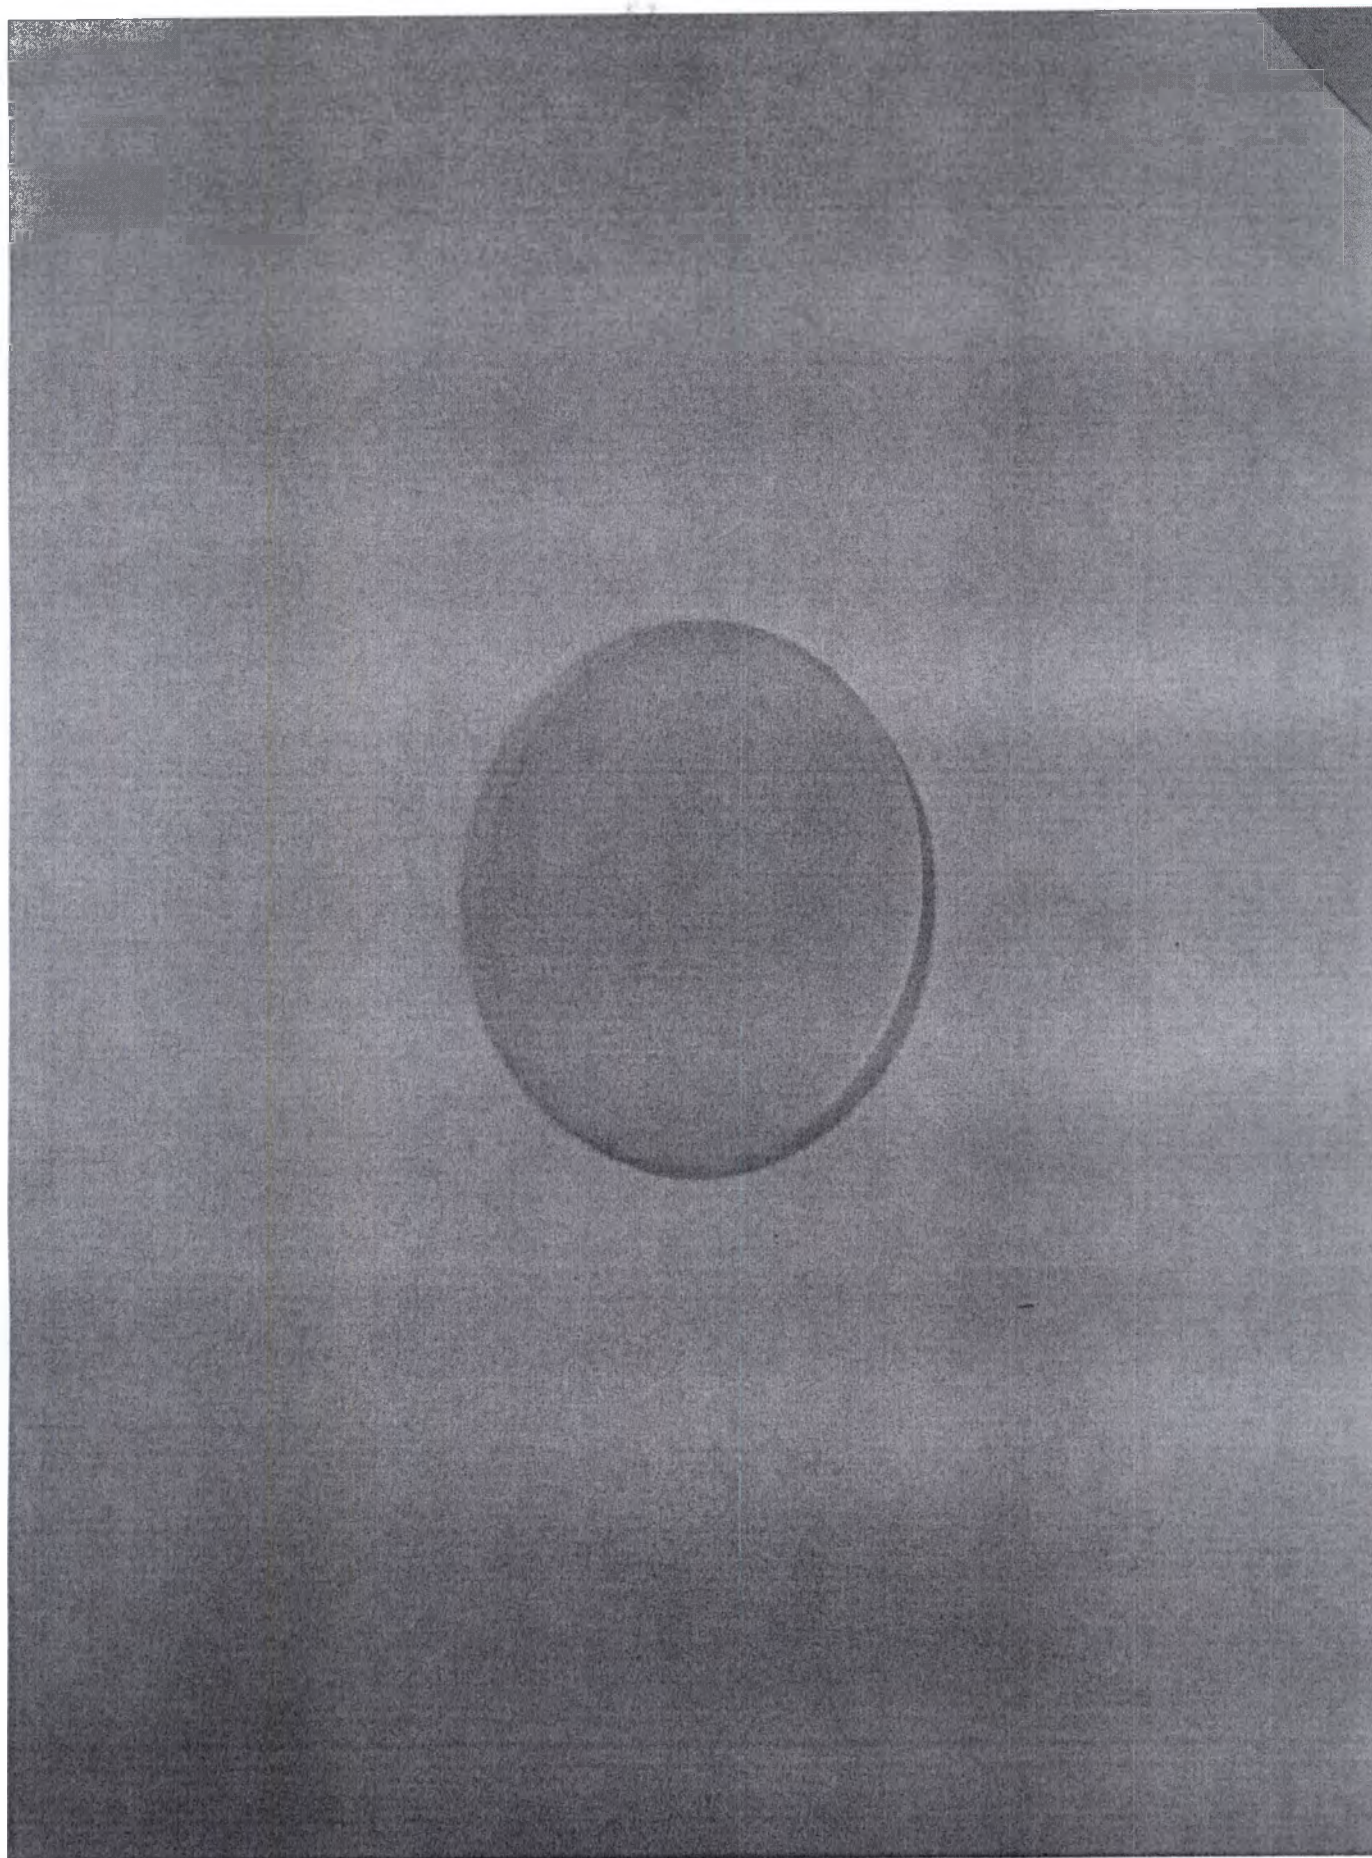


Светофильтр матовый

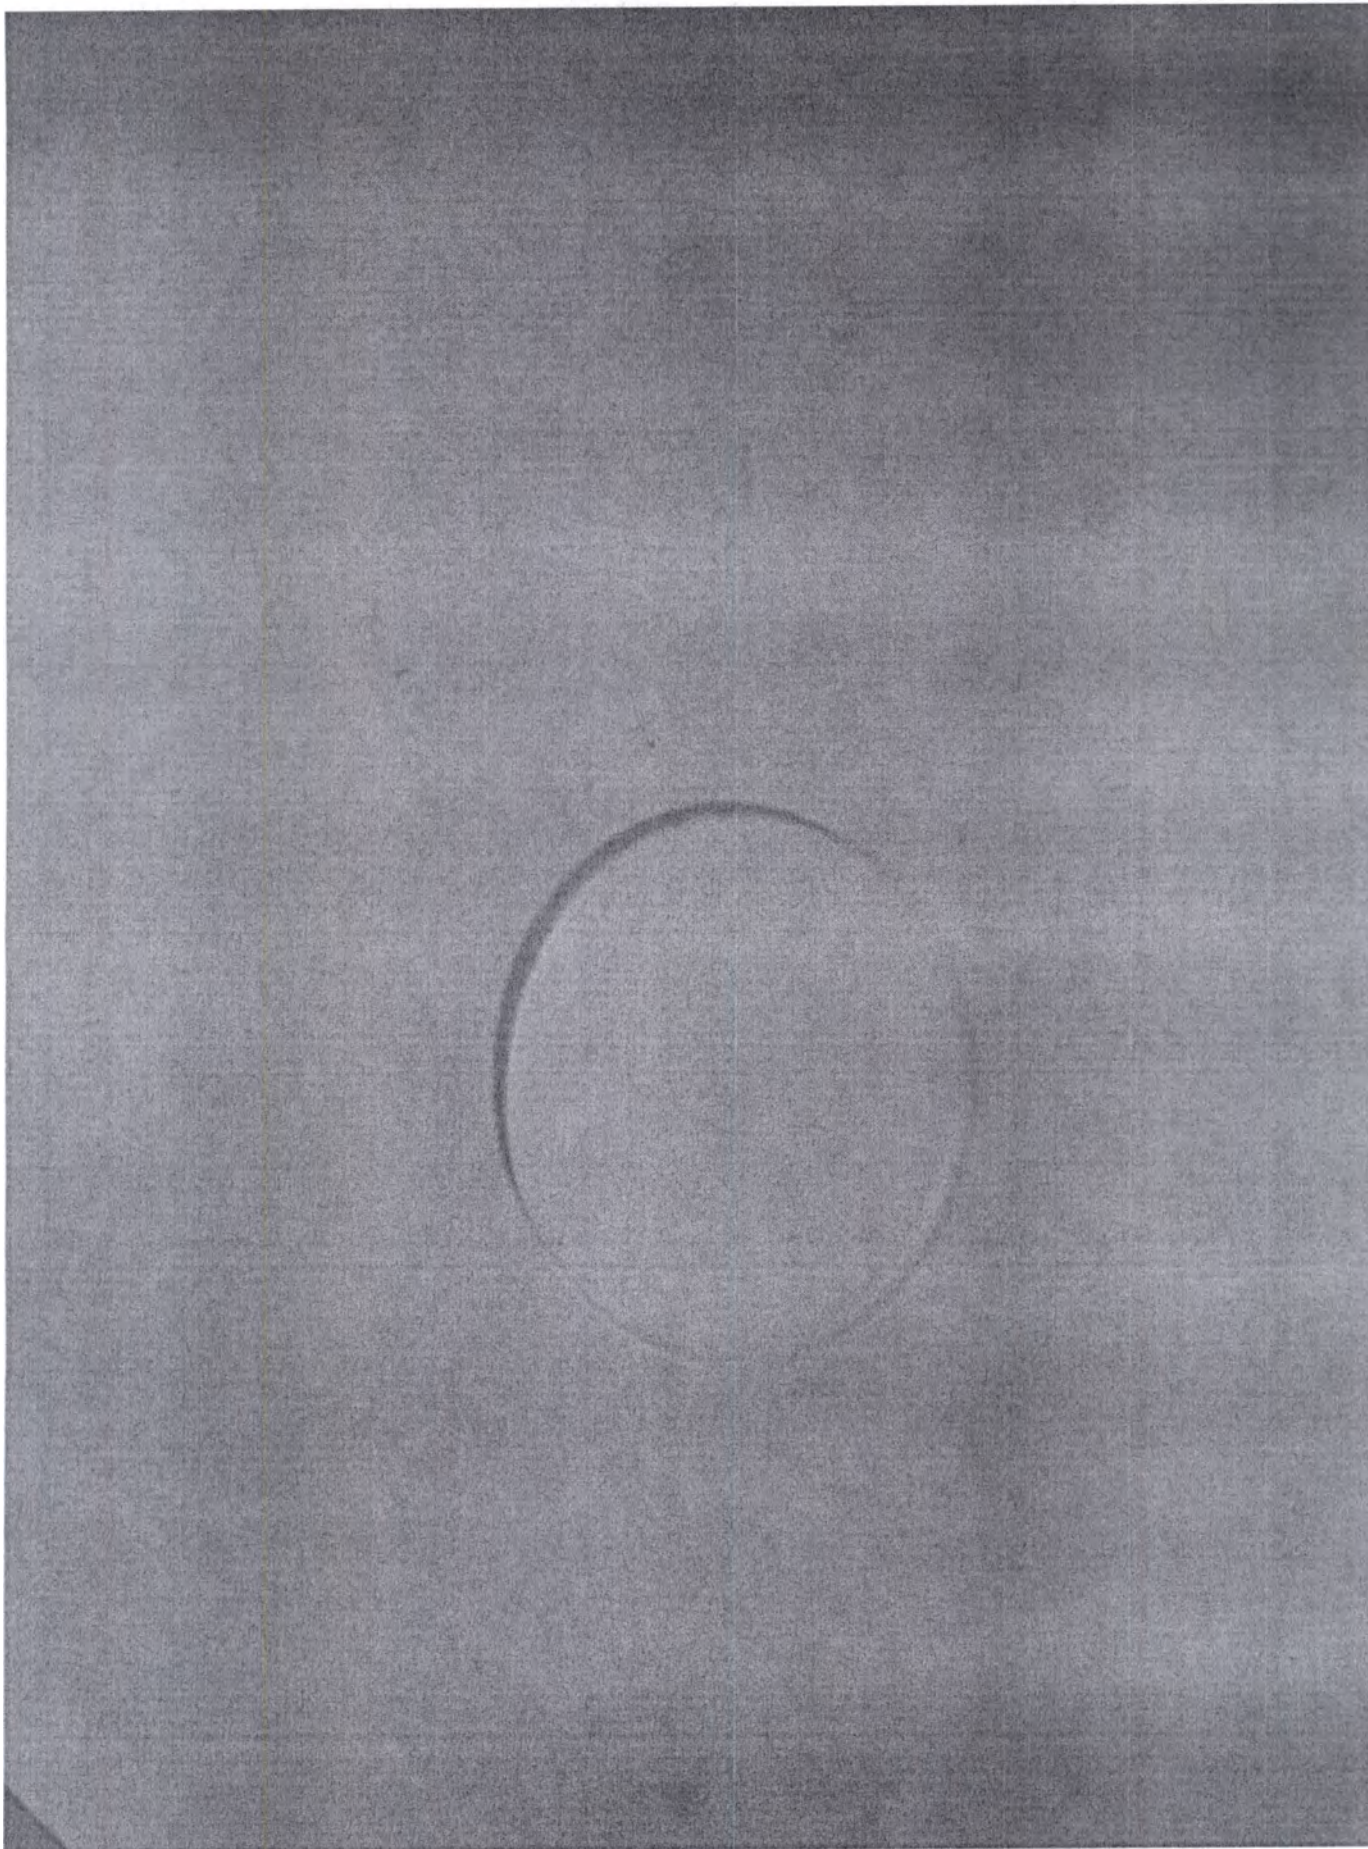


Светофильтр желтый

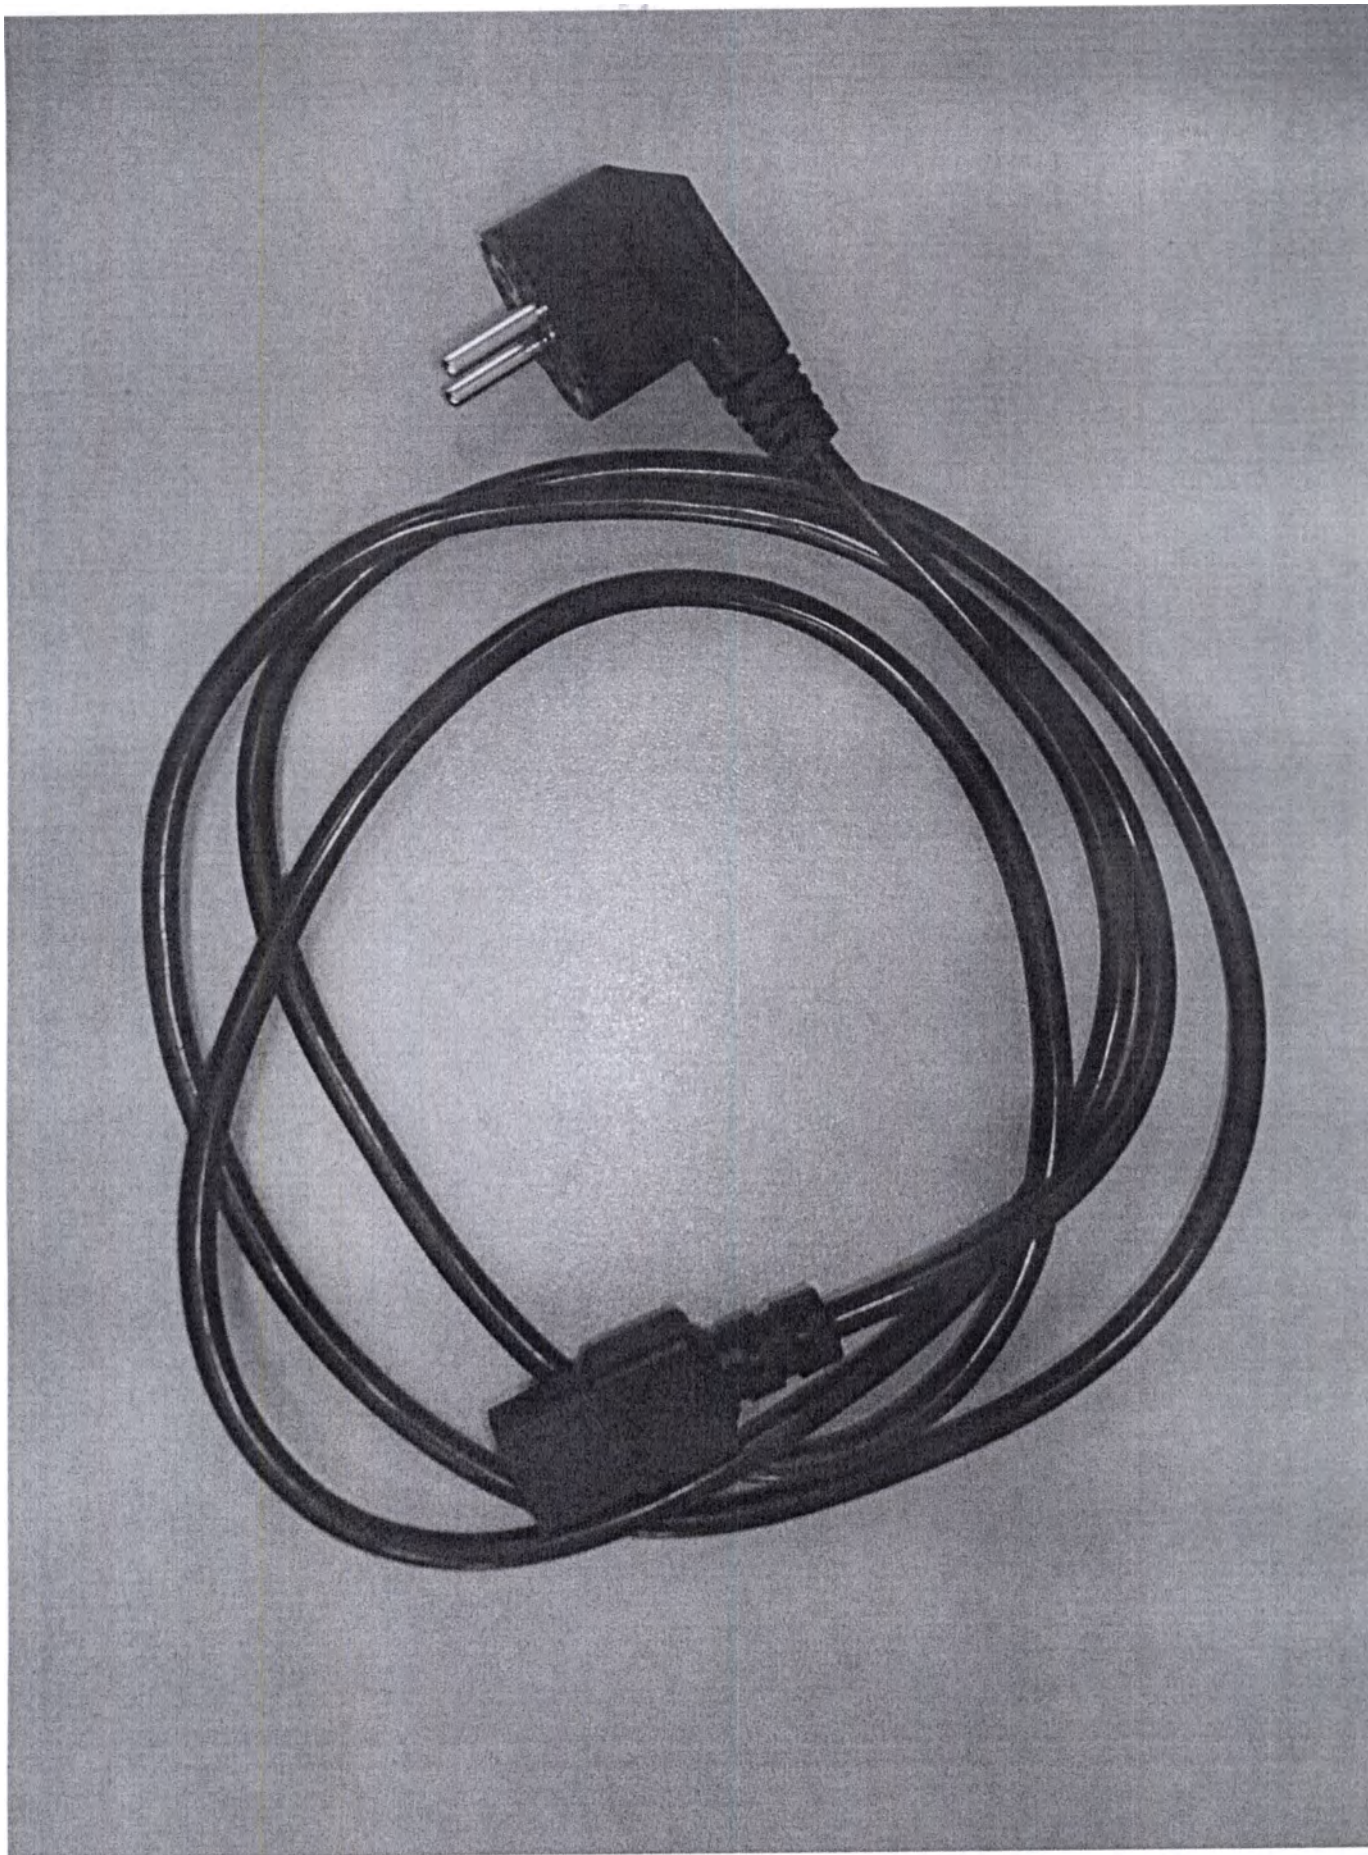


Кабель сетевой

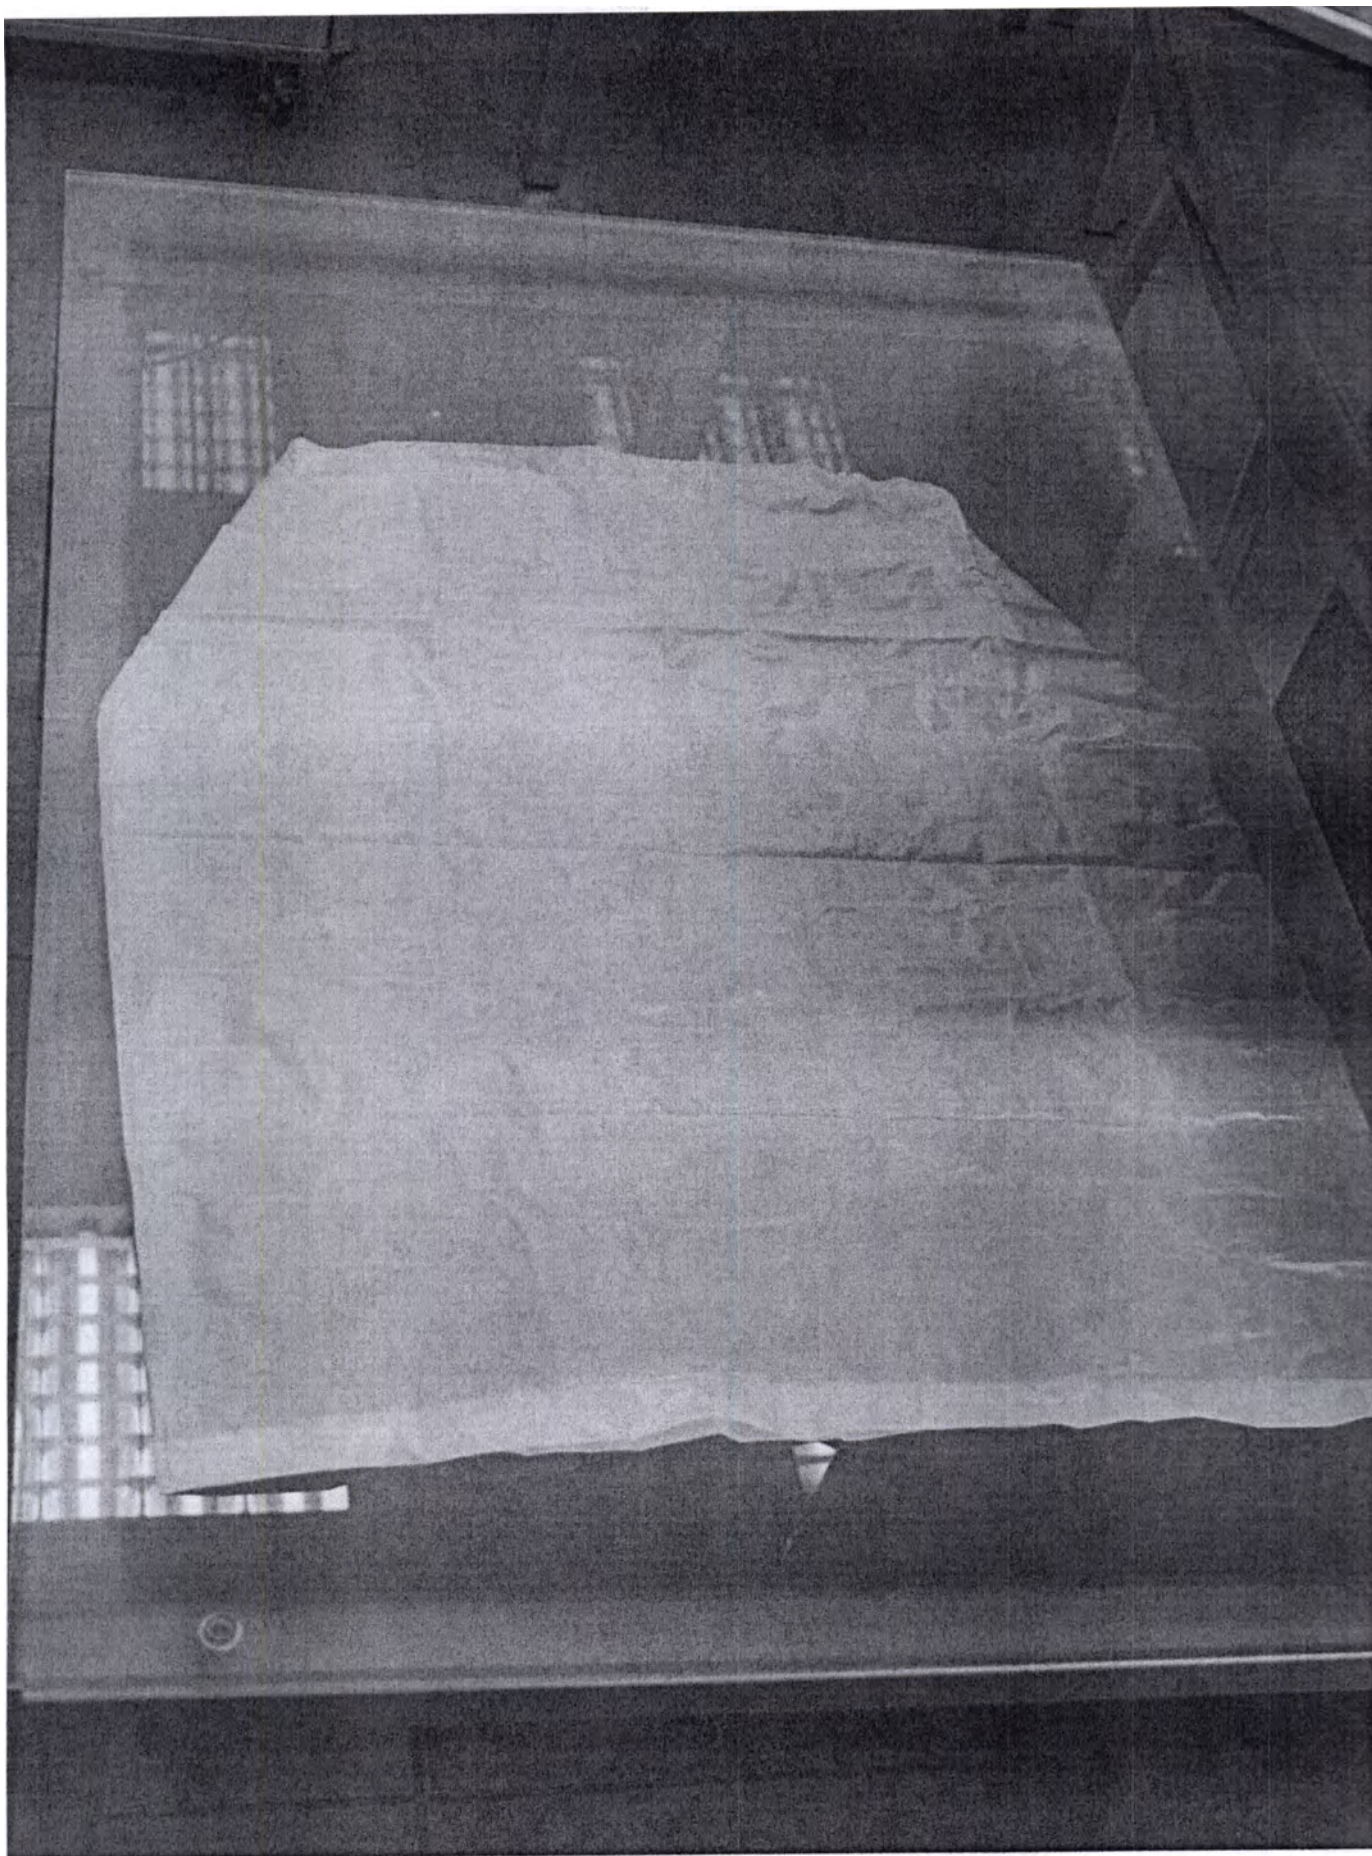

Чехол защитный

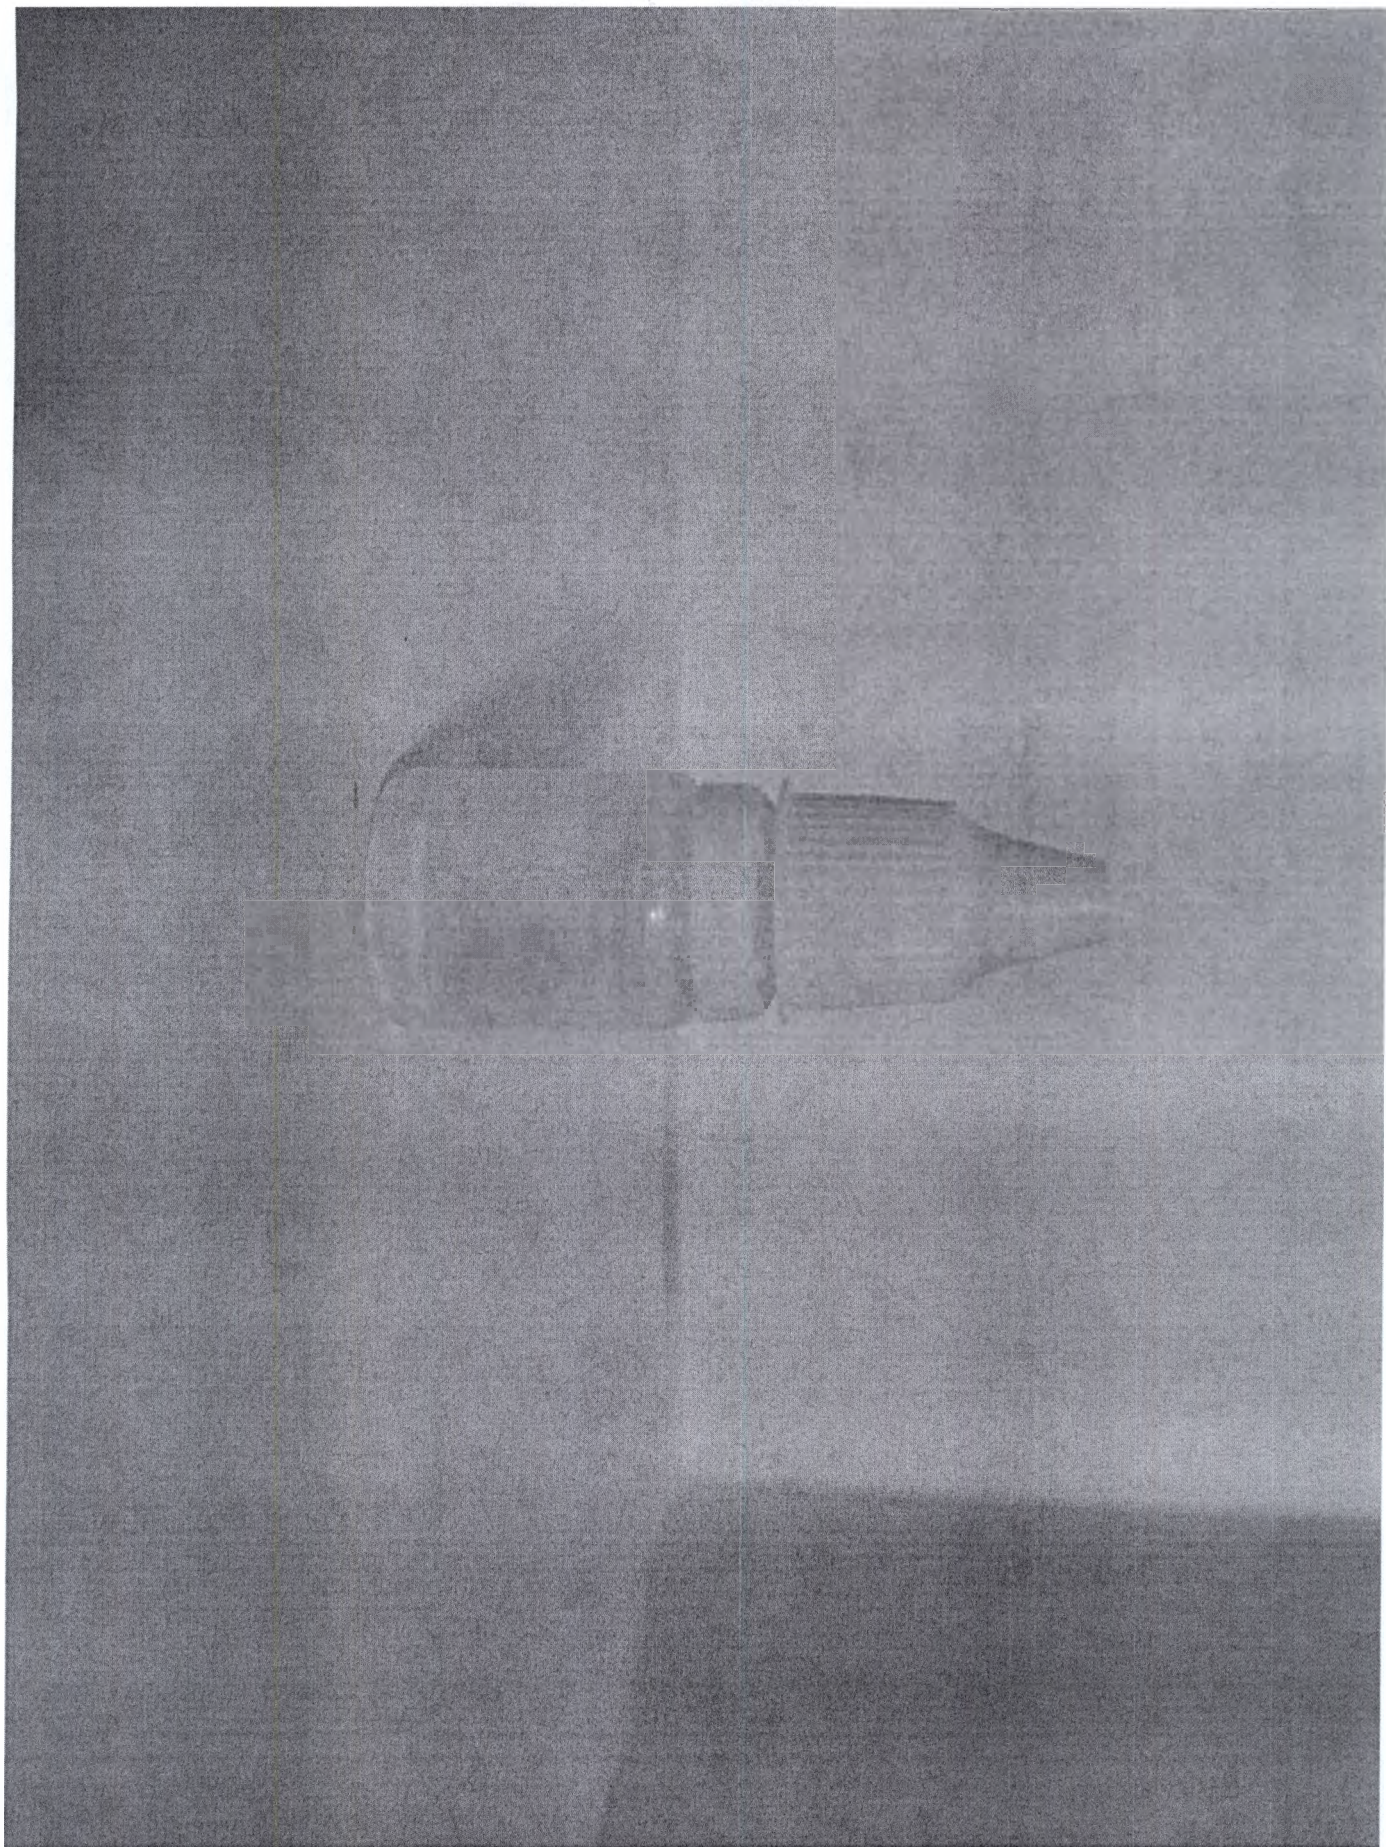

Масло для иммерсии

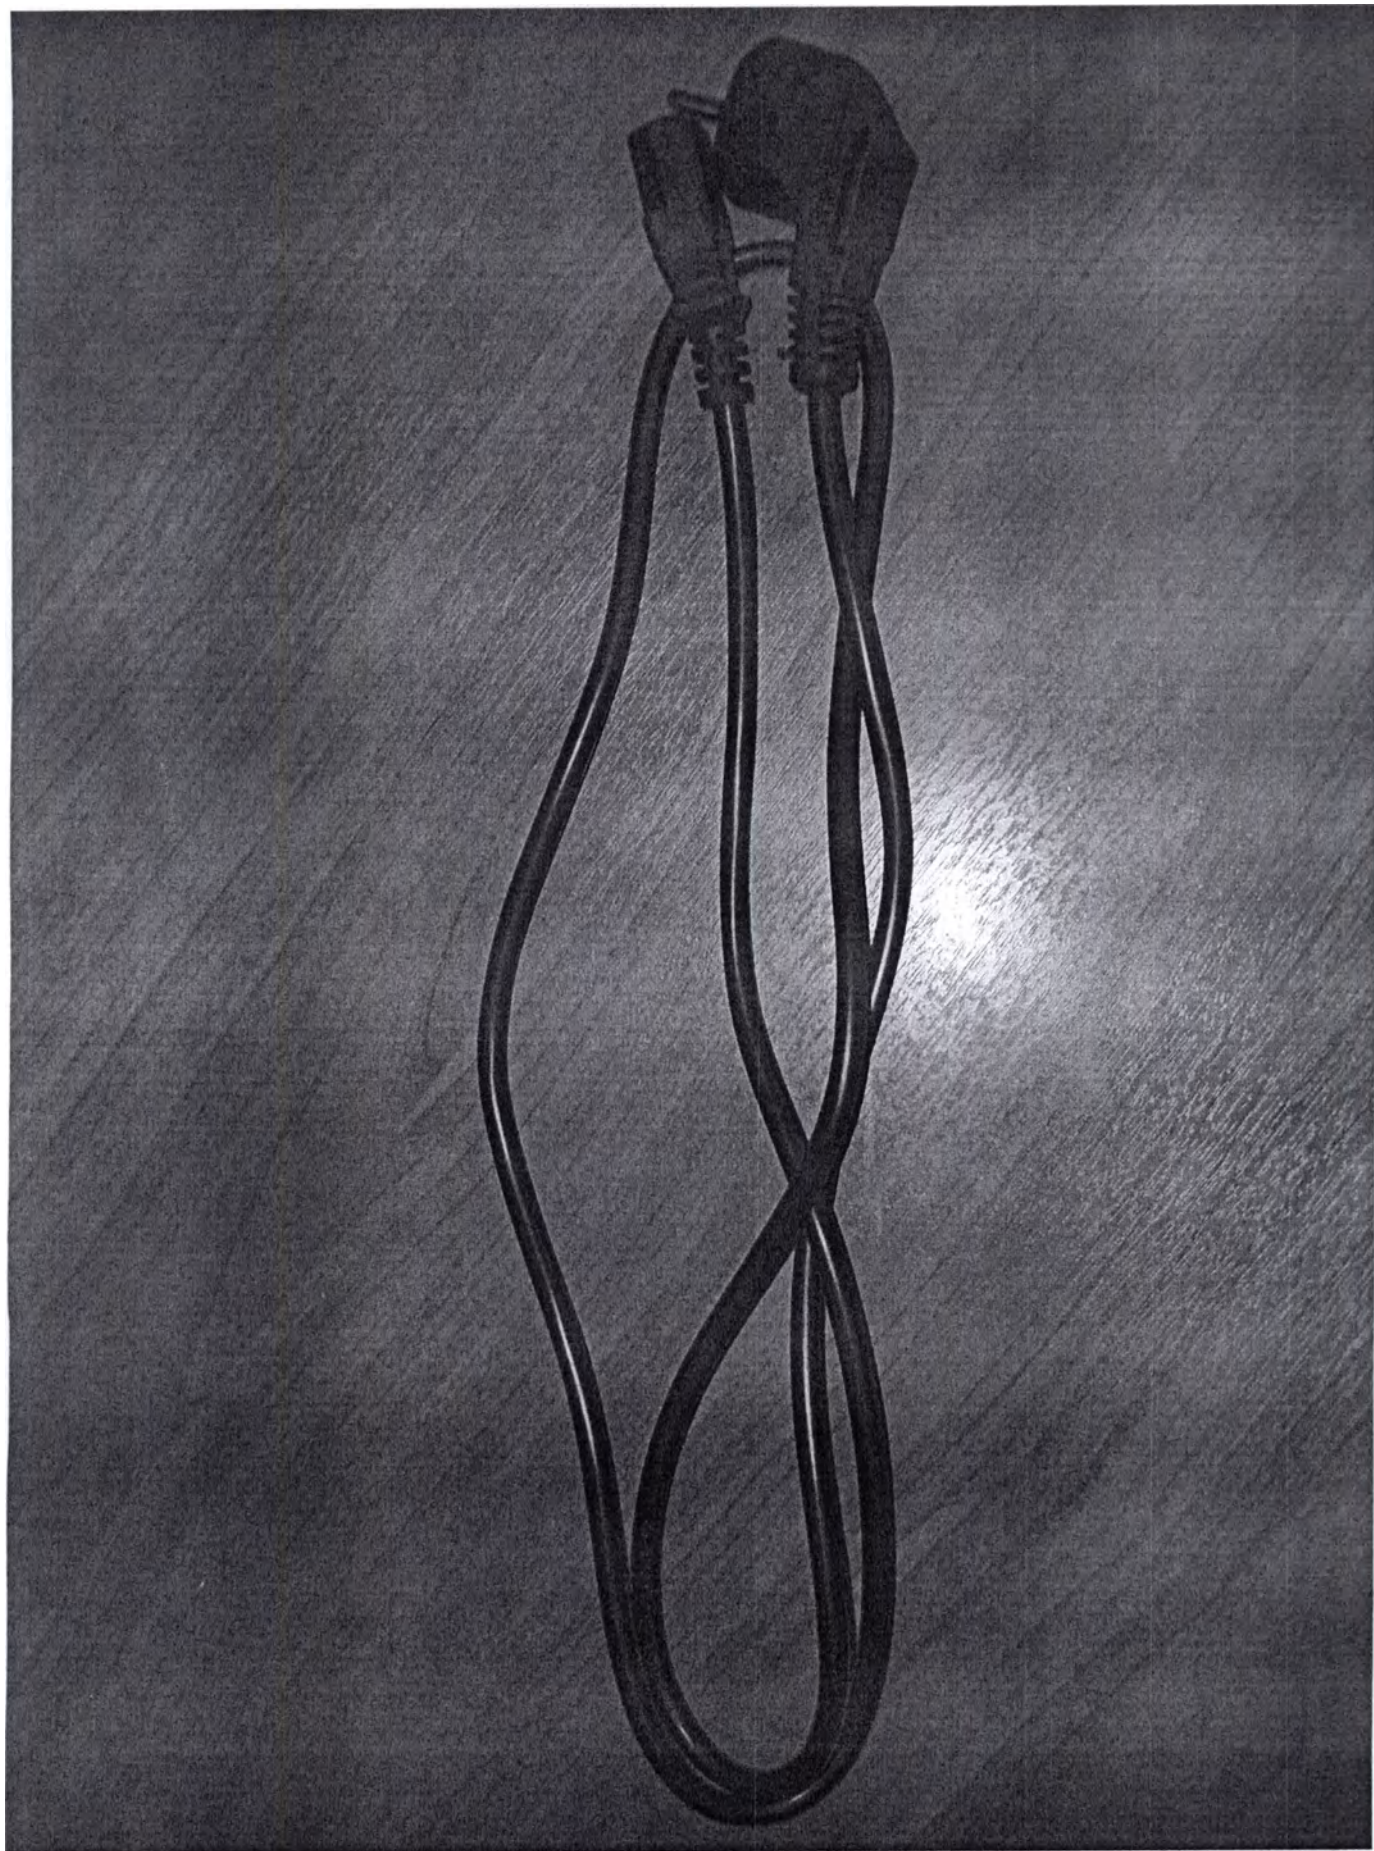

Сетевой кабель для блока питания флуоресцентного блока

ООО
«МО «Отдел медицинской техники»
Итого в настоящем документе

54
Директор
Цикин А. Ю.

