

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель департамента
регистрации и сертификации России и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

С.Б. Парахина

2016 г



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


**" Медицинская диагностическая рентгеновская
система Brivo XR575 с принадлежностями "**

**I. Медицинская диагностическая рентгеновская система Brivo XR575
с принадлежностями:**


Общая фотография МИ.



1. Генератор.

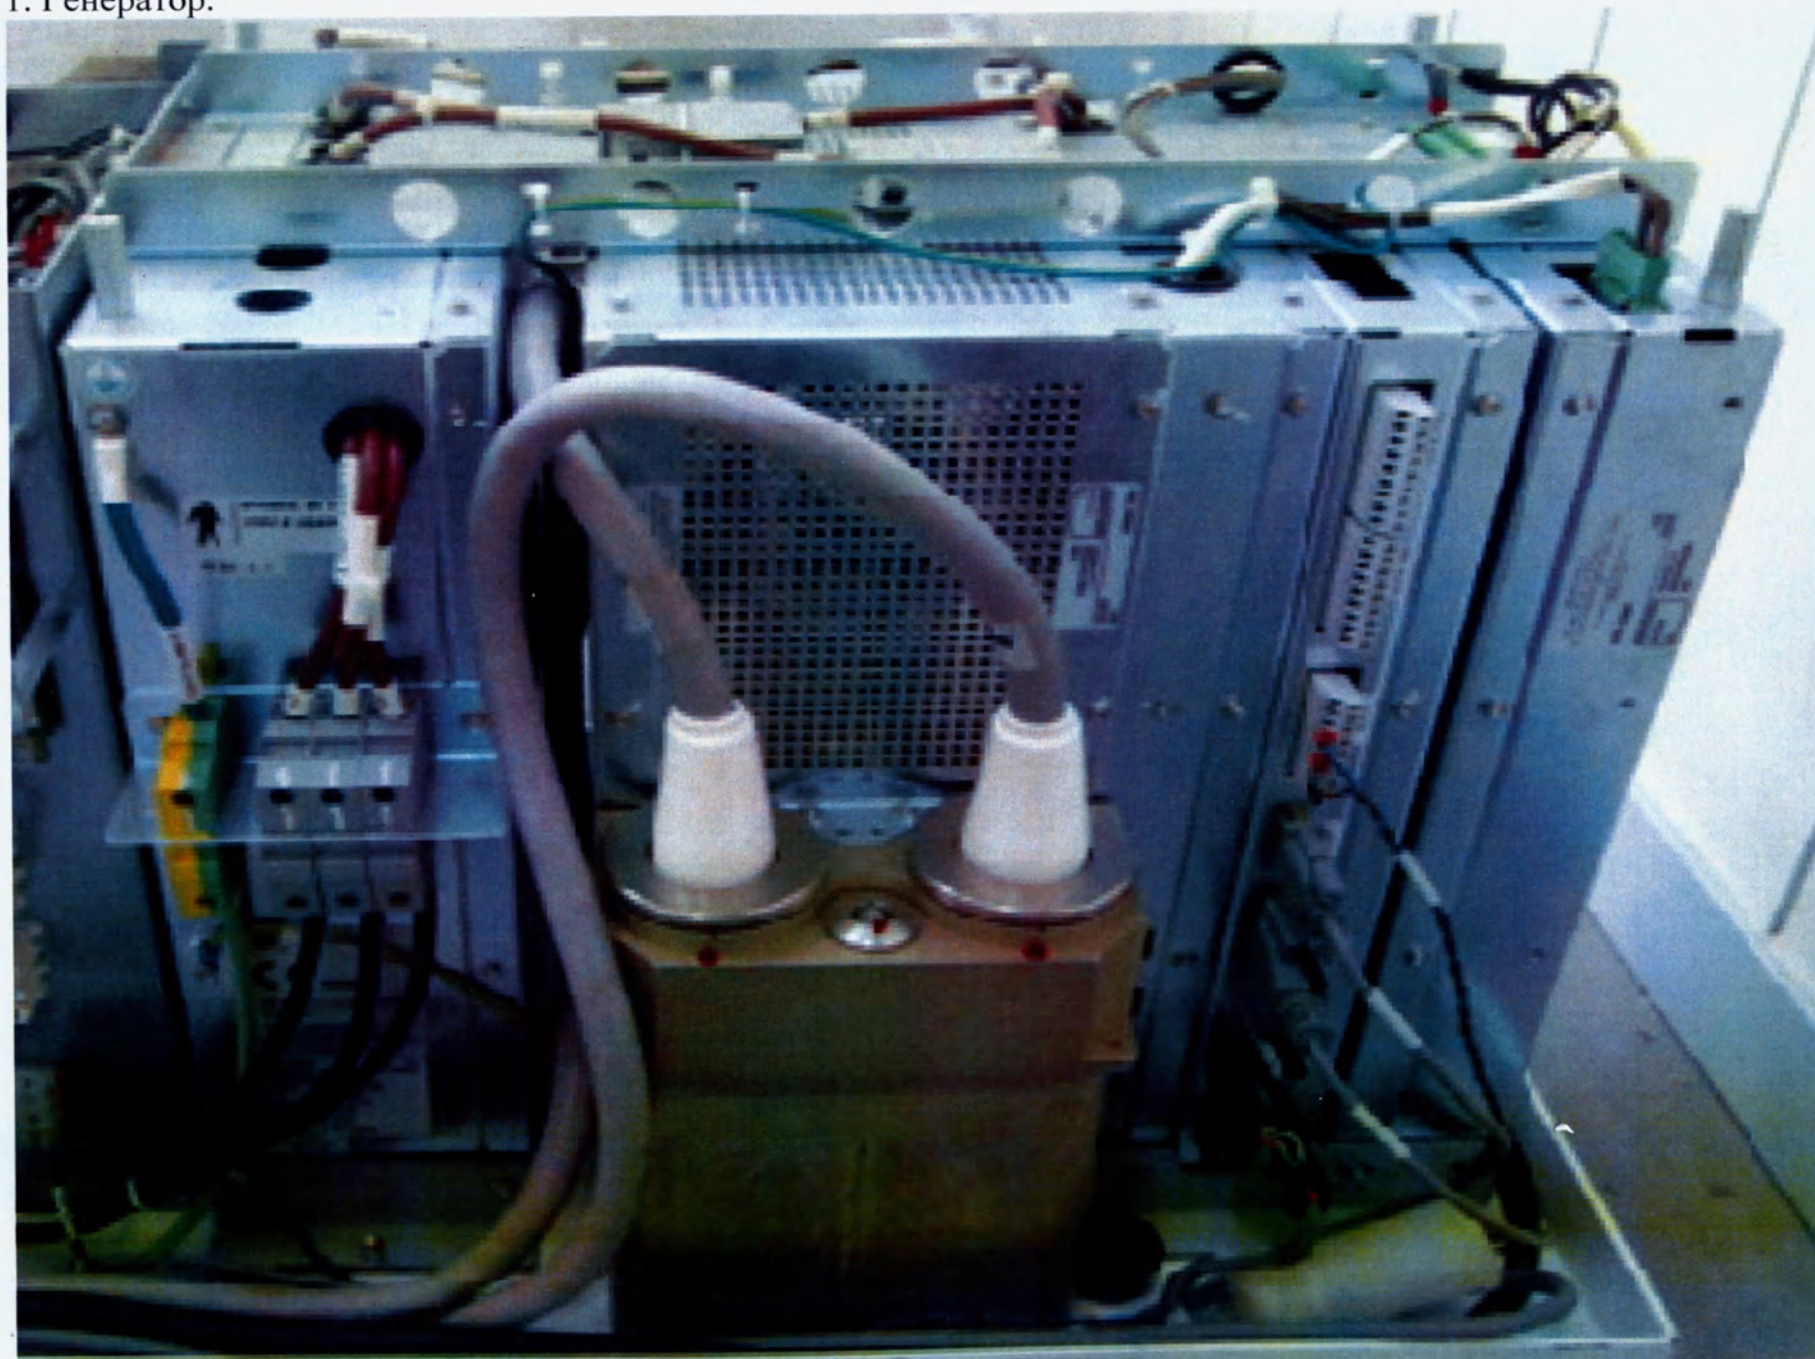

2. Детектор.

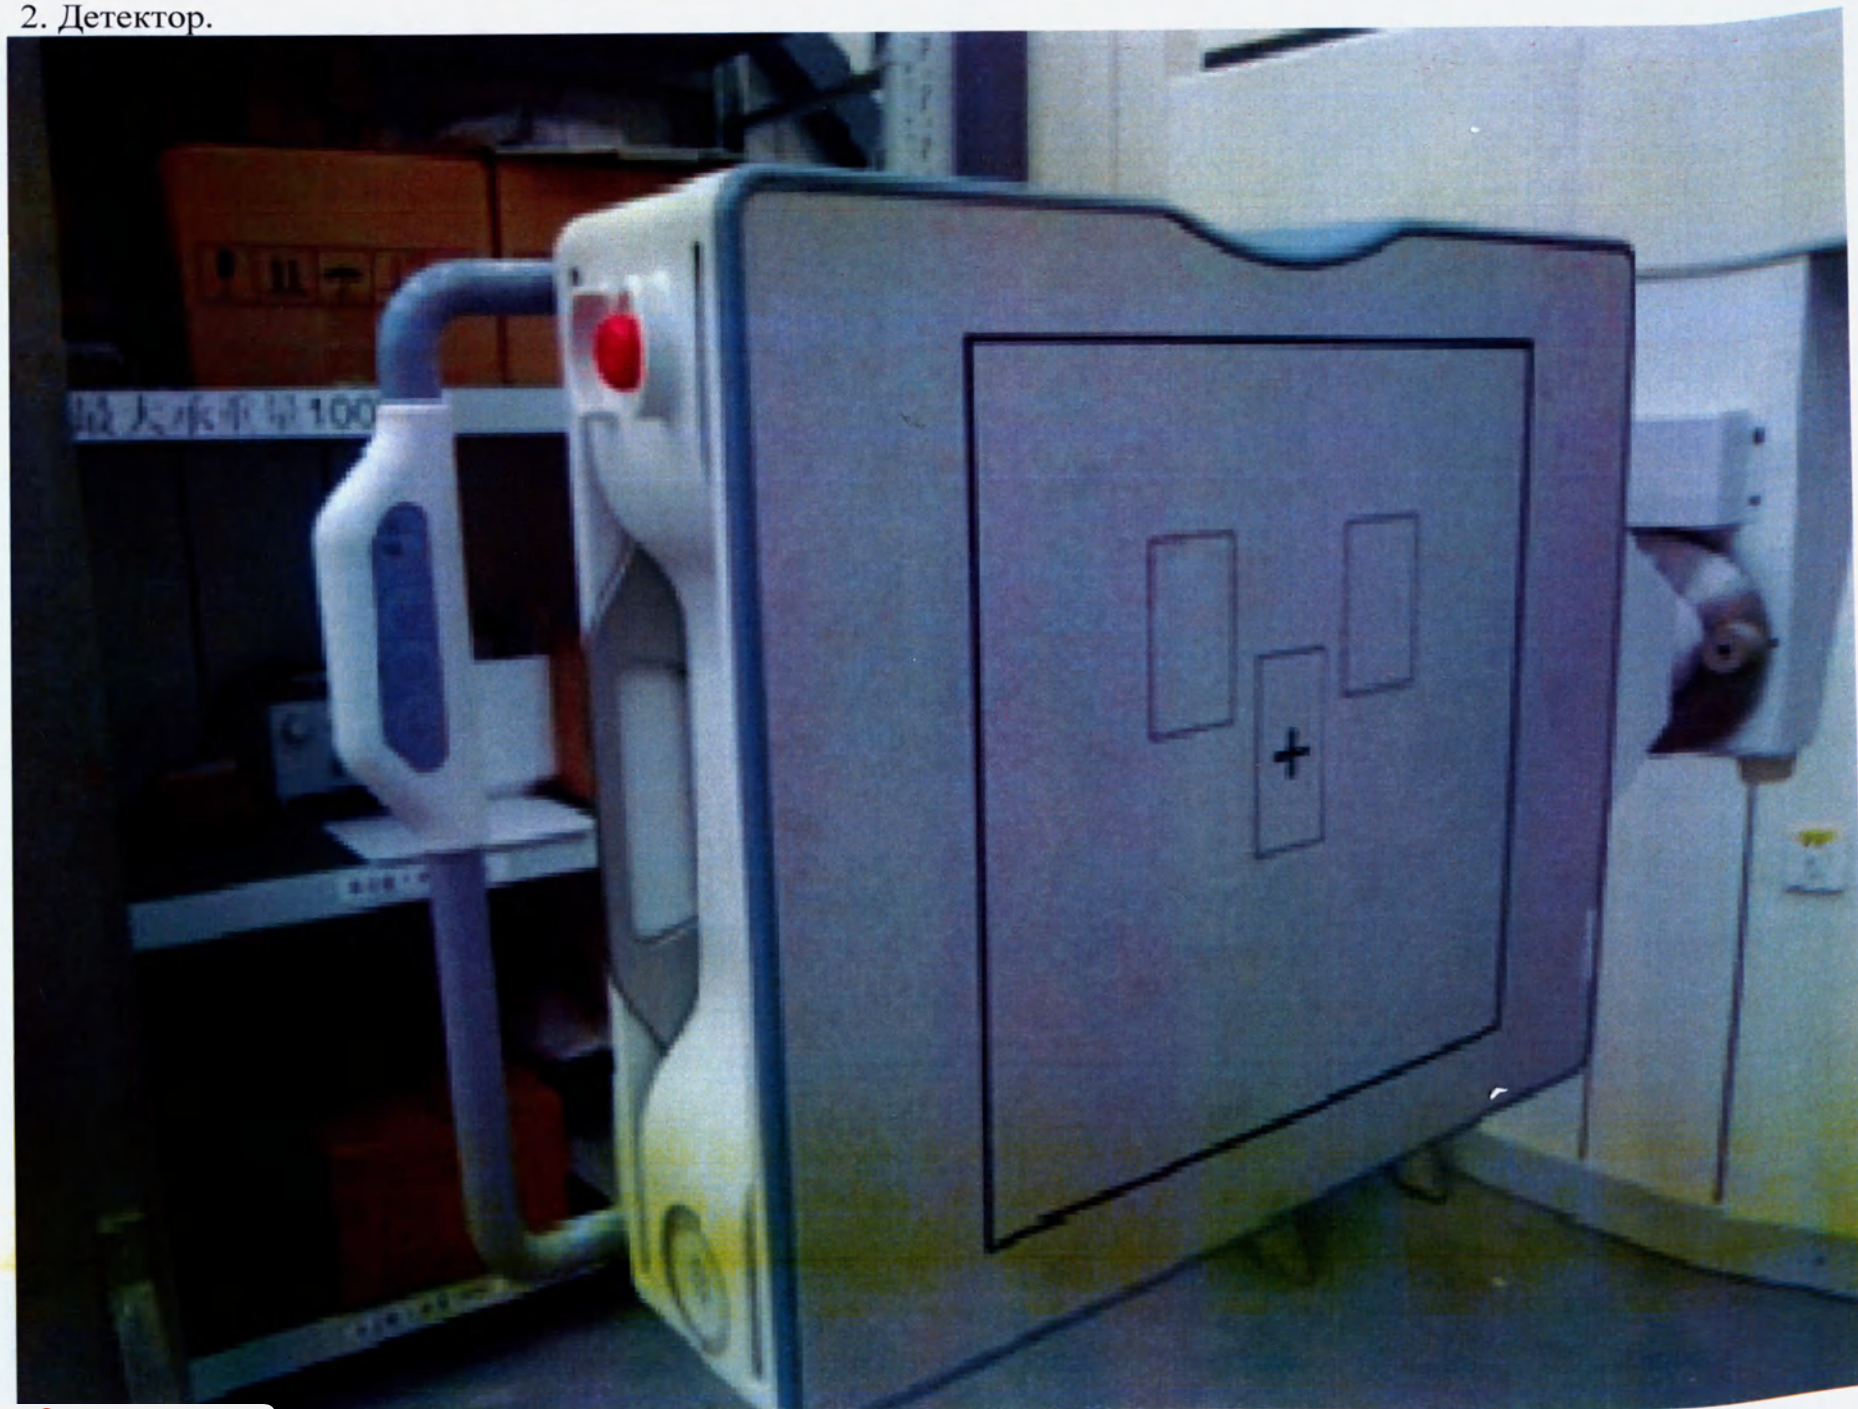


3. Пульт управления системой.



4. Рентгеновская трубка.




5. С-дуга.

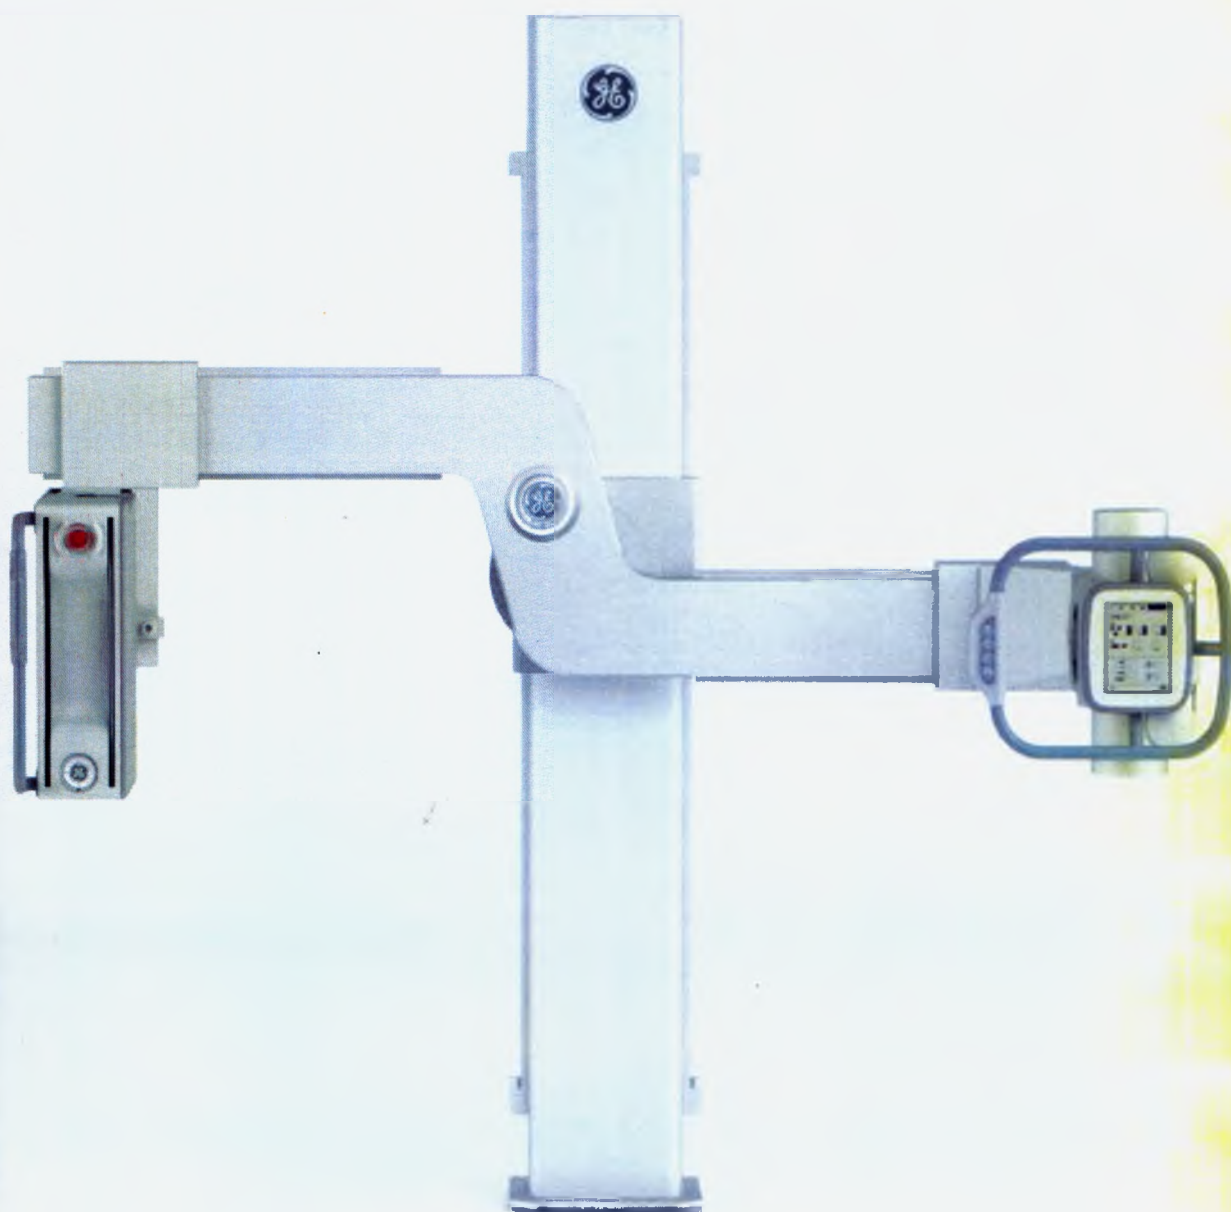

6. Коллиматор.



7. Рабочая станция для сбора и анализа полученных изображений.

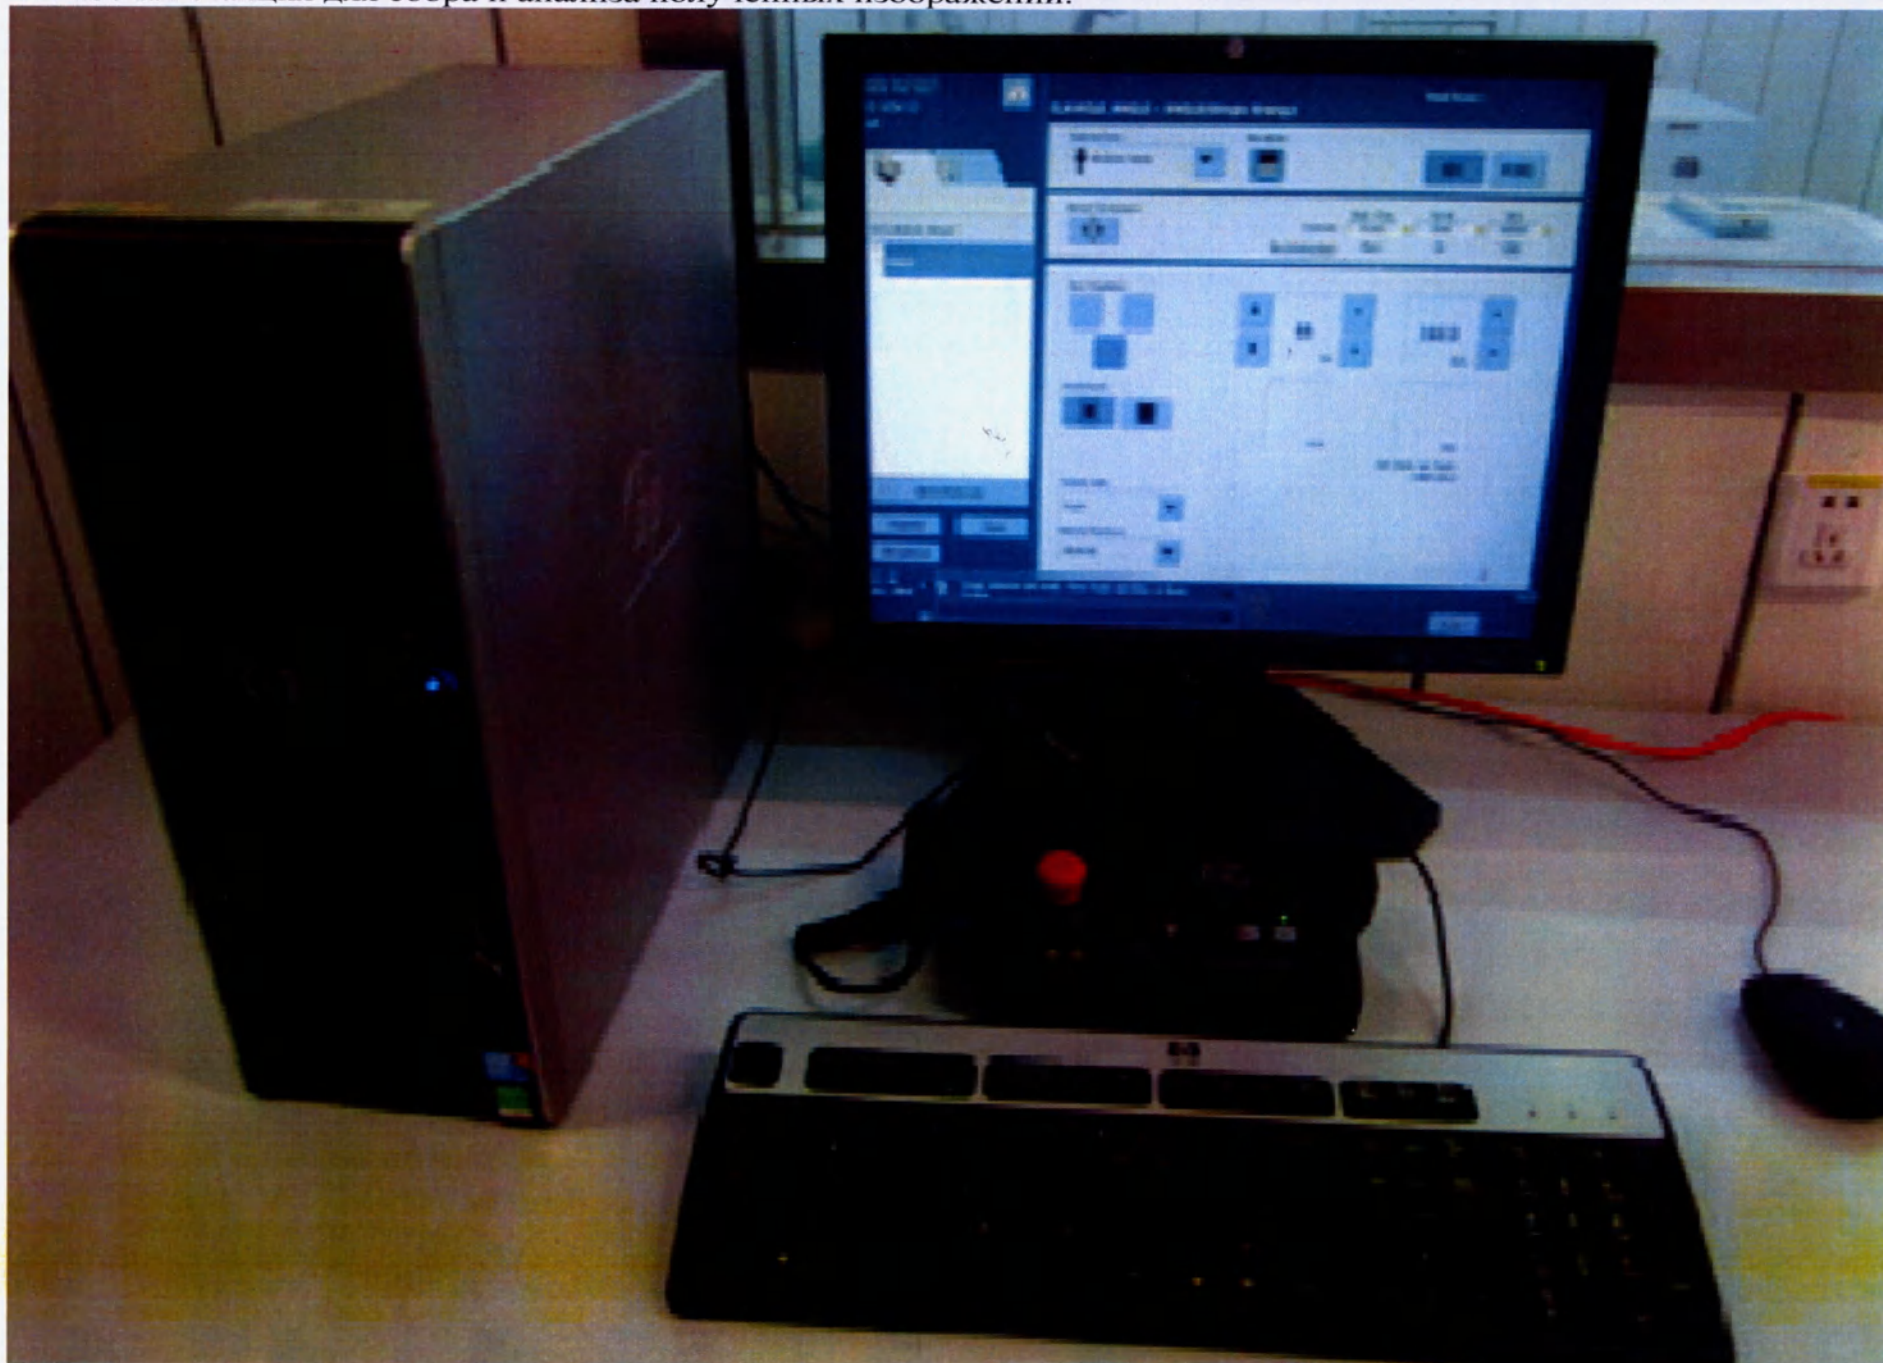


1. Буквенно-цифровые клавиатуры (не более 5 шт.)




2. Индикатор дозы экспозиции.




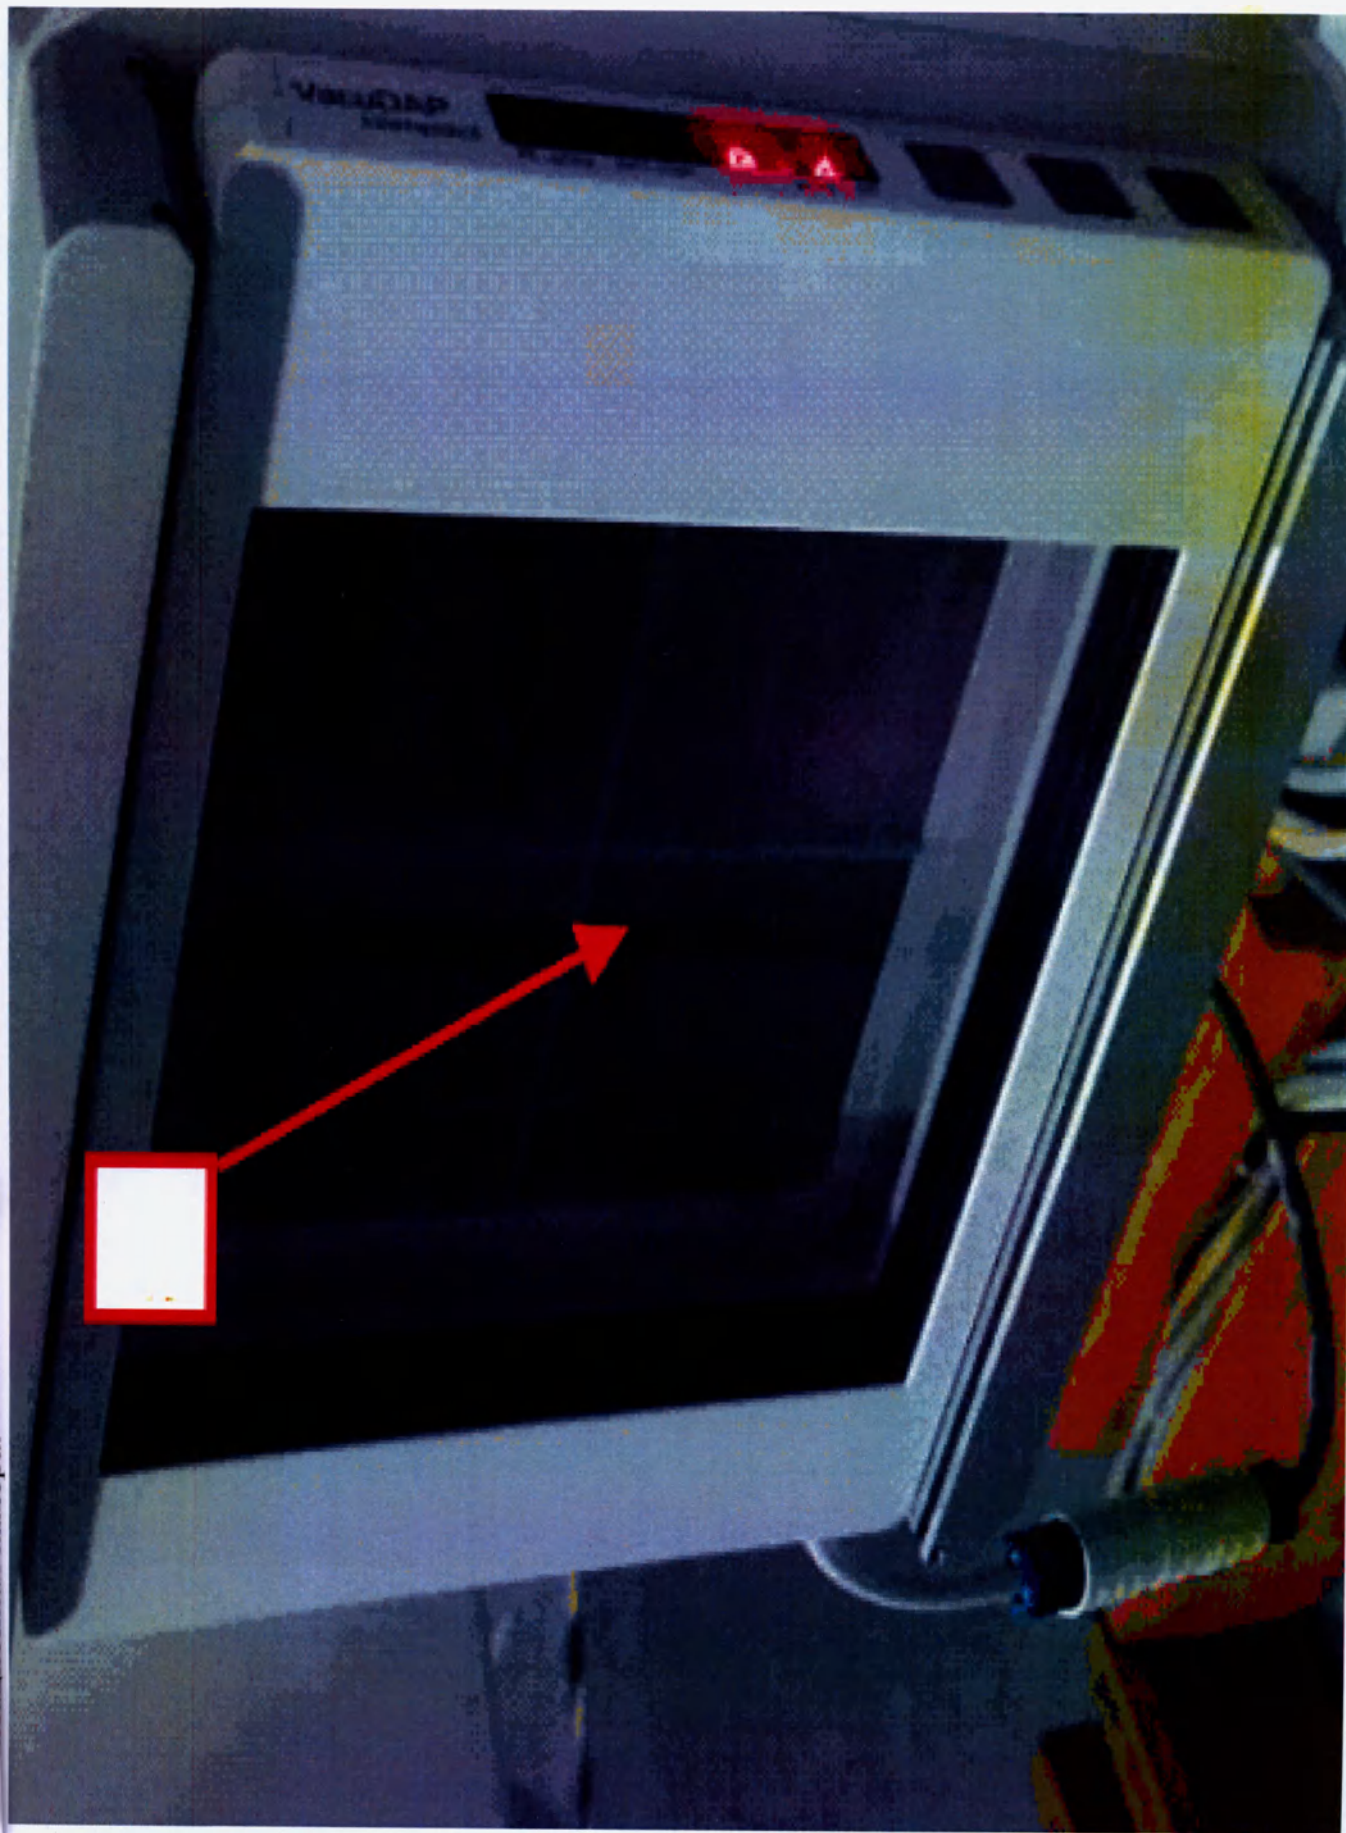


4. Кабели высоковольтные (не более 10 шт.)

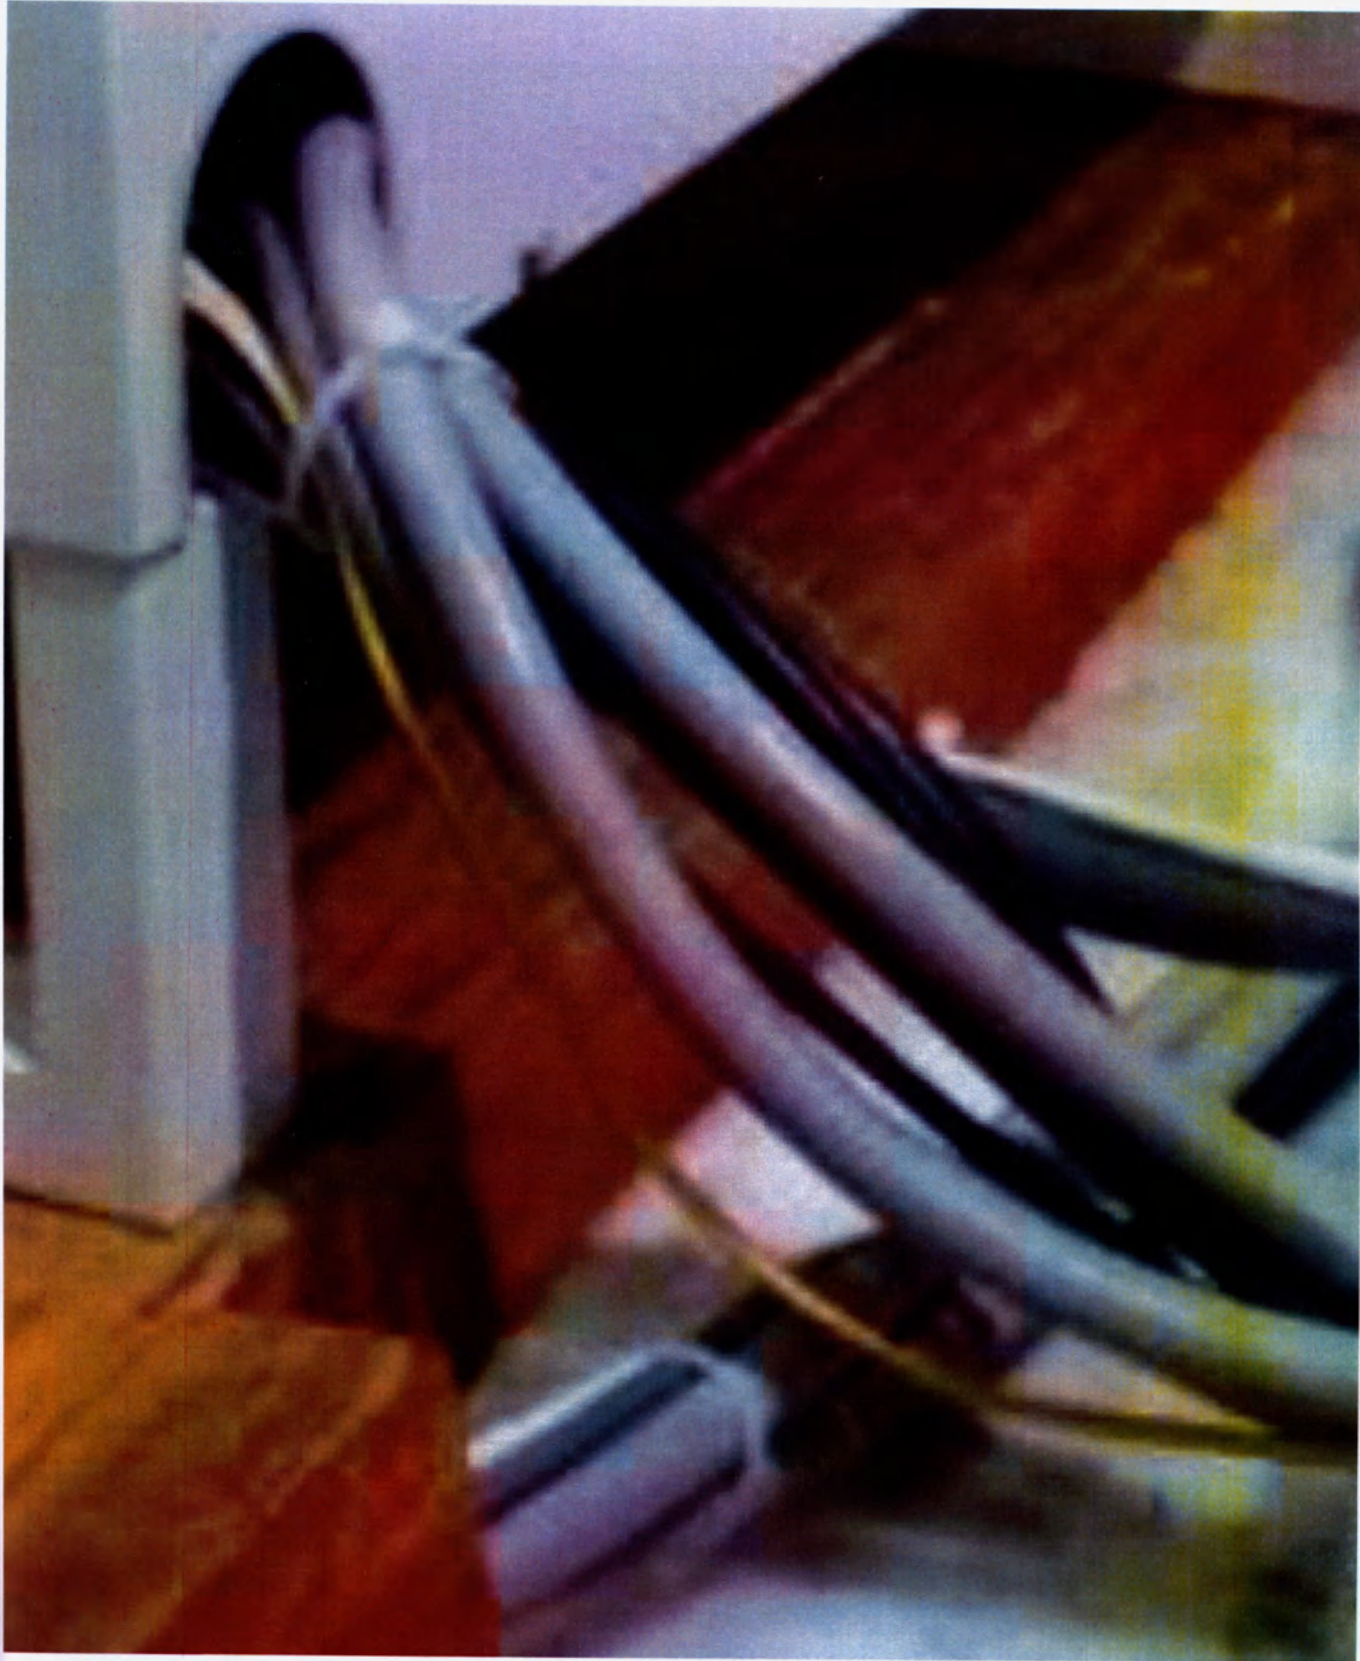


5. Кабели для подключения (не более 30 шт.)

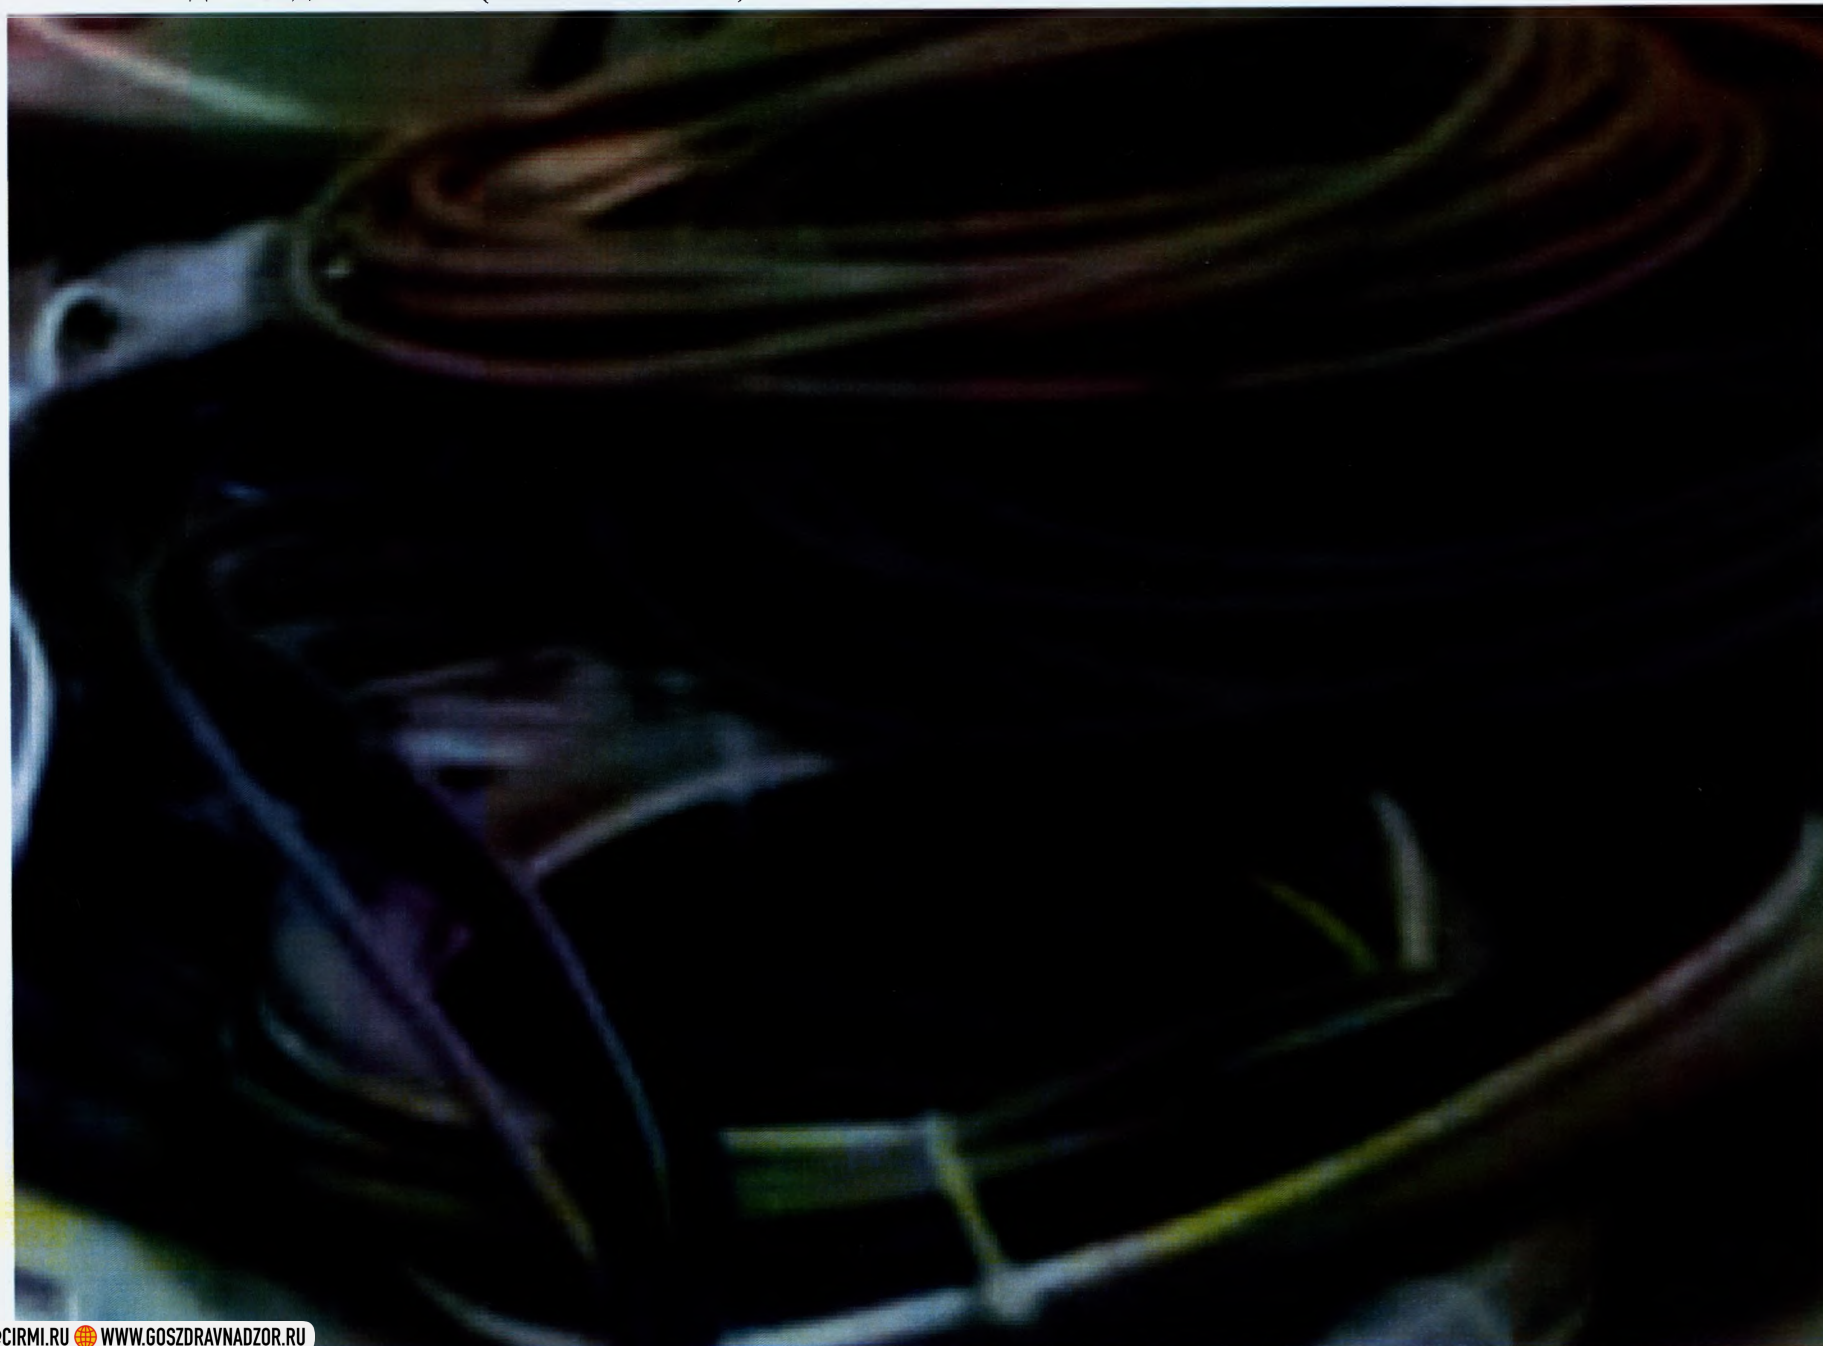


6. Ключи активации для программного обеспечения для визуализации полученных данных (не более 5 шт.)

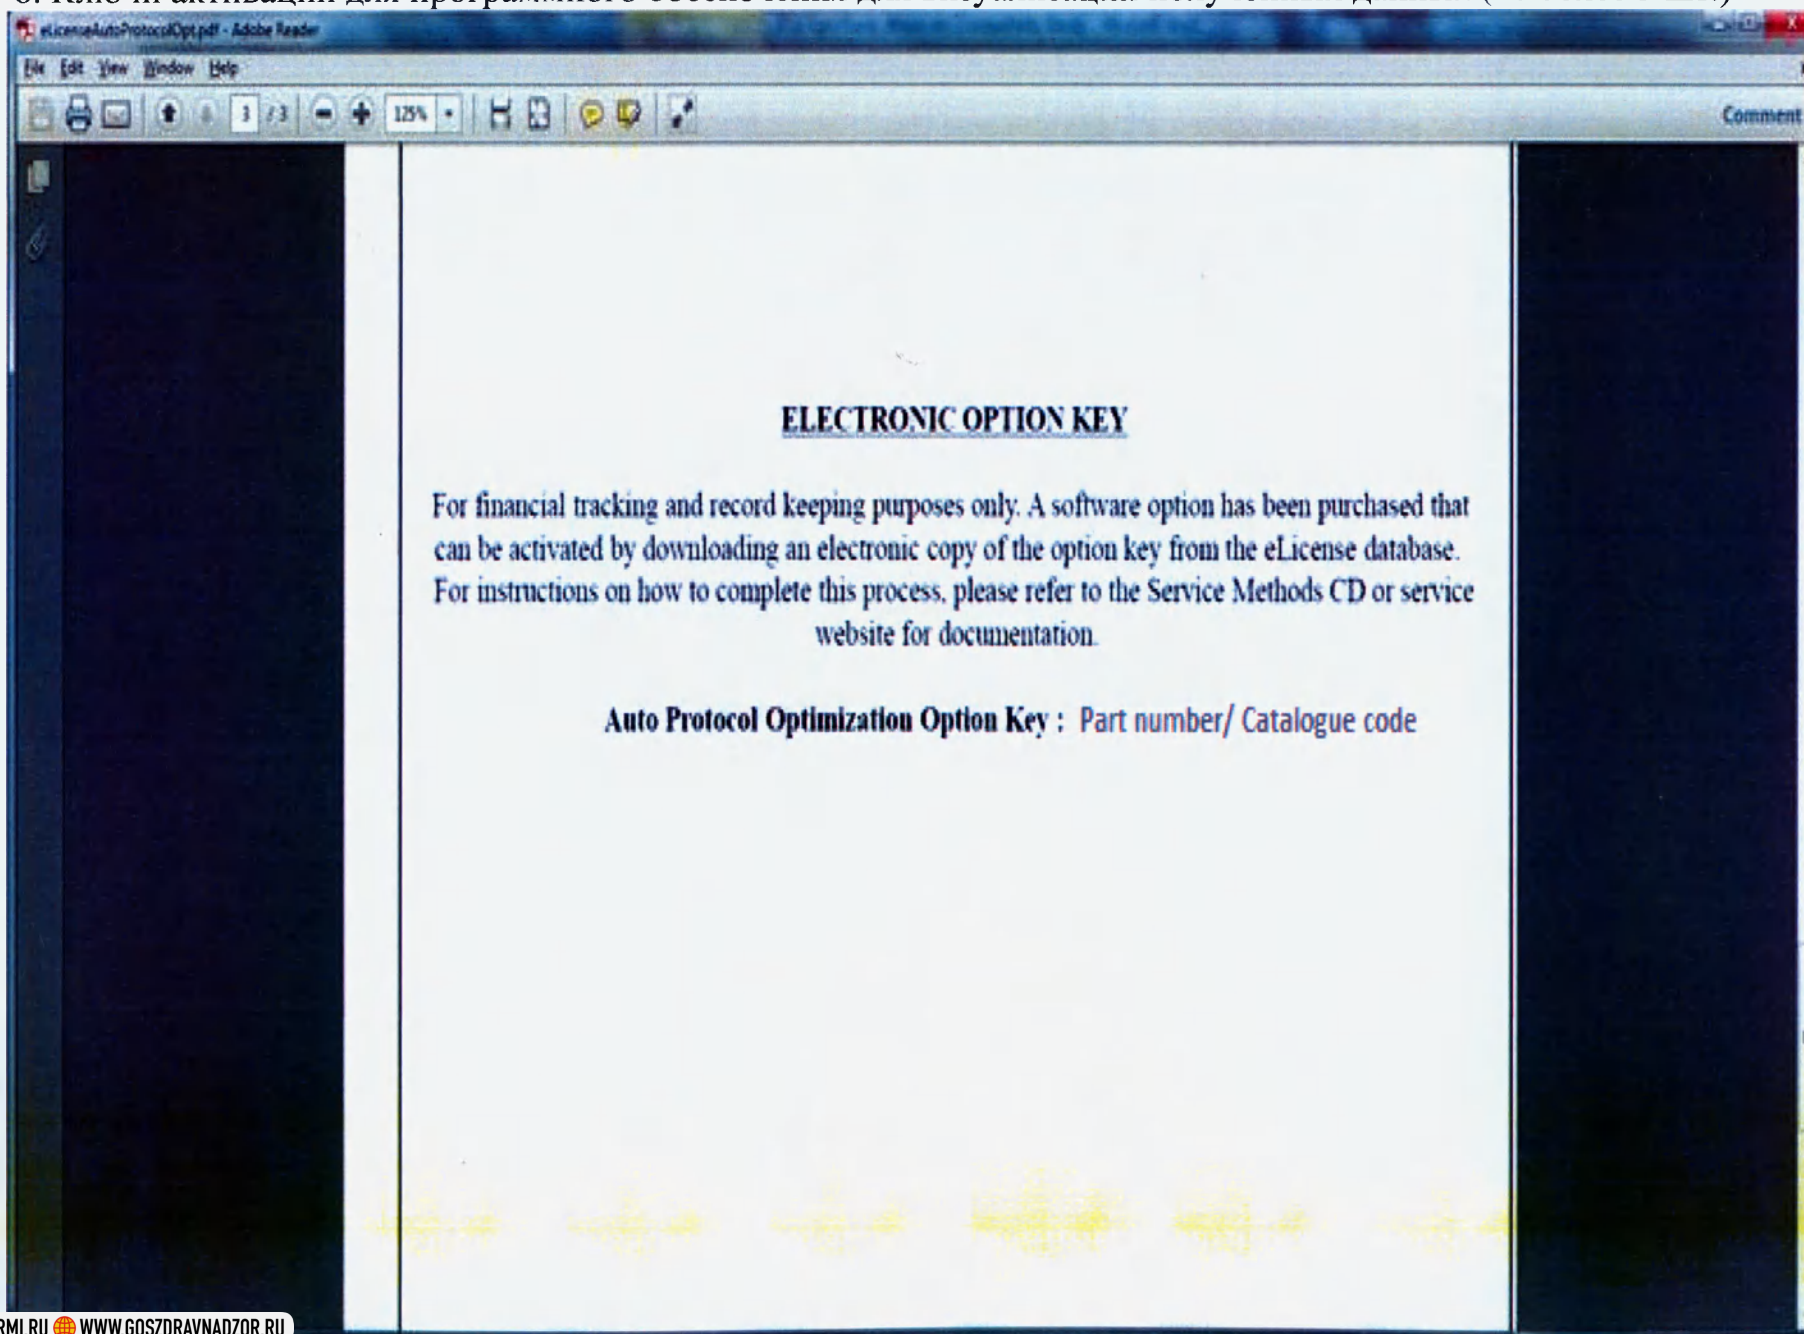


7. Ключи активации для программного обеспечения для исследований (не более 5 шт.)

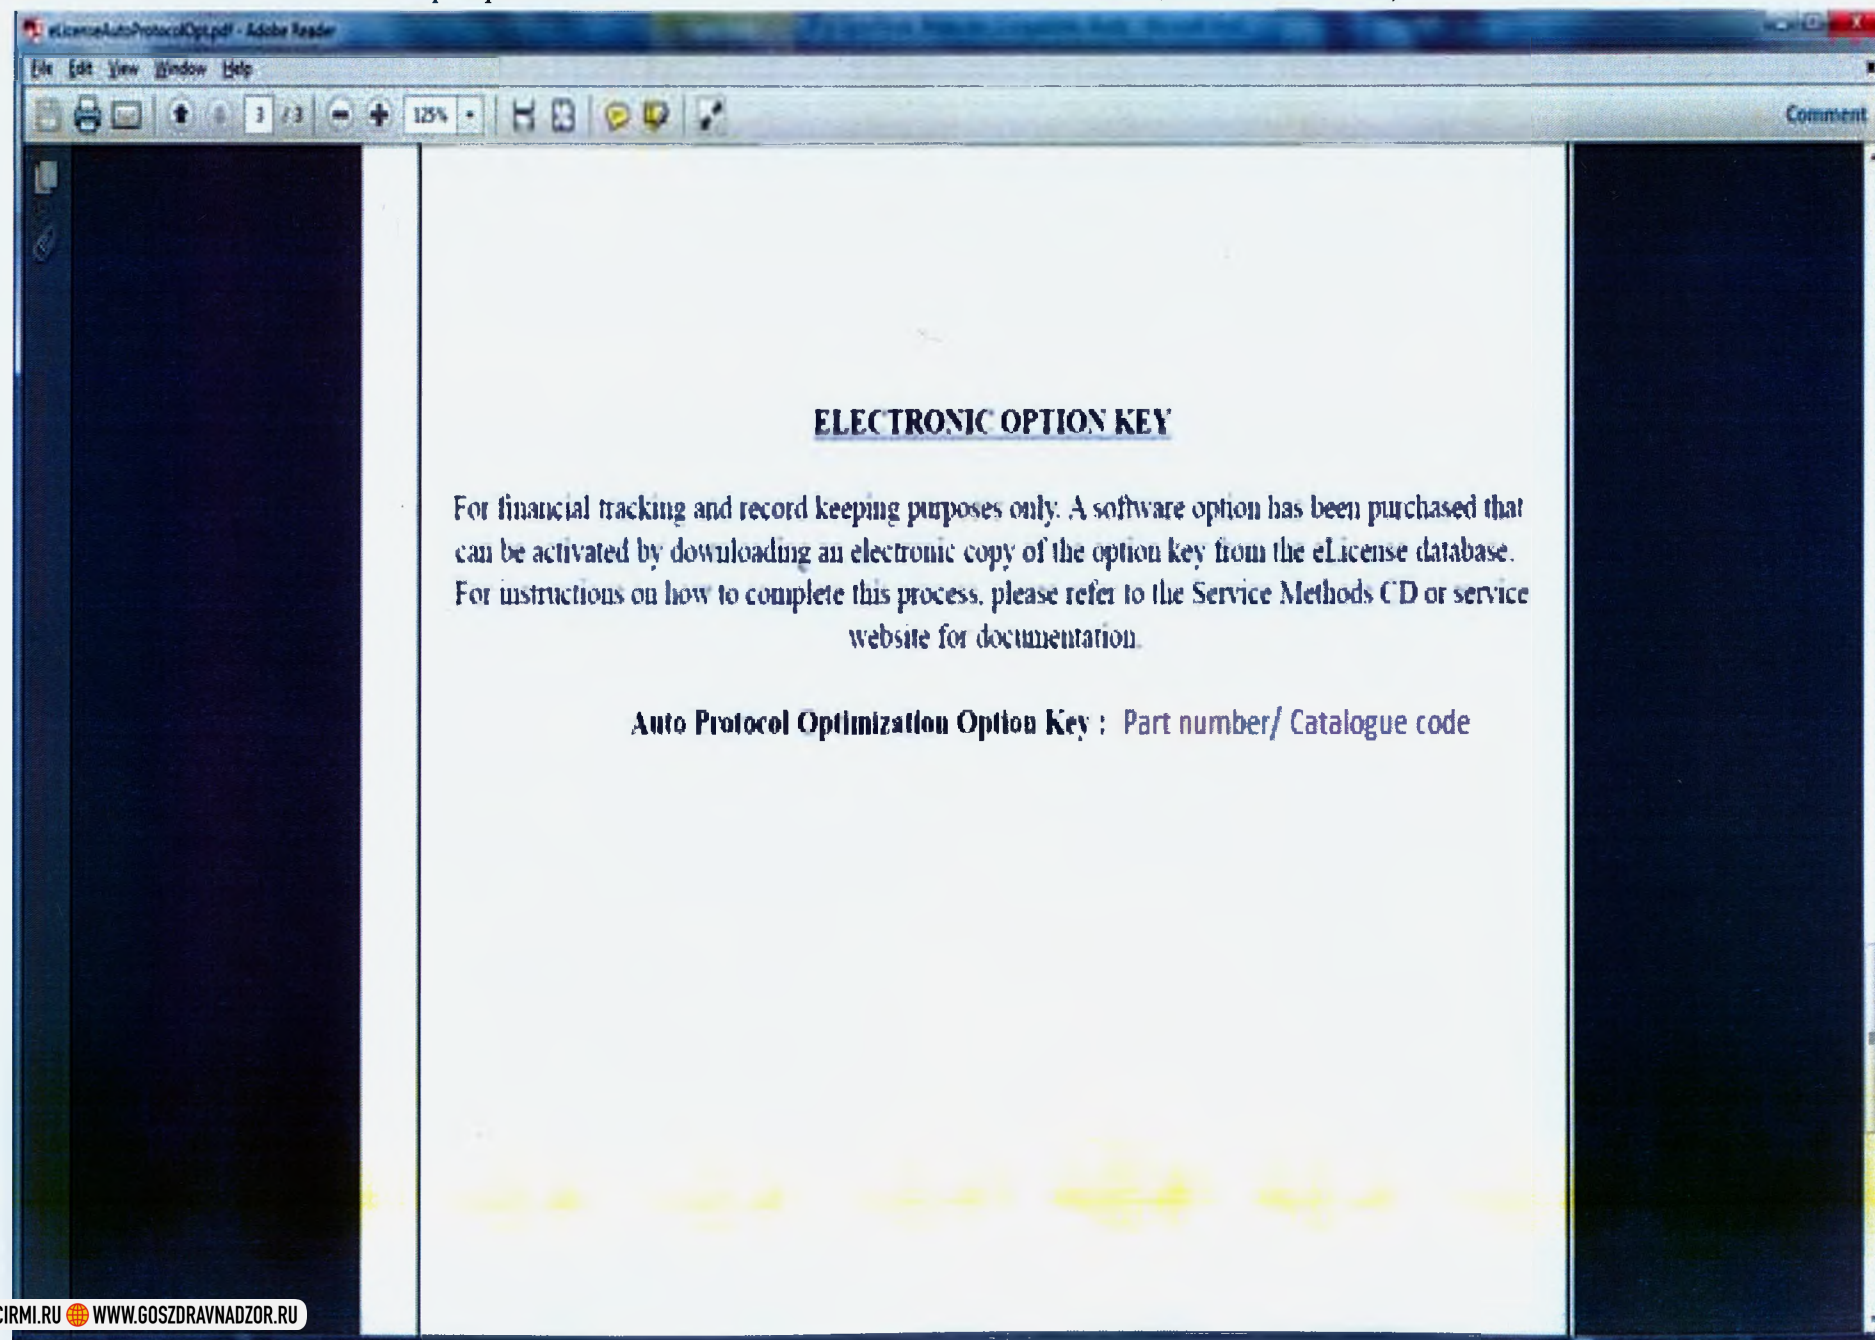


8. Ключи активации для программного обеспечения для поддержки формата DICOM (не более 5 шт.)

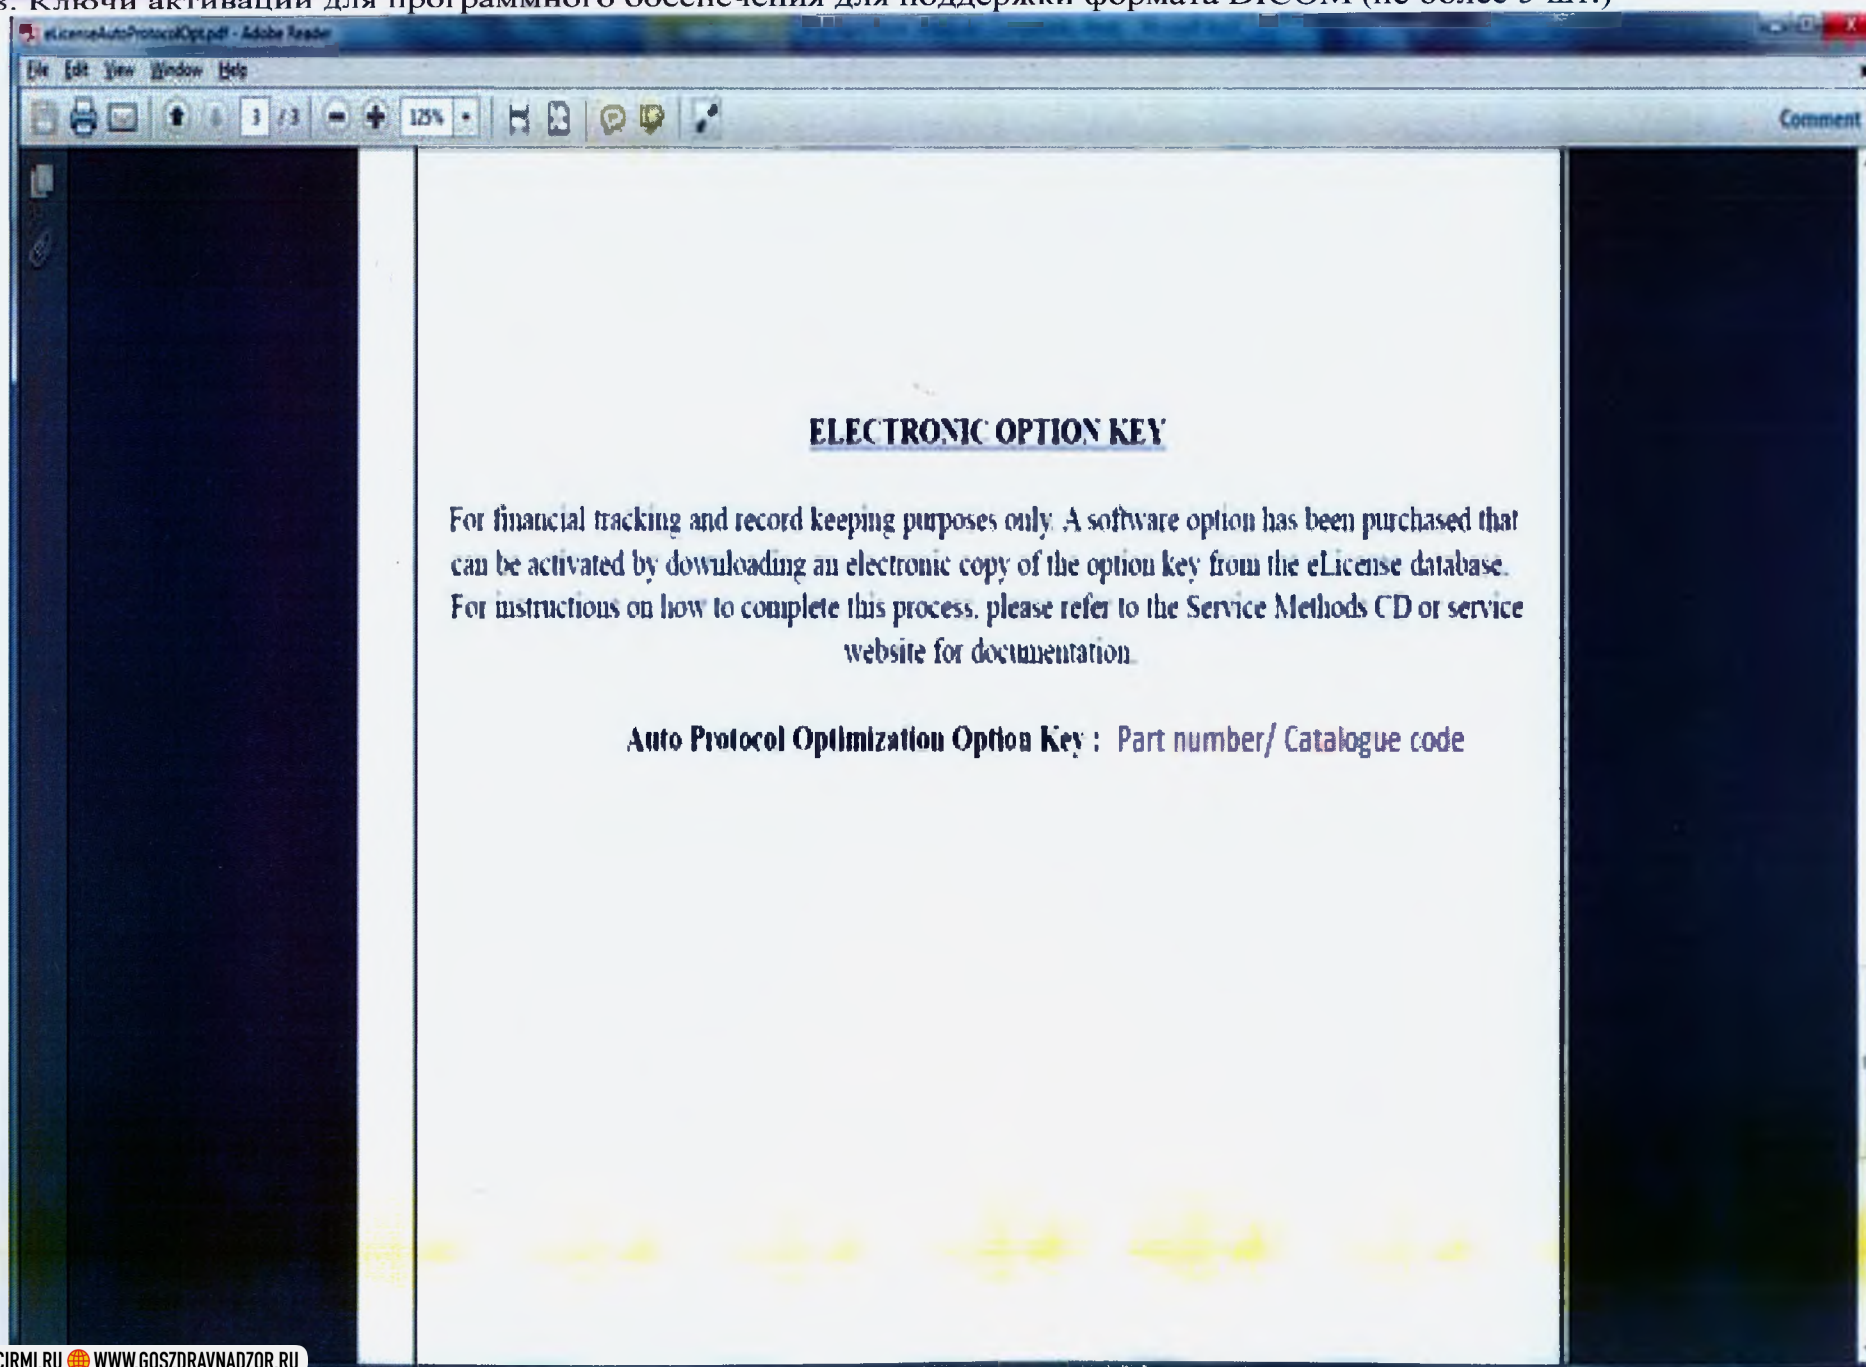


9. Ключи активации для программного обеспечения для реконструкции изображений (не более 5 шт.)

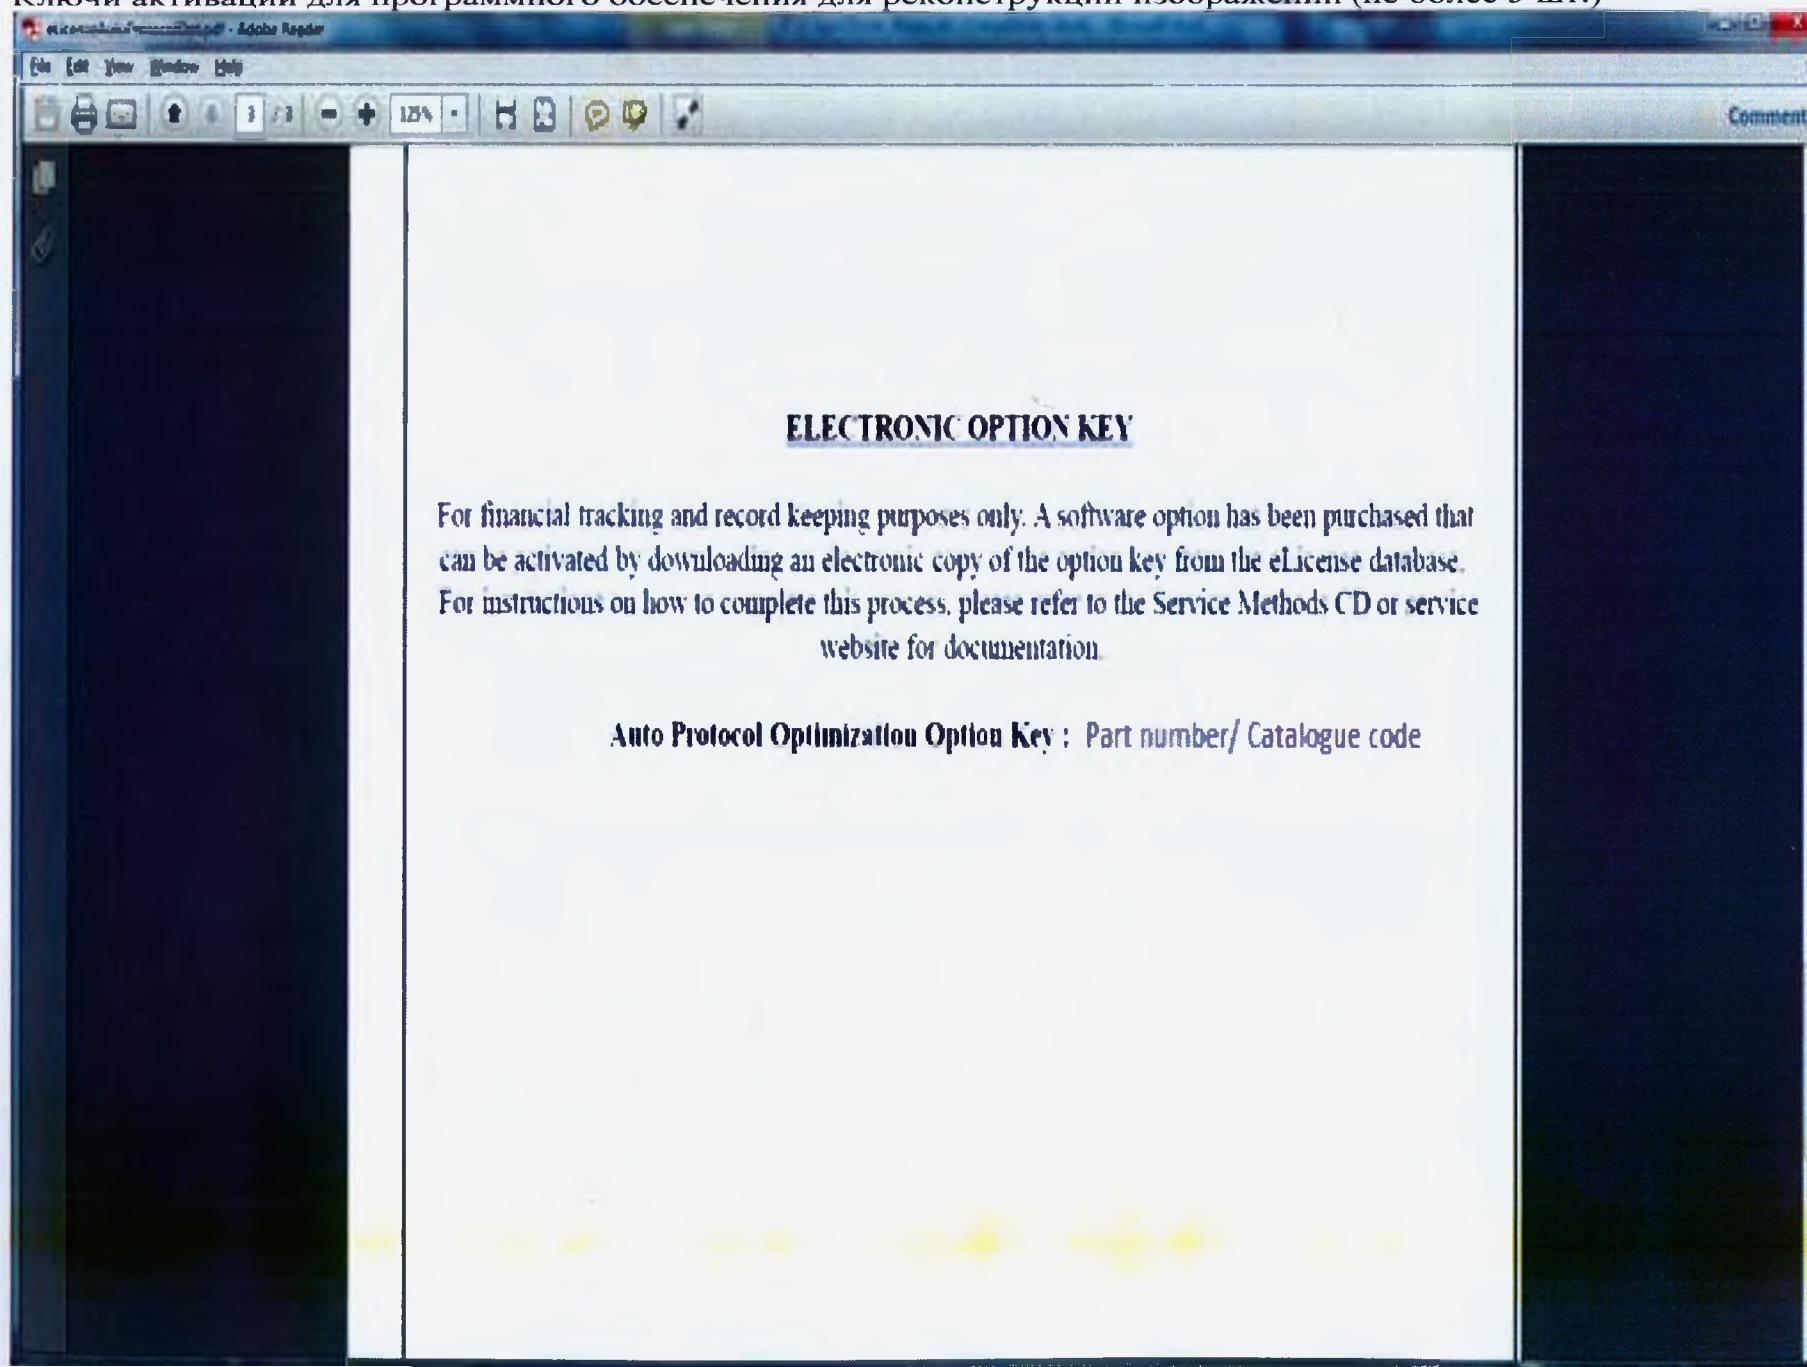


10. Ключи активации для программного обеспечения для сбора данных (не более 5 шт.)

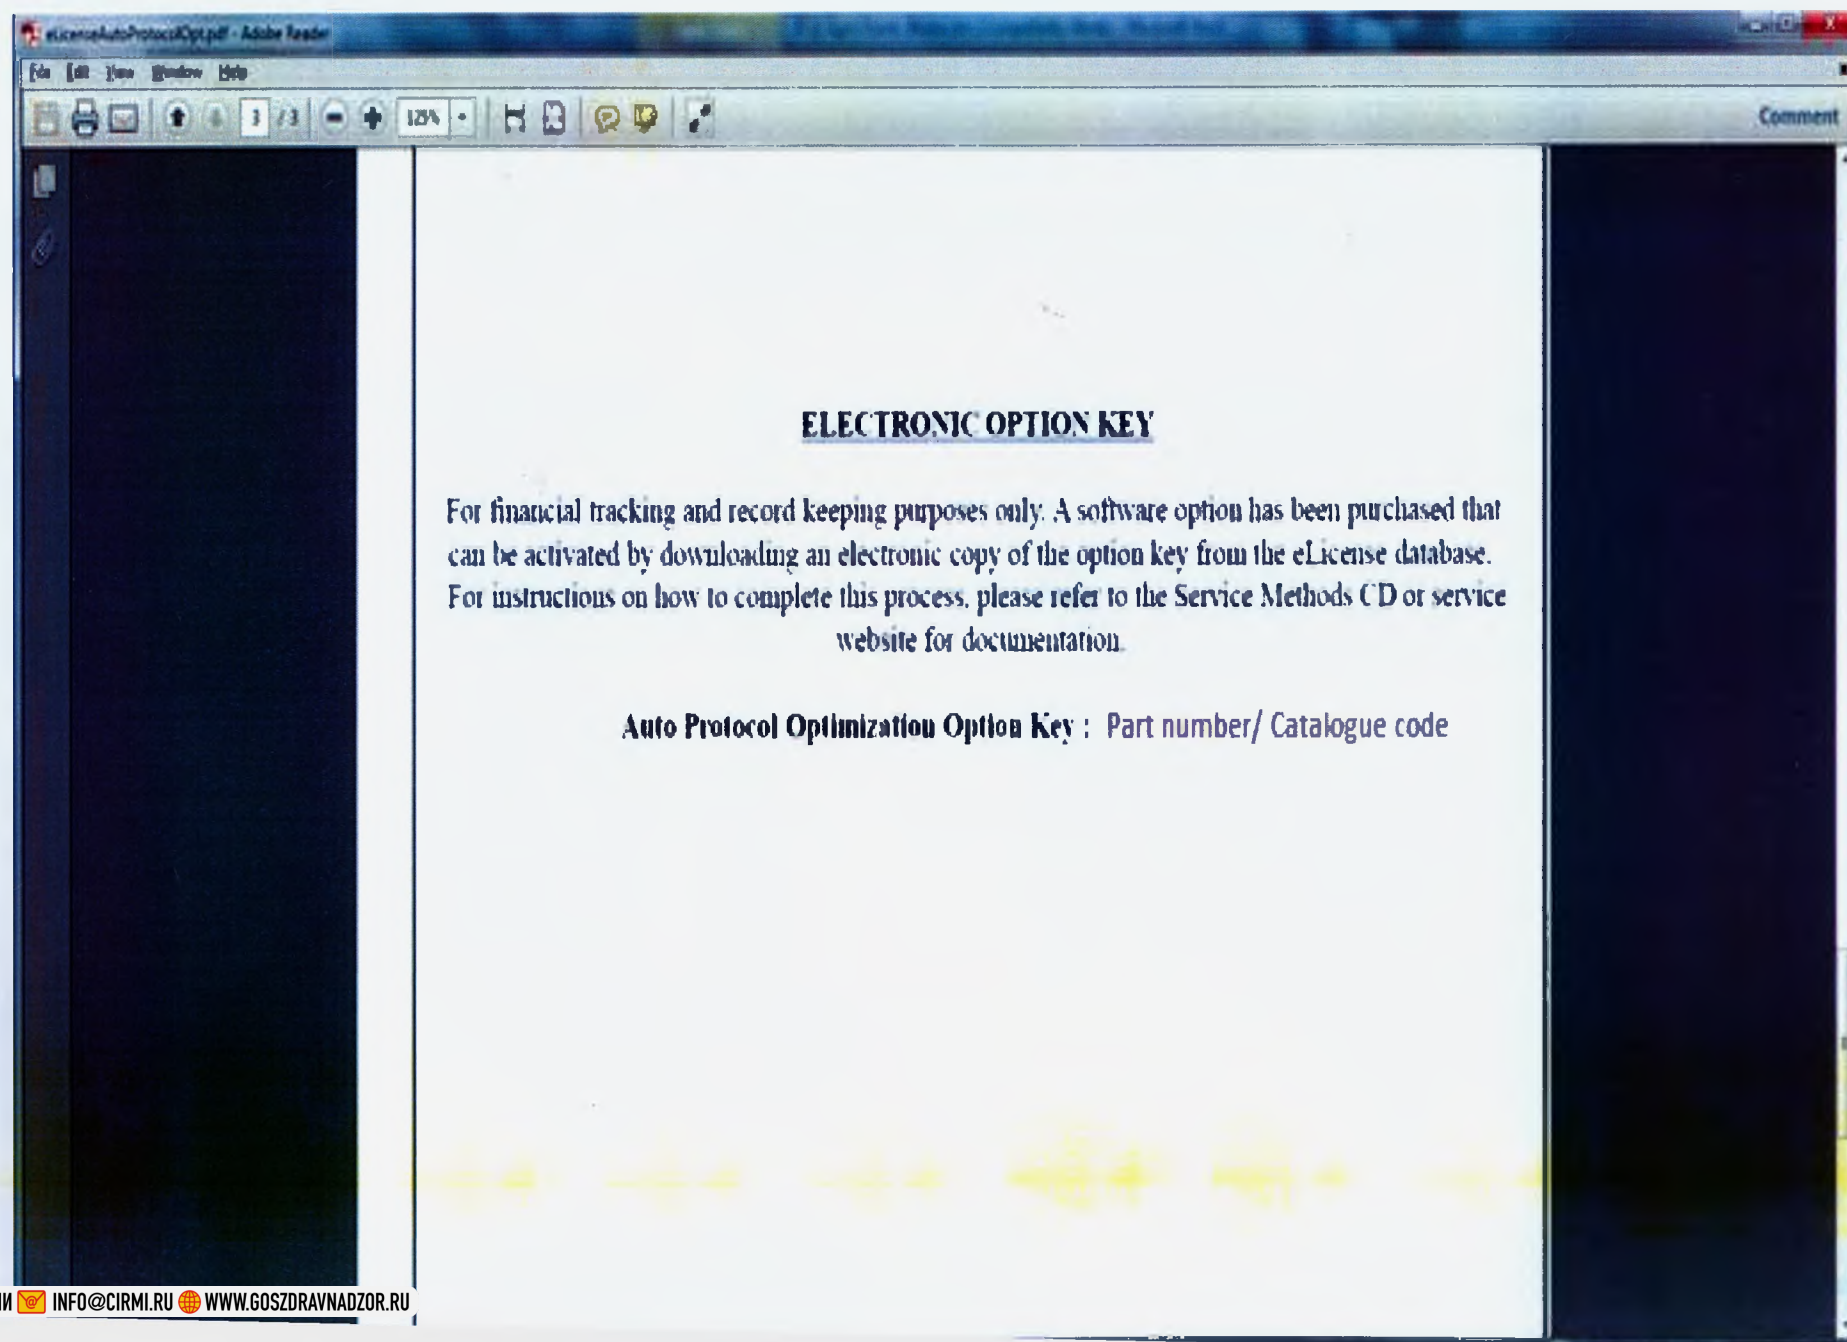


11. Компрессионные ремни (не более 5 шт.)

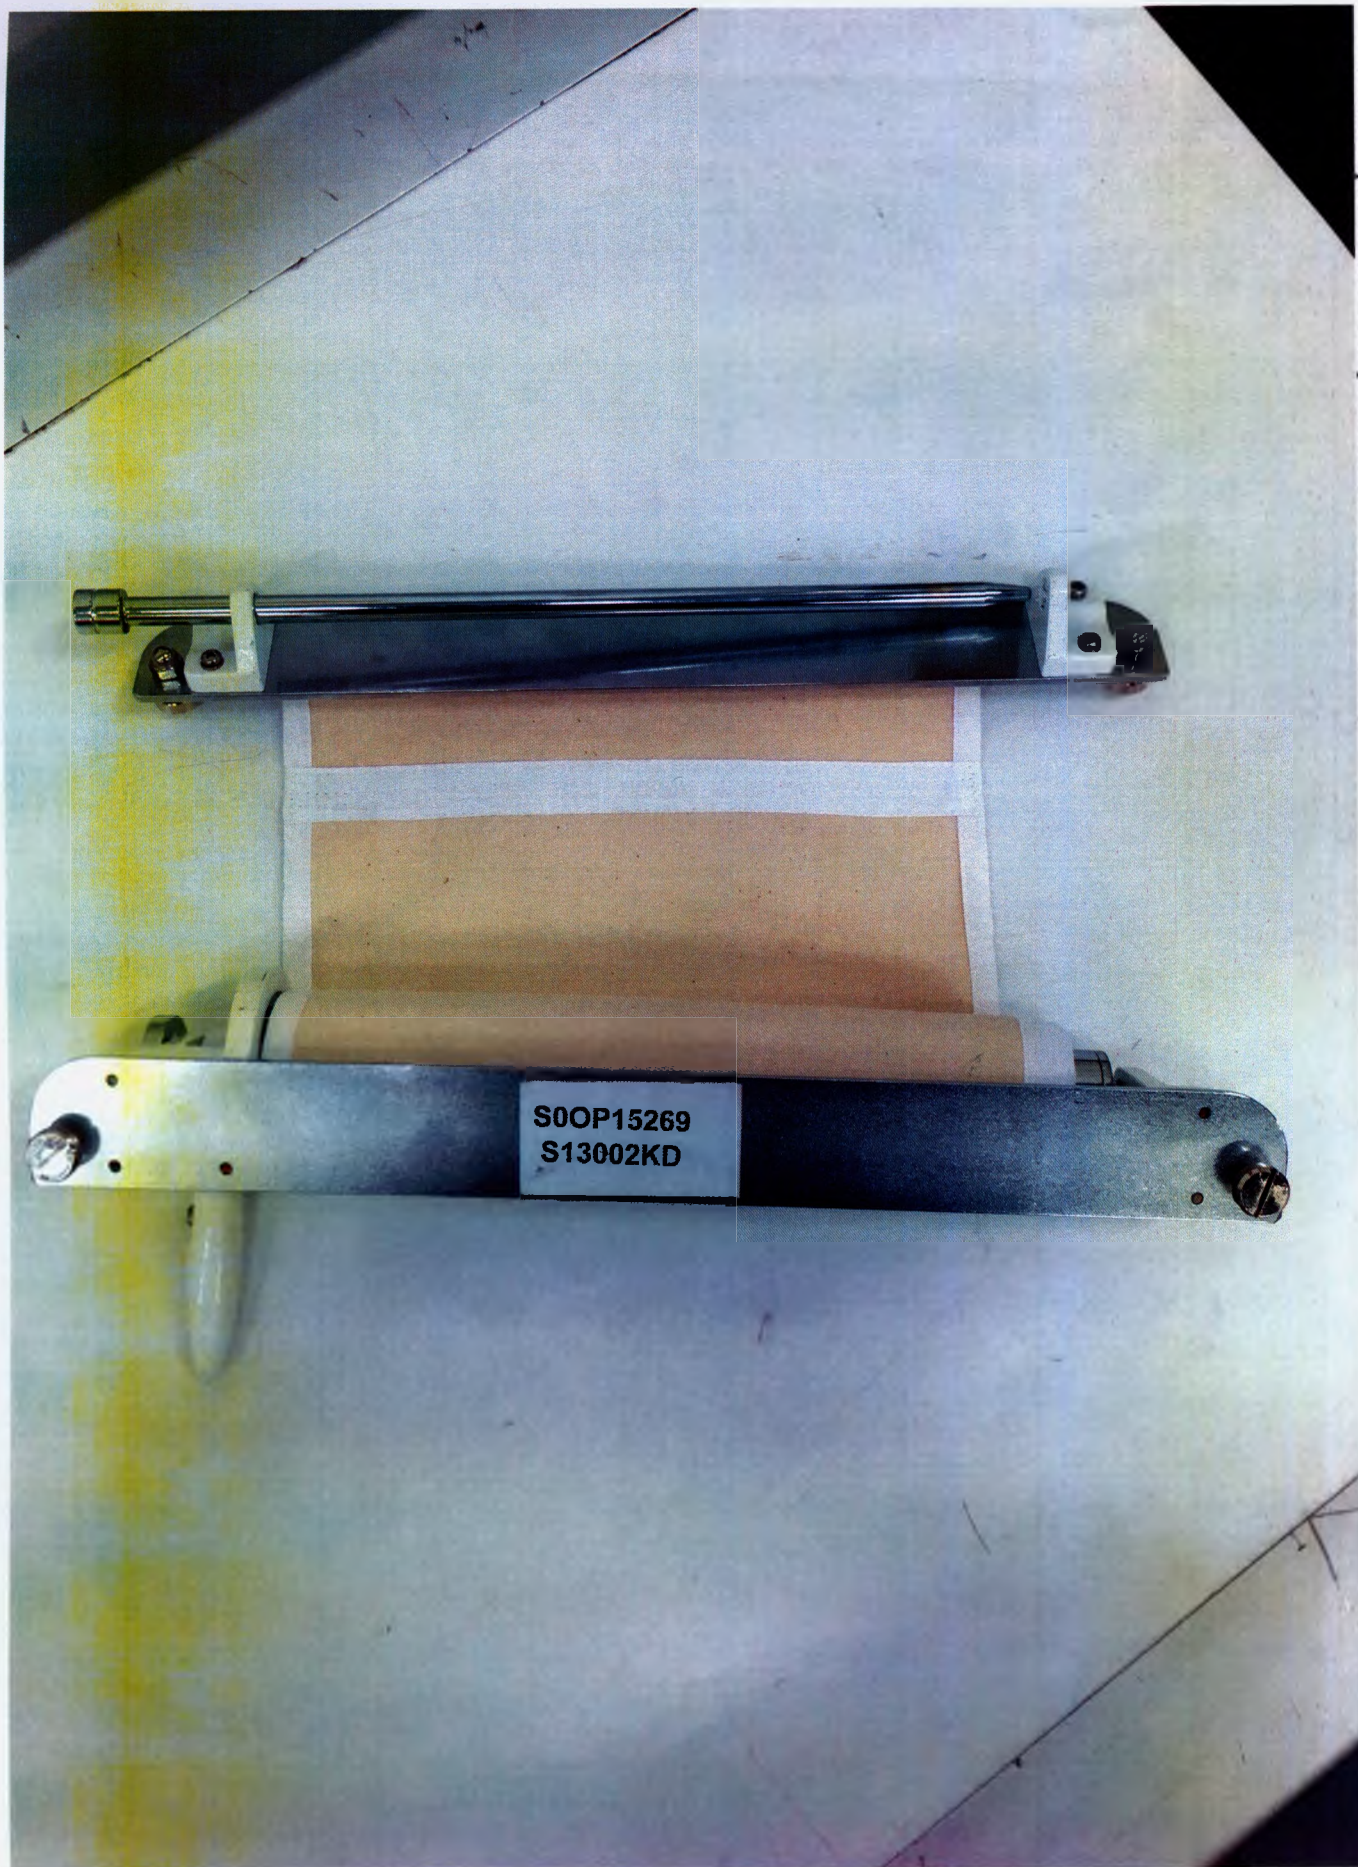


12. Мобильные рентгеновские столы (не более 5 шт.)

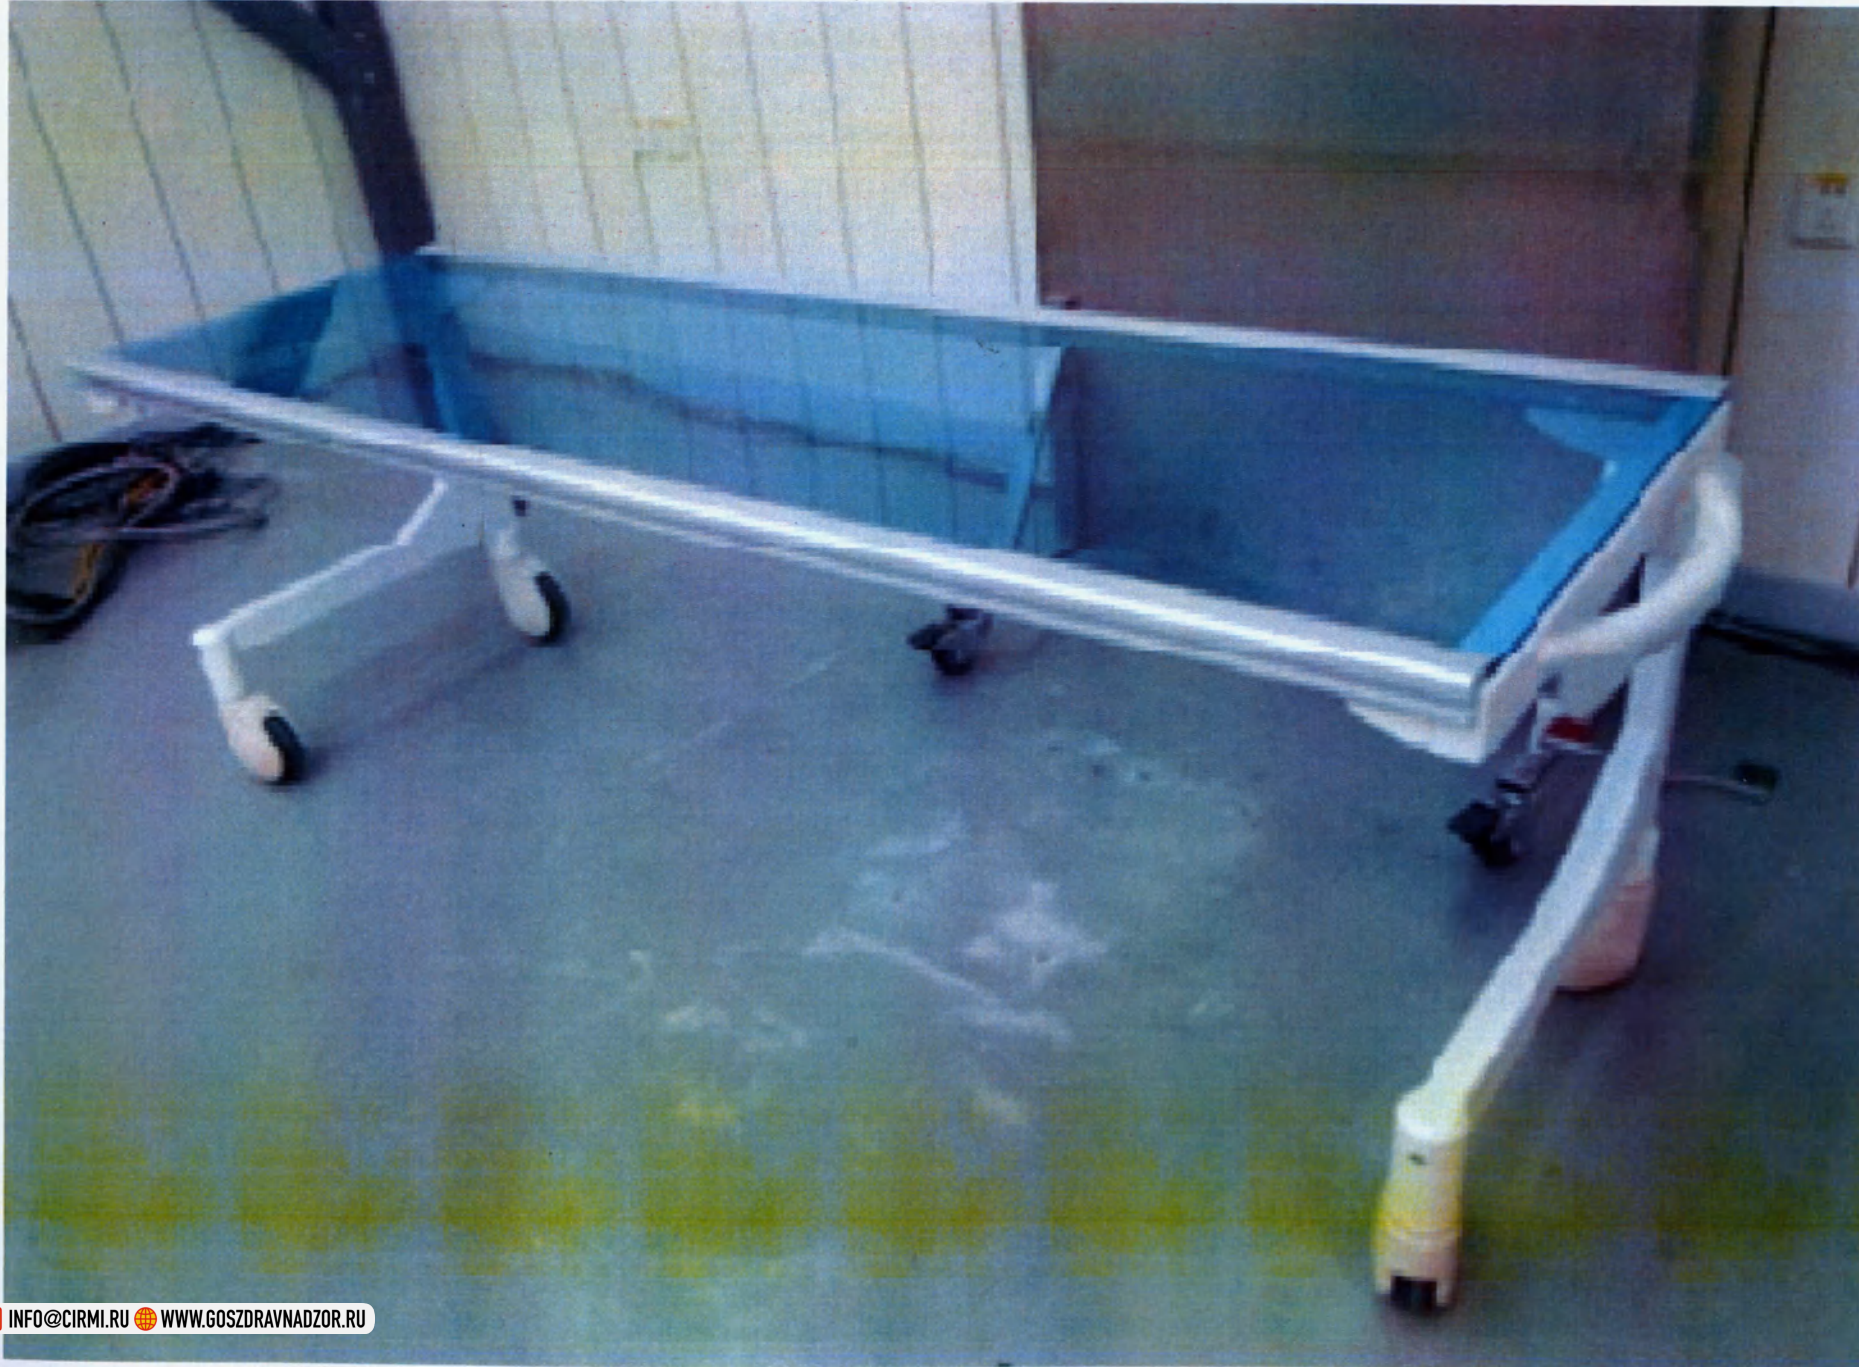

13. Мониторы для рабочей станции сбора медицинских данных (не более 5 шт.)

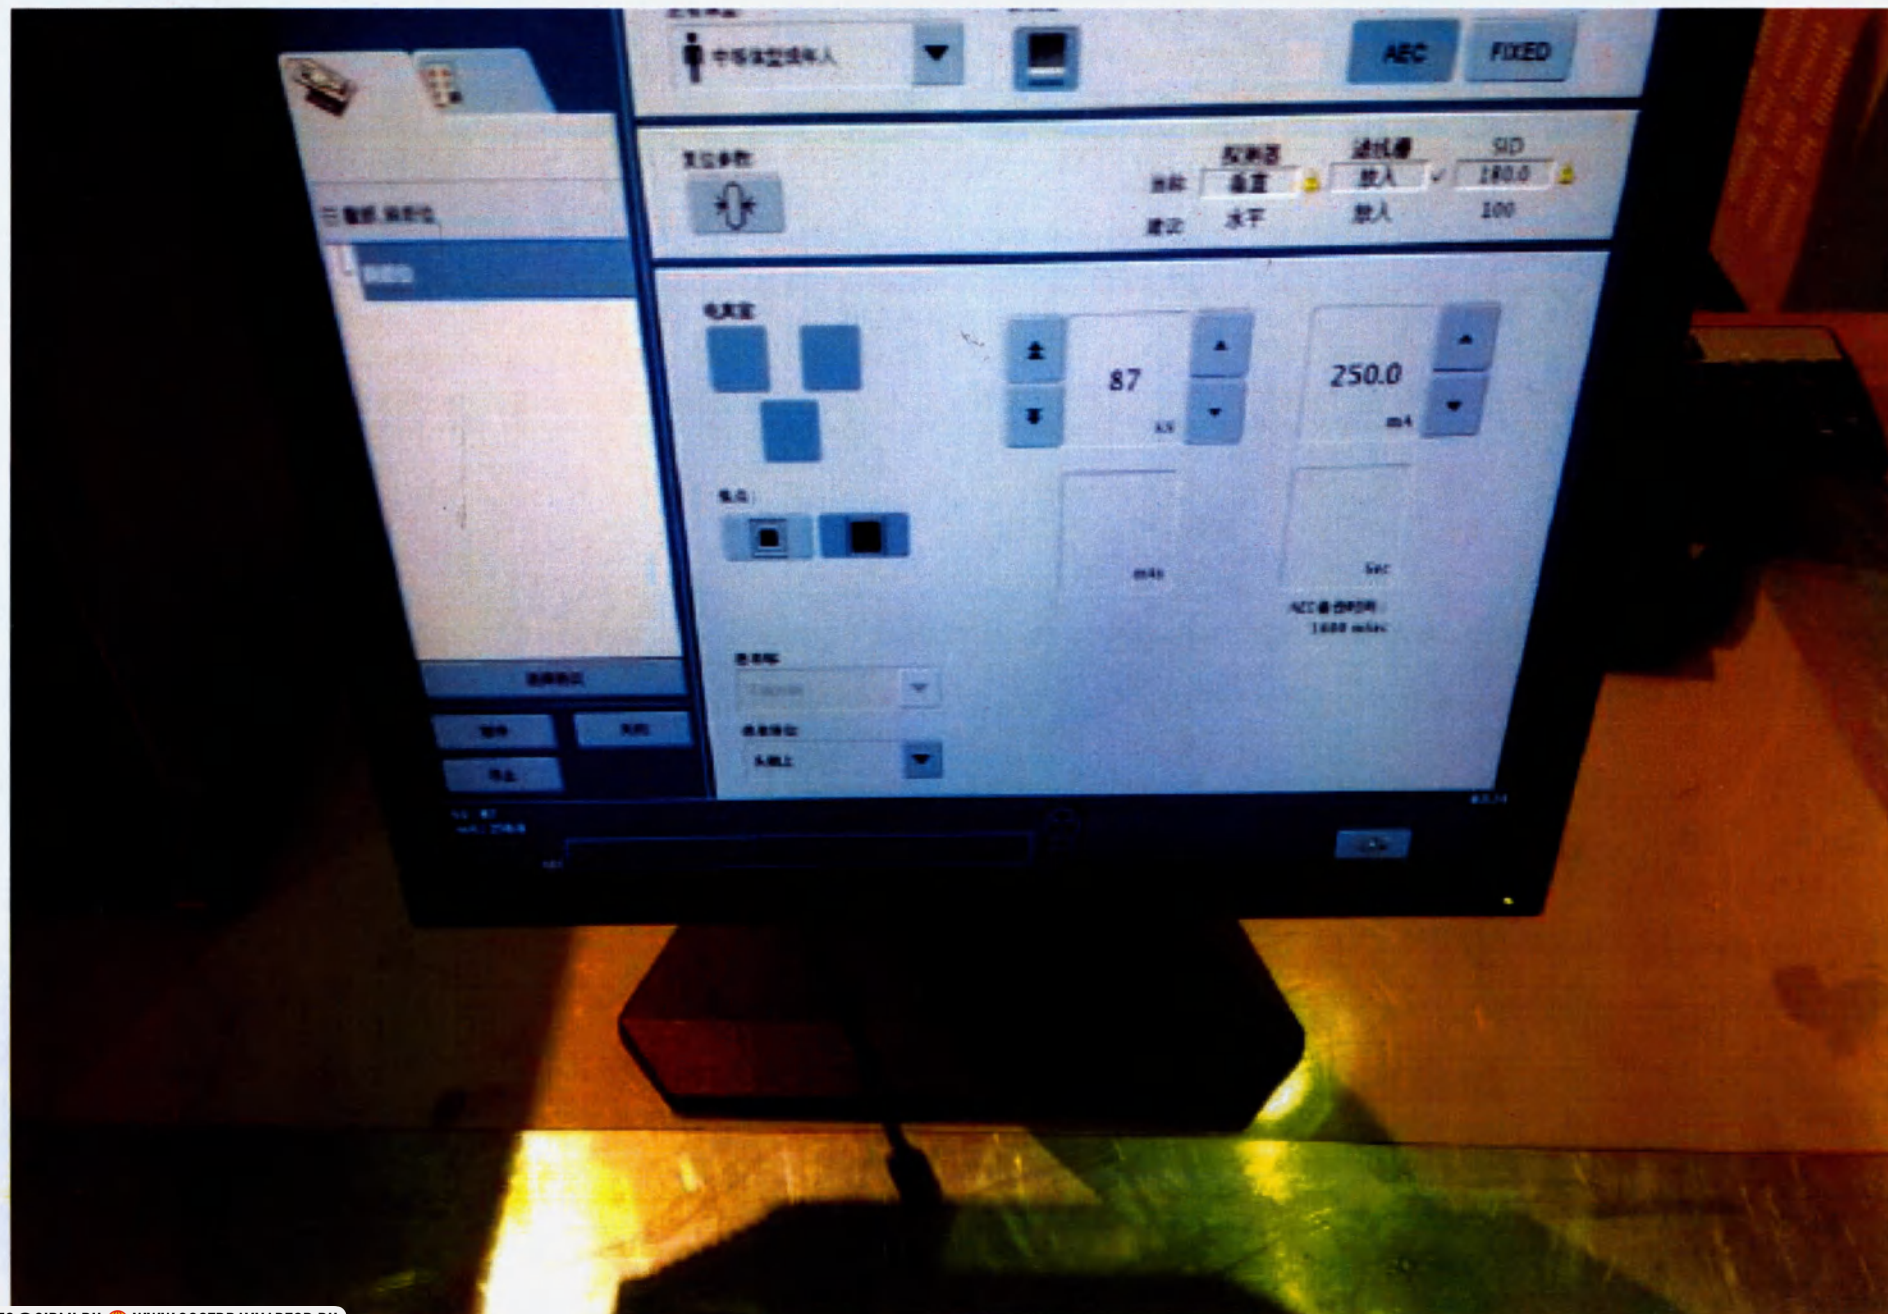

14. Мыши (не более 5 шт.)

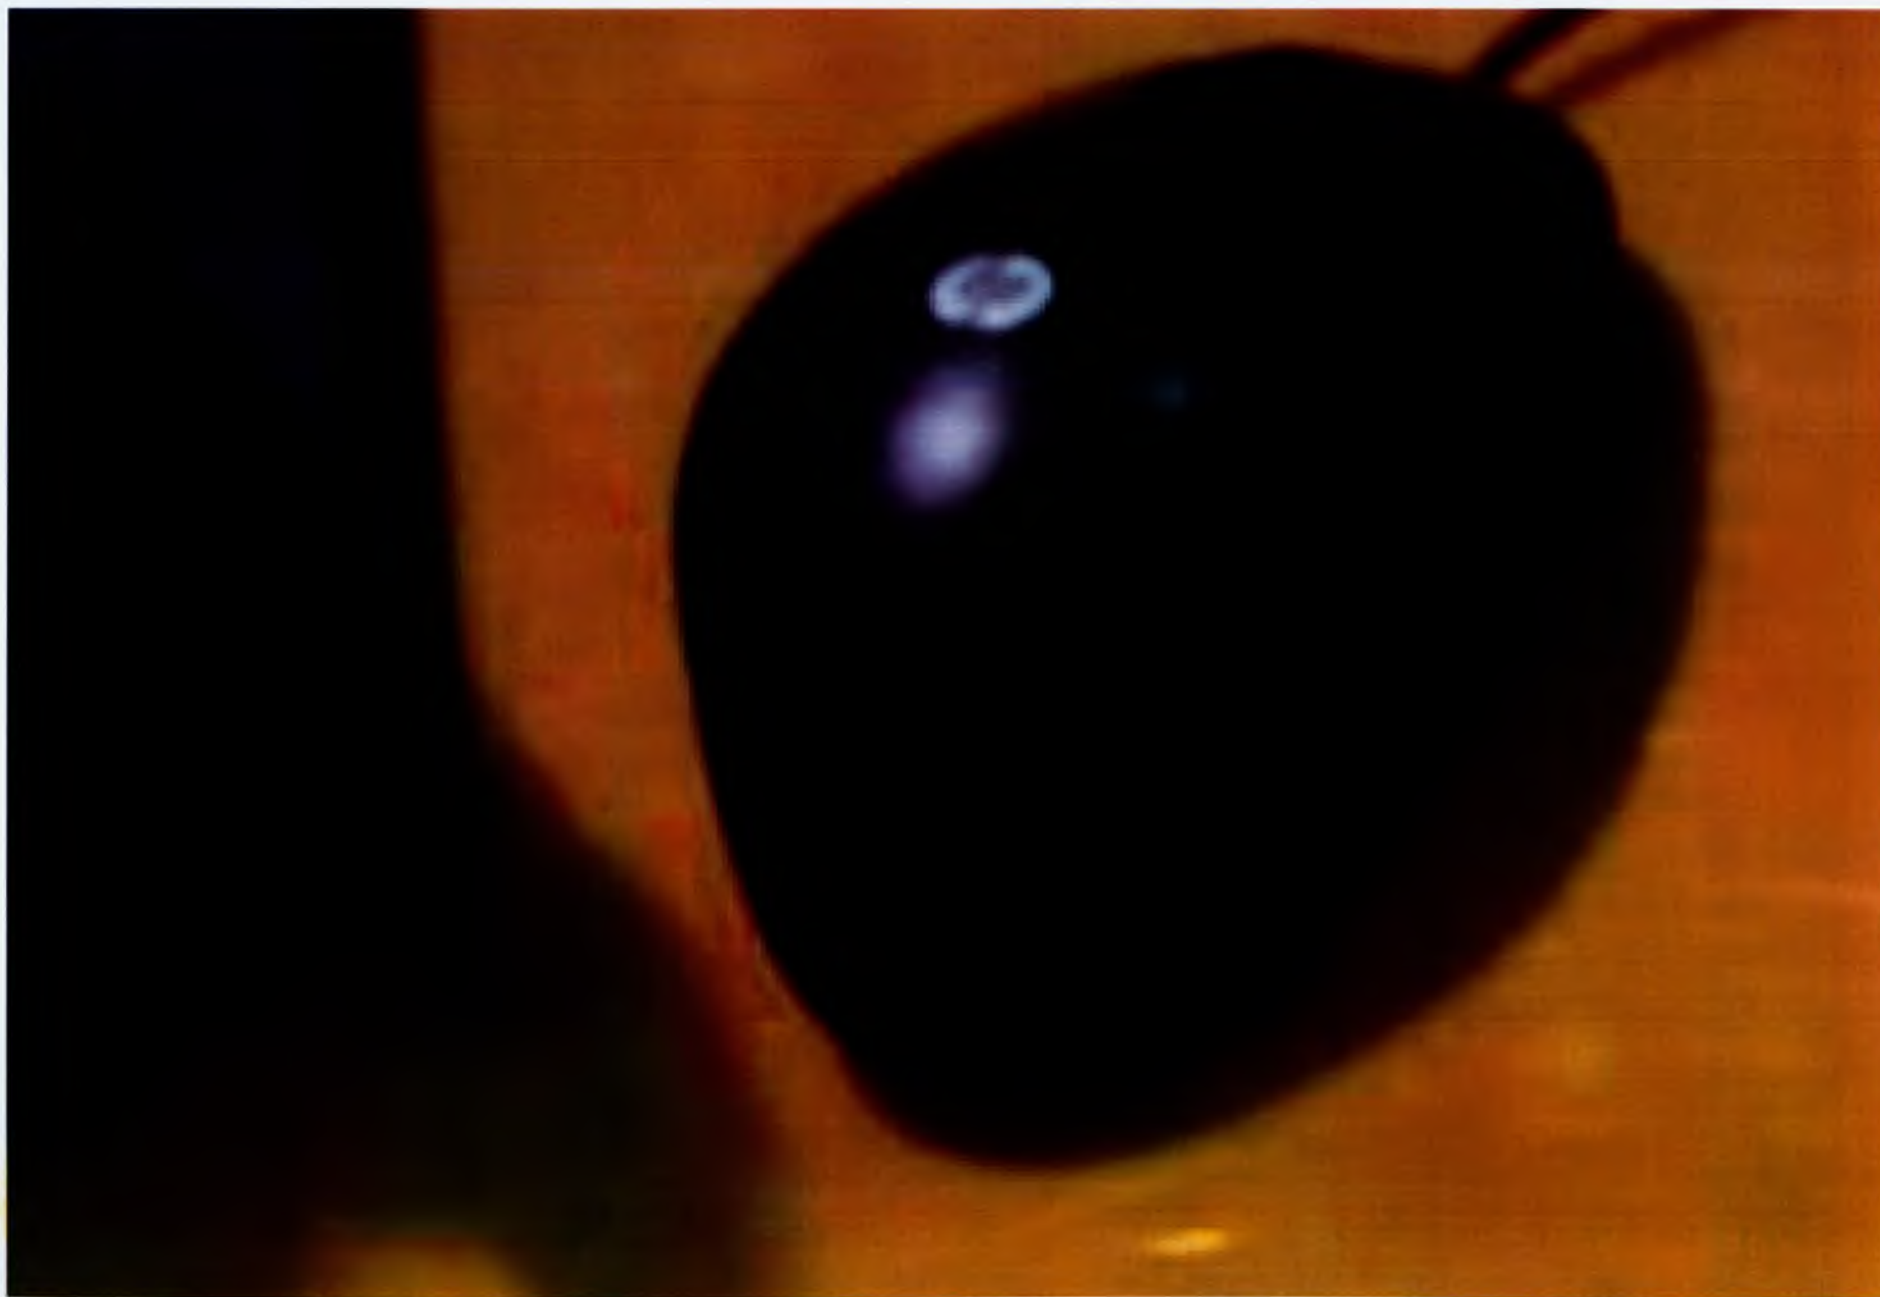


13. Отсеивающие решетки (не более 2 шт.)



16. Переговорное устройство.



17. Рабочая станция для просмотра полученных изображений (не более 4 шт.)

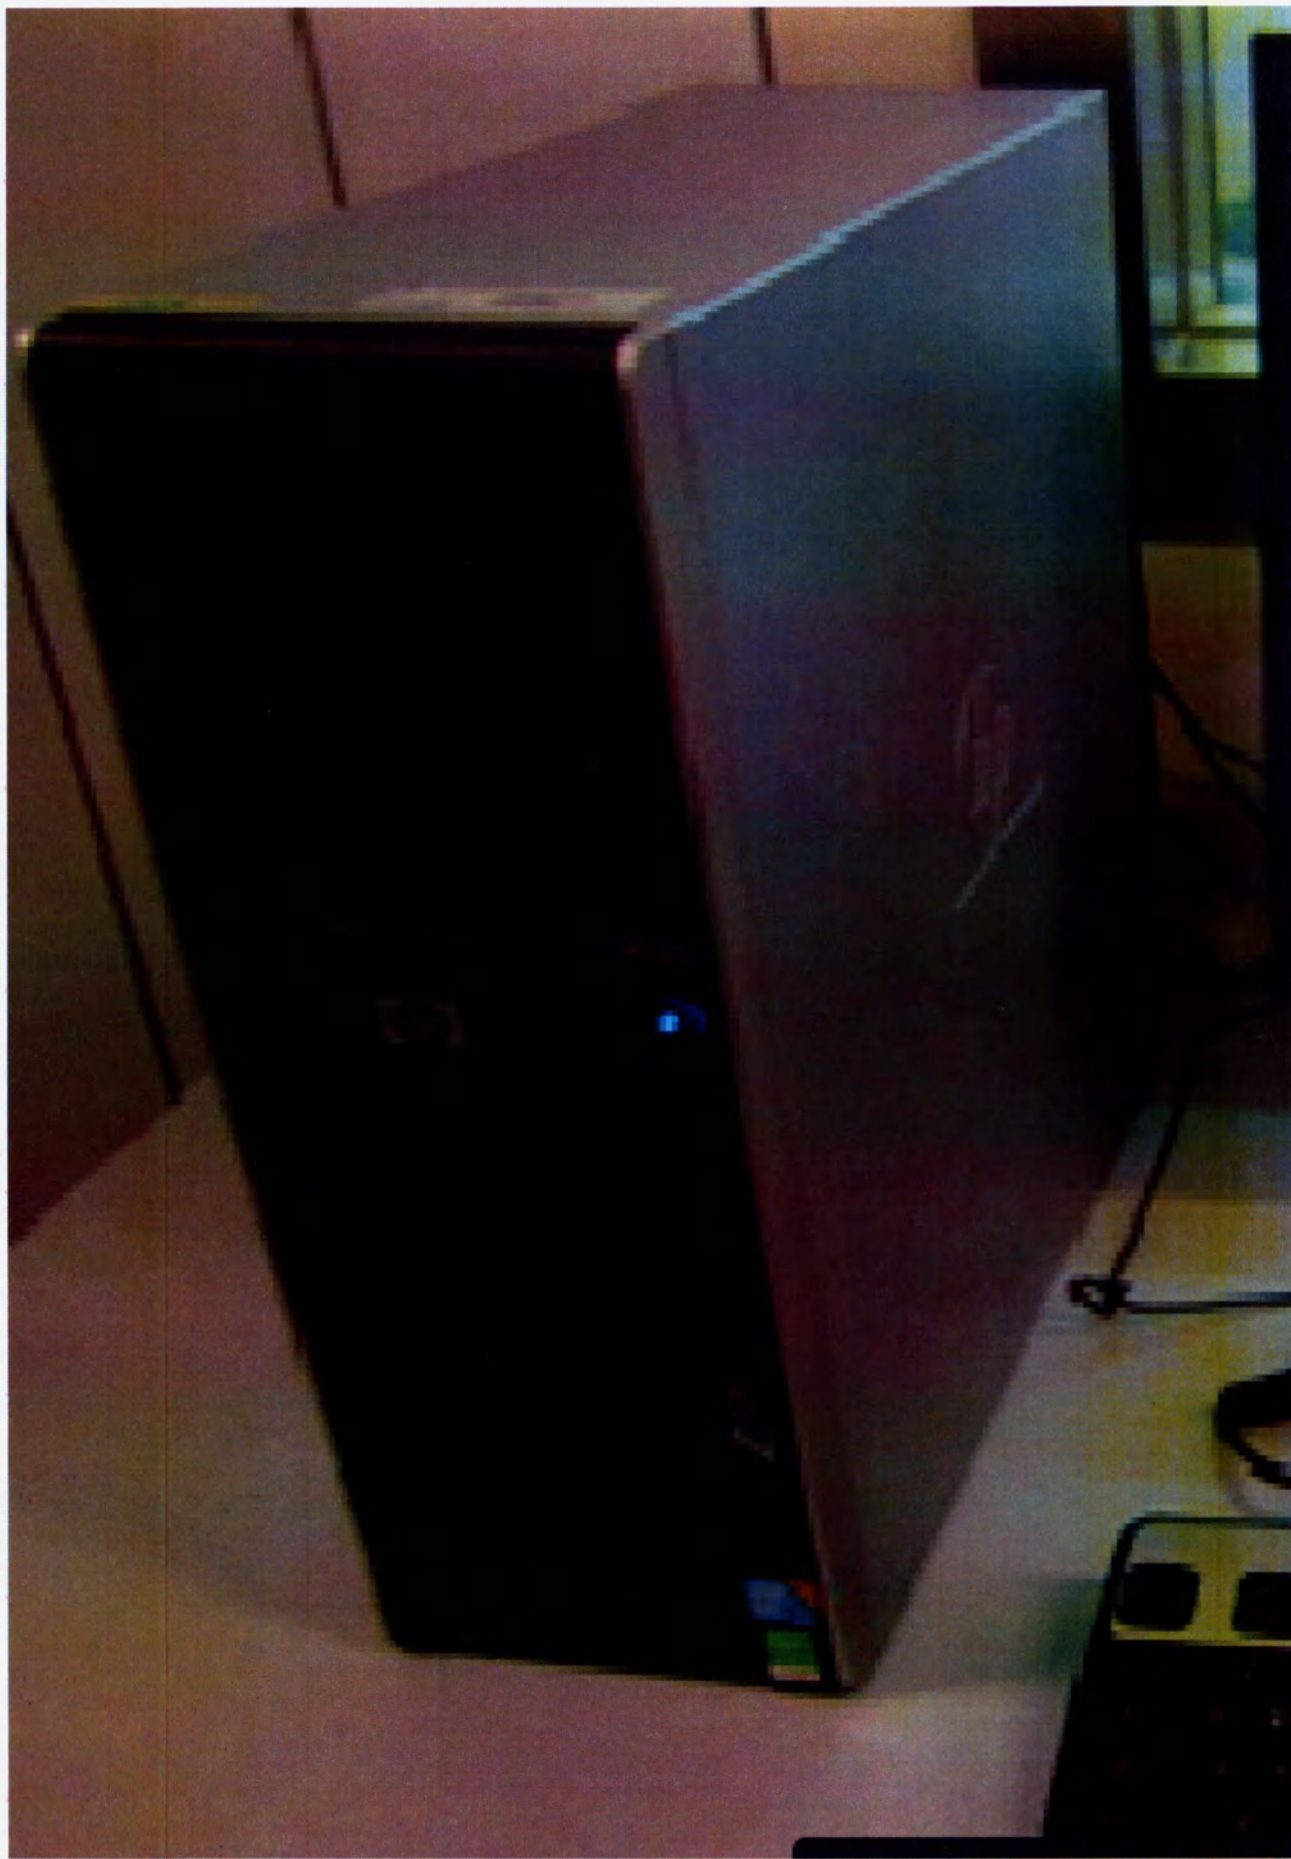


18. Руководство оператора (не более 10 шт.)

**Медицинская диагностическая
рентгенографическая система Brivo
XR575**
Руководство оператора

5429575-1RU

Редакция 1

© 2015 General Electric Company. Все права защищены.

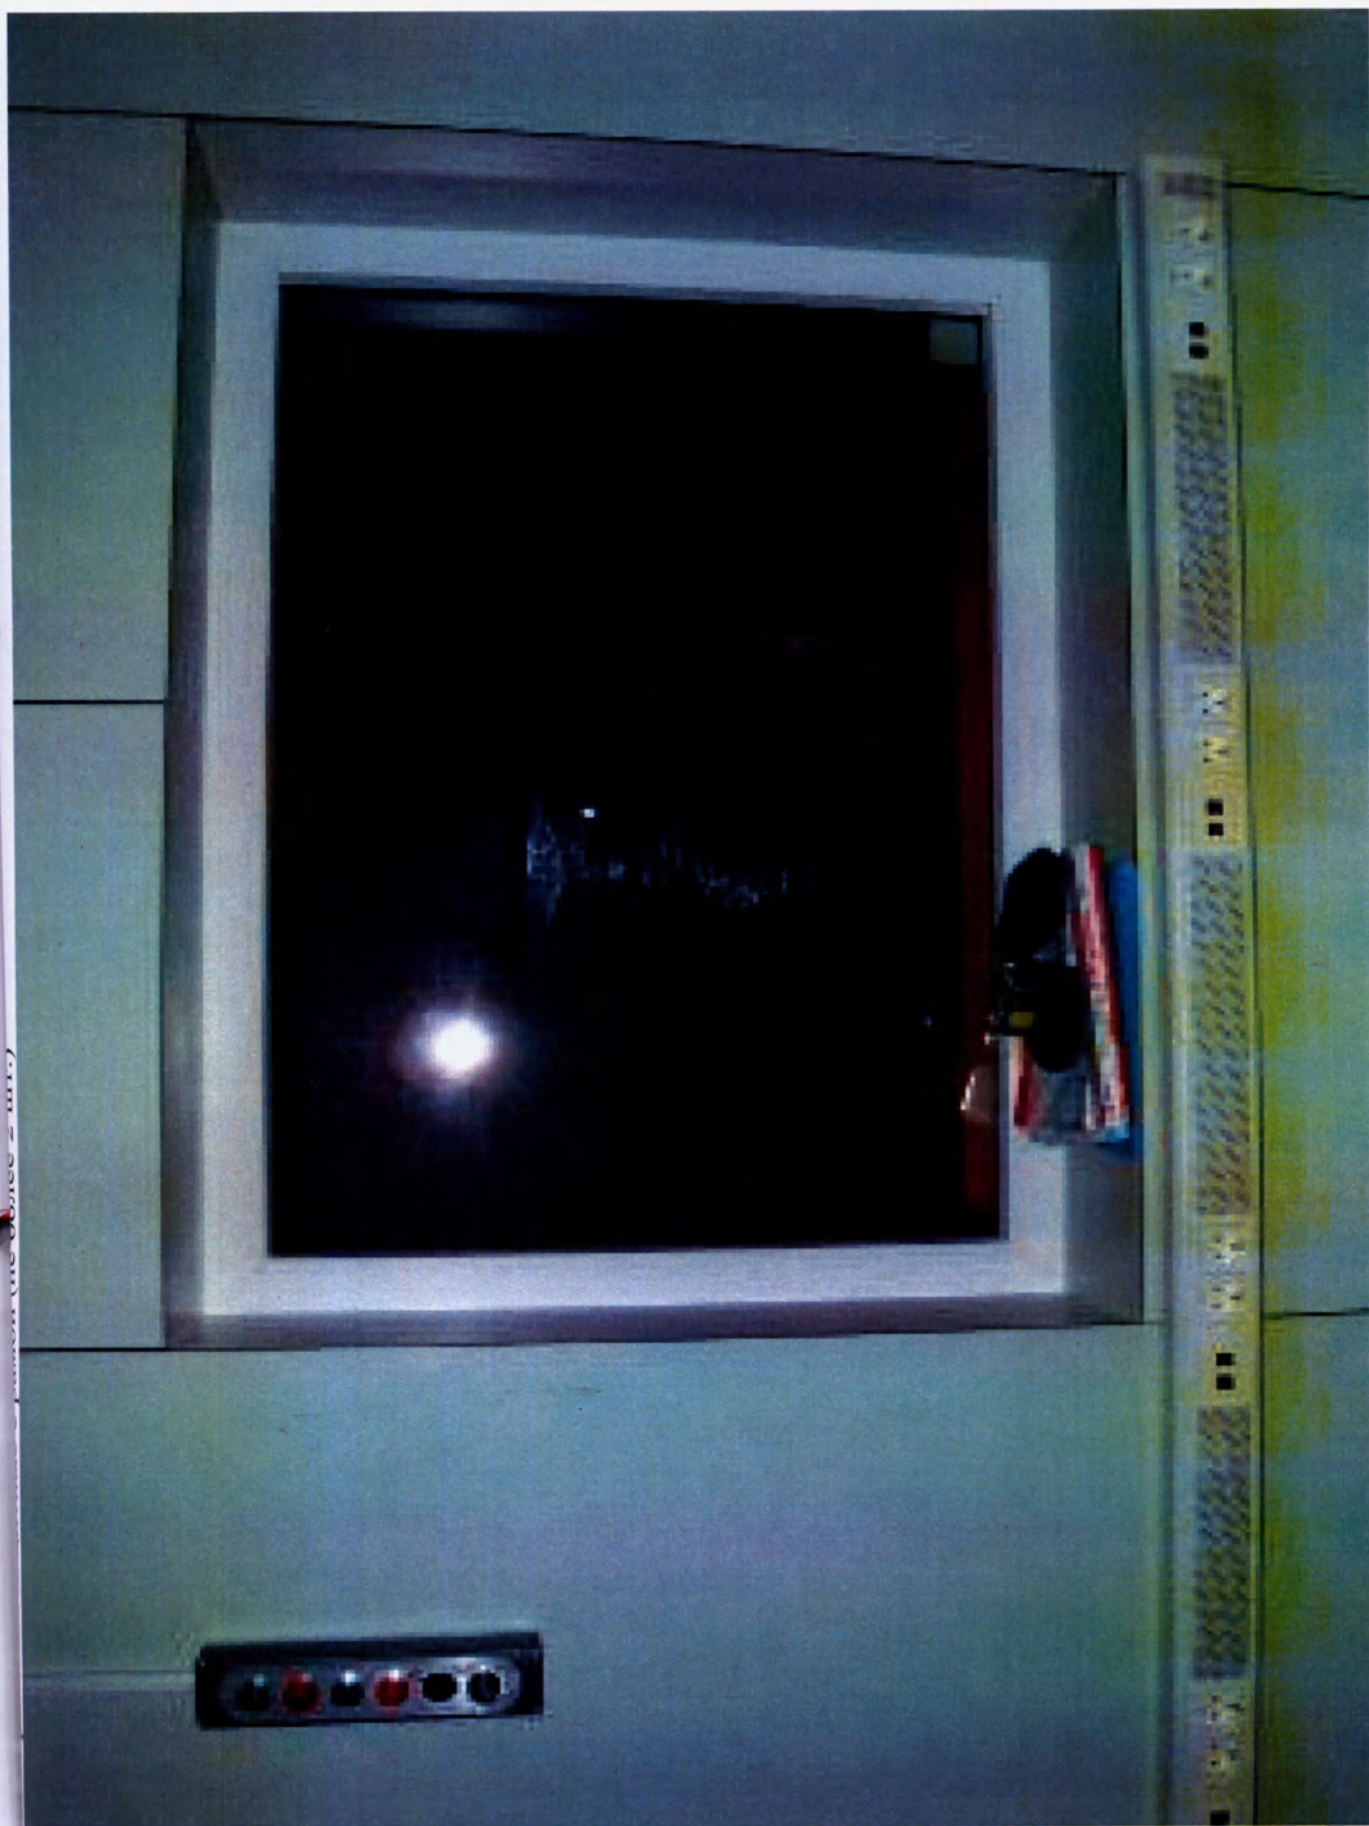



GE Healthcare

gehealthcare.com

Technical Publication

Direction 5429575-CA-1EN

Version 3


GE Healthcare

Brivo XR575 Service Manual(Class A)

Copyright © 2015 by General Electric Company, Inc. All Rights Reserved




21. Устройства для позиционирования (не более 20 шт.)

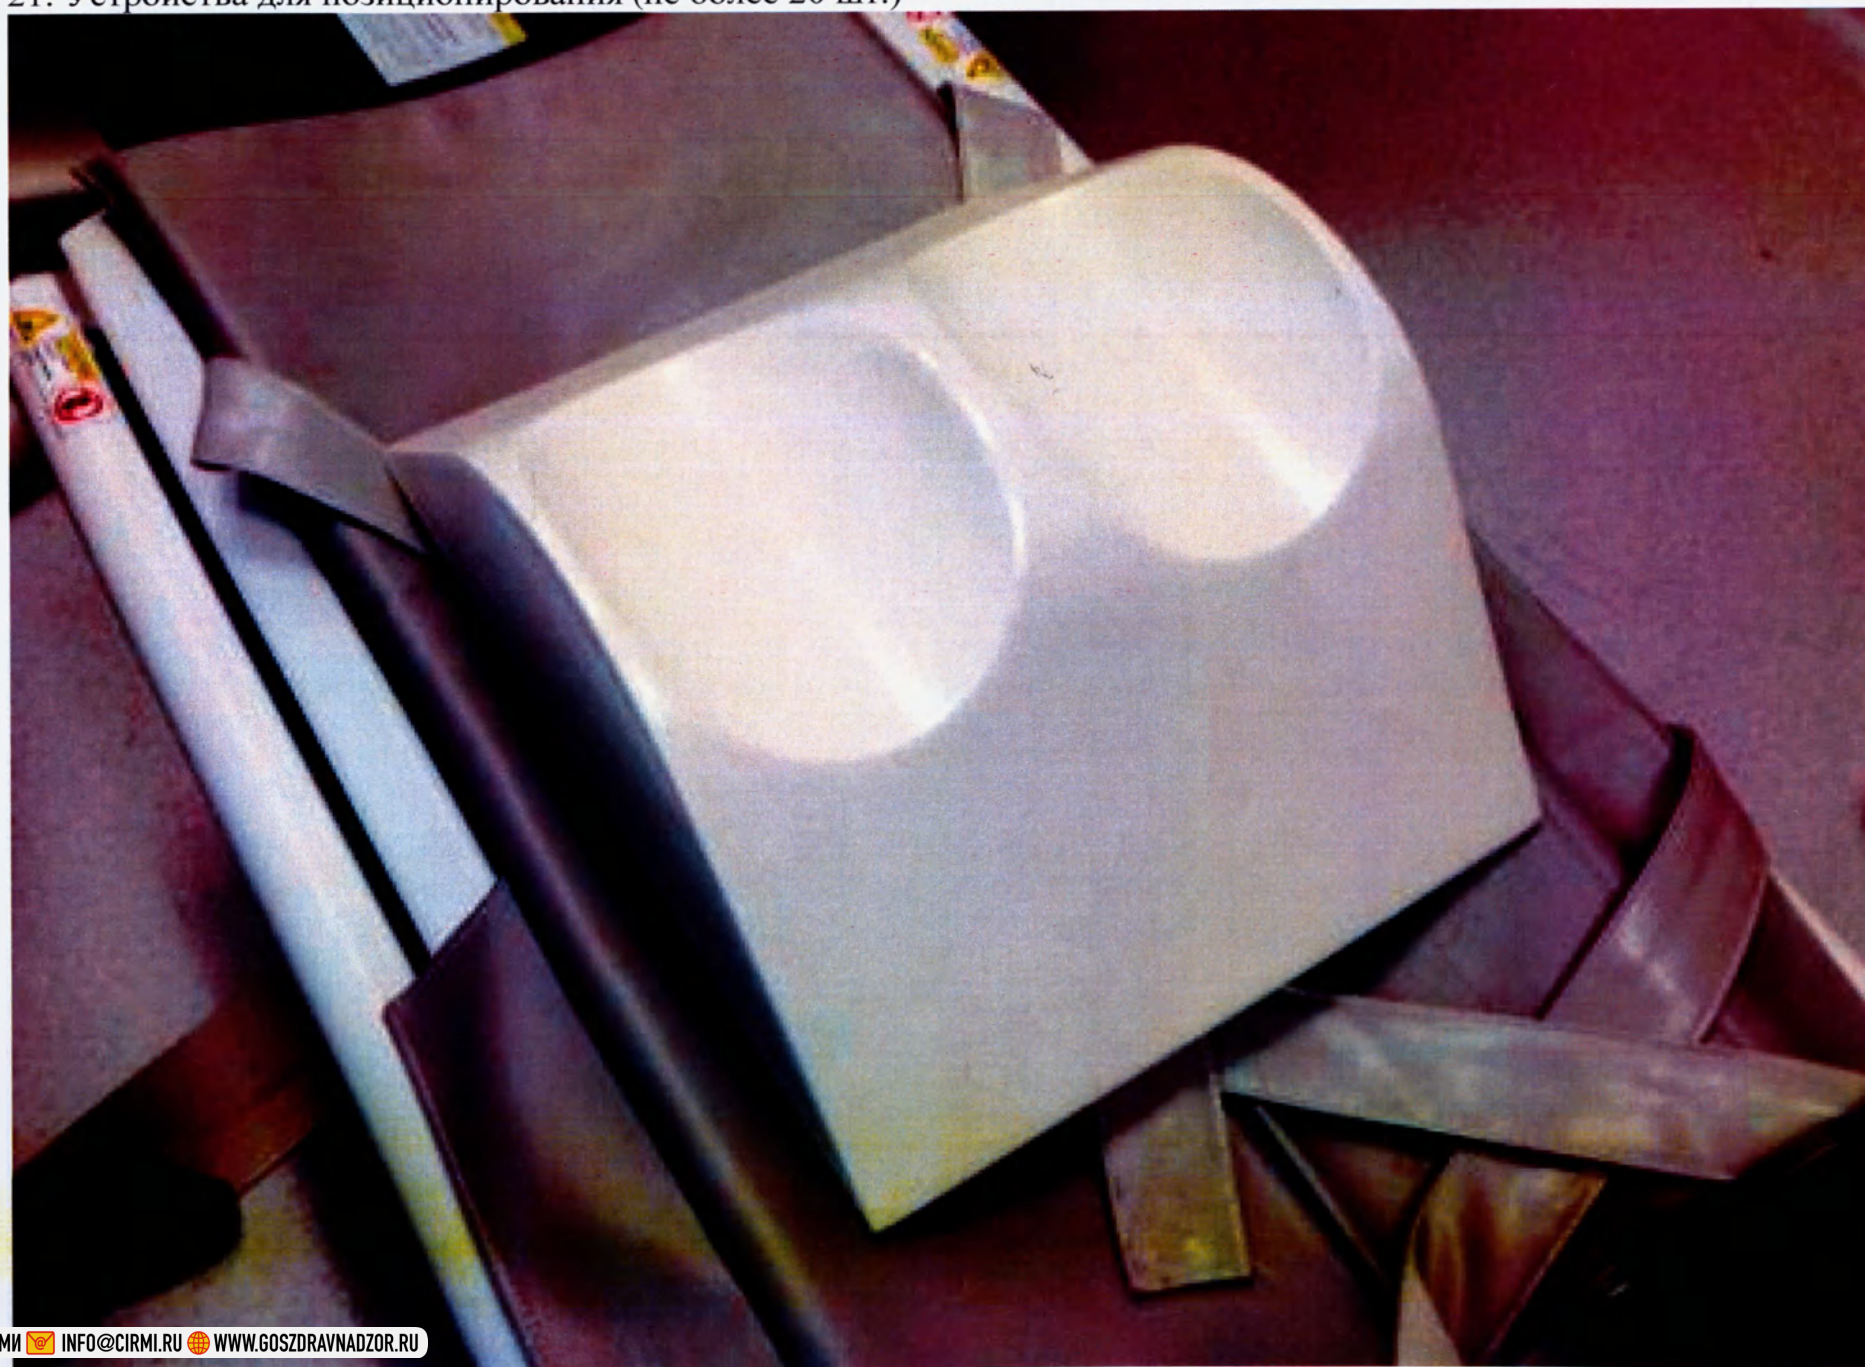


22. Устройства считывания штрихкода (не более 5 шт.)




23. Фантомы для калибровки (не более 5 шт.)

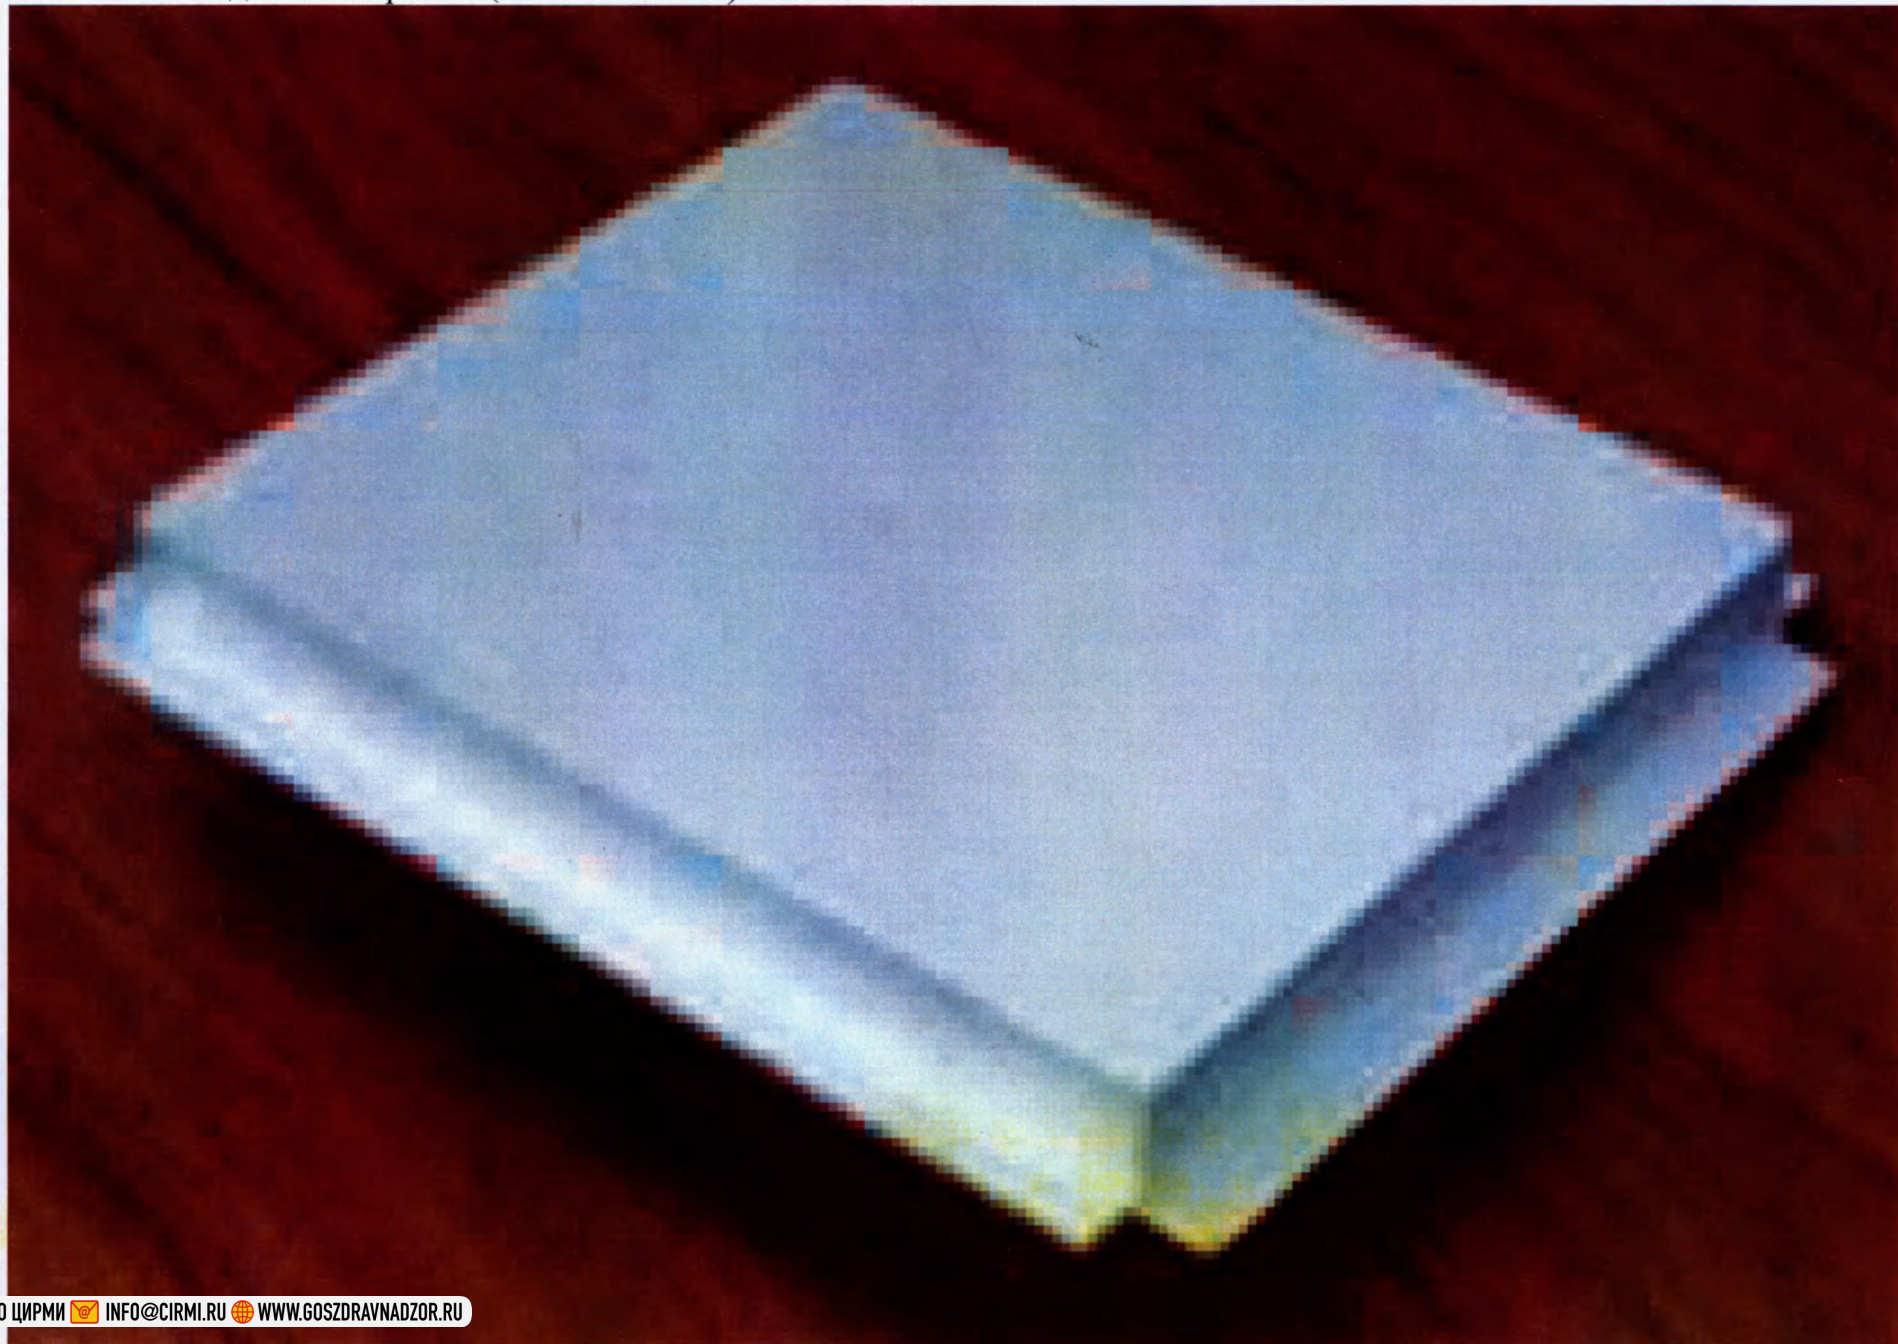


24. Фильтры рентгеновского излучения (не более 5 шт.)

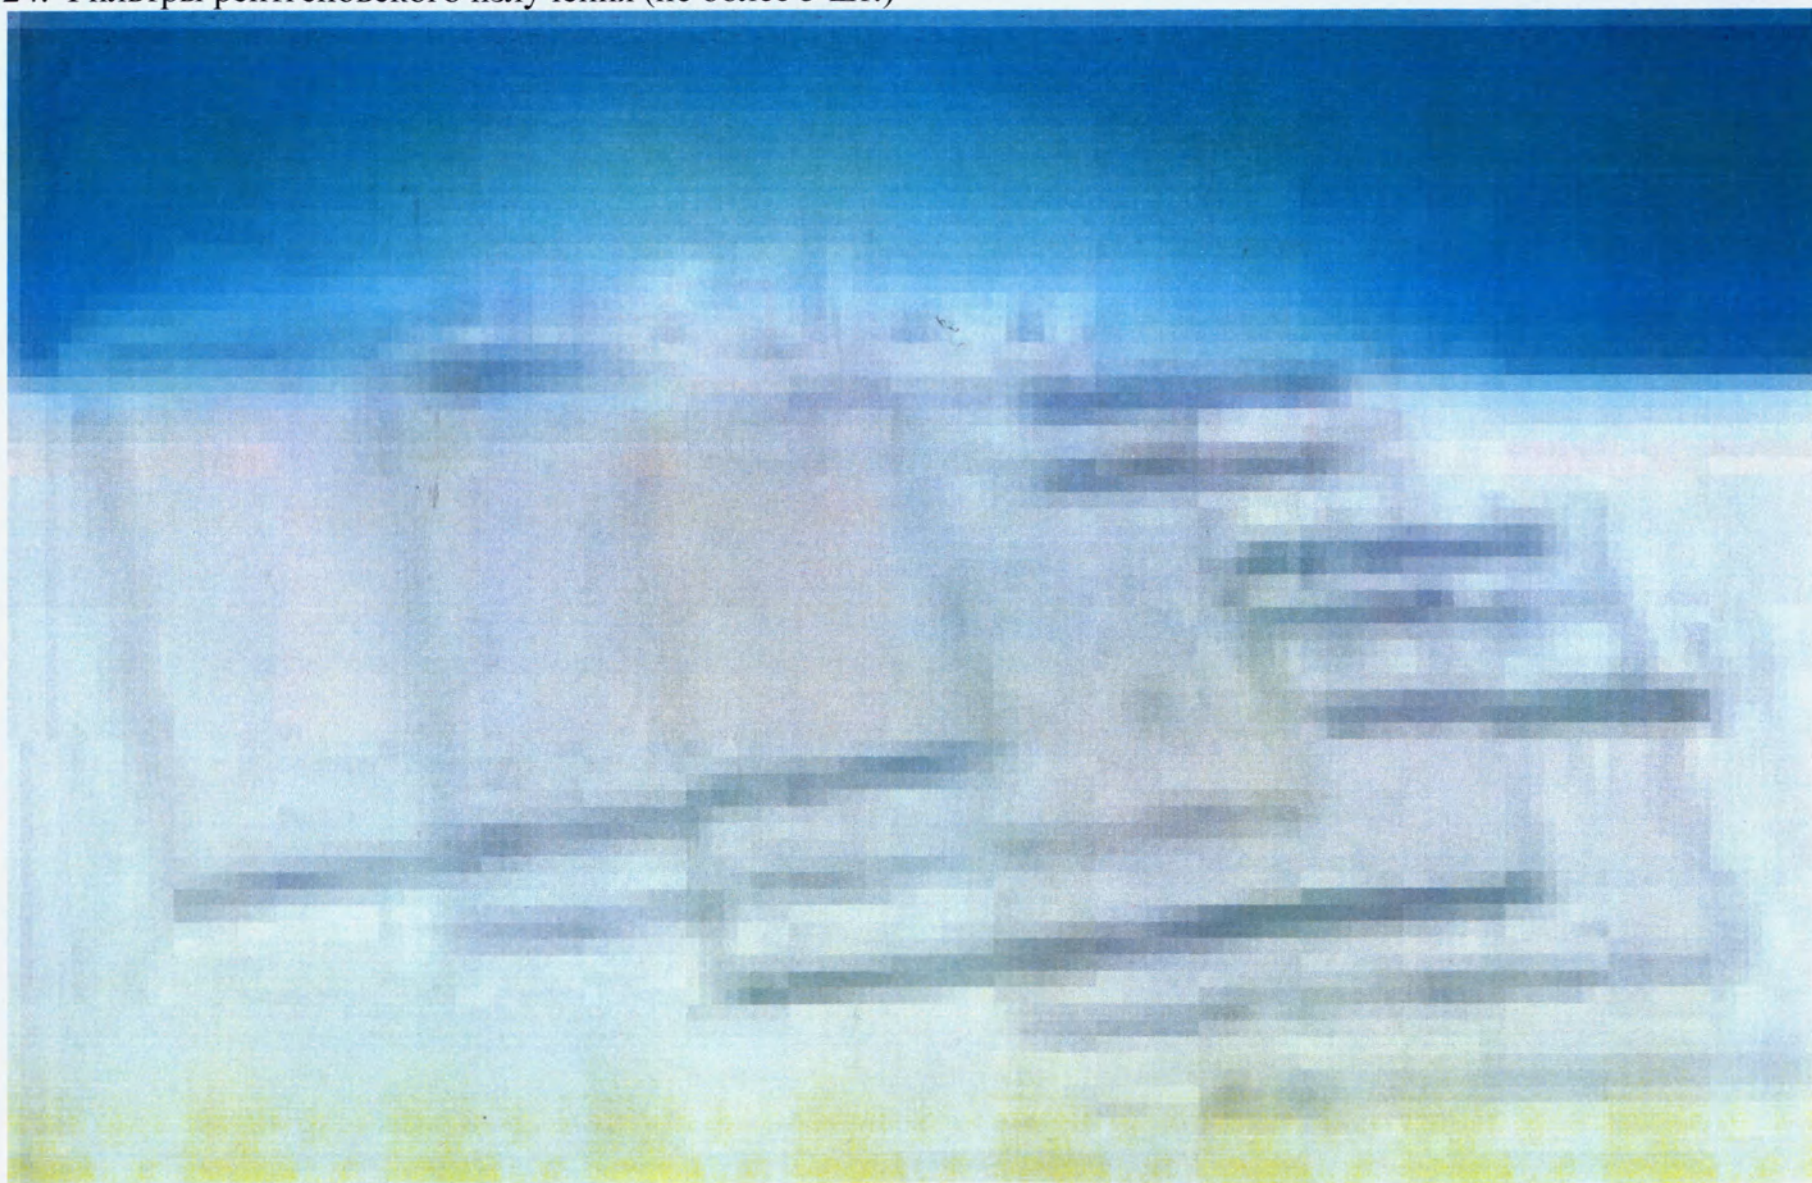

25. Щиты электрораспределительные (не более 5 шт.)

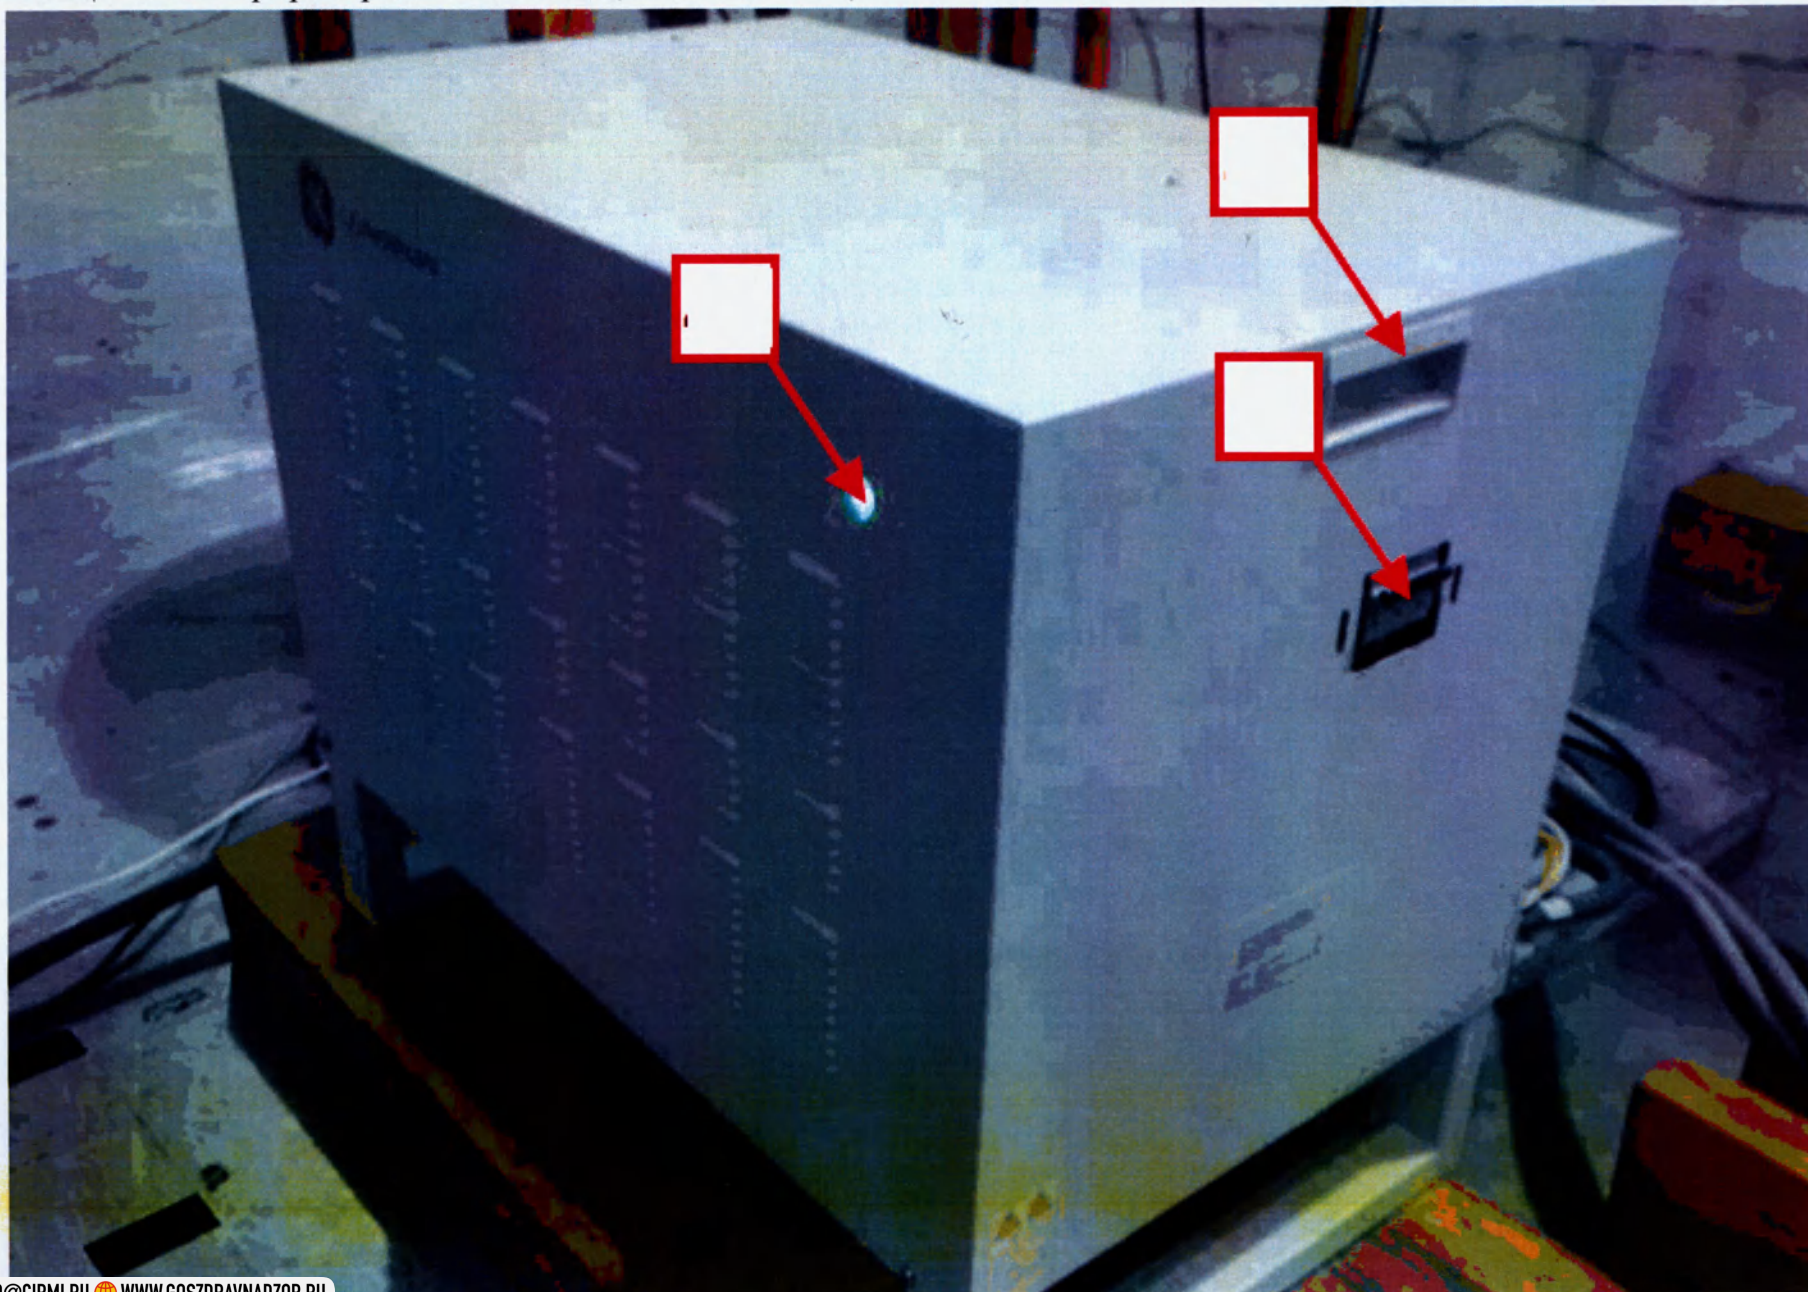

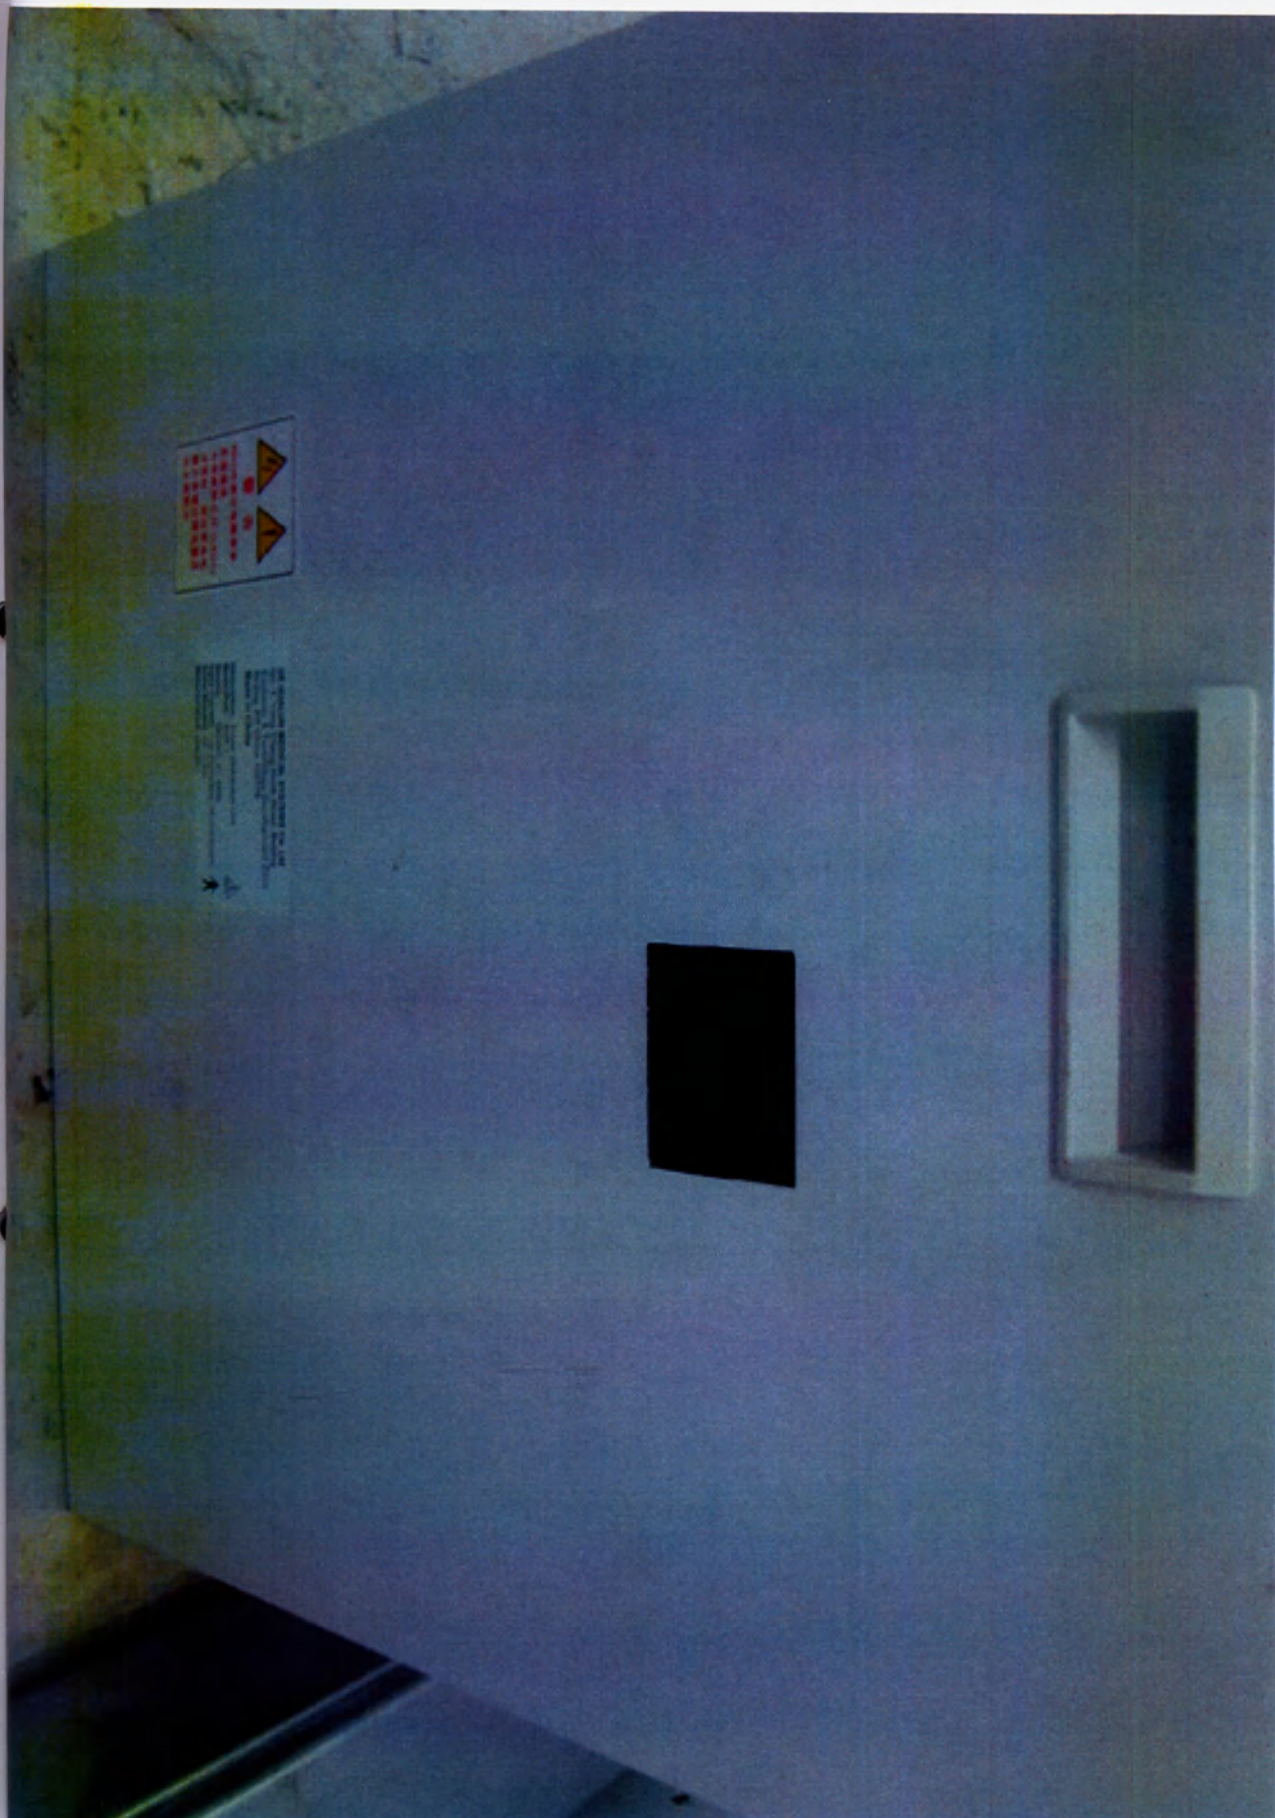

GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS Co. Ltd
 No. 1, Yong Chang North Road, Beijing
 Economic Technological Development Zone
 BEIJING 100176 CHINA
 Made in China

Description: Power Distribution Unit
Part/Model #: GVP-2
Source: 380/400/440/480VAC, 3~, 50/60Hz
Input Current: 110A (Momentary), 8A (Continuous)
Serial Number:
Manufactured:



GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS Co. Ltd
 No. 1, Yong Chang North Road, Beijing
 Economic Technological Development Zone
 BEIJING 100176 CHINA
 Made in China

Description: Power Distribution Unit
Part/Model #: GVP-1
Source: 380VAC, 3~, 50Hz
Input Current: 110A (Momentary), 8A (Continuous)
Serial Number:
Manufactured:



GE HUALUN MEDICAL SYSTEMS Co. Ltd
 No. 1, Yong Chang North Road, Beijing
 Economic Technological Development Zone
 BEIJING 100176 CHINA
 Made in China

Description: U-arm
Part/Model #: GUA575
Source: 220VAC, 3.0A
Serial Number:
Manufactured:





не пронумеровано,
для документирования и
скреплено печатью
36 листа (ов)