

**Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
вместе с принадлежностями, необходимыми для применения
медицинского изделия по назначению**

Аспираторы вакуумные Medela с принадлежностями

Аспиратор вакуумный Medela
модель Basic

Ручка

Вакууметр

Регулятор вакуума



Шильдик: аспиратор вакуумный
модель Basic

Basic

REF 200.5461


SN 1610136

[VAC] 100-240

[Hz] 50/60

[W] 50

 T1.6AH

 Date of manufacture

21.04.2016

Made in Switzerland



medela 

Medela AG,
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland

IP21

CE

0123

c



Rx only



Аспиратор вакуумный Medela
модель Dominant Flex



Шильдик: аспиратор вакуумный
модель Dominant Flex

Dominant Flex

PEF 200.4919

SN 1609472


[VAC] 100-240

[Hz] 50/60


[W] 120

 T1.6AH

Date of manufacture

 18.04.2016

Made in Switzerland




medela 

Medela AG,
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland

IP21


CE

0123



Rx only



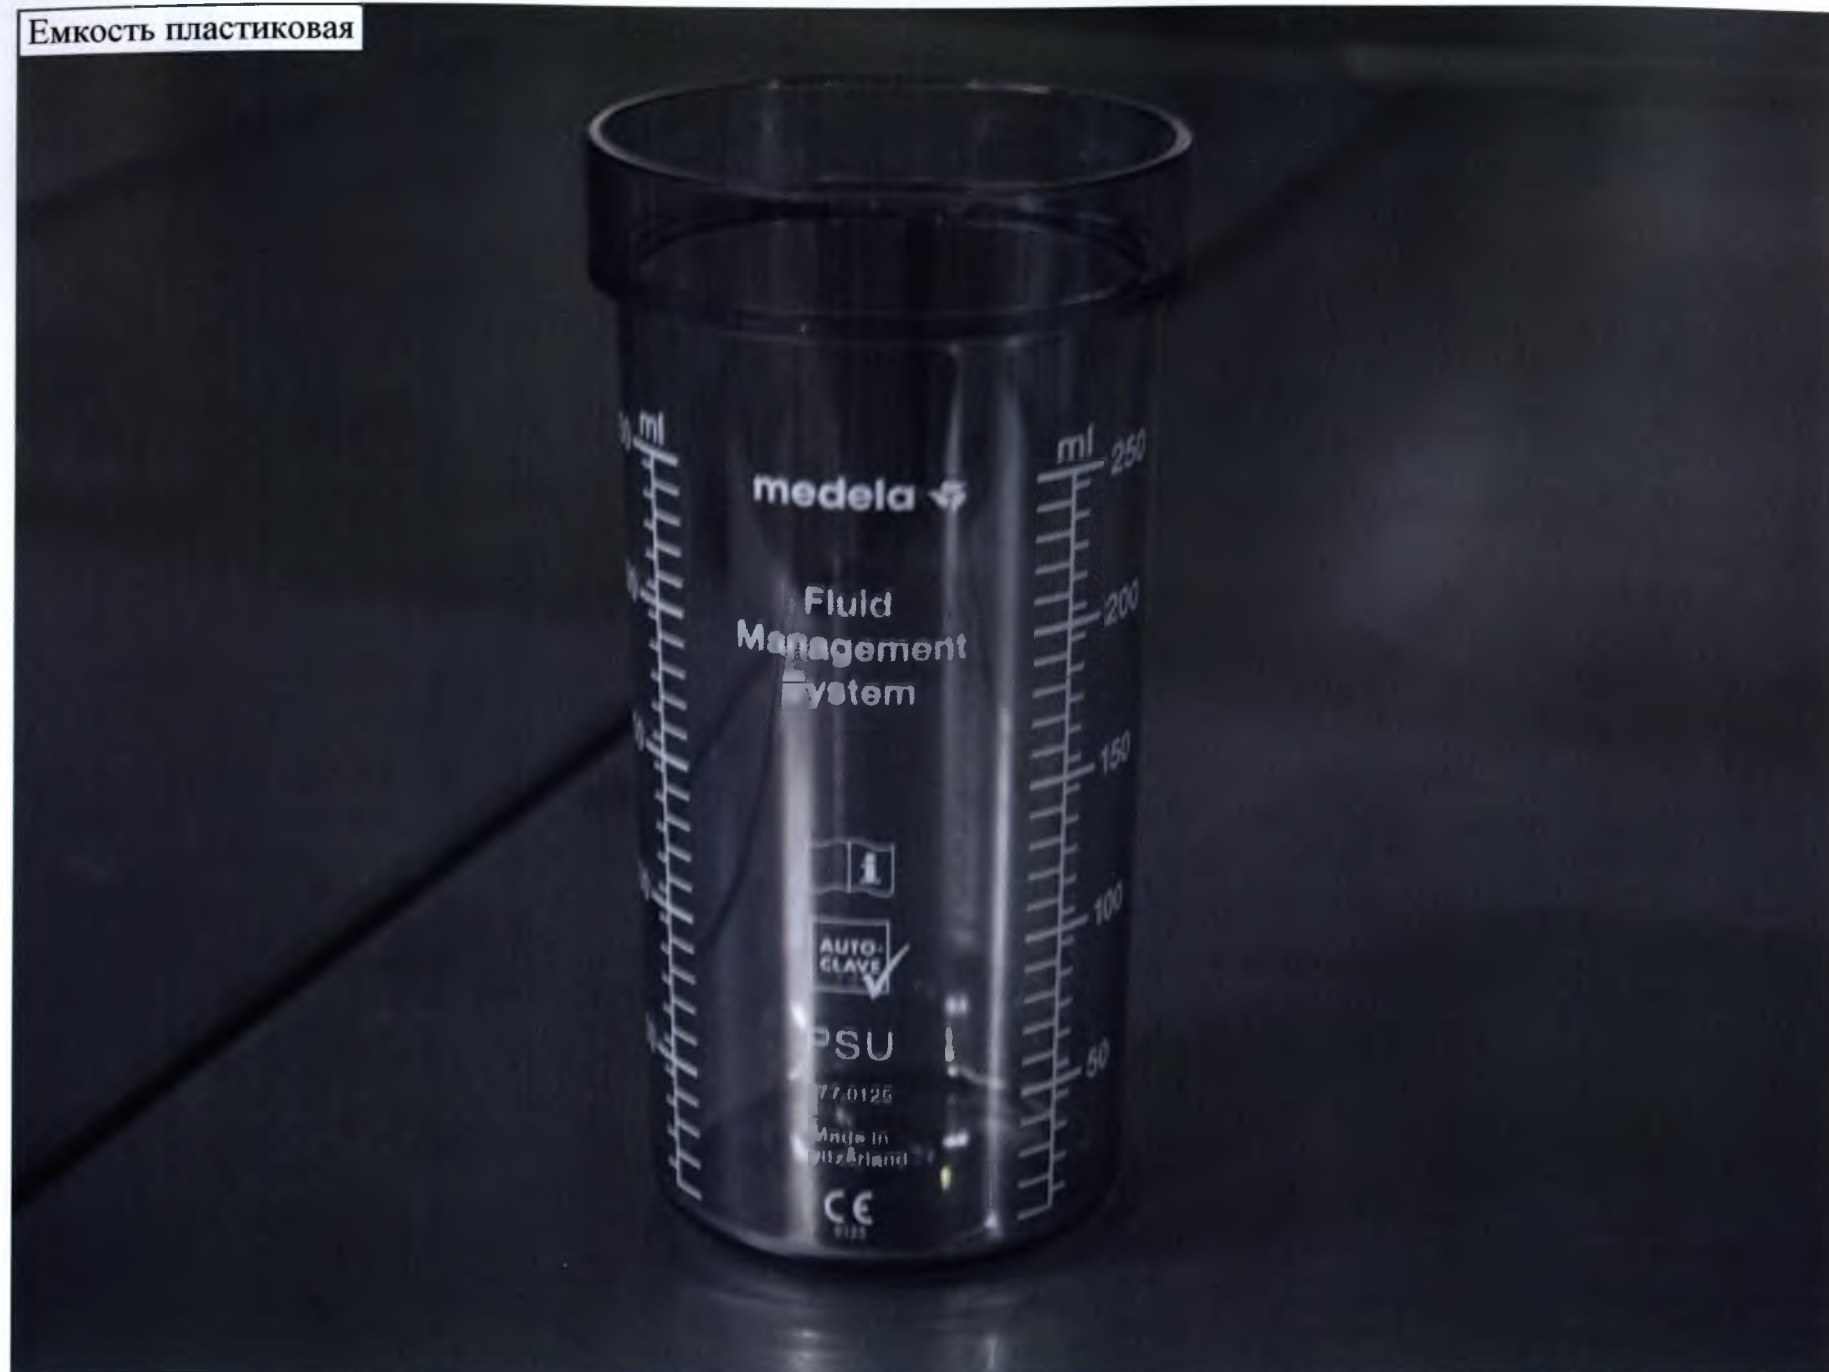

Крышка




Клапан



Наконечник



Кабель

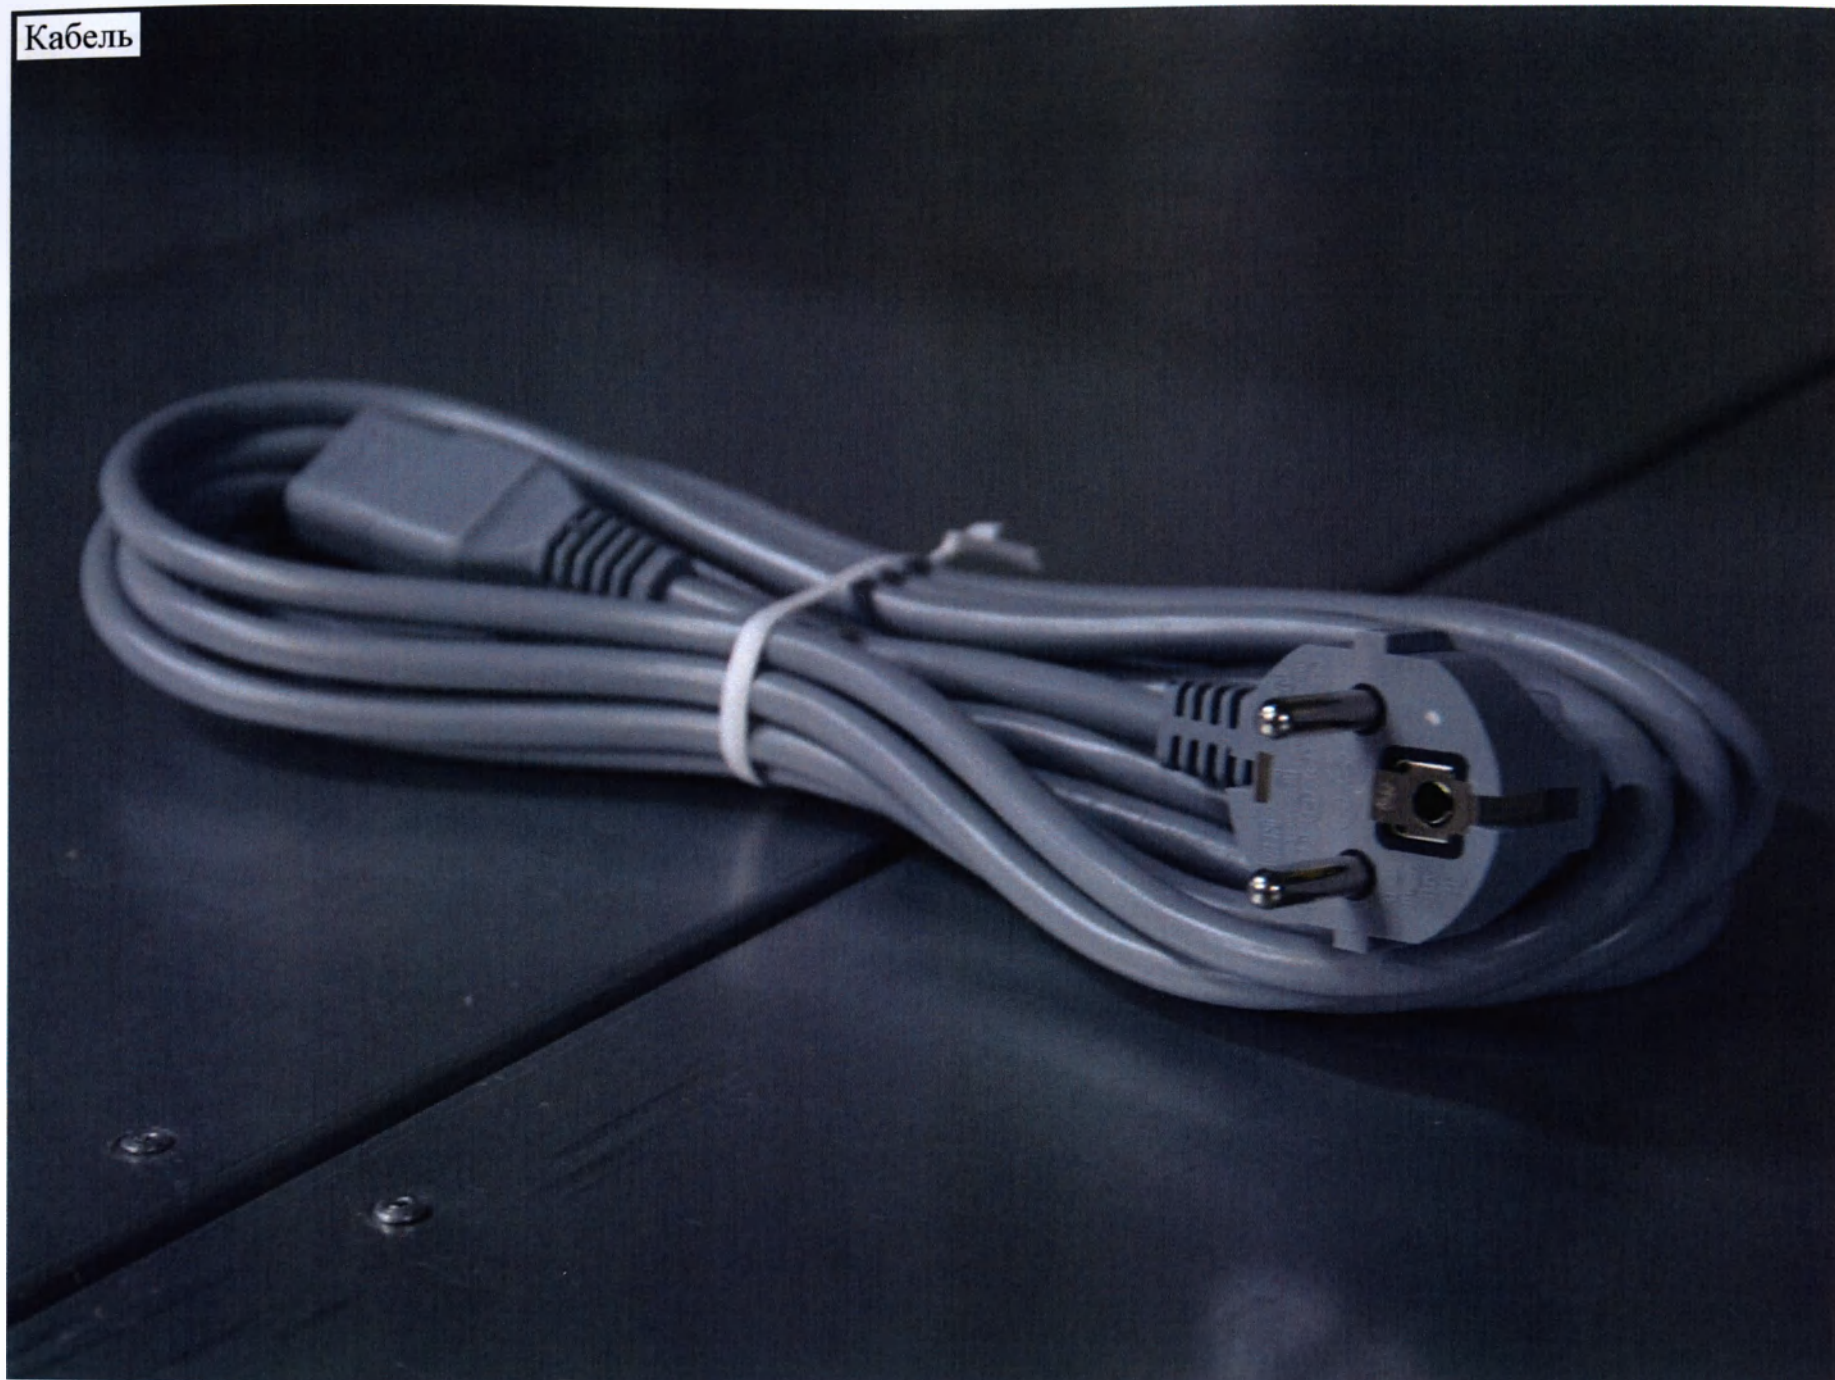

Шнур соединительный





Сумка



Тележка


Полка для aspiratora



Емкость для дренажа



Держатель

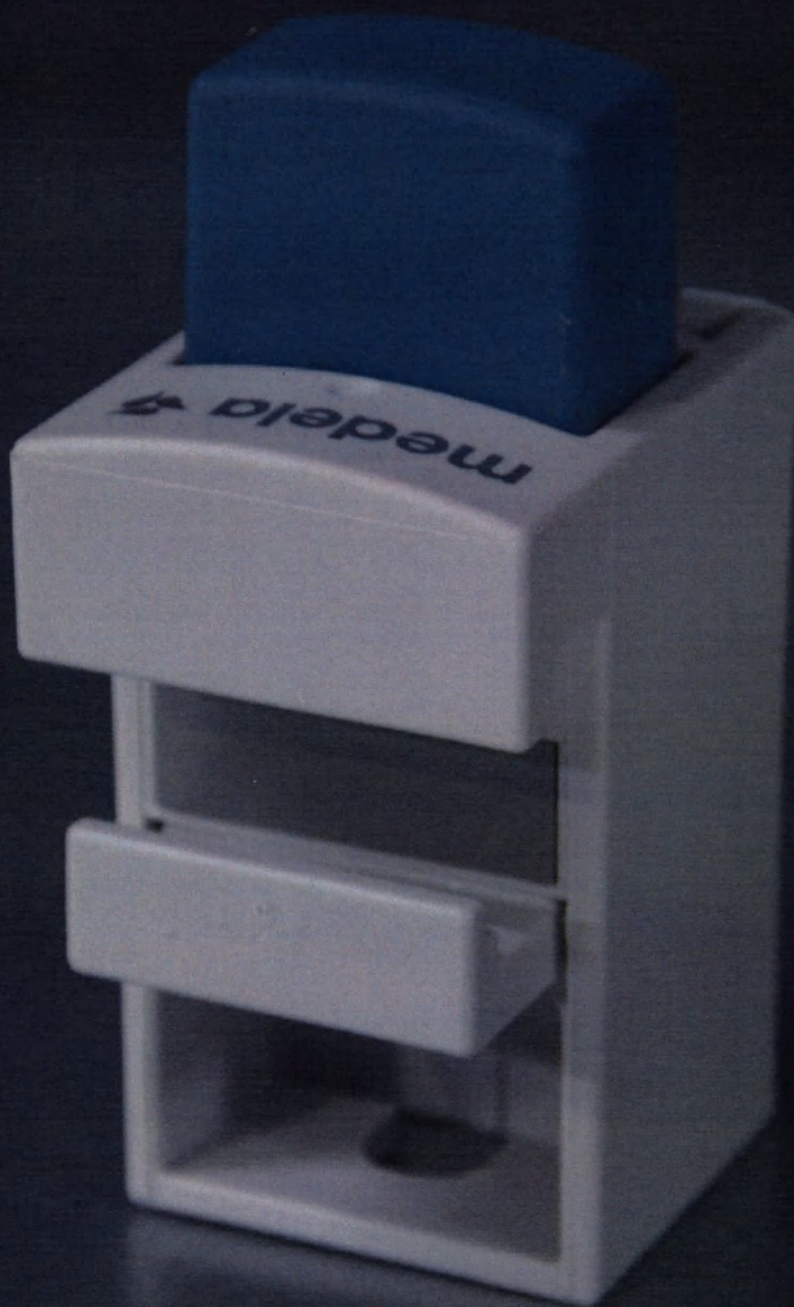


Трубка



Трубка силиконовая



Адаптер

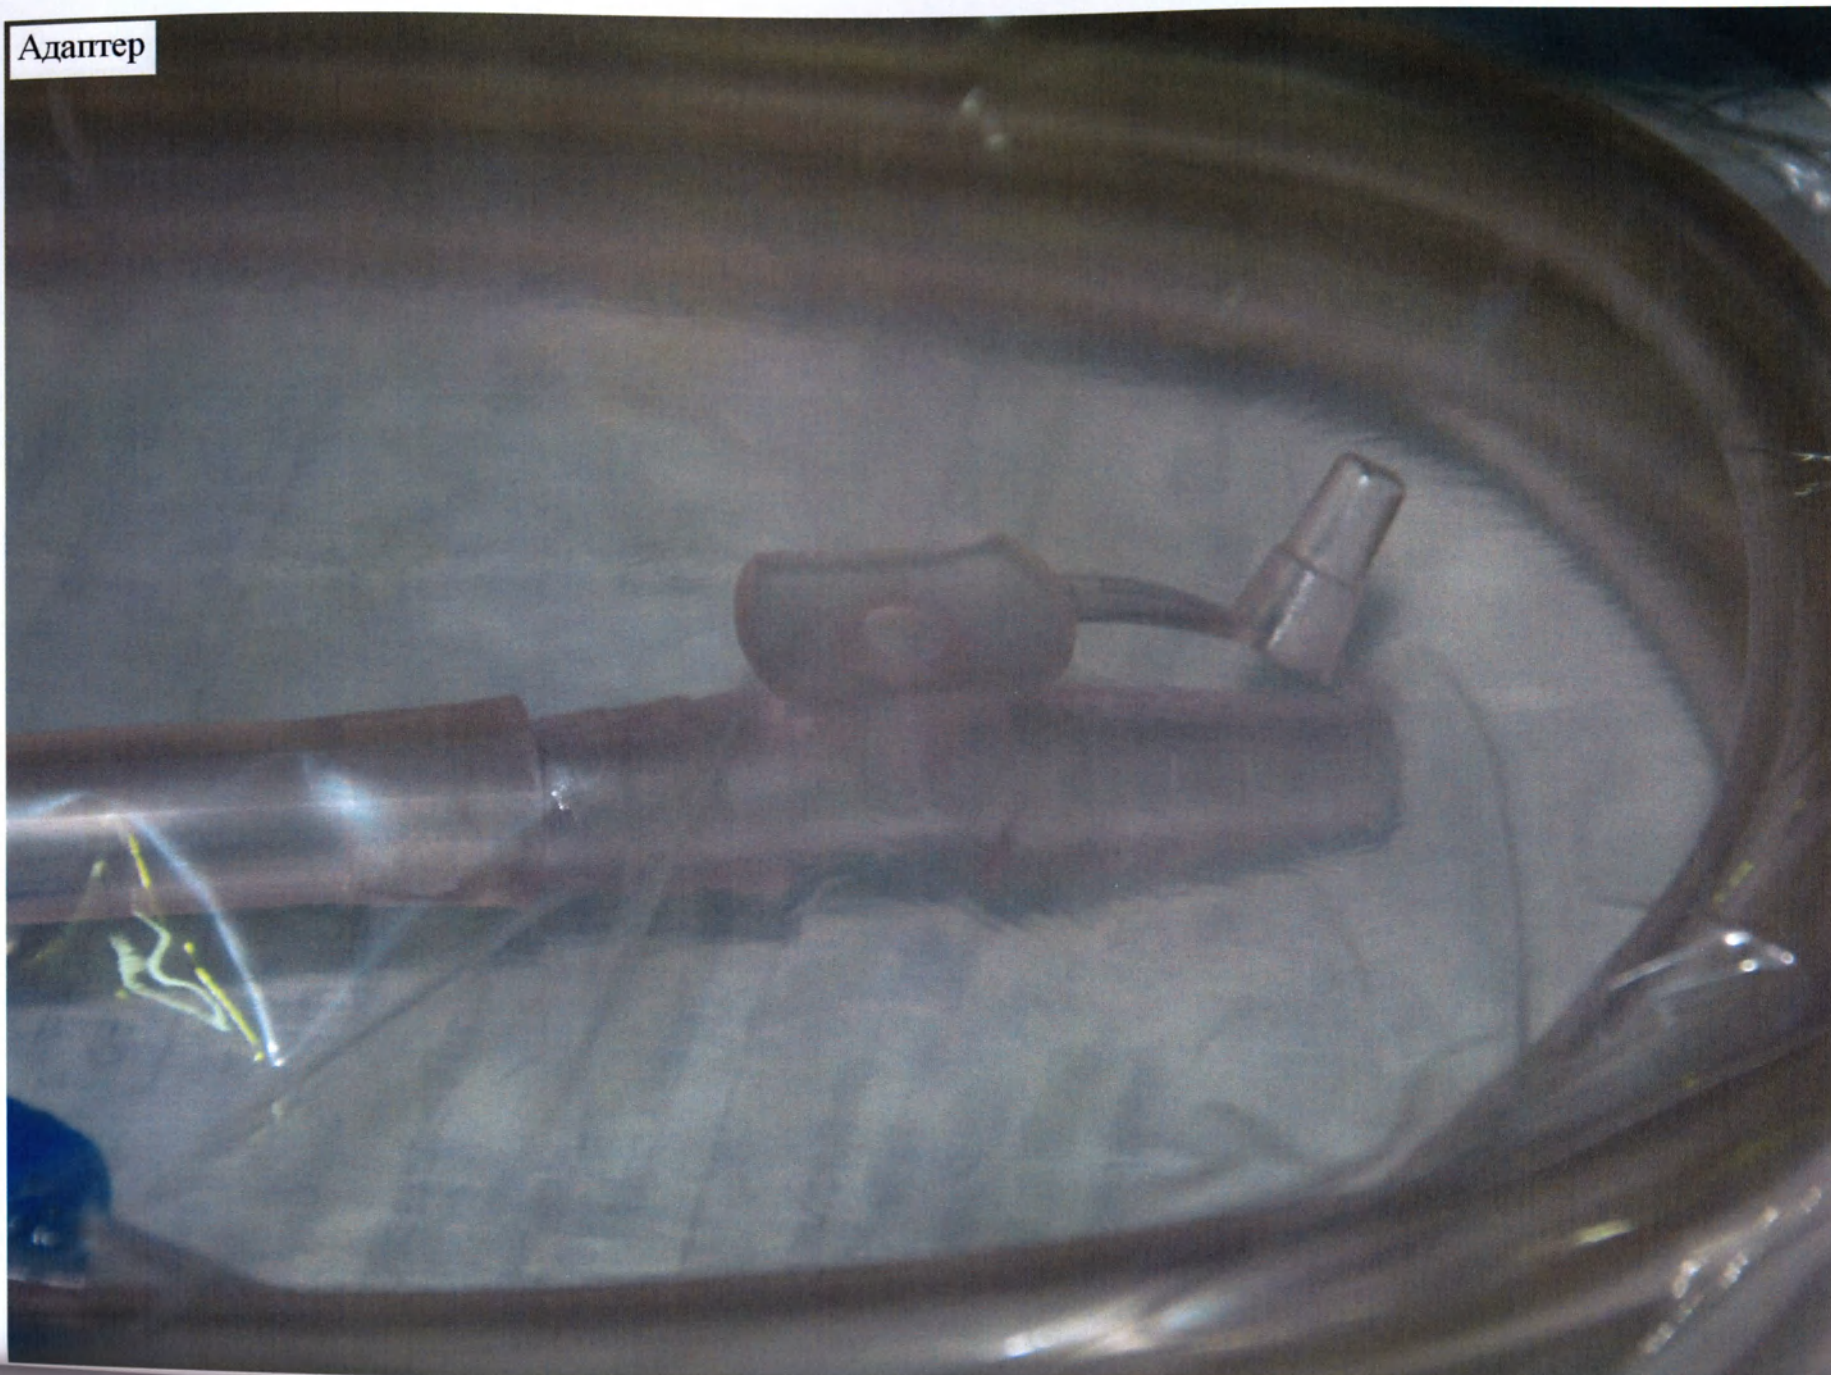

Фильтр



Колесо с
блокиратором колеса



Стойка мобильная



Переходник



Педаль включения/выключения ножная

/ Немецкий

Bedienung und Montage
Die Fußschalter des Modells RT (ohne Schalterkopf) sind 90° auf
Schalterkopf (siehe auch Abb. 1) einsteckbar. Nach dem Einstecken
kann der Schalterkopf durch einen Klick auf den Schalterkopf
festgeklickt werden.

Bedienung / Anweisung
Die Fußschalter sind als einstufige Antriebsmechanismen
ausgesteuert. Die einstufigen Antriebsmechanismen können auch
als einstufige Antriebsmechanismen für die Bedienung von
Schaltgeräten verwendet werden. Die einstufigen Antriebsmechanismen
sind für die Bedienung von Schaltgeräten geeignet. Die einstufigen
Antriebsmechanismen sind für die Bedienung von Schaltgeräten
geeignet. Die einstufigen Antriebsmechanismen sind für die
Bedienung von Schaltgeräten geeignet.



Педадь регулятора вакуума



прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
25 ЛИСТОВ



ЗАО "Компания "Интермедсервис"
Директор службы
регистрации и сертификации
Чекова Е.С.