

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Спектр»


Суржиков Л.Н.




«24» июня 2016 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

«Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 6950 Laser Imaging System с принадлежностями»

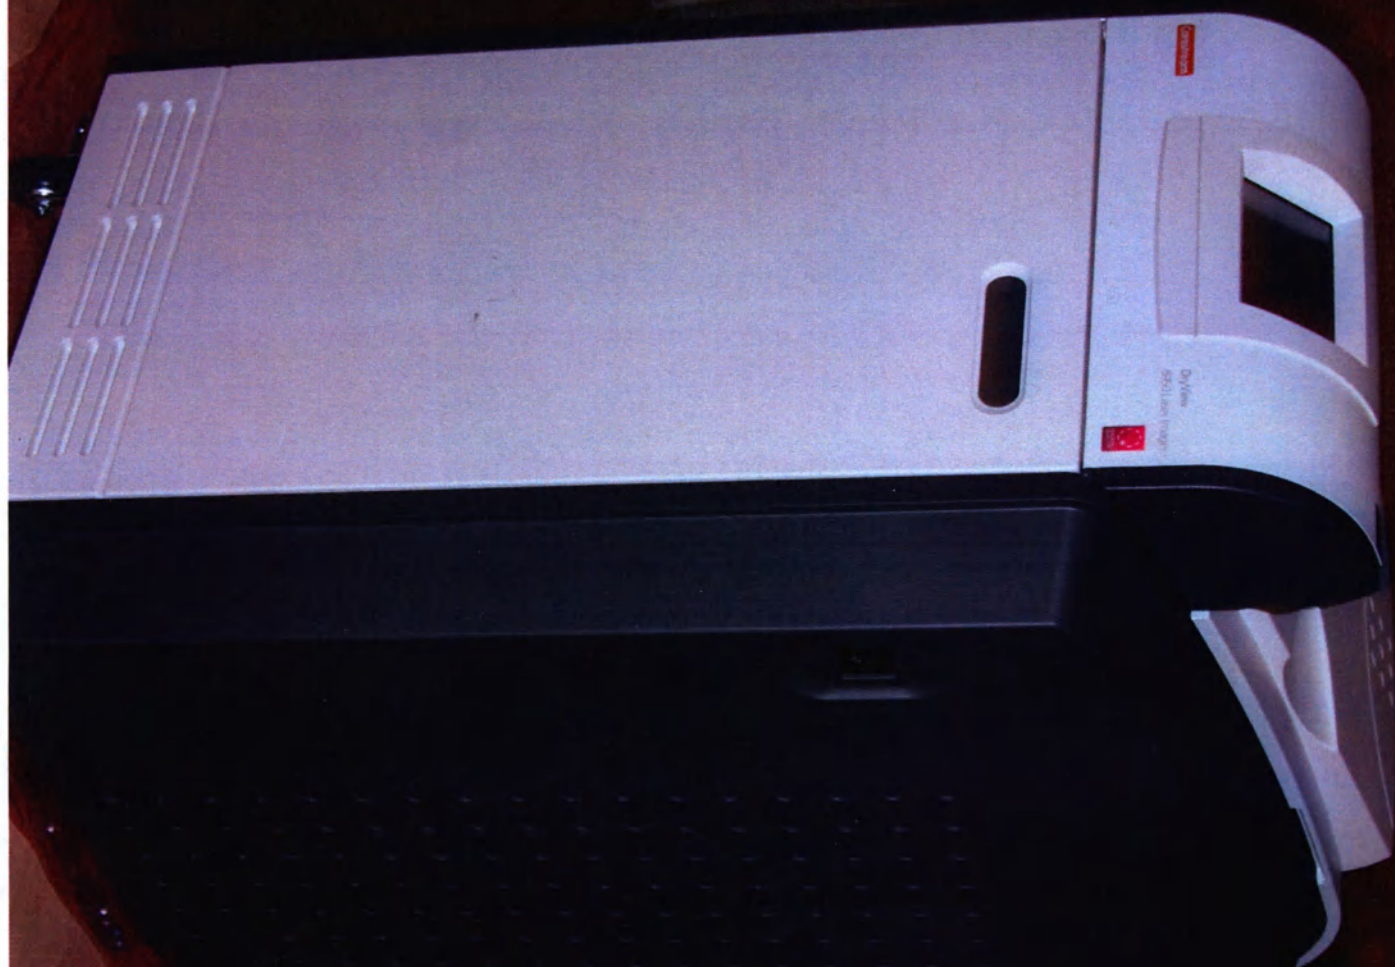

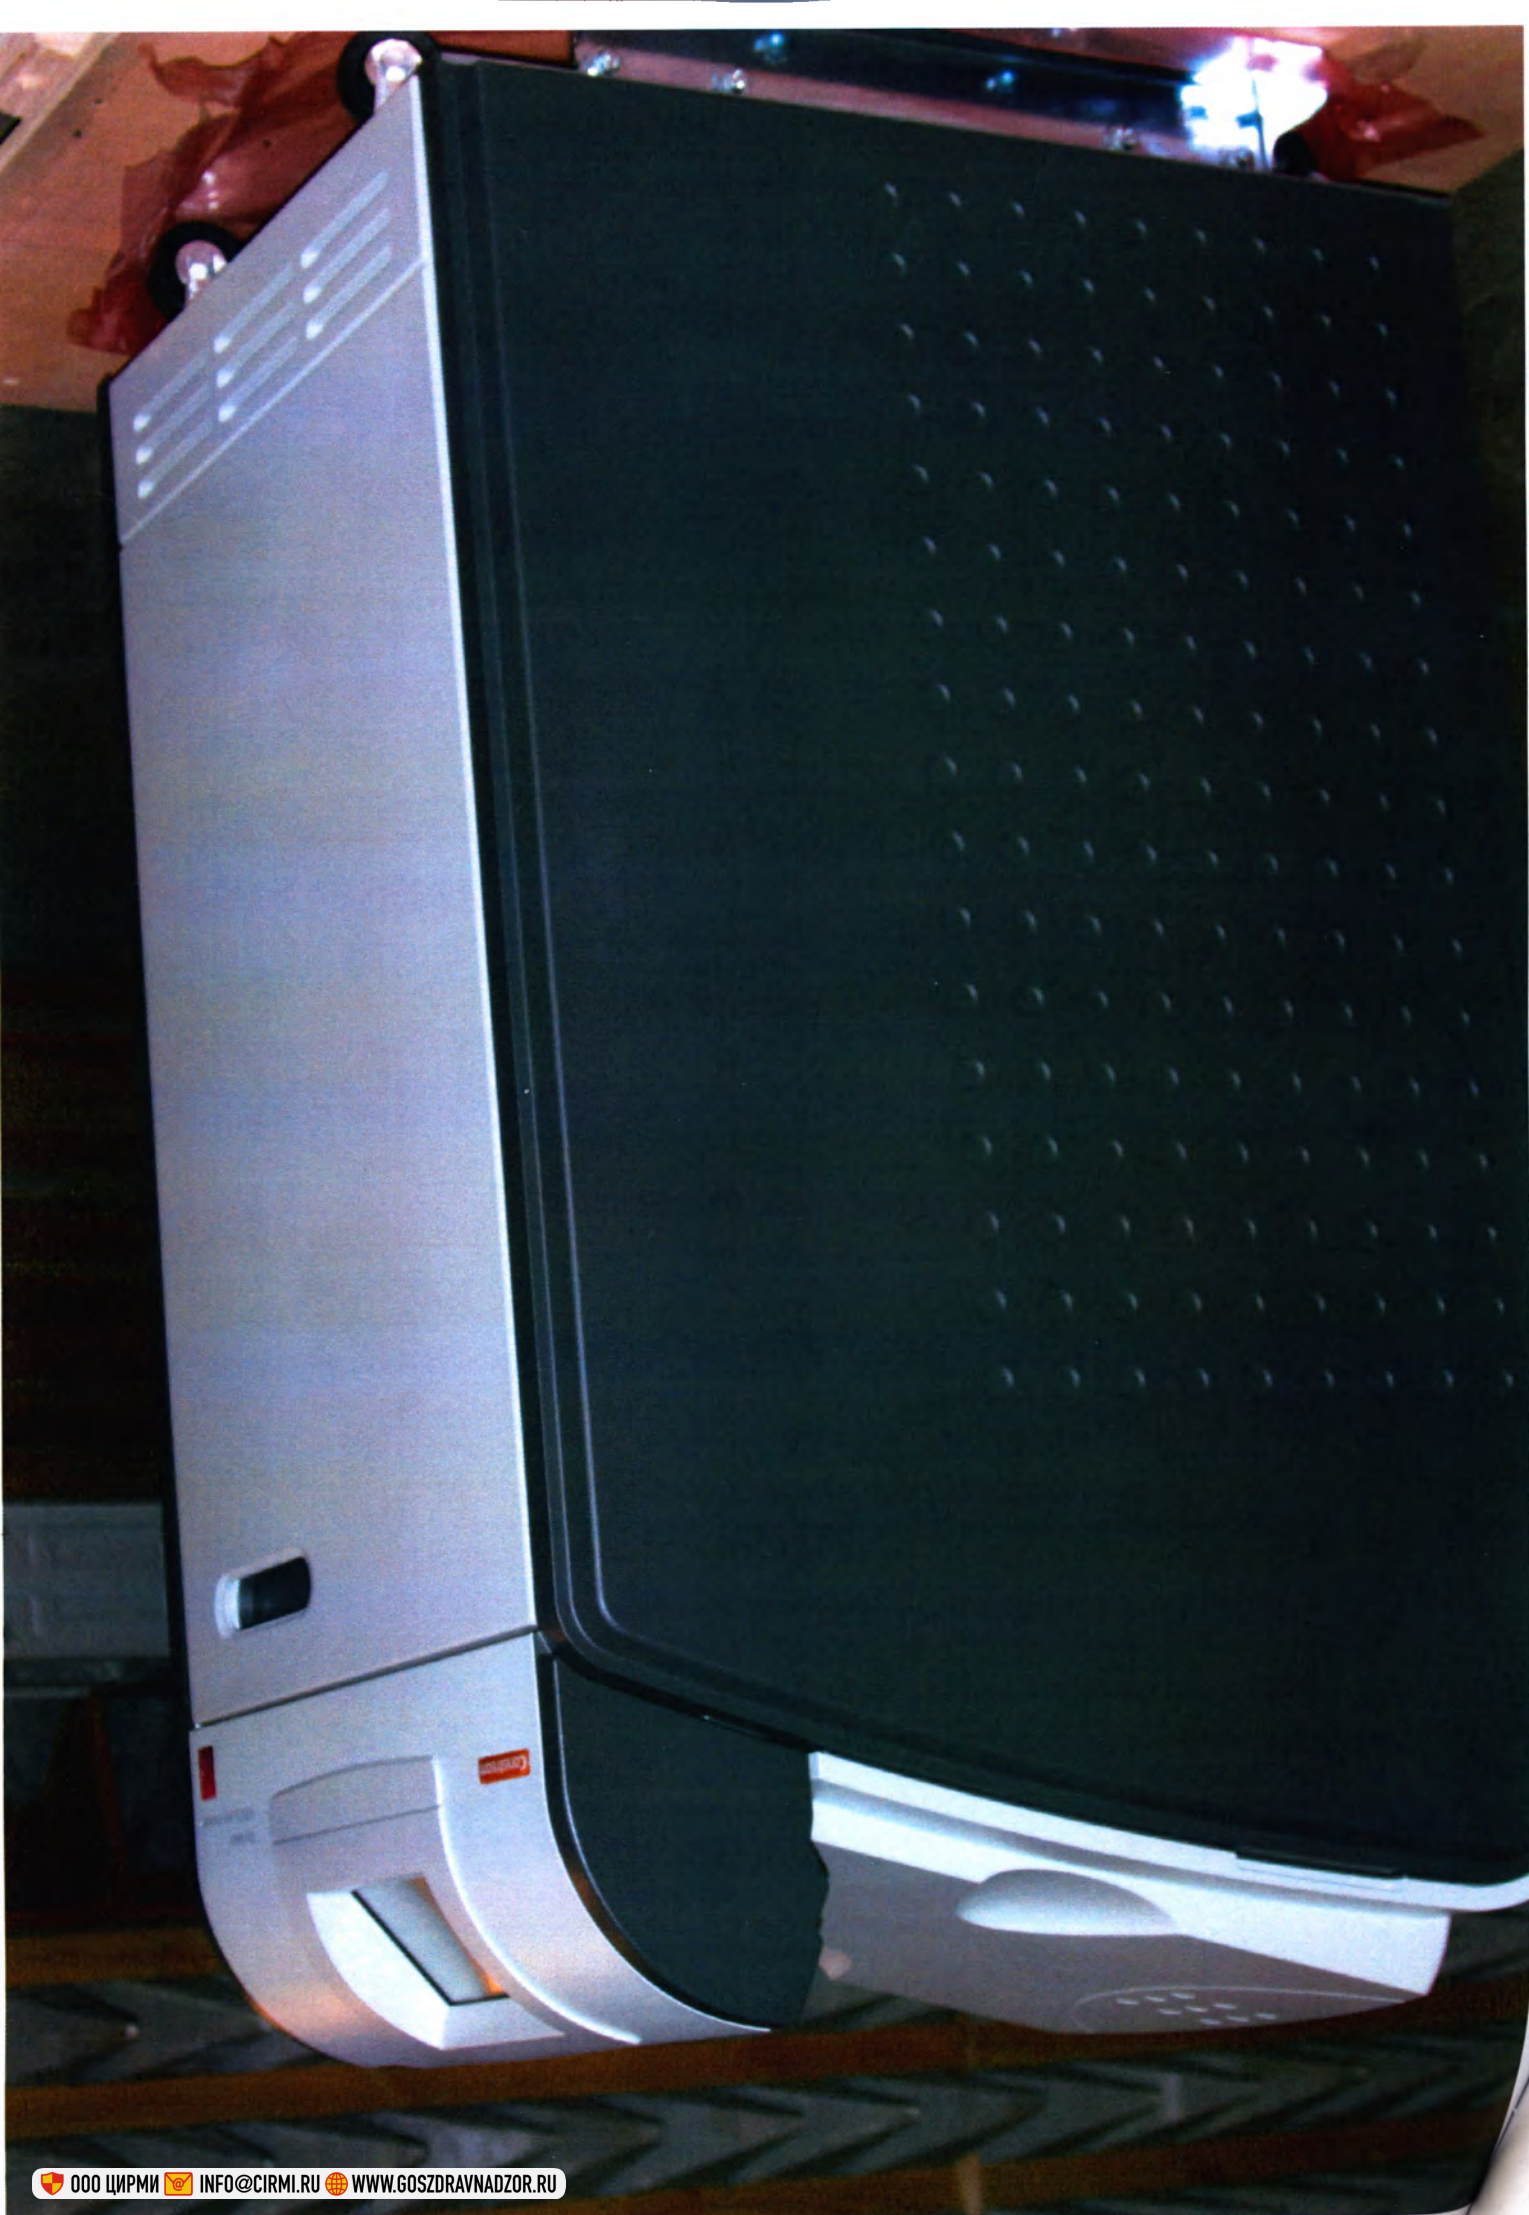

Carestream

DryView
6950 Laser Imager



DRYVIEW 6950 Laser Imaging System

干式激光成像仪

MODEL

6950

SN

69530512

P/N

AB5002

REF

6565469



MANUFACTURED

June--2015/2015-6

V

200-240 V~

A

6A

HZ

50/60Hz

Made in China by Rayco for

Carestream Health Inc

150 Verona Street

Rochester, NY USA 14606

锐珂(上海)医疗器材有限公司

上海市浦东新区金桥出口加工区川桥路1510号



第4幢通用厂房第1层南侧B单元、第7幢通用厂

房第2层 邮编: 201206

7F3118.W



WWW.CARESTREAM.COM
DOCUMENTATION



激光成像打印机


レーザーイメー
ジングプリンター

Laserprinter voor beeldverwerking

Laserbildbehandlingskrivare

Принтер лазерного

- 只有当设备连接到标有「医院使用」或「医院专用」的同等插座上，才能确保接地可靠性。
- 接地线的连续性是机器「医院专用」或「医院专用」与表示されている等価シヤツタカに接続されている場合のみ確保されます。
- Grounding reliability can only be achieved when the equipment is connected to an equivalent receptacle marked 'Hospital Only' or 'Hospital Grade'.
- La fiabilidad de la toma de tierra sólo puede garantizarse cuando el equipo está conectado a una toma equivalente de grado hospitalario.
- Damit eine zuverlässige Erdung erzielt wird, muss das Gerät an eine Steckdose mit Schutzerdungskontakt angeschlossen werden.
- La fiabilité de la mise à la terre ne peut être obtenue que si l'équipement est connecté à une prise électrique marquée « Hospital Only » (Usage hospitalier uniquement) ou « Hospital Grade » (Qualité hospitalière).
- Si può ottenere l'affidabilità della messa a terra solo quando l'apparecchiatura è collegata a una presa equivalente contrassegnata con 'Hospital Only' (Solo Ospedale) o 'Hospital Grade' (Grado ospedale).
- Päällelly jording oppnas kun när utstyret er tilkoblet fast monteret stikkontakt.
- Luotettava maadoitus voidaan saavuttaa vain, kun laite liitetään vastaavaan pistoraasiaan, jossa on merkintä "Hospital Only" (Vain sairaala) tai "Hospital Grade" (Sairaalataso).
- Det er kun muligt at opnå en sikker jordforbindelse, når apparatet er tilsluttet en tilsvarende stikkontakt mærket 'Hospital Only' eller 'Hospital Grade'.
- Een betrouwbare aarding kan alleen worden bereikt als de apparatuur wordt aangesloten op een vergelijkbaar stopcontact met de aanduiding 'Ziekenhuisgebruik' of 'Ziekenhuisklasse'.
- Säker jording kan endast uppnås om utrustningen ansluts till ett nätströmsuttag för sjukhusbruk.
- Η αξιοπιστία της γείωσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε ισοδύναμο πρίζα με την ένδειξη 'Hospital Only' (μόνο για νοσοκομείο) ή 'Hospital Grade' (Κατηγορία νοσοκομειακή χρήση).
- A confiabilidade do aterramento somente pode ser alcançada quando o equipamento está conectado receptáculo equivalente marcado como 'Somente hospital' ou 'Grade do hospital'.
- Niezawodne uzimienie można uzyskać jedynie podłączając urządzenie do odpowiedniego gniazda oznaczonego jako "tylko szpital" lub "szpitalne".
- 접지(안정성)은 광범위하게 'Hospital Only' 또는 'Hospital Grade'로 표시된 해당 콘센트에 연결되었을 경우에만 보장할 수 있습니다.
- Topraklama güvenilirliği ancak ekipman 'Sadece Hastane' veya 'Hastane Sınıfı' işaretli eşdeğer bir prize takıldığında sağlanabilir.
- 只有當設備連接到標示為「醫院專用」或「醫院等級」的同等插座時，才能提供穩定的接地。
- Keutuhan pembumihan hanya boleh dicapai apabila peralatan disambungkan ke bekas yang setara bertanda 'Hospital sahaja' atau 'Gred Hospital'.
- Надежность заземления гарантируется только при подключении оборудования в эквивалентное гнездо с пометкой 'Только для больницы' или 'Для медицинского оборудования'.
- Chỉ có thể nói đạt an toàn khi thiết bị được kết nối với một ổ cắm điện có ký hiệu 'Chỉ dành cho Bệnh viện' hoặc 'Loại dành cho Bệnh viện' hoặc loại tương đương.





AB3448.E

Charcoal Filter Assembly

For Use With Laser Imagers

SN

Cycle Count Out:

Date Out:

M197951



Re-Order:
Kit - Filter, Charcoal, No: 1876325

Cycle Count In:

Date In:

AIRFLOW CHECK PASS



Made in China for
Carwestream Health, Inc.
150 Verona Street
Rochester, New York 14608 USA

20071010

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов
Генеральный директор ООО «Спектр»



Л.Н. Суржиков