

ООО «Терумо Рус»



Бизнес-Центр «Северная Башня»
123317, Москва, Россия,
ул. Тестовская, д. 10, 2-ой под., 13-й этаж,
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

www.terumo-europe.com

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Терумо Рус»

Уго Минору




« 24 » июня 2016 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Миксер донорской крови T-RAC II с принадлежностями»



Миксер донорской крови T-RAC II (версии Ethernet, Wi-Fi, Junior):– общий вид изделия

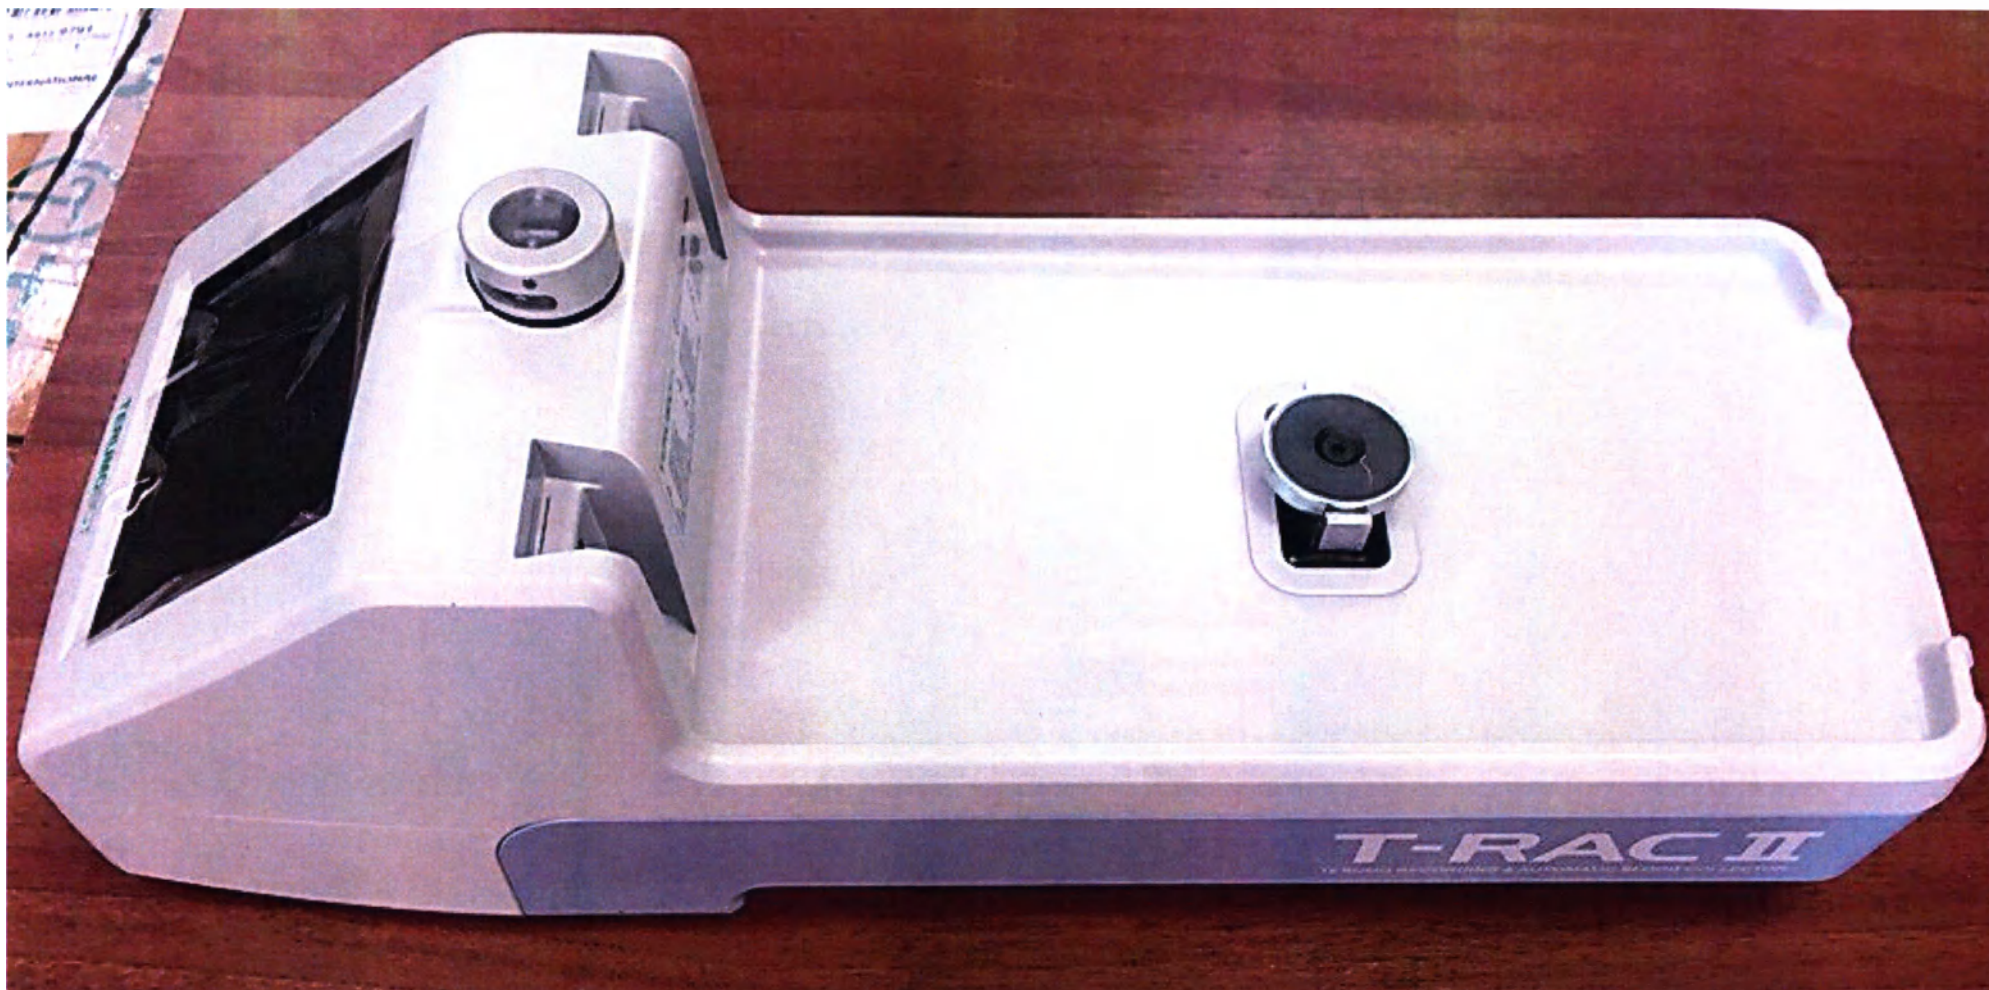


Миксер донорской крови T-RAC II (версии Ethernet, Wi-Fi, Junior):– общий вид изделия без лотка



Миксер донорской крови Т-РАС II (версии Ethernet, Wi-Fi, Junior):

Провод электропитания с источником питания.

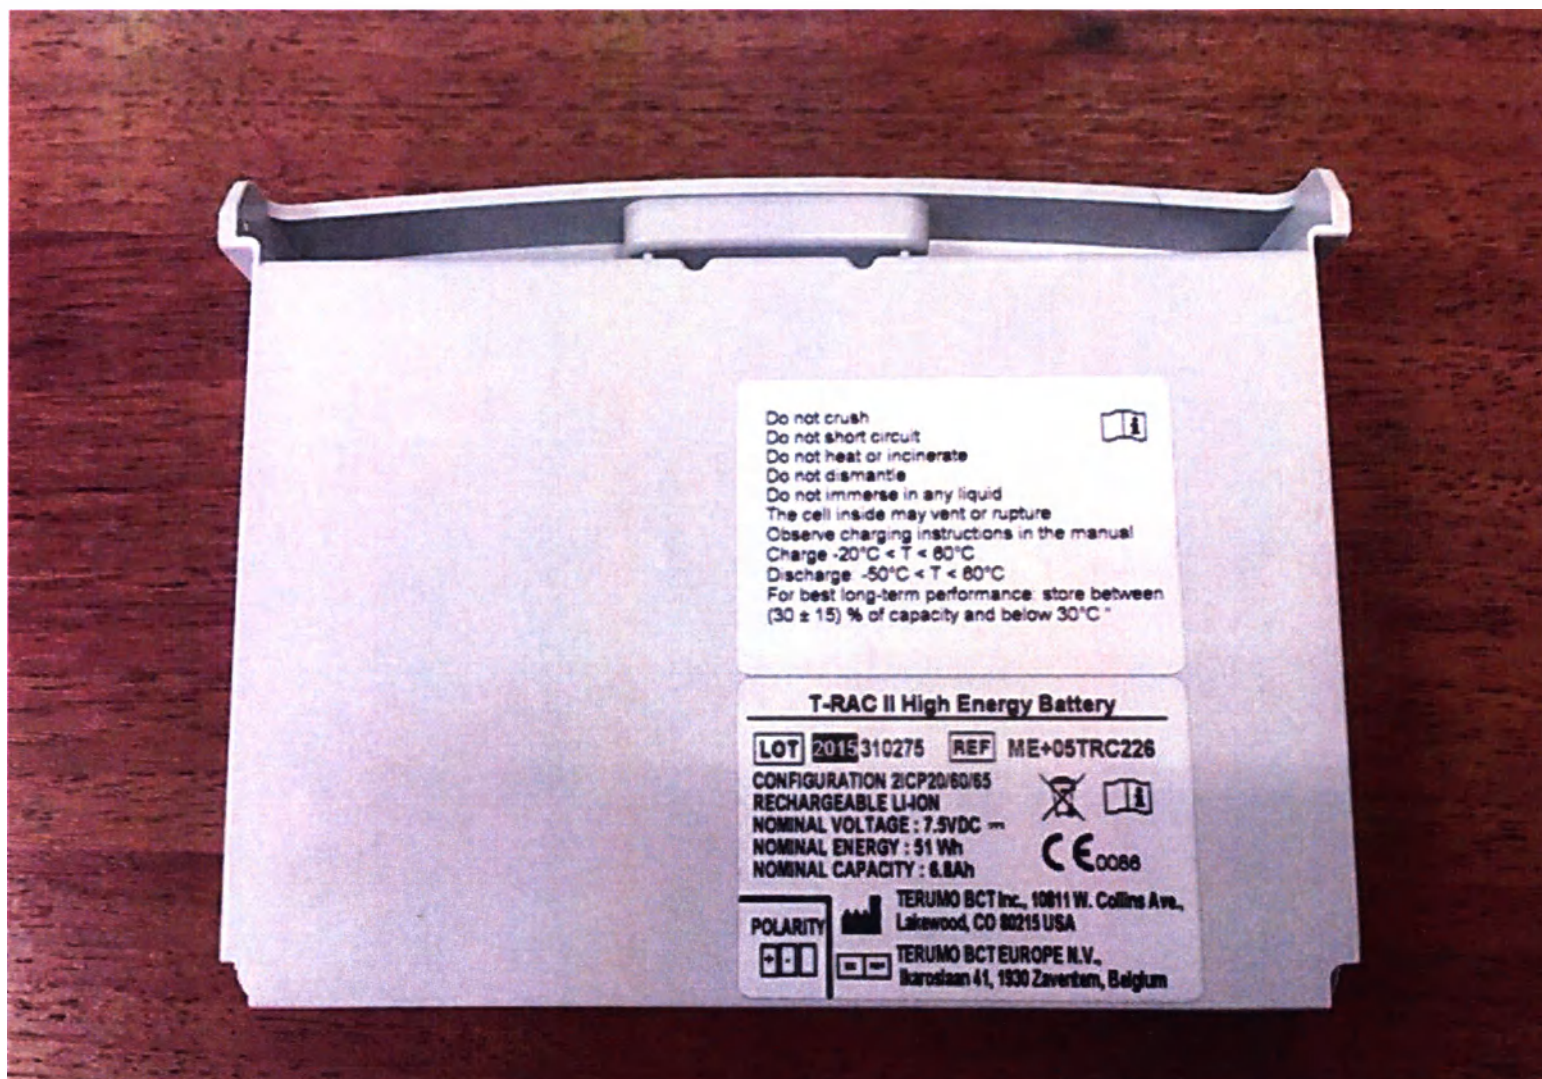

Миксер донорской крови T-RAC II (версии Ethernet, Wi-Fi, опционально для Junior):

Батарея высокочастотная



Миксер донорской крови Т-РАС II (версии Ethernet, Wi-Fi):

Сканер штрих-кодов с кабелем.


Инструкция по эксплуатации



USB-накопитель



Талон гарантийный

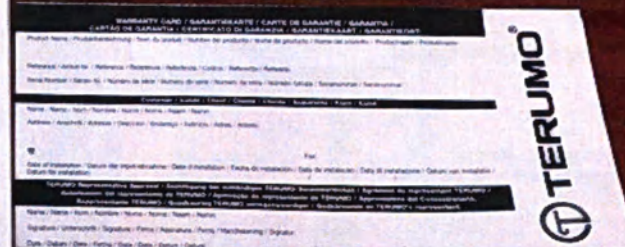

CD-ROM с инструкциями по эксплуатации

Миксер донорской крови T-RAC II (версия Ethernet):

USB-накопитель.

Инструкция по эксплуатации.

CD-ROM с инструкциями по эксплуатации.

Талон гарантийный.

Миксер донорской крови T-RAC II (версия Wi-Fi):

USB-накопитель.

Инструкция по эксплуатации.

CD-ROM с инструкциями по эксплуатации.

Талон гарантийный.

Кабель RJ-45





Миксер донорской крови T-RAC II (версия Junior):


Инструкция по эксплуатации.

CD-ROM с инструкциями по эксплуатации.


Талон гарантийный.



Контейнер транспортировочный.

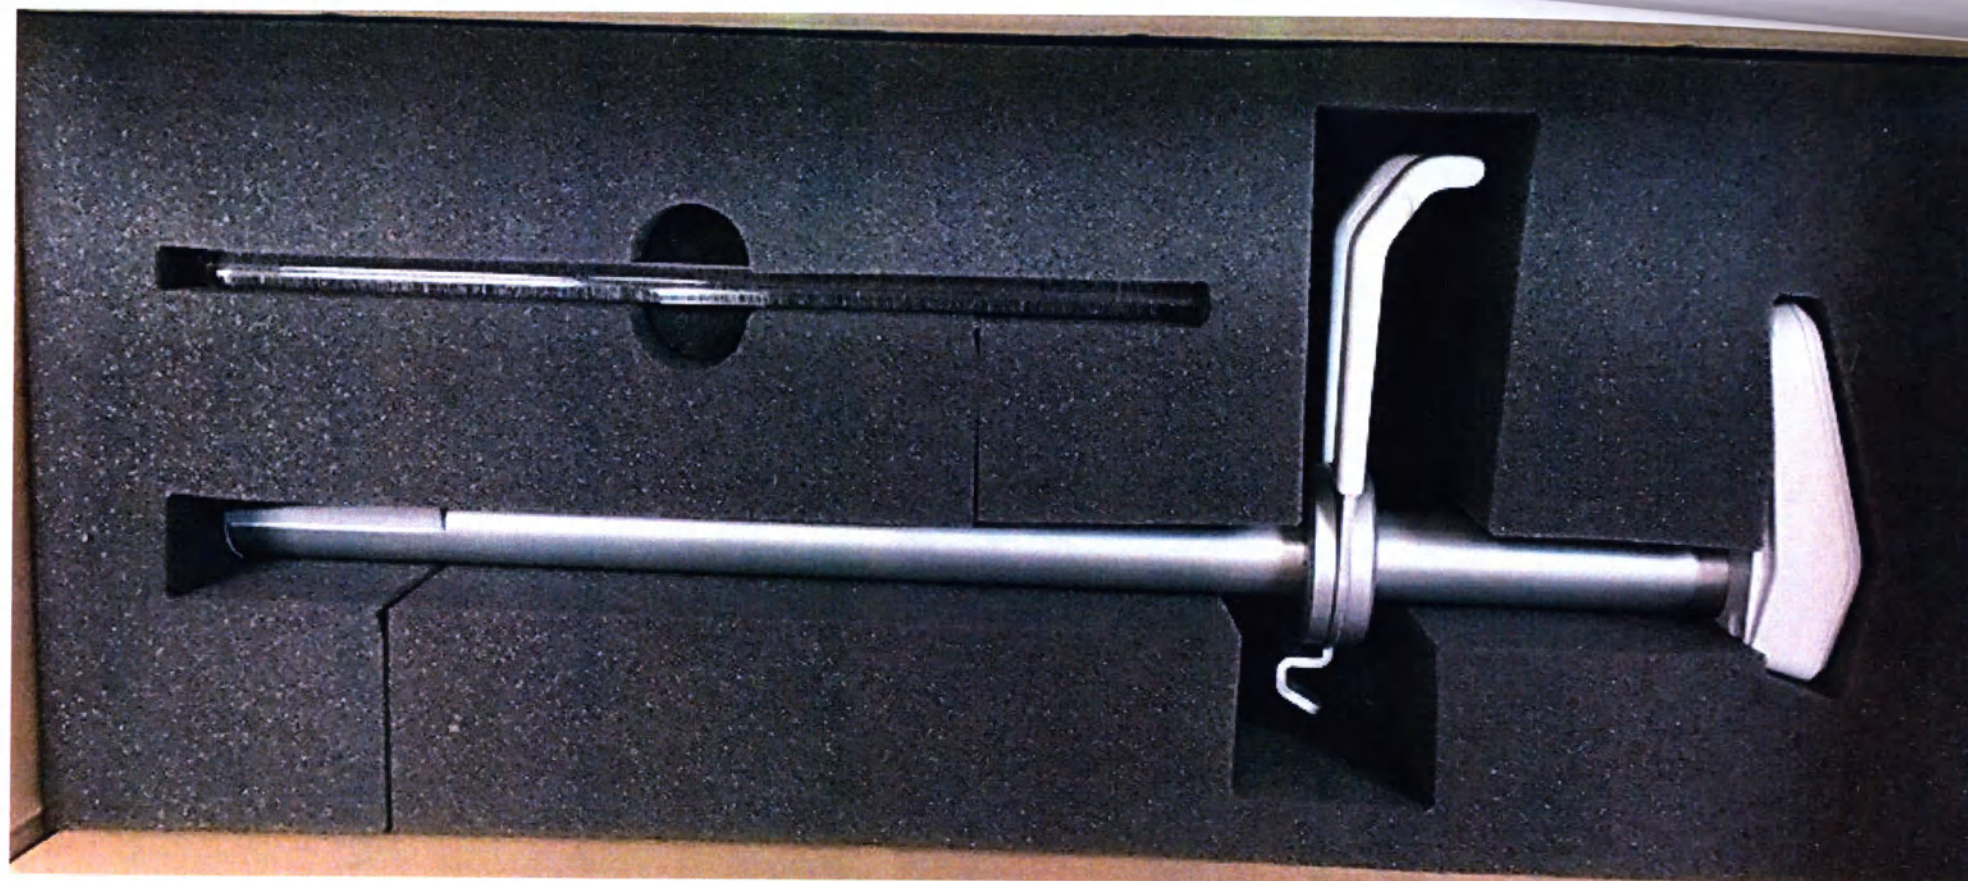

Штатив многофункциональный с длинной антенной (25 см).

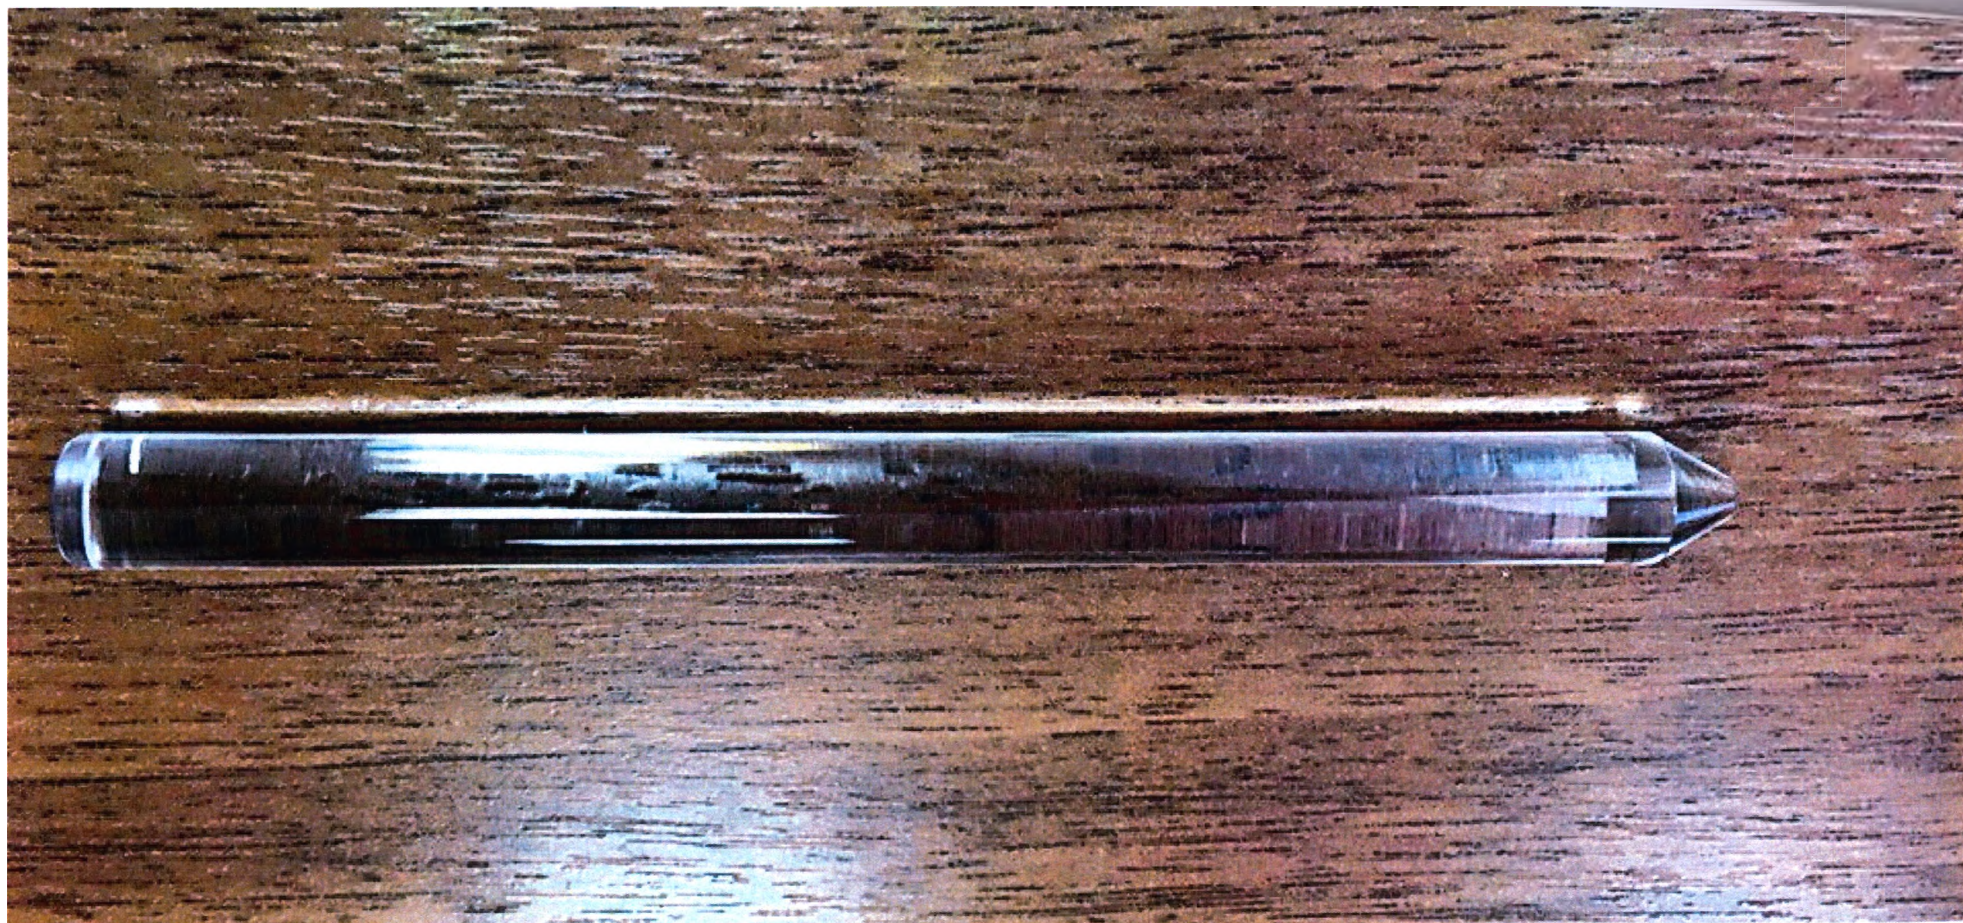

Антенна короткая 12,5 см для многофункционального штатива.



Пульт настольный дистанционного управления

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
13 листа (ов)

