

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

000 «Make»,

Ульянова К.Н.

2017 г.




Фотографические изображения медицинского изделия


Протез кровеносных сосудов FUSION в вариантах исполнения

MAKE ООО
109004 Москва
Ул. Станиславского, д. 21 стр. 3
тел.: +7 (495) 514-0055
факс: +7 (495) 514-0056
info.ru@maquet.com
www.maquet.ru

MEMBER OF THE GETINGE GROUP

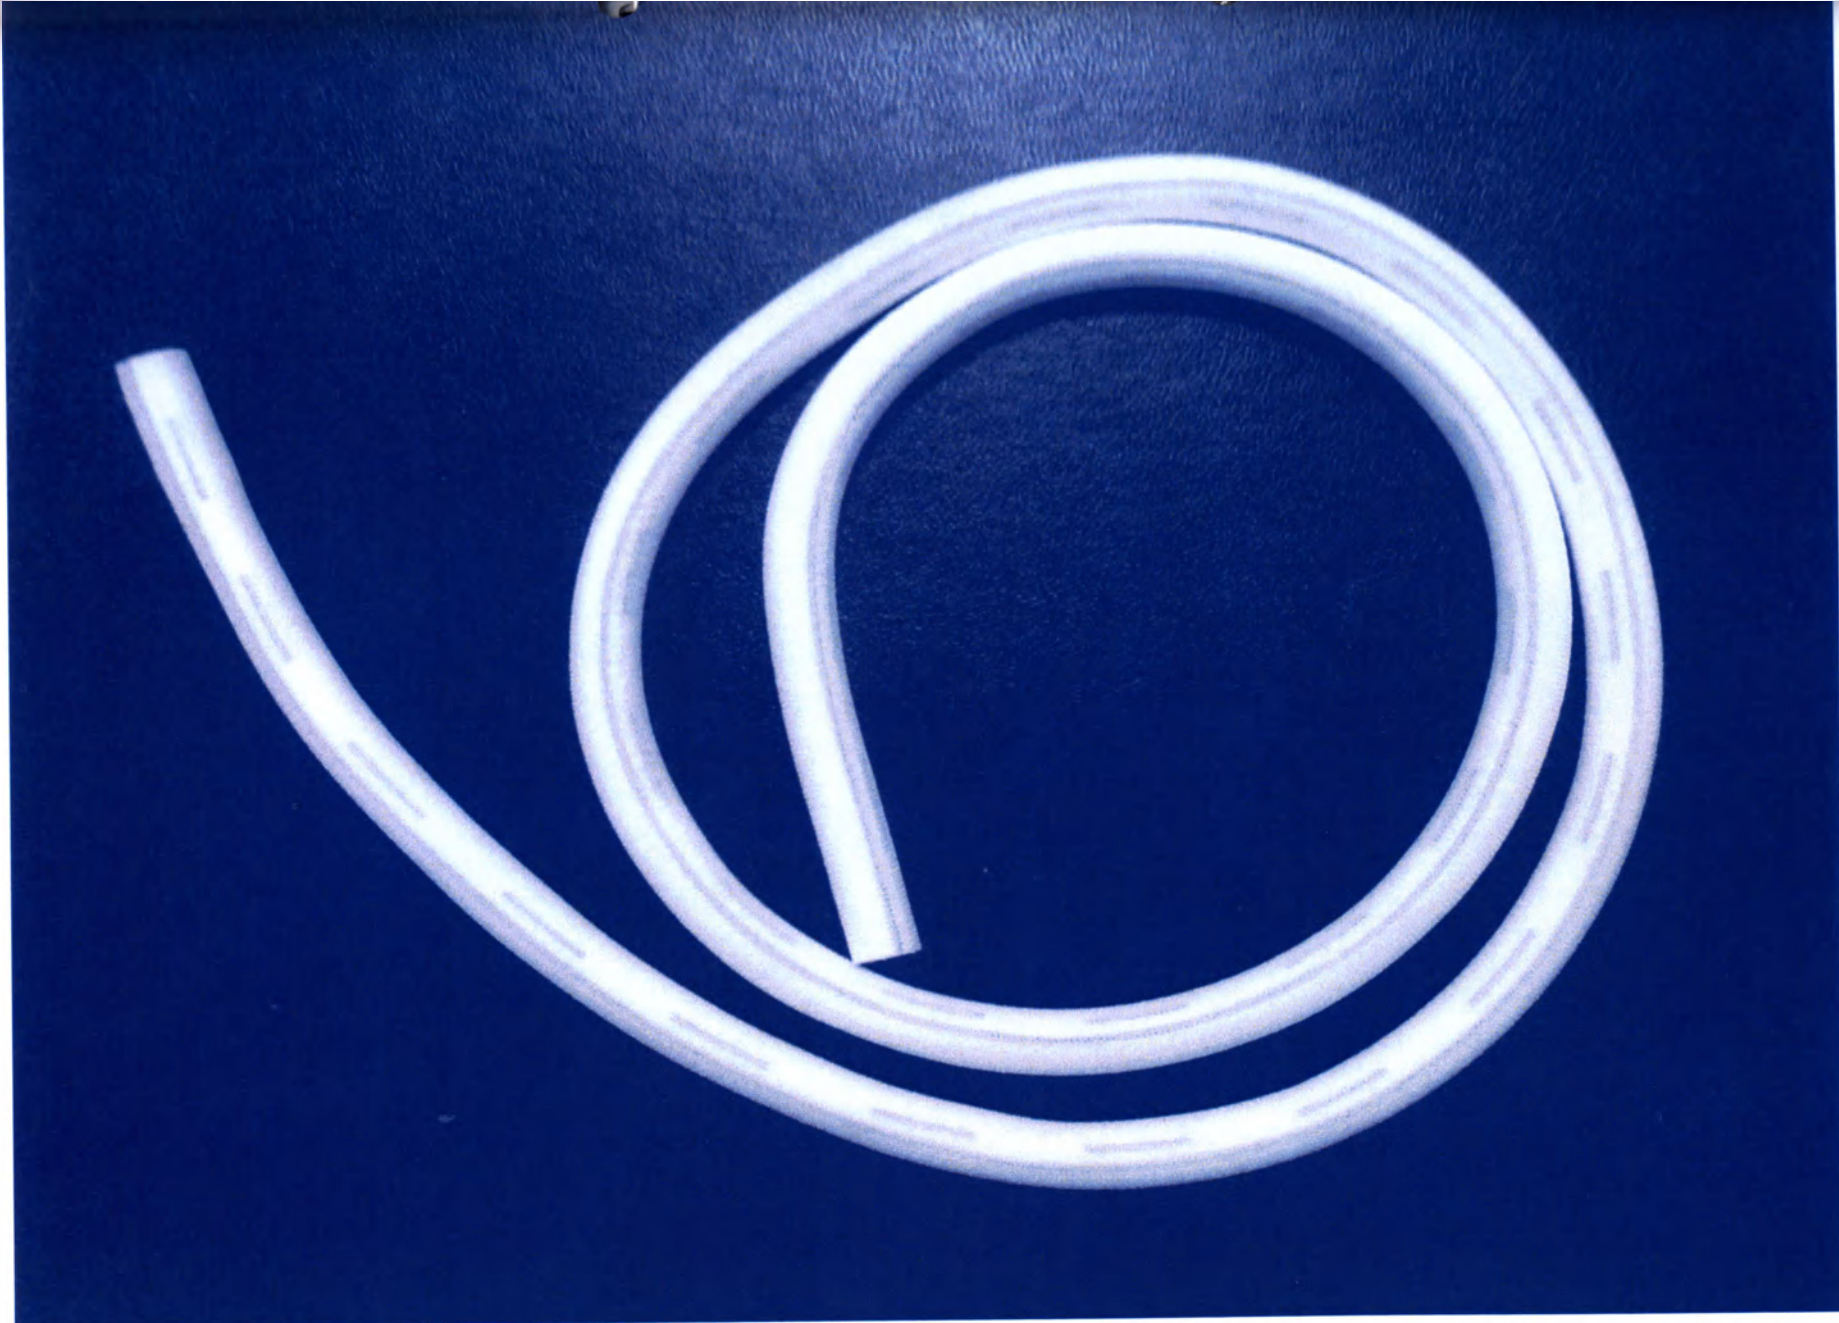


Протез кровеносных сосудов FUSION без поддержки

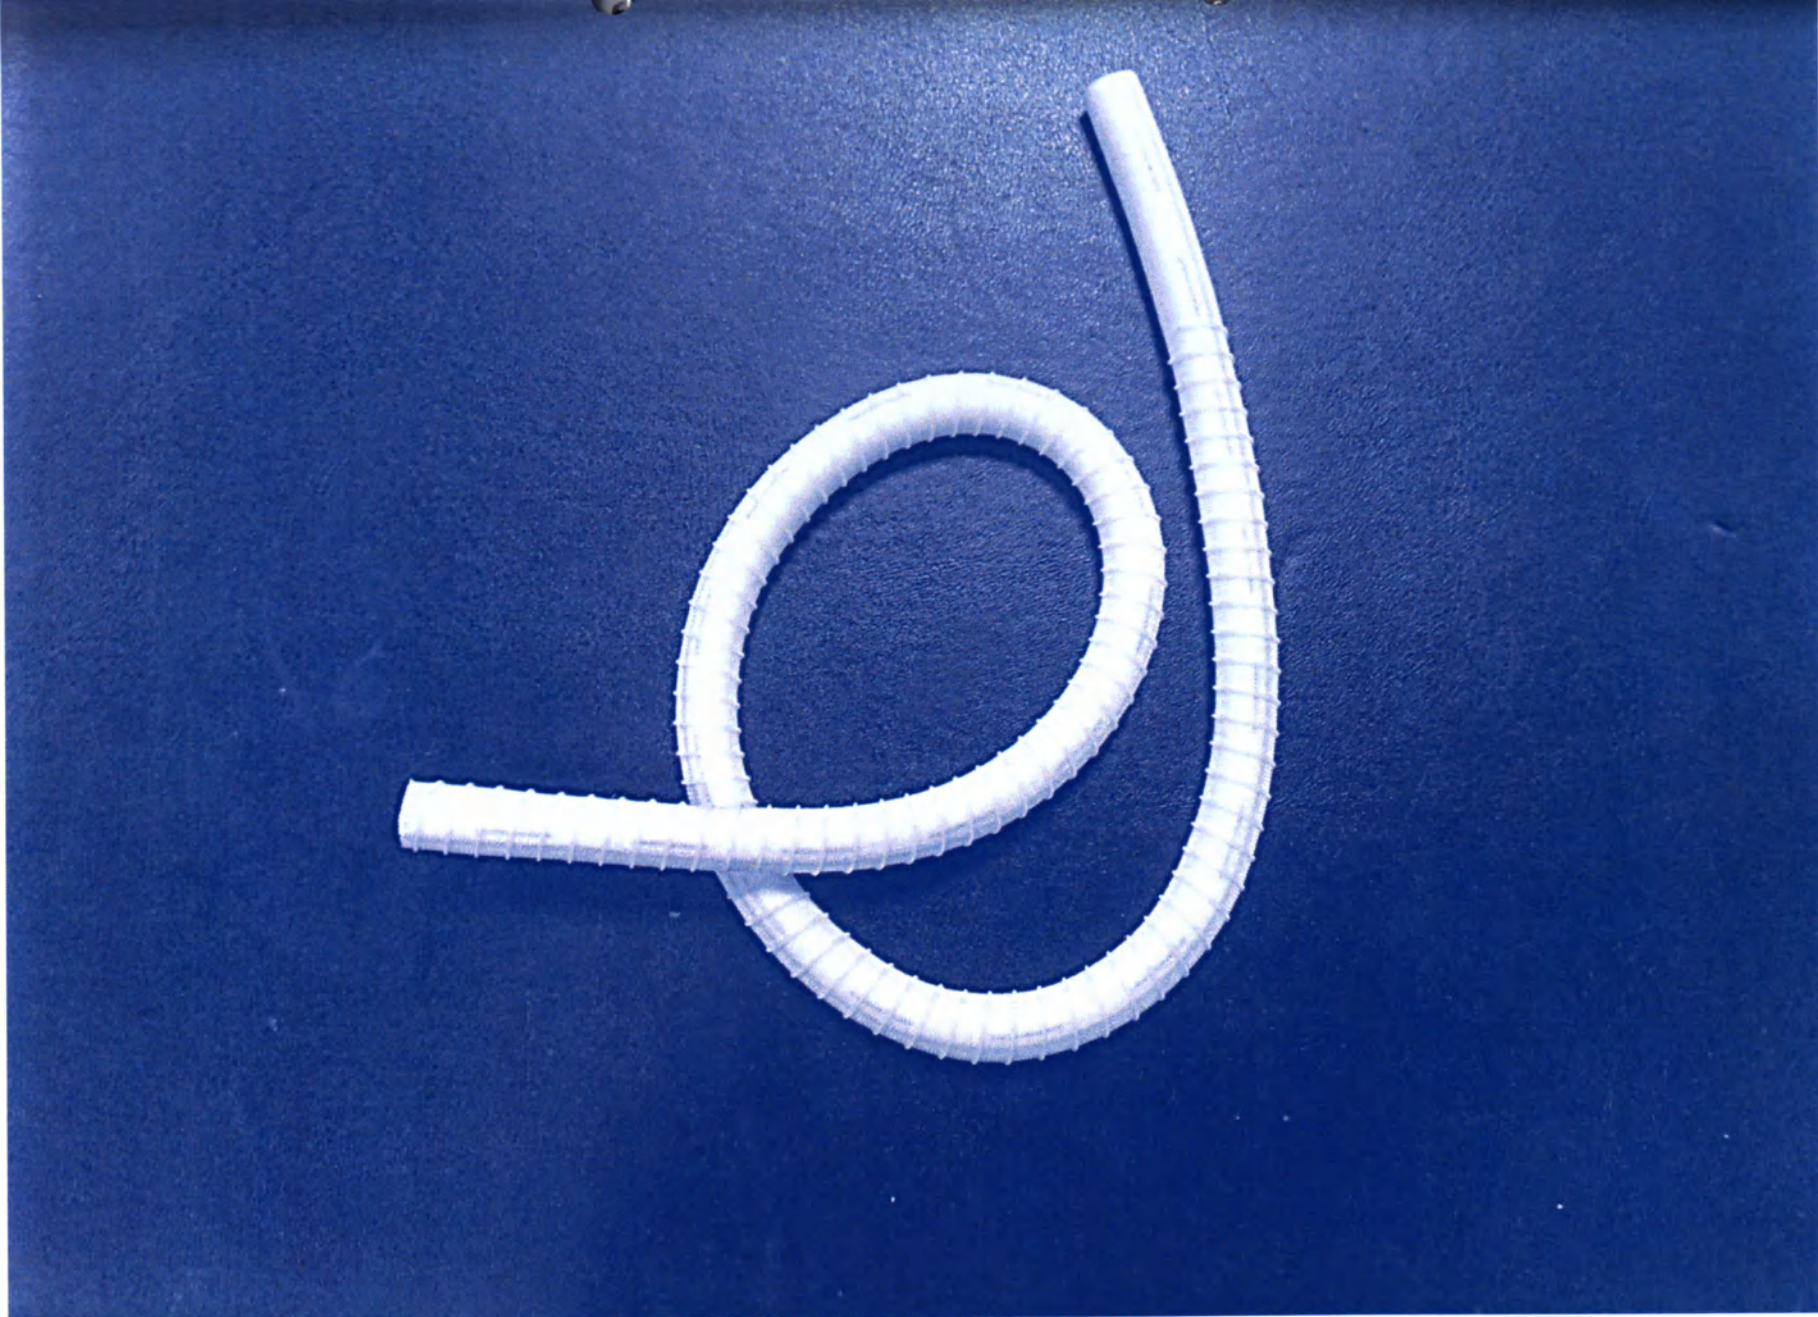

Протез кровеносных сосудов FUSION с поддержкой

3

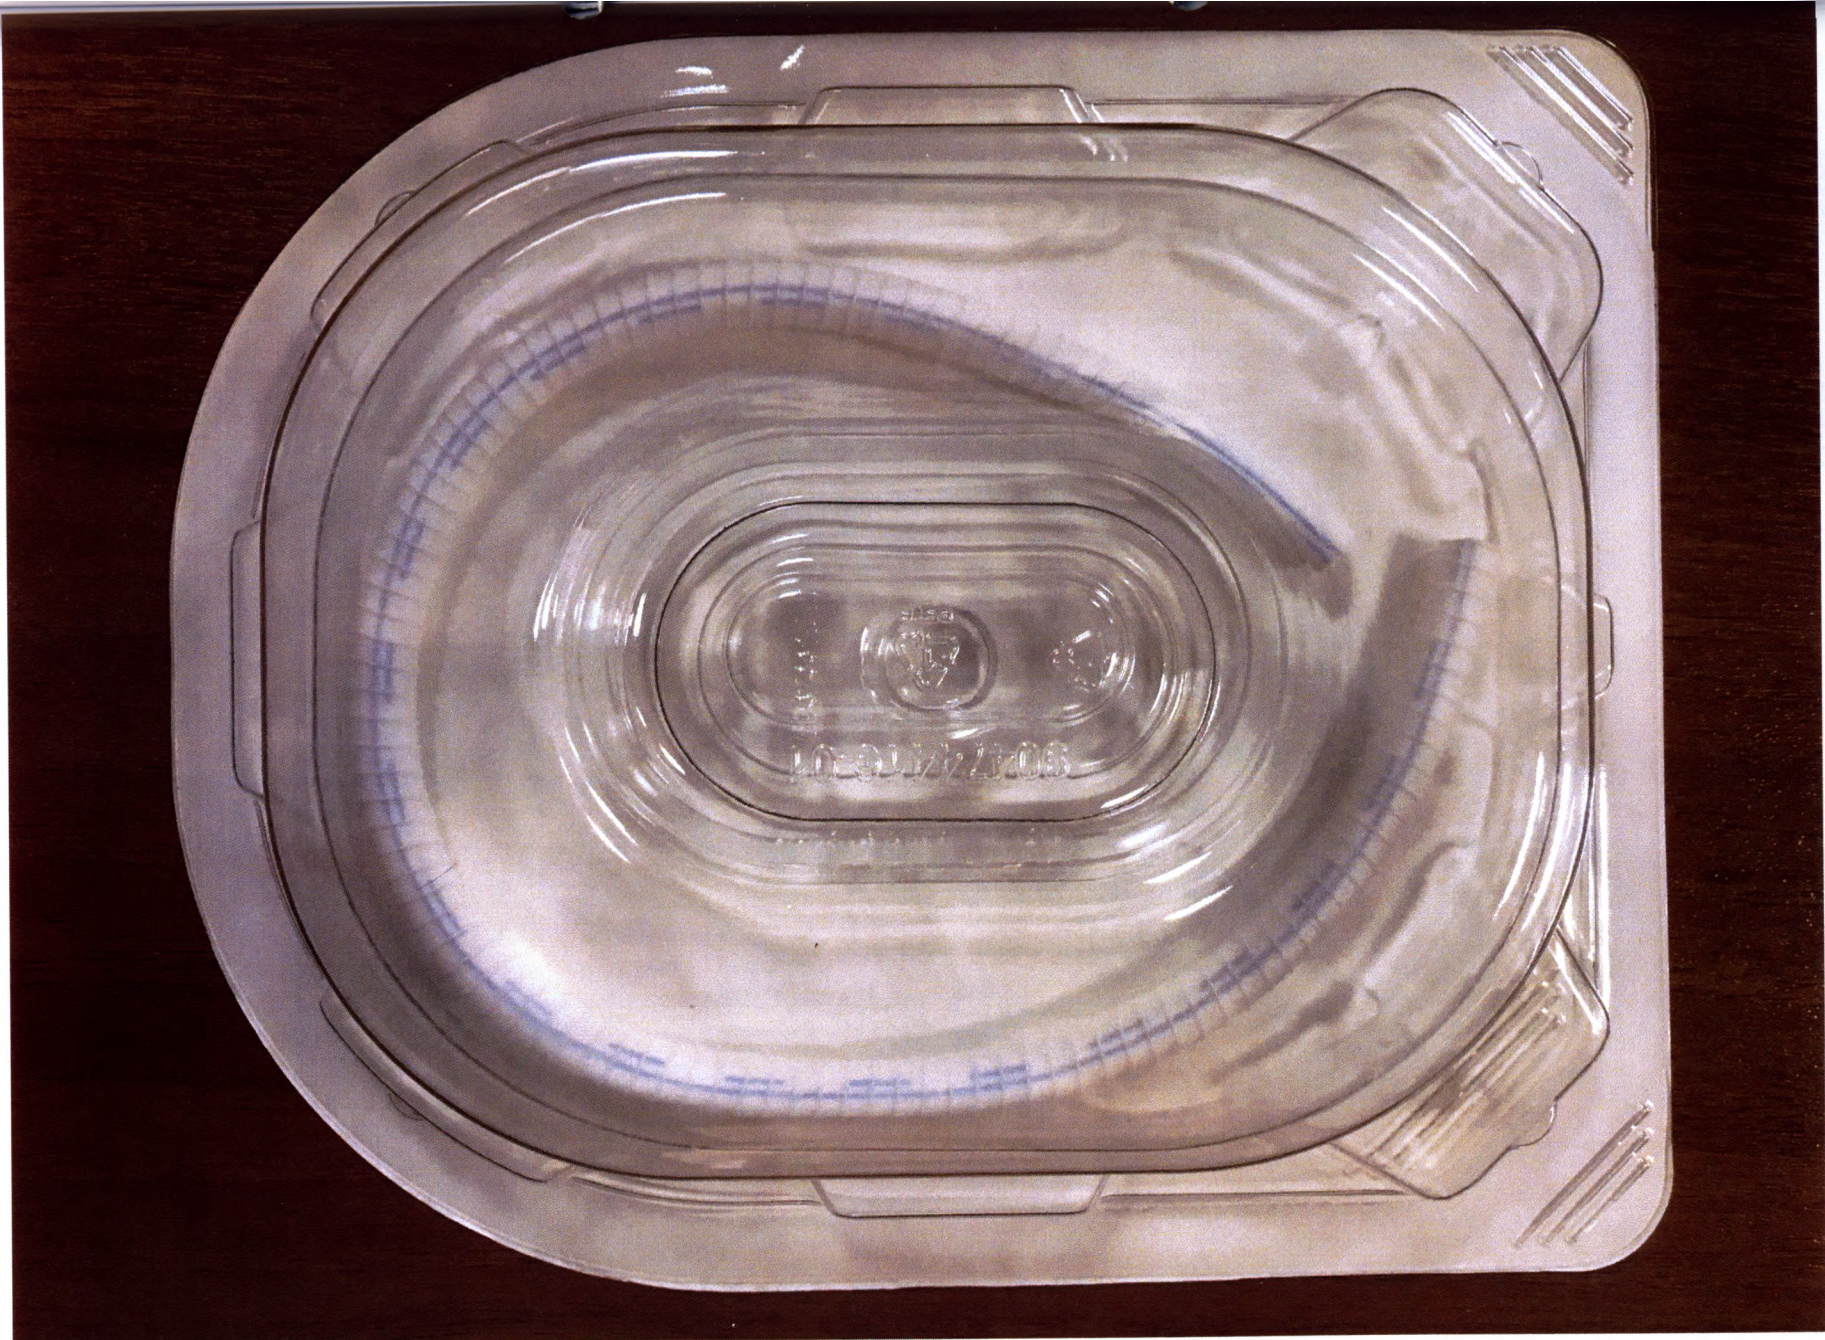

Протез кровеносных сосудов FUSION с поддержкой (во внешней стерильной упаковке - лицевая часть)

Use of a sheath tunneler is **required** for this graft
 L'utilisation d'un tunnélisateur à gaine est **obligatoire** avec ce greffon
 Diese Prothese **erfordert** die Verwendung eines Schleusentunnelers
 Para este injerto se **requiere** el uso de un tunelizador de vaina
 Per questo innesto è **necessario** l'uso di un tunneler per guaina
 このグラフトには、シース・トンネラーを必ず使用すること
 Voor deze prothese is het gebruik van een schachtkanalisatie-instrument **vereist**
 Det er **nødvendigt** at anvende et hylstertunnelinstrument til dette transplantat
 Για το μόσχευμα αυτό **απαιτείται** η χρήση εξαρτήματος δημιουργίας σήραγγας θηκαριού
 Este enxerto **requer** a utilização de um tunelizador de bainha
 Användning av tunnelerare **krävs** för detta graft
 此移植植物必須使用鞘管通道器

 Contents (1)

FUSION™

VASCULAR GRAFT

Straight Externally Supported

D: 8mm

L: 40cm

REF 503048

STERILE EO

UPN M002015030480

2014-03

LOT 25029067



Do Not Use If Sterile Barrier
Is Damaged



+M0020150304800



+S9010314250290670

CV000000332 A

TYVEK LABEL

MAQUET



Legal
Manufacturer

MAQUET Cardiovascular LLC
45 Barbour Pond Drive
Wayne, NJ 07470 USA
Customer Service 888-880-2874

EC REP EU Authorized
Representative

MAQUET Cardiopulmonary AG
Hechinger Str. 38
72145 Hirrlingen
Germany

CE 0123

Rx ONLY



Do not use if sterile
barrier is damaged.



This Product Contains
No Detectable Latex.

90484969-02 Rev B

Протез кровеносных сосудов FUSION с поддержкой (внешняя стерильная упаковка - задняя часть)



Протез кровеносных сосудов FUSION с поддержкой (во внутренней стерильной упаковке - лицевая часть)

Use of a sheath tunneler is required for this graft
 L'utilisation d'un tunnélisateur à gaine est obligatoire avec ce greffon
 Diese Prothese erfordert die Verwendung eines Schleusentunnelers
 Para este injerto se requiere el uso de un tunelizador de vaina
 Per questo innesto è necessario l'uso di un tunnelizer per guaina
 このグラフトには、シース・トンネラーを必ず使用すること
 Voor deze prothese is het gebruik van een schachtkanalisatie-instrument vereist
 Det er nødvendigt at anvende et hylstertunnelinstrument til dette transplantat
 Για το μόσχευμα αυτό απαιτείται η χρήση εξοπλισμού δημιουργίας σήραγγας θήκαριού
 Este enxerto requer a utilização de um tunelizador de bainha
 Användning av tunnelerare krävs för detta graft
 此移植植物必須使用鞘管通過器

Contents (1)

FUSION™
VASCULAR GRAFT

Straight Externally Supported

D: 8mm L: 40cm

REF 503048

STERILE EO

UPN M002015030480

2014-03 LOT 25029067



Do Not Use If Sterile Barrier
 Is Damaged



+M002015030480



+S0010314290290670

CV000000332 A

TYVEK LABEL

MAQUET

Legal
 Manufacturer


MAQUET Cardiovascular LLC
 45 Barbour Pond Drive
 Wayne, NJ 07470 USA
 Customer Service 888-880-2874

EC REP EU Authorized
 Representative

MAQUET Cardiopulmonary AG
 Hechinger Str. 38
 72145 Hirrlingen
 Germany

CE 0123

Rx ONLY



Do not use if sterile
 barrier is damaged.



This Product Contains
 No Detectable Latex.

90484956-02 Rev B

FUSION™ D: 8mm L: 40cm
VASCULAR GRAFT Straight Externally Supported

REF 503048

UPN M002015030480

LOT 25029067

MAQUET Cardiovascular LLC, 45 Barbour Pond Drive
 Wayne NJ 07470 888-880-2874

FUSION™ D: 8mm L: 40cm
VASCULAR GRAFT Straight Externally Supported

REF 503048

UPN M002015030480

LOT 25029067

MAQUET Cardiovascular LLC, 45 Barbour Pond Drive
 Wayne NJ 07470 888-880-2874

Протез кровеносных сосудов FUSION с поддержкой (внутренняя стерильная упаковка - задняя часть, стикеры для истории болезни пациента)

MAQUET
GETINGE GROUP

Use of a sheath tunneler is **required** for this graft
L'utilisation d'un tunnélisateur à gaine est **obligatoire** avec ce greffon
Diese Prothese **erfordert** die Verwendung eines Schleusentunnelers
Para este injerto se **requiere** el uso de un tunelizador de vaina
Per questo innesto è **necessario** l'uso di un tunneler per guaina
このグラフトには、シース・トンネラーを必ず使用すること
Voor deze prothese is het gebruik van een schachtkanalisatie-instrument **vereist**
Det er **nodvendigt** at anvende et hylstertunnelinstrument til dette transplantat
Για το μόσχευμα αυτό **απαιτείται** η χρήση εξαρτήματος δημιουργίας σήραγγας θηκαρίου
Este enxerto **requer** a utilização de um tunelizador de bainha
Användning av tunnelerare **krävs** för detta graft
此移植体必須使用鞘管通道器

 Contents (1)

FUSION™

VASCULAR GRAFT

Straight Externally Supported

D:8mm L:40cm

REF 503048

UPN M002015030480

 2014-03

LOT 25029067

STERILE EO



+H002015030480



+S0010314250290670

FUSION™
VASCULAR GRAFT
D:8mm L:40cm

Протез кровеносных сосудов FUSION с поддержкой (внешняя картонная упаковка)

Ген. директор
ООО «Маке»
Ульянова К.Н.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
8 листа (ов)

