

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Группа АСВОМЕД»



А. В. Чиняев

2016 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат для ударно – волновой терапии ShockMaster 300 с принадлежностями,
производства Uniphy Elektromedizin GmbH & Co. KG, Германия.


СОДЕРЖАНИЕ

1. Блок управления.....	4
2. Аппликатор.....	5
3. Держатель аппликатора	6
4. Ключ аппликатора.....	7
5. Головка диаметром 15 мм.....	8
6. Головка D-Actor диаметром 20 мм Т.....	9
7. Фиксатор головок.....	10
8. Гель контактный	11
9. Трубка направляющая металлическая.....	12
10. Сердечник ударный металлический.....	13
11. Сетевой шнур.....	14
12. Ручка - стилус для управления через сенсорный экран.....	15
13. Защитный противоскользящий коврик.....	16
14. Держатель аппликатора V- Actor.....	17
15. Аппликатор V-Actor.....	18
16. Сердечник ударный МА-Х.....	19
17. Головка диаметром 6 мм.....	20
18. Головка диаметром 10 мм.....	21
19. Головка диаметром 15 мм CERAMAX.....	22
20. Головка D-Actor диаметром 20 мм S.....	23
21. Головка диаметром 25 мм.....	24
22. Головка диаметром 30 мм.....	25
23. Головка D-Actor диаметром 35 мм S.....	26
24. Головка D-Actor диаметром 35 мм Т.....	27
25. Головка диаметром 40 мм.....	28
26. Головка глубокого воздействия Deep Impact.....	29
27. Головка фокусирующая.....	30


28. Головка шарообразная.....	31
29. Индикатор боли F-METER.....	32
30. Комплект сменных частей аппликатора.....	33
31. Комплект сменных частей MAX.....	34
32. Расширенный комплект сменных частей аппликатора.....	35
33. Колпачки защитные одноразовые.....	36
34. Компрессор.....	37
35. Фильтр воздушный 5 мкм с прокладками.....	38
36. Щётка для чистки принадлежностей.....	39
37. Тележка аппаратная.....	40
38. Чемодан транспортировочный с колёсами и выдвижной ручкой.....	41
39. Кофр транспортировочный.....	42
40. Приложение.....	43

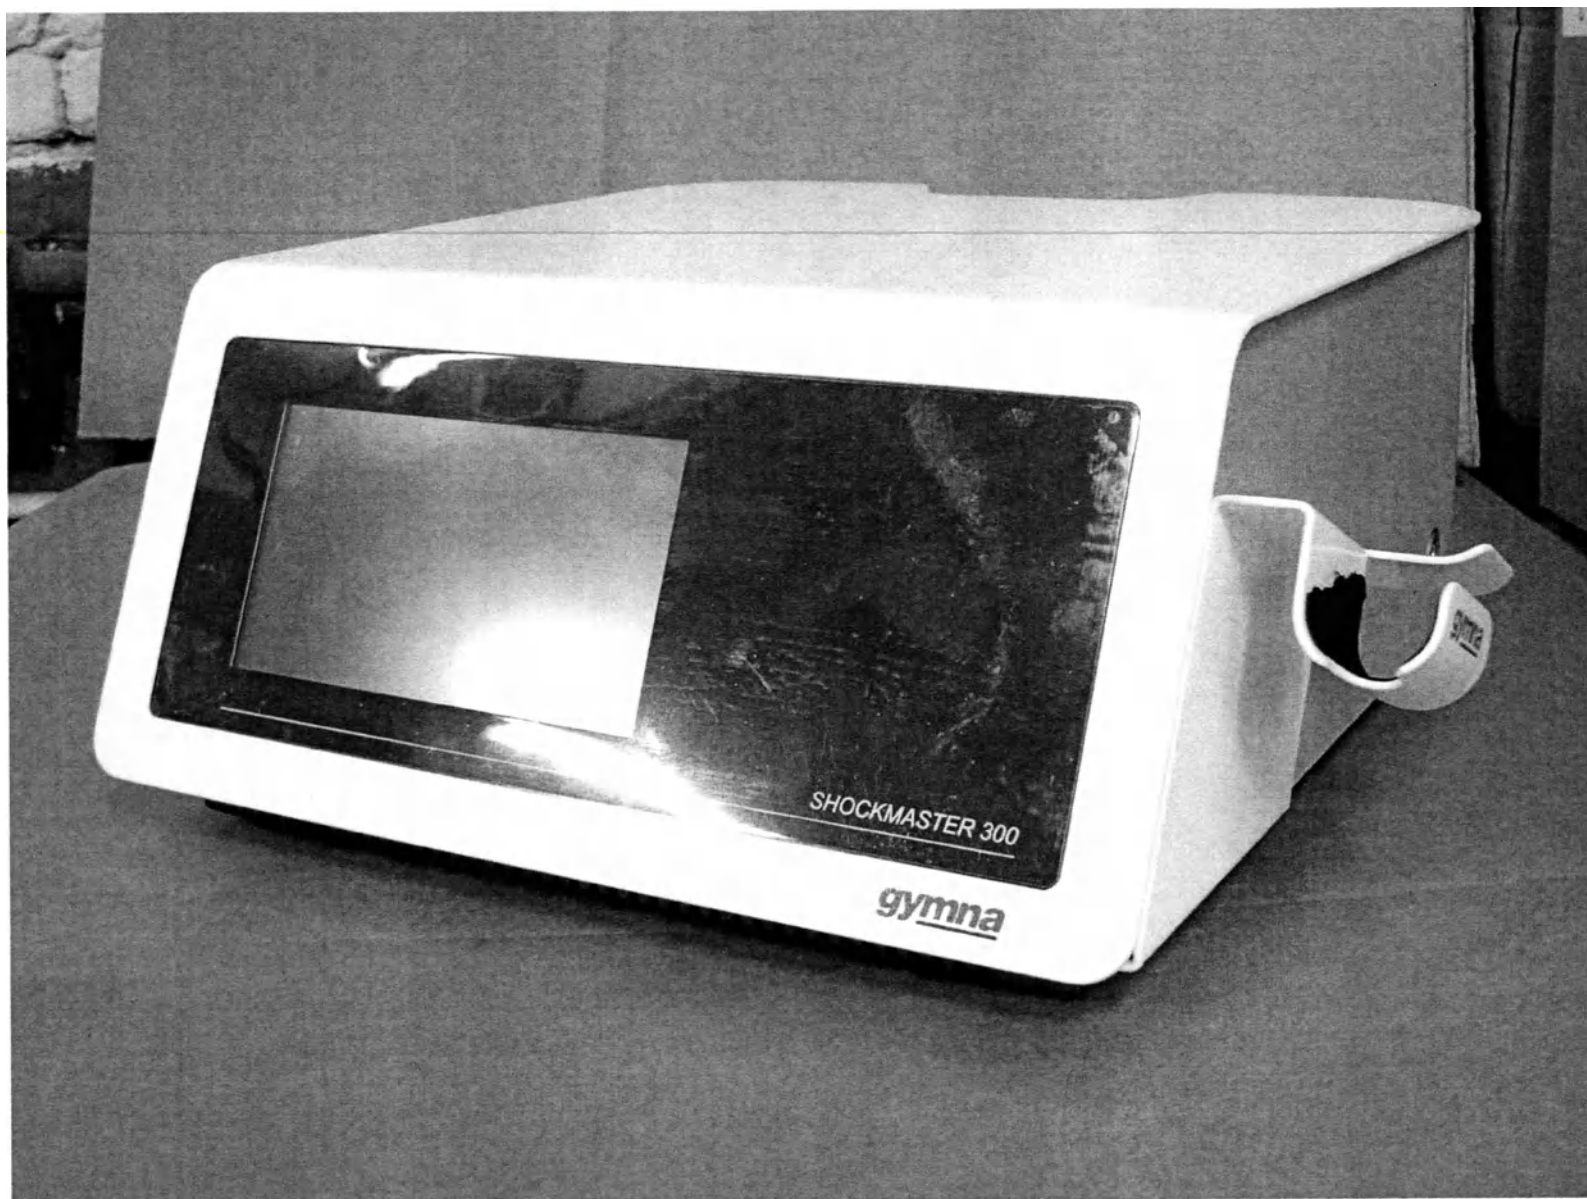

2. Аппликатор

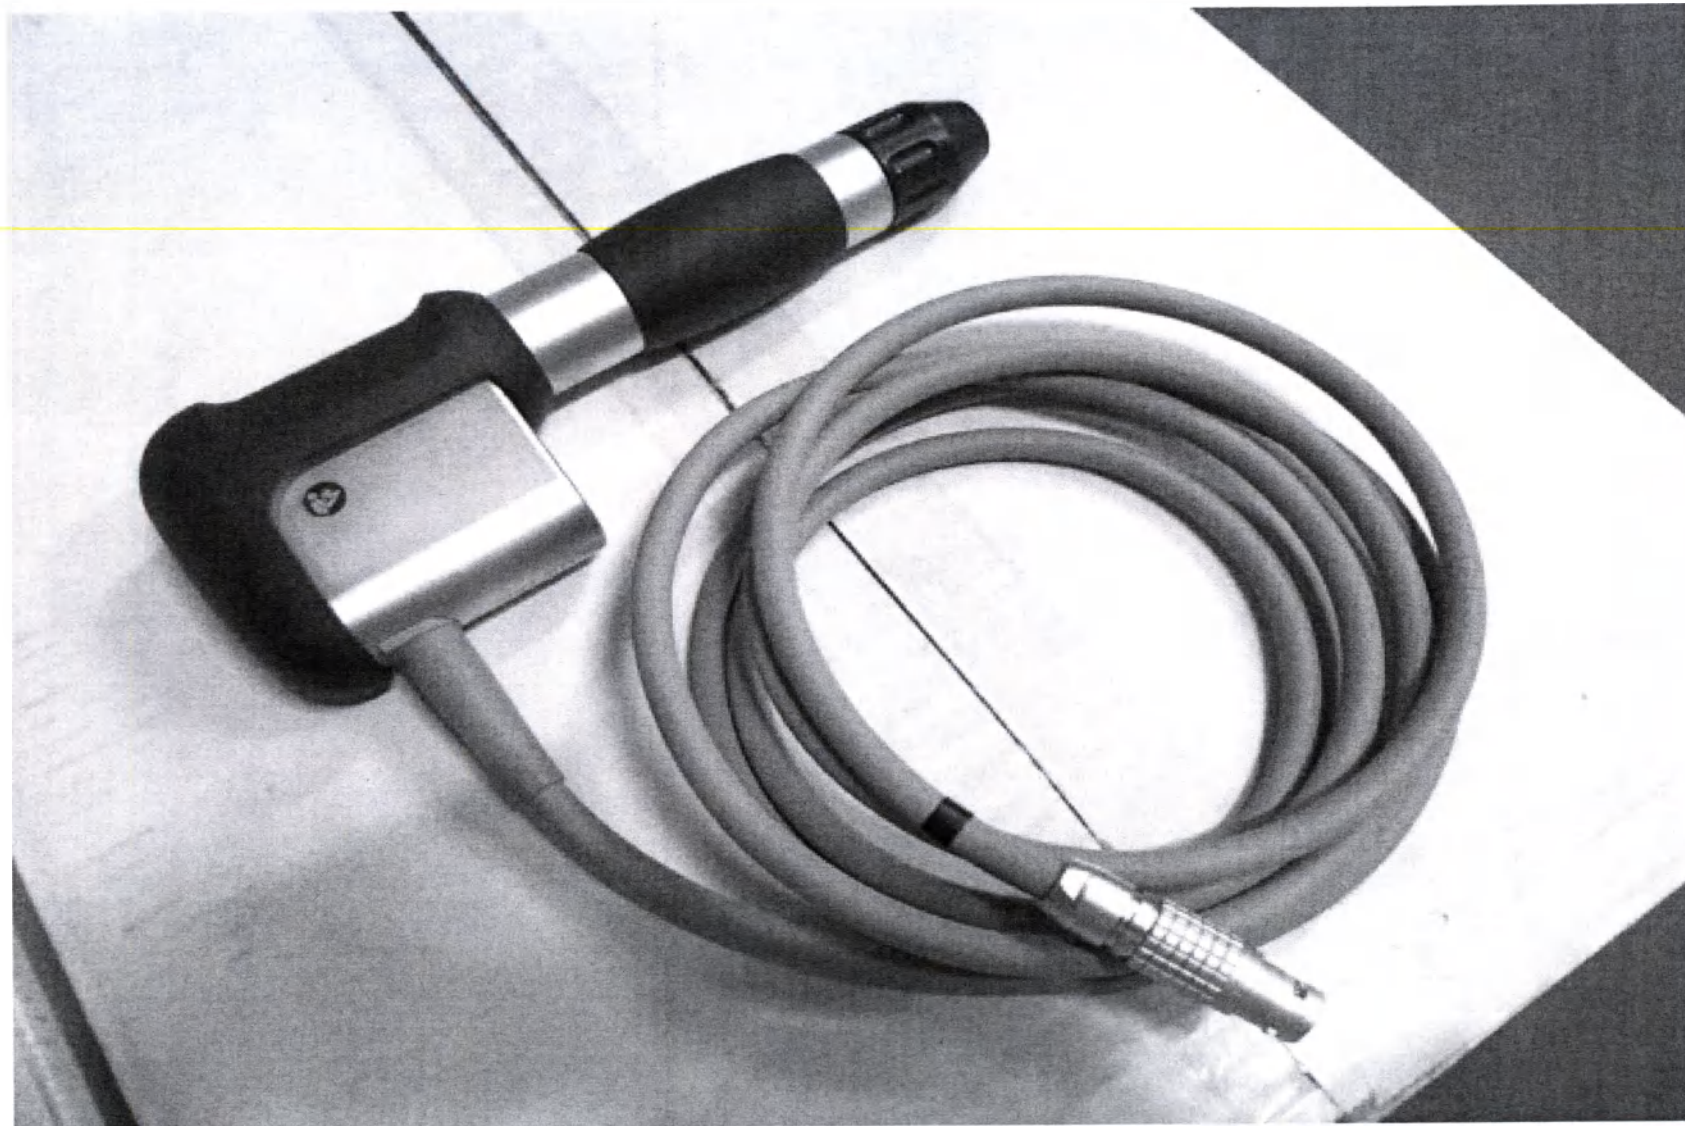


3. Держатель аппликатора

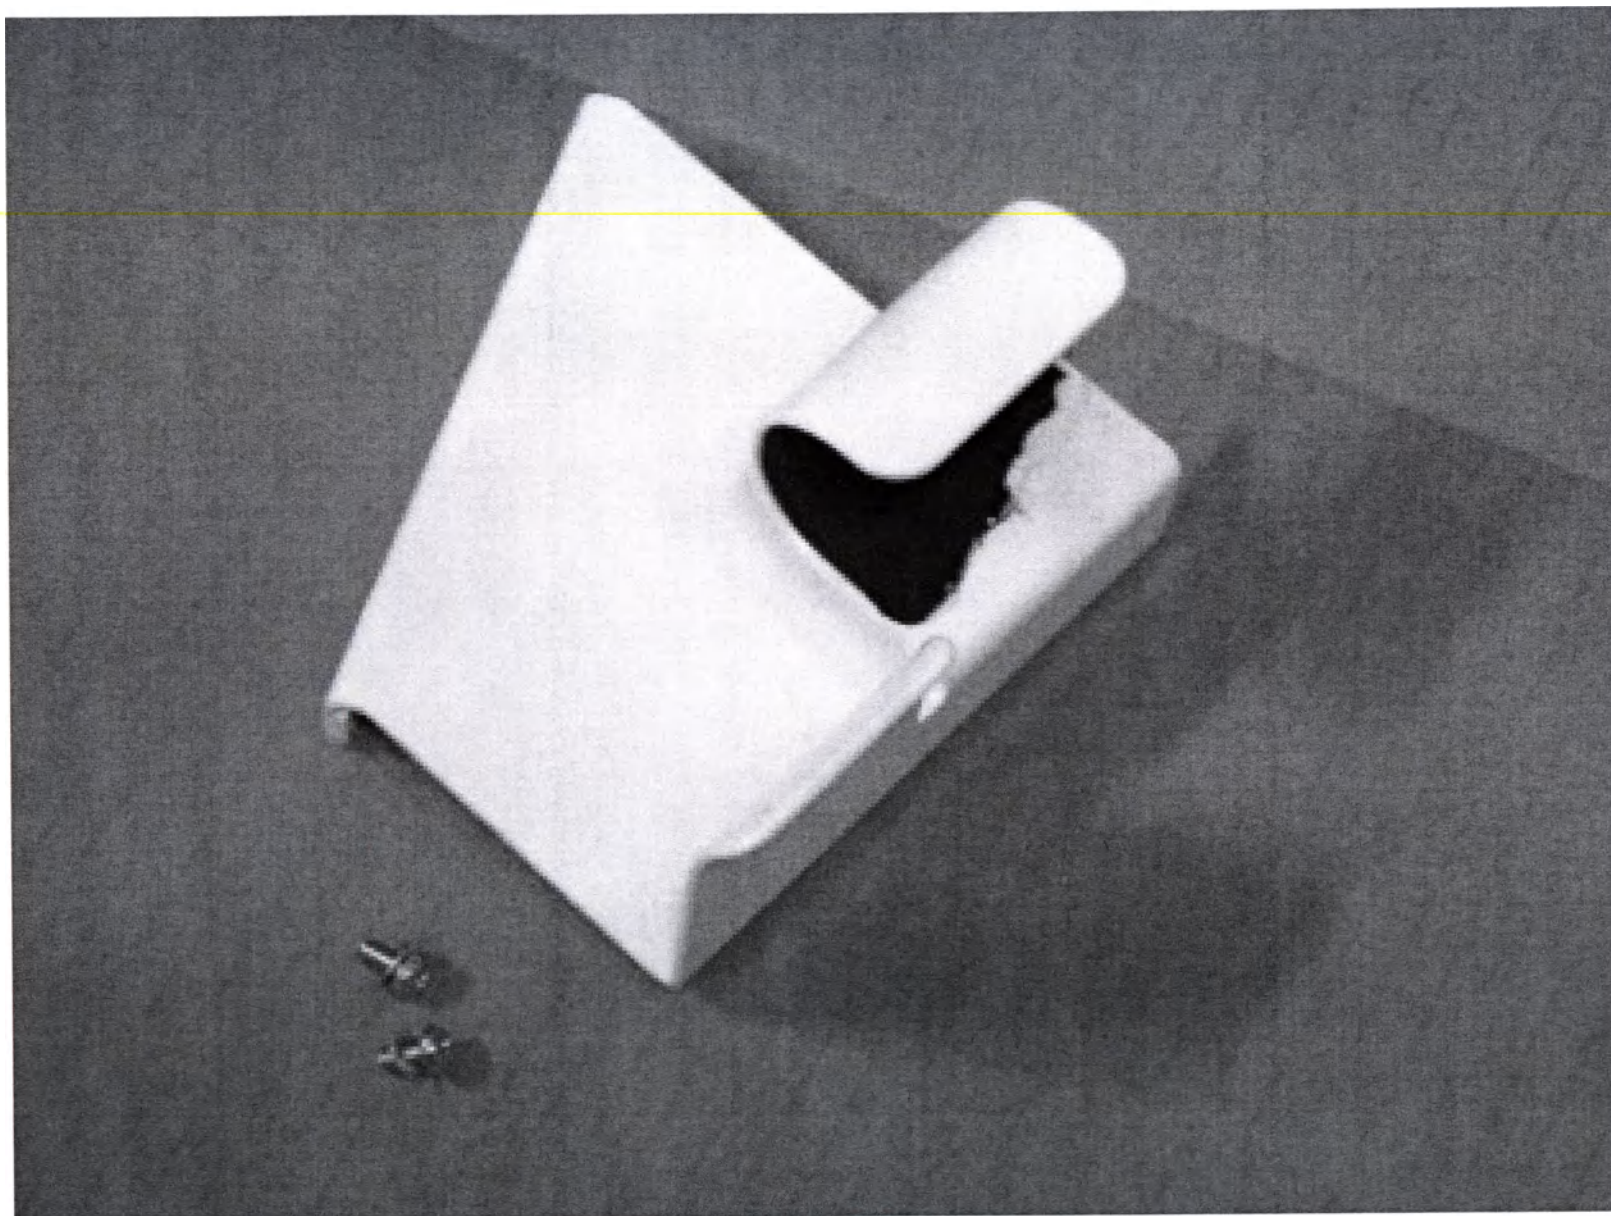


4. Ключ аппликатора



5.Головка диаметром 15 мм

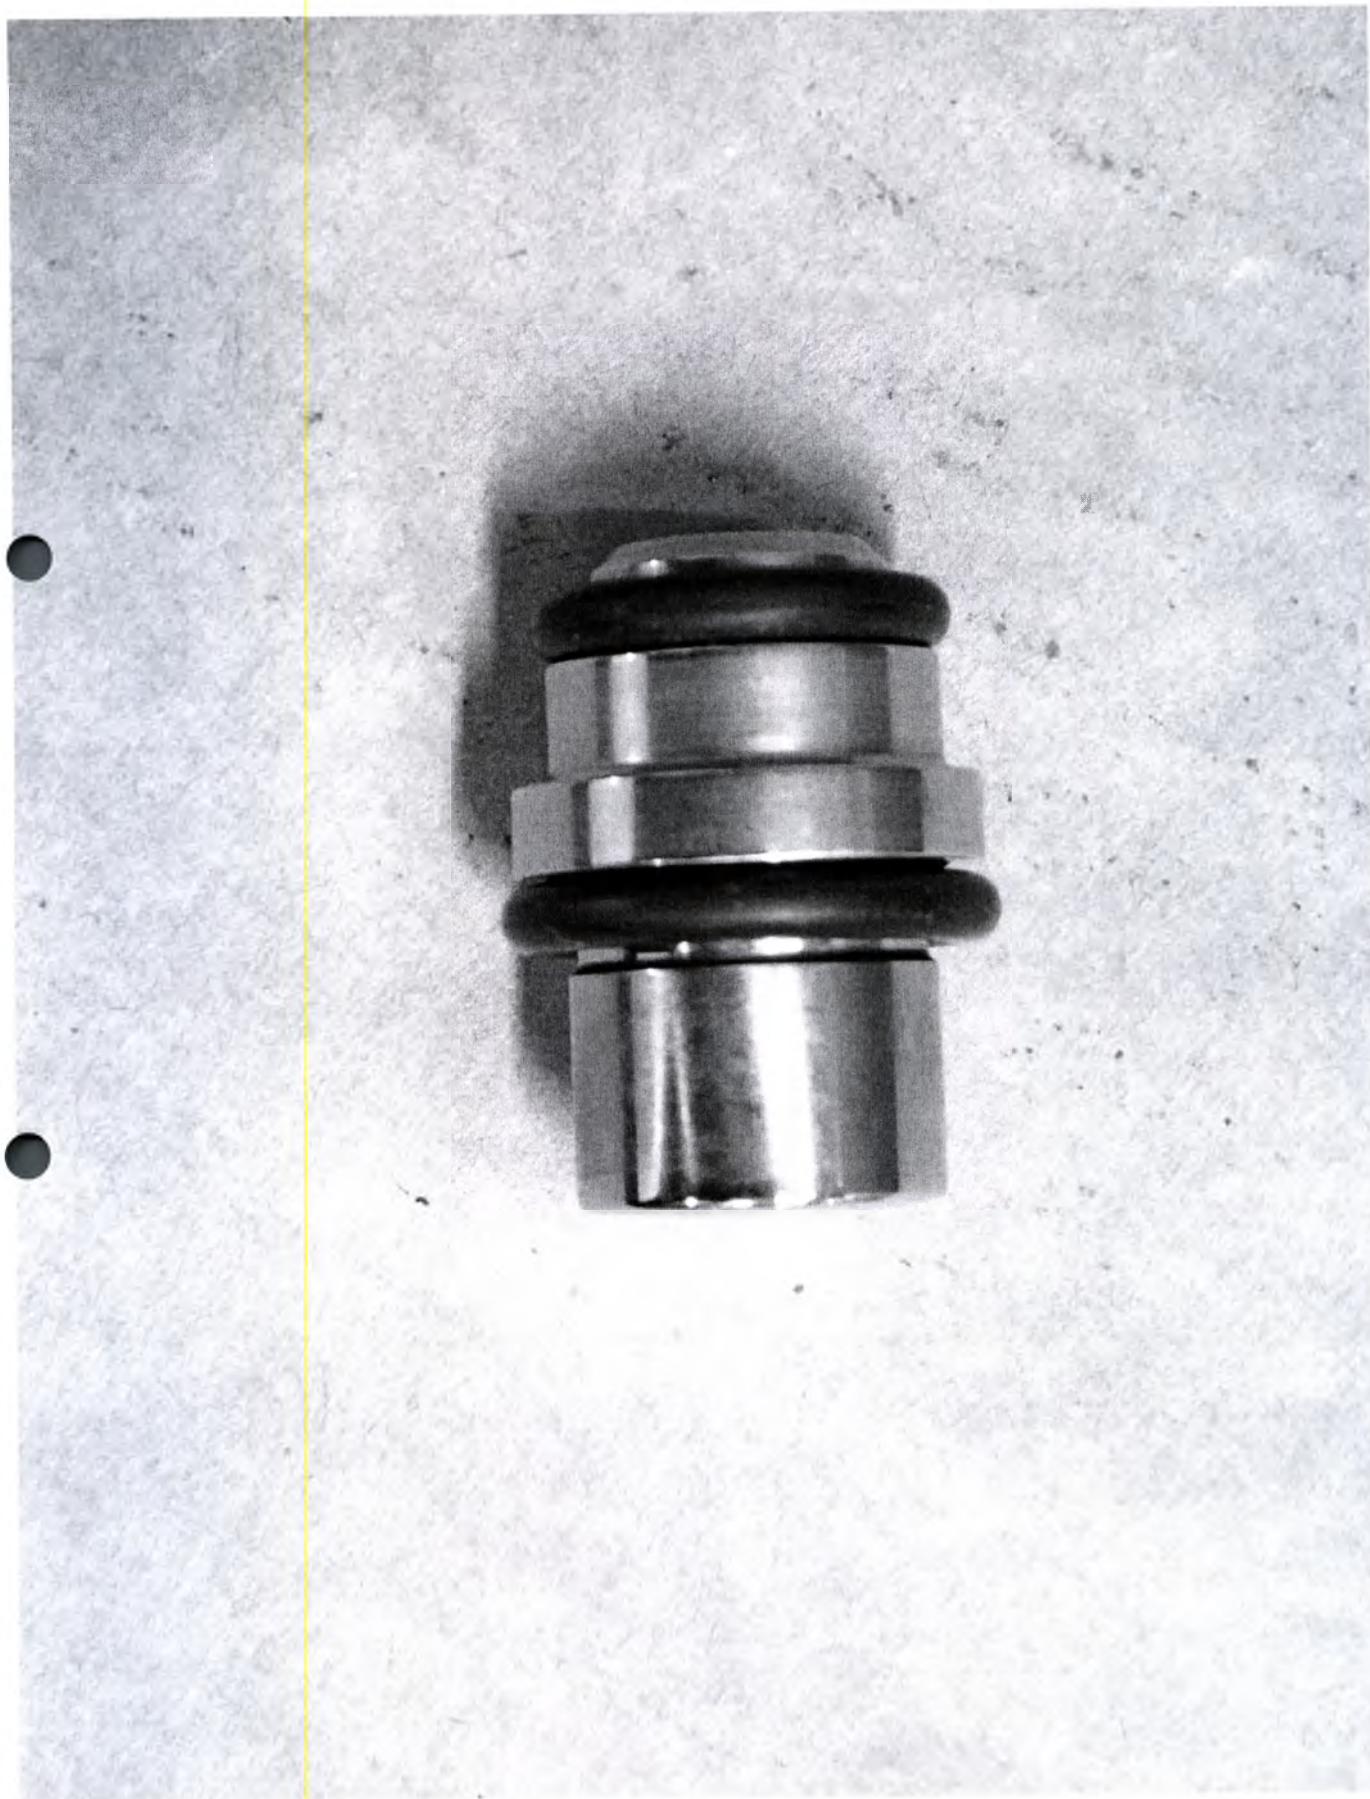

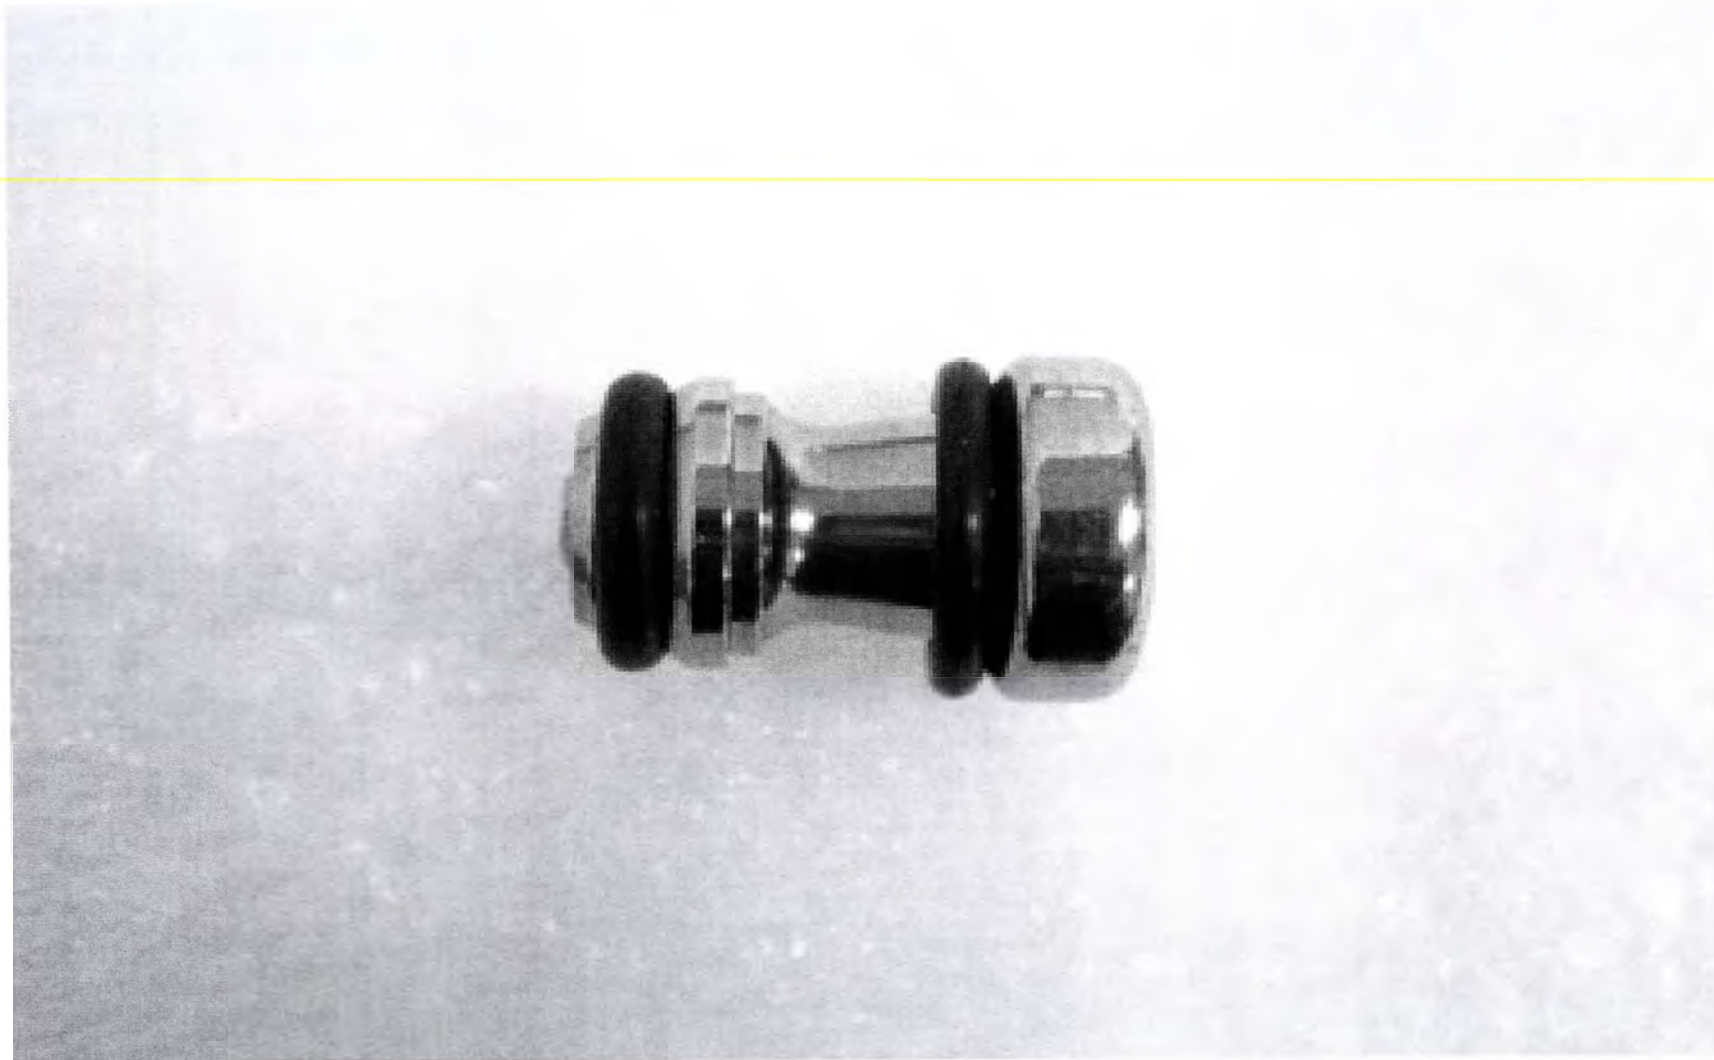



8. Гель контактный




9.Трубка направляющая металлическая




10. Сердечник ударный металлический




11. Сетевой шнур

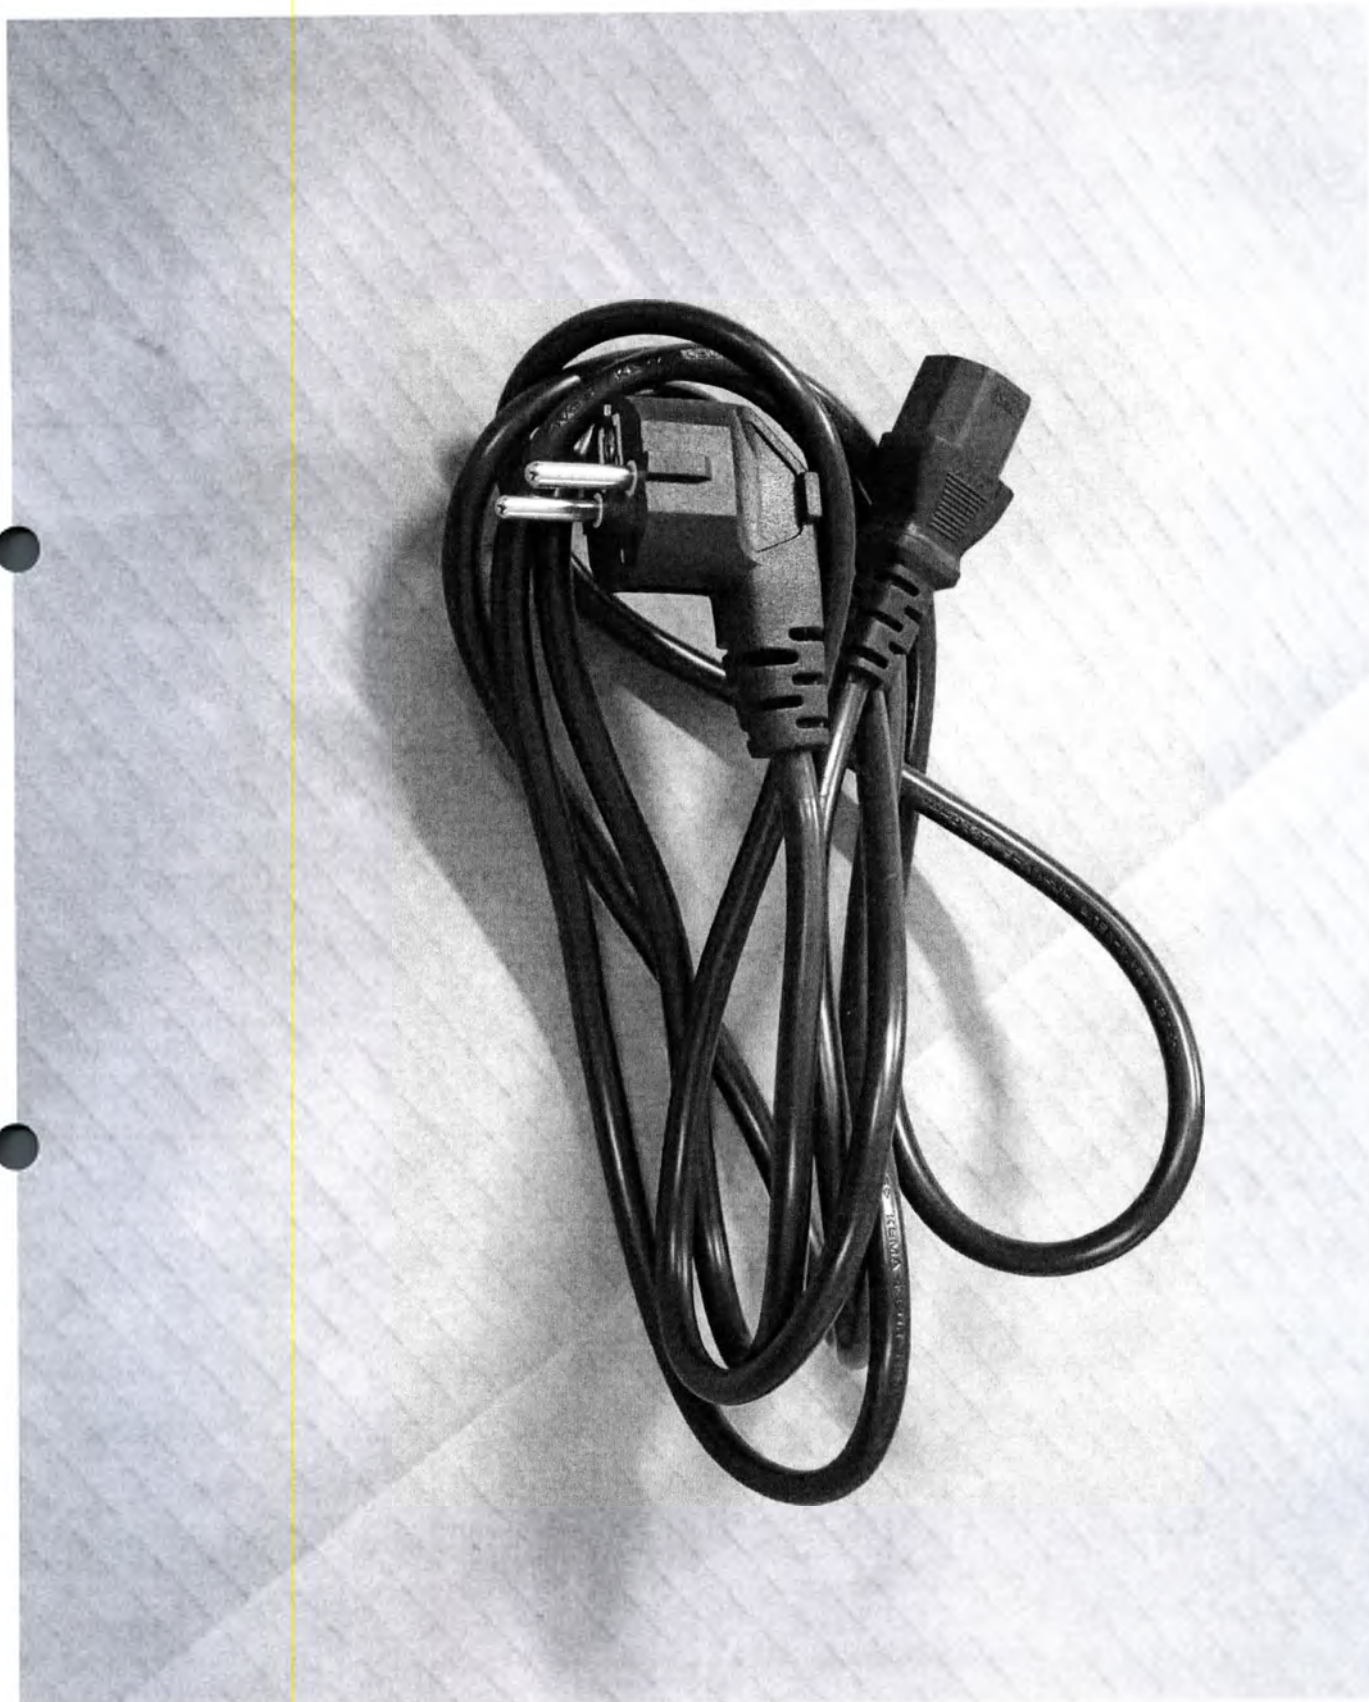


12. Ручка - стилус для управления через сенсорный экран

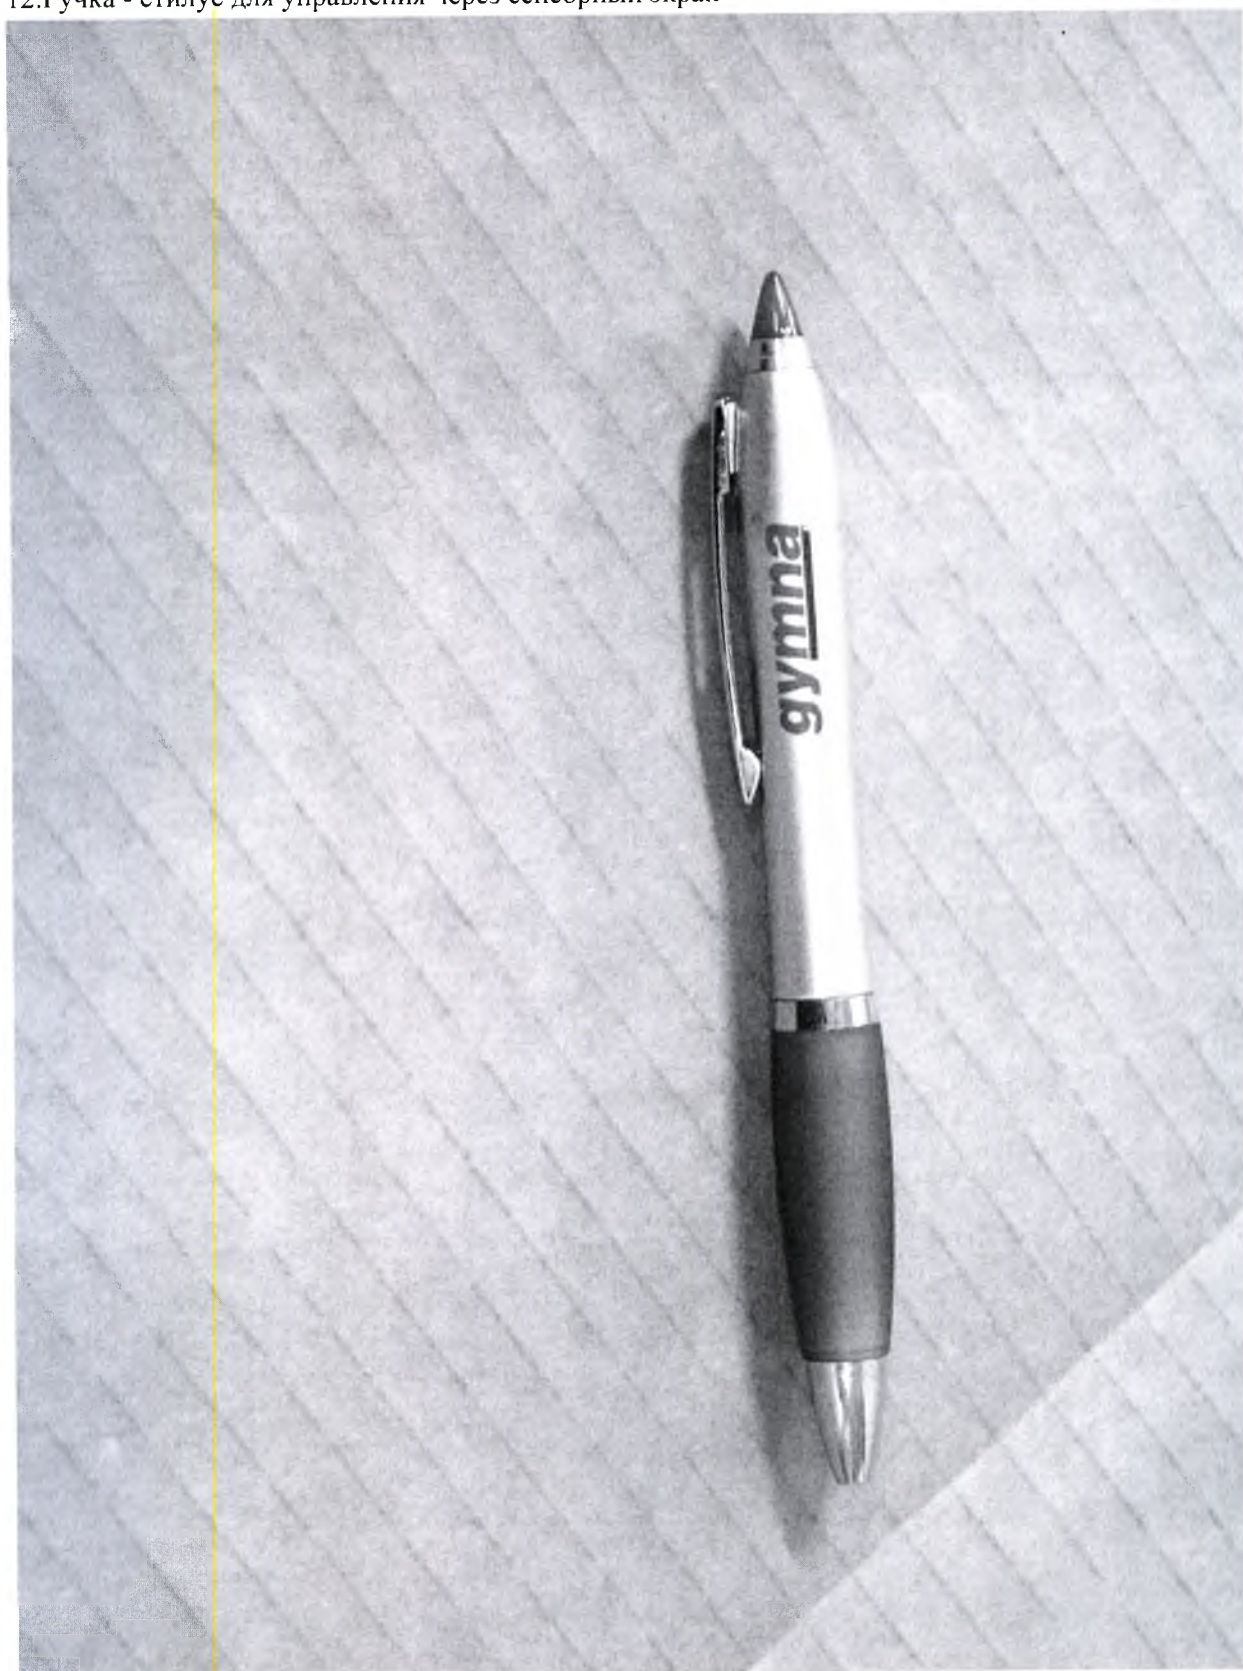


13.Защитный противоскользящий коврик

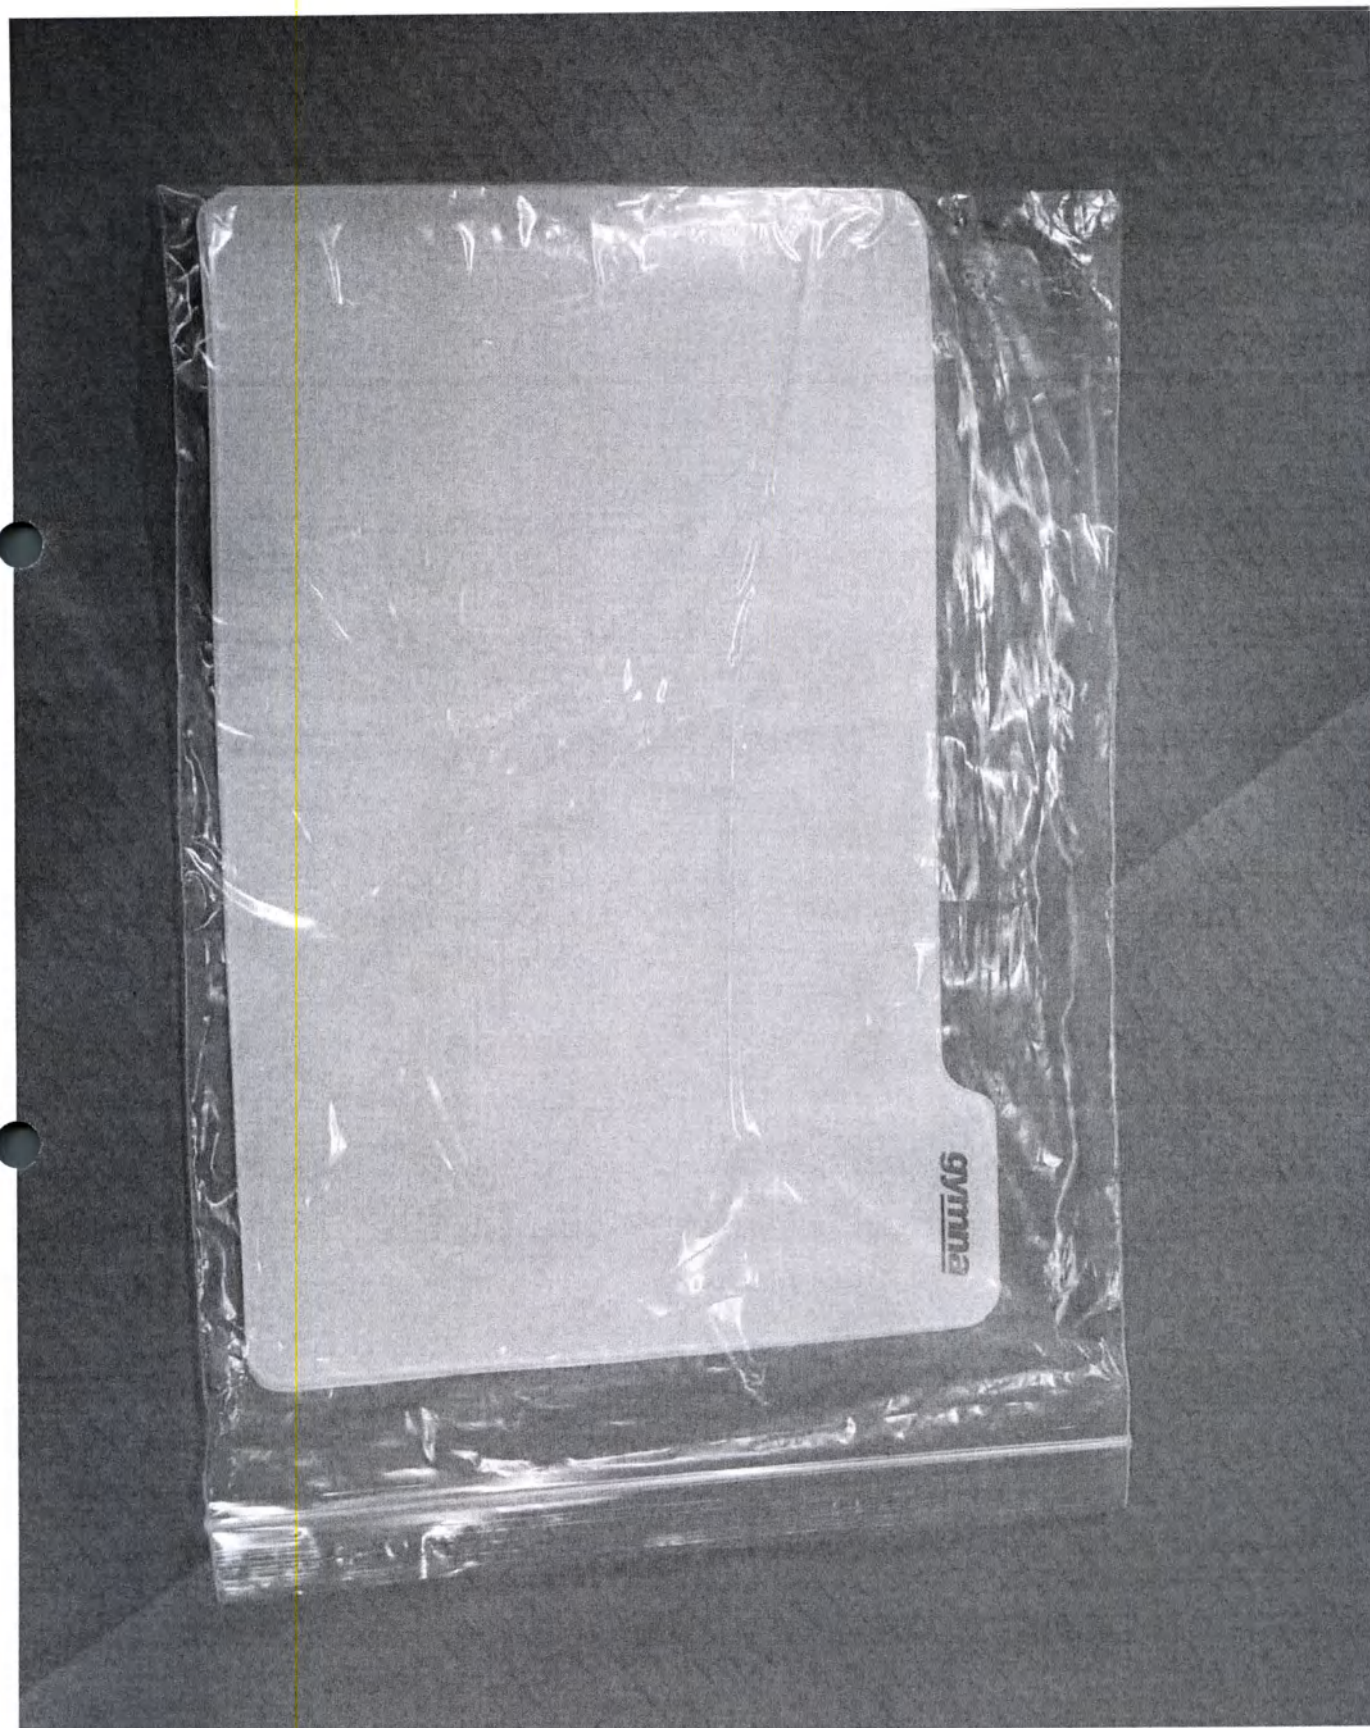

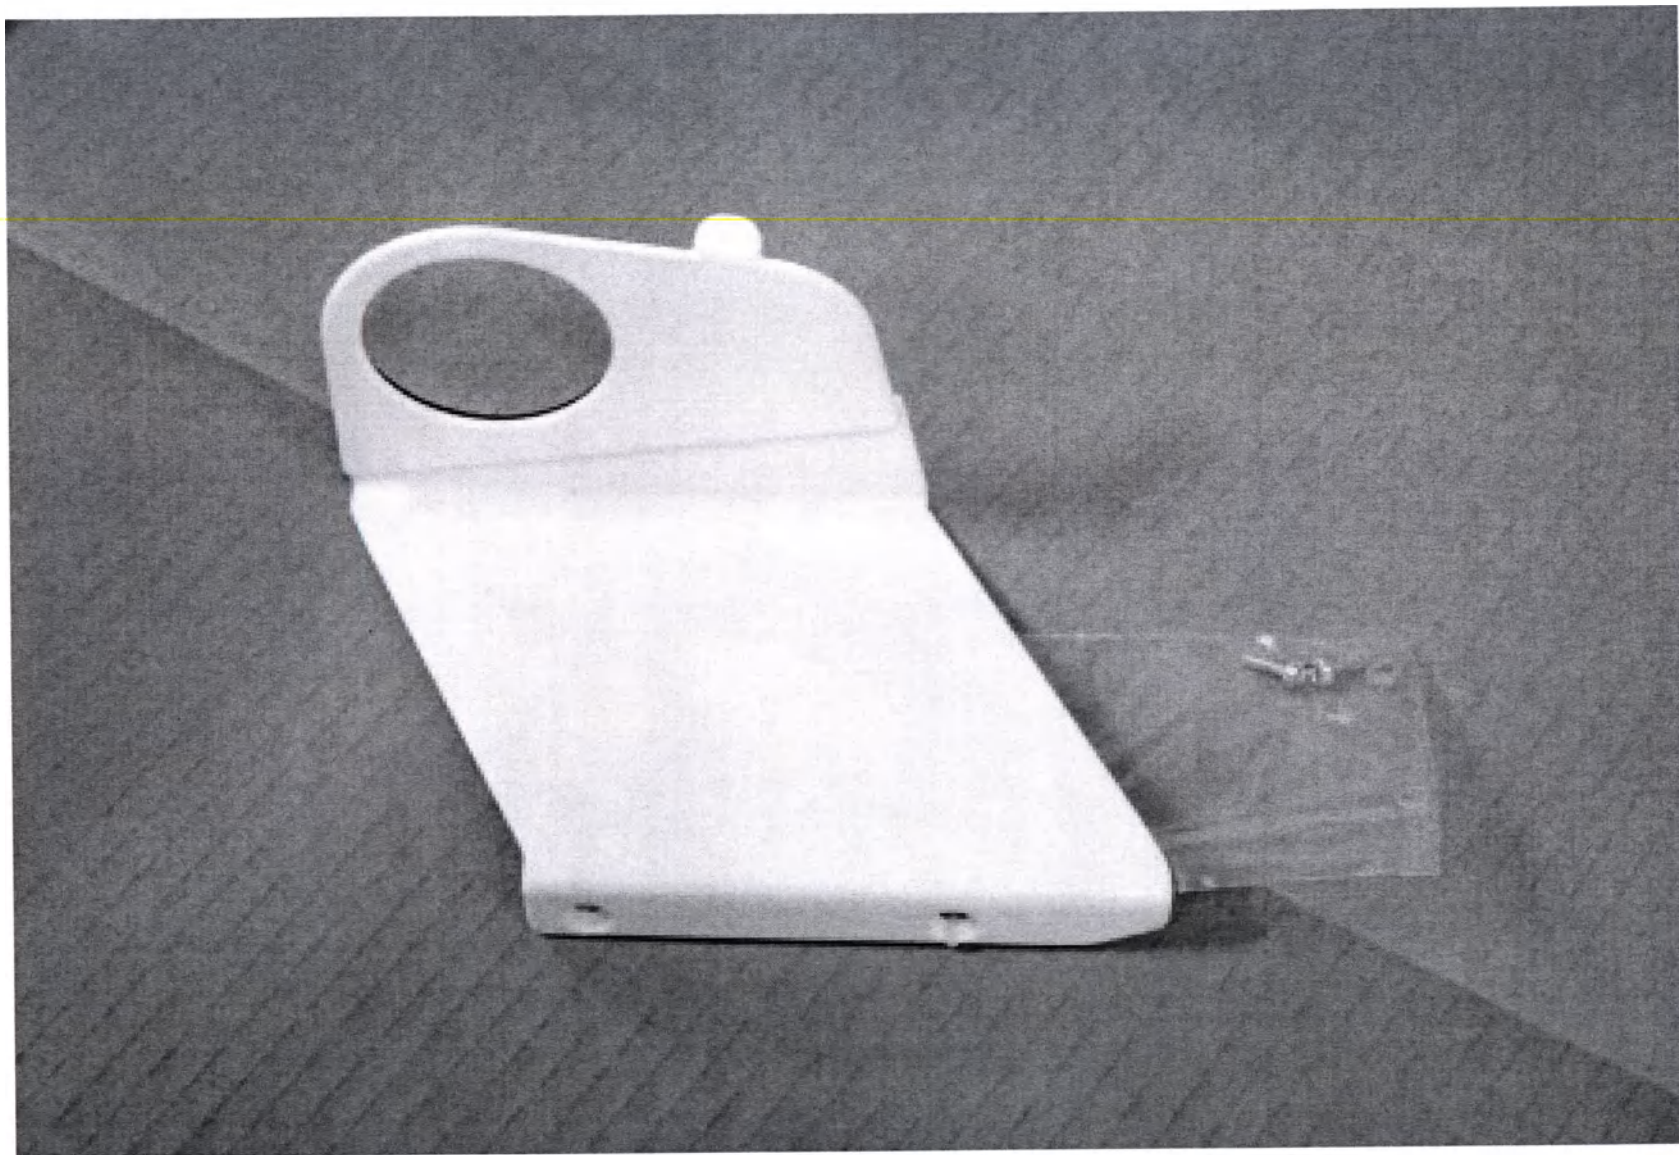




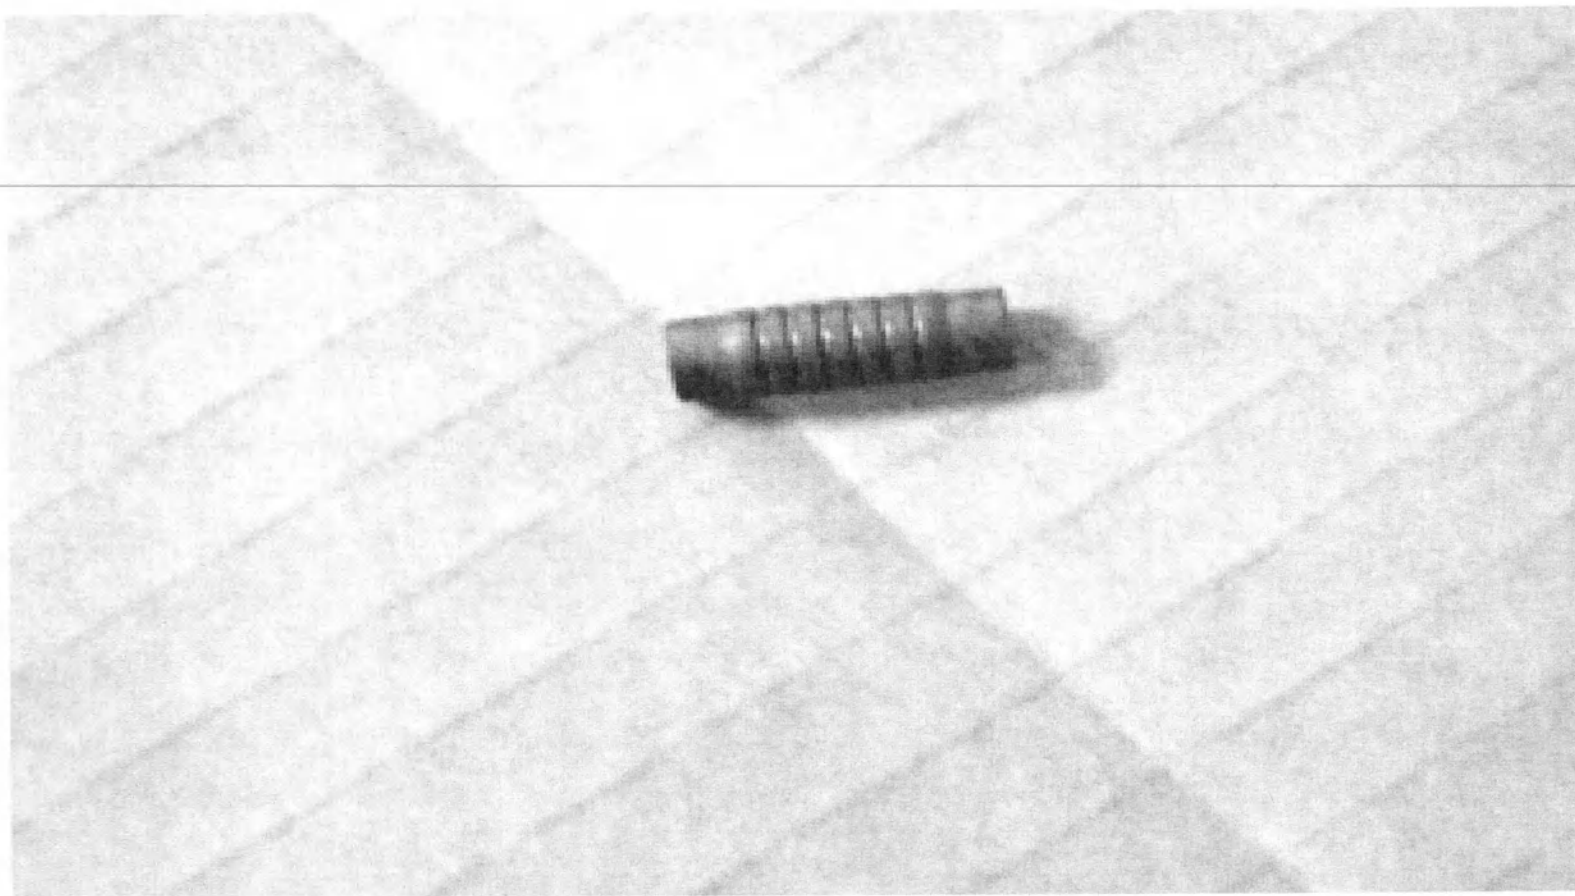



17.Головка диаметром 6 мм




18.Головка диаметром 10 мм

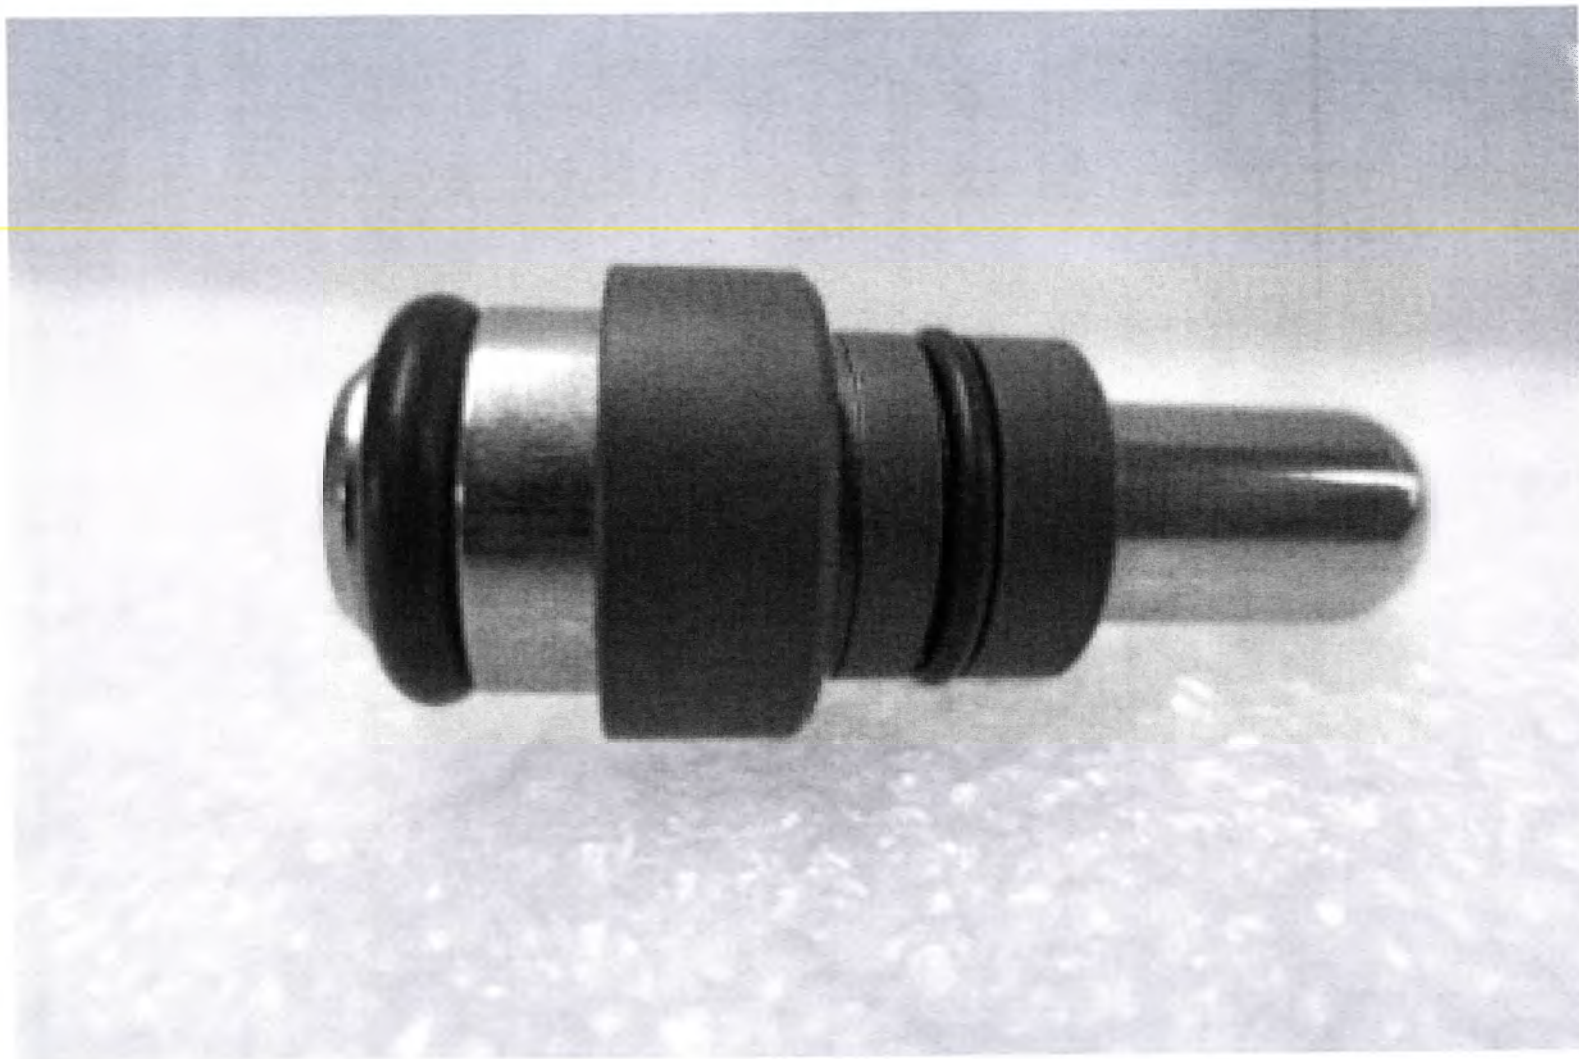

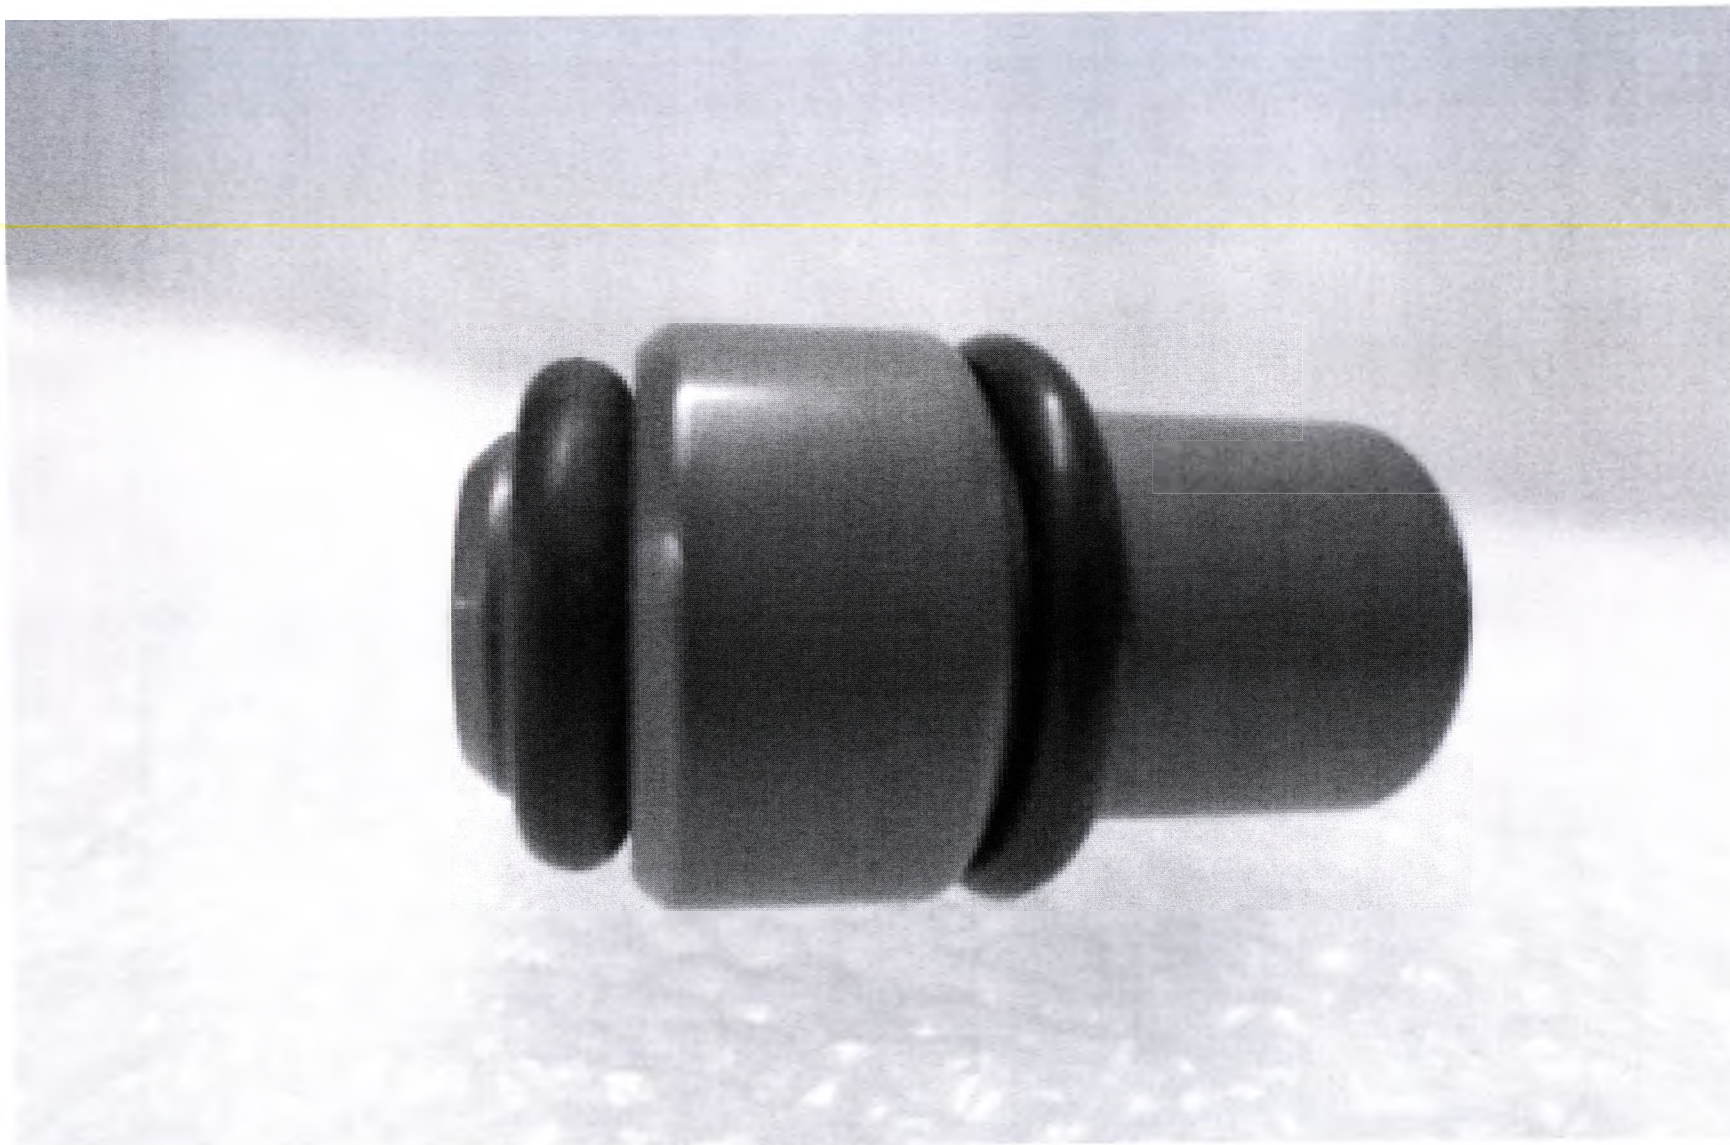


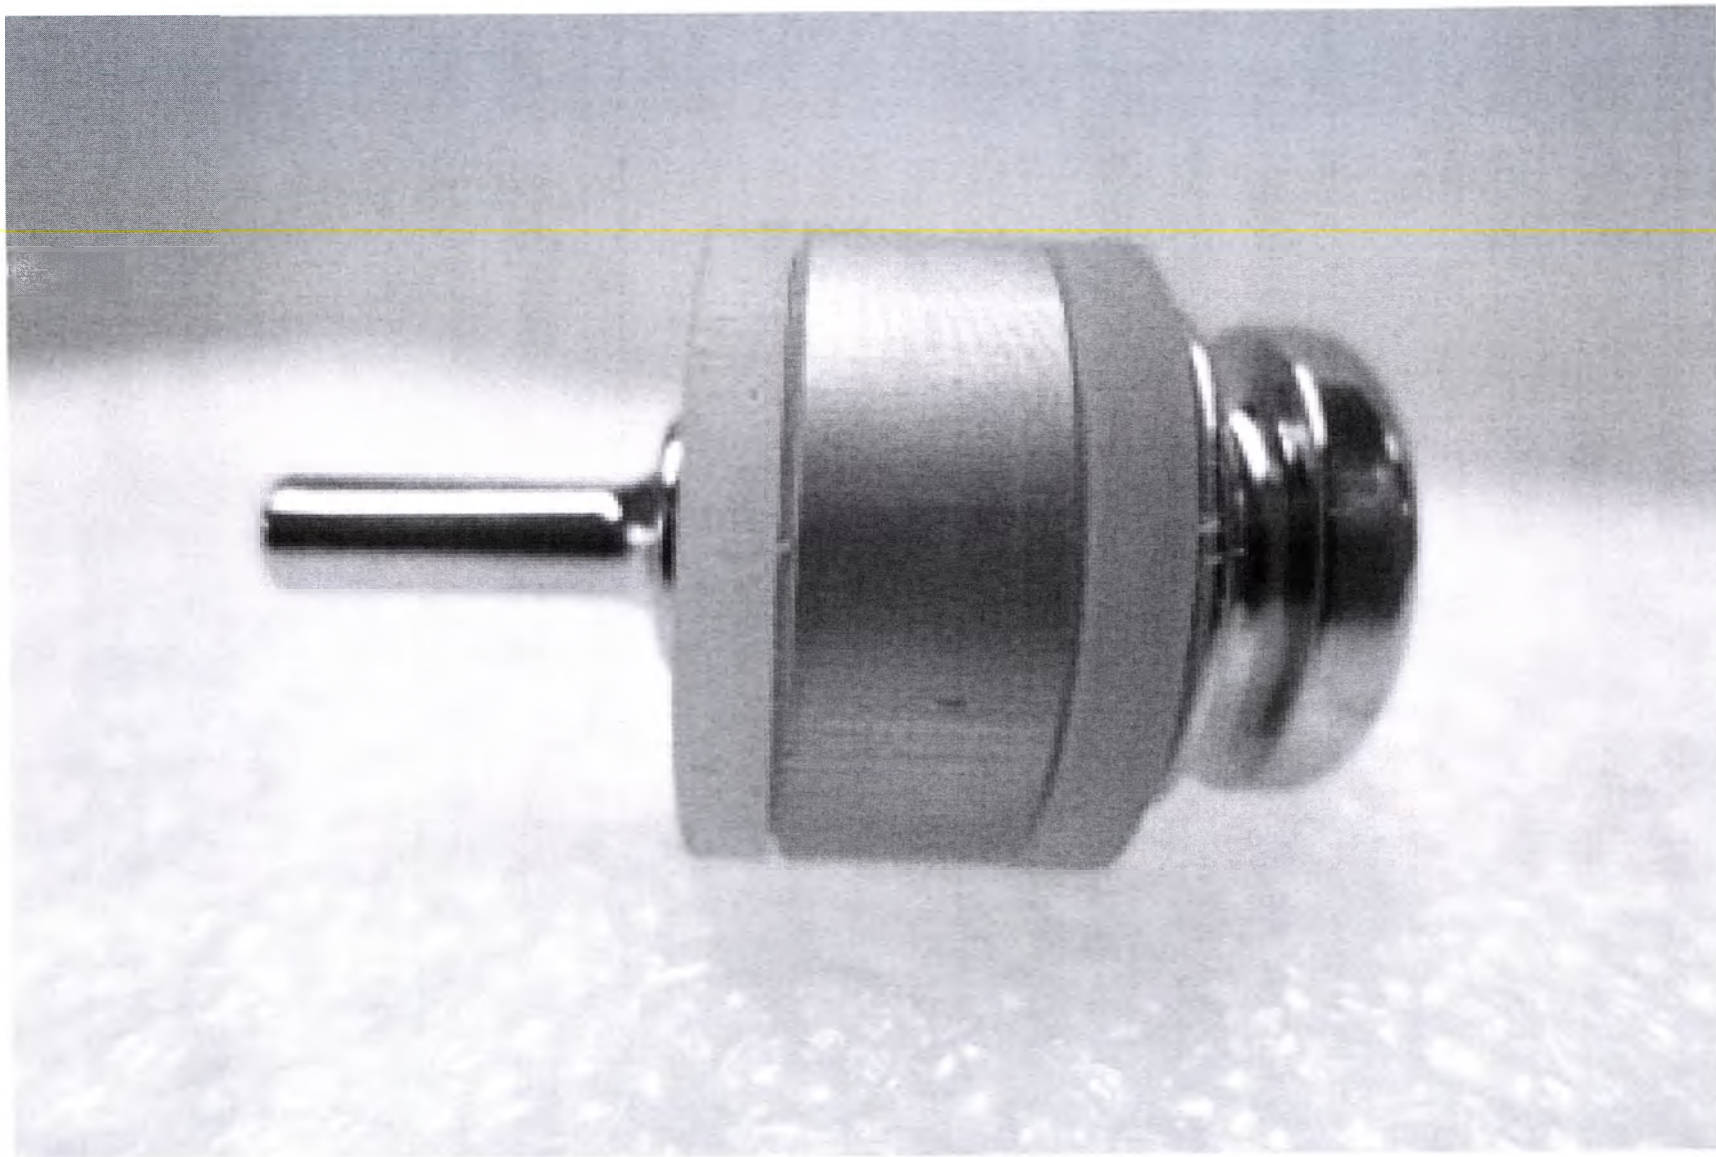


21.Головка диаметром 25 мм

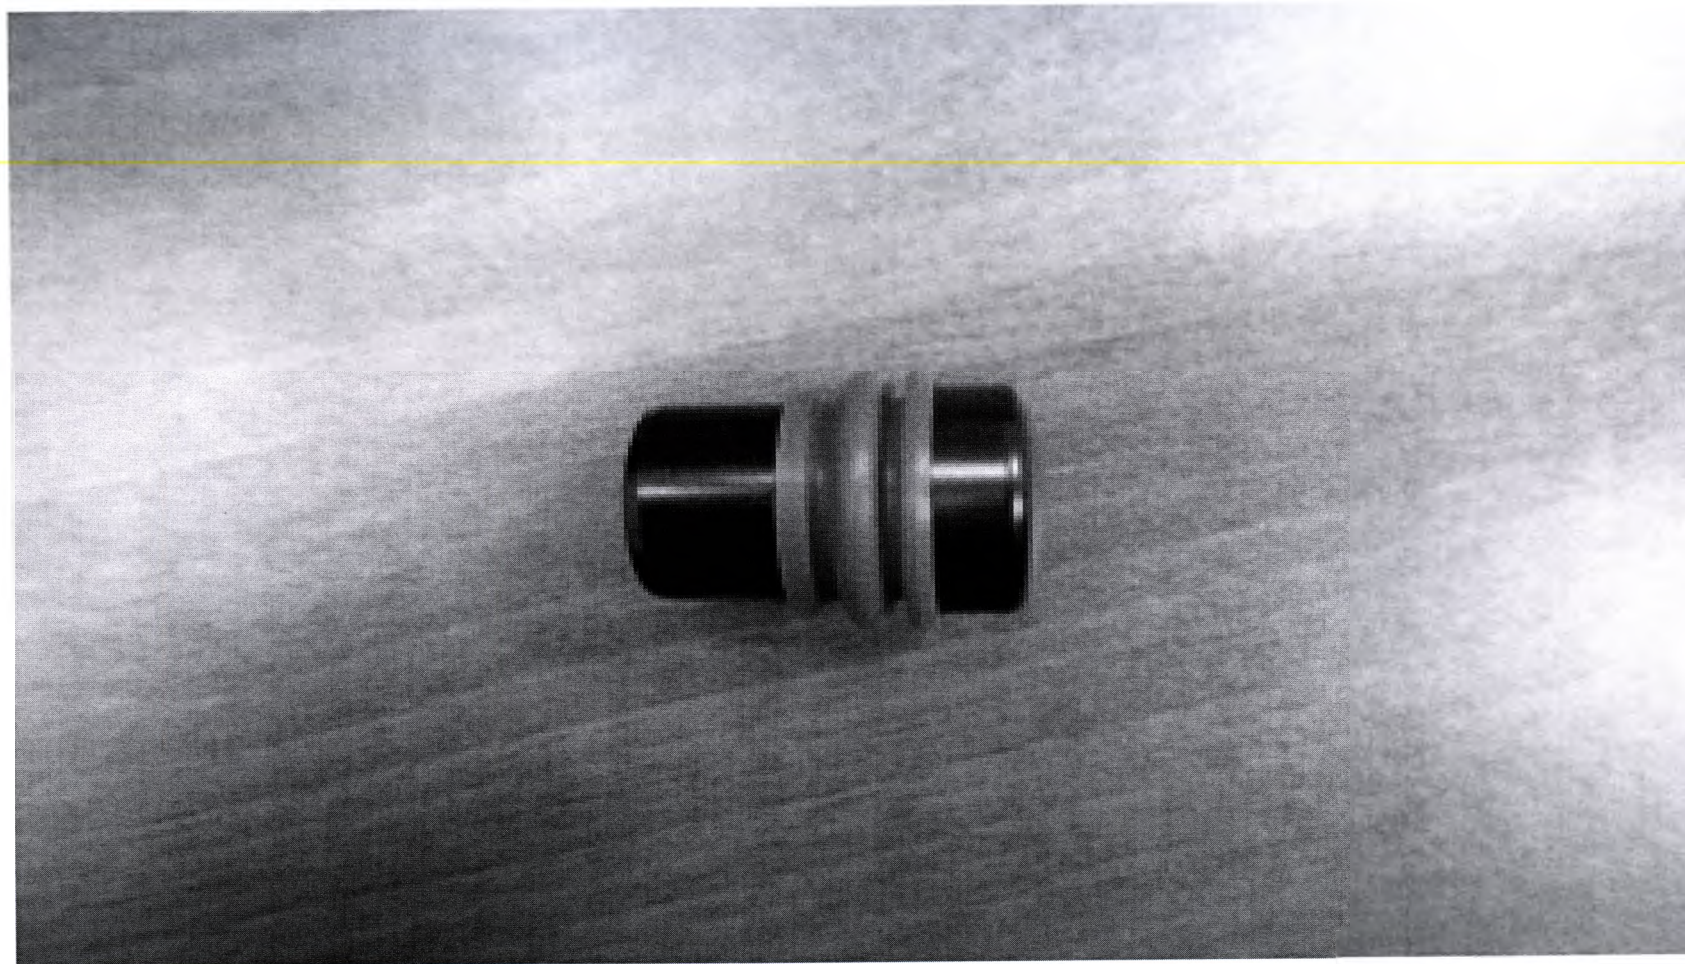


22.Головка диаметром 30 мм

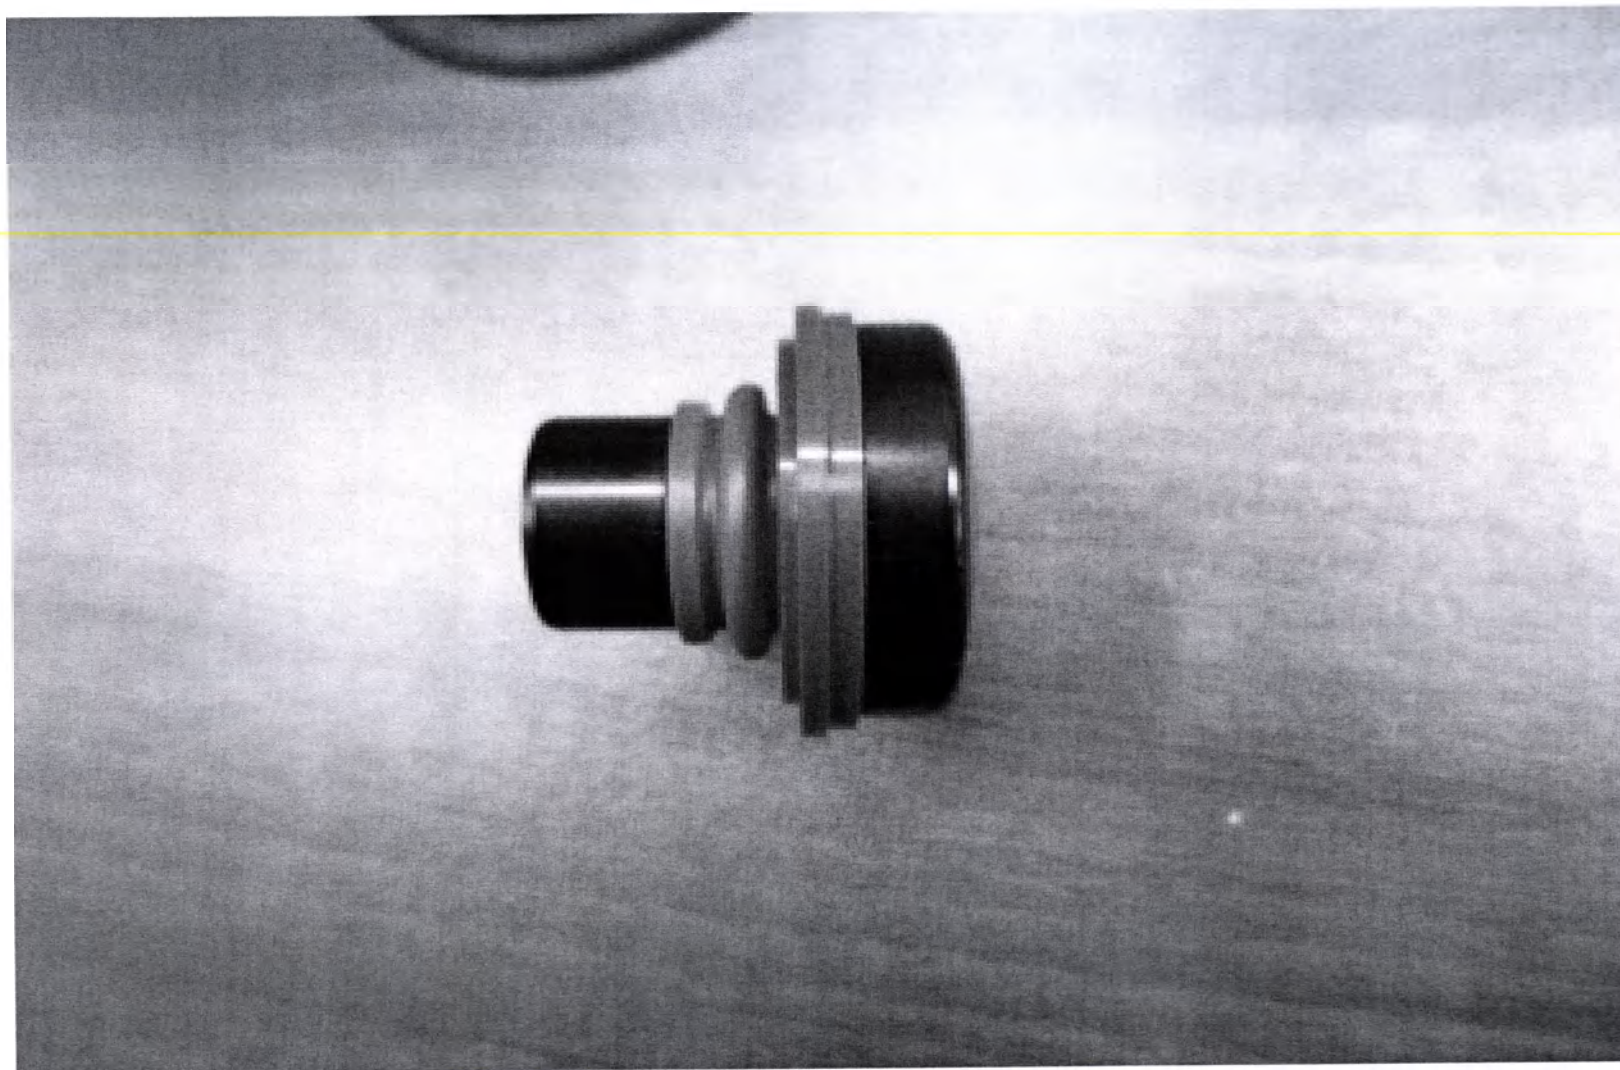


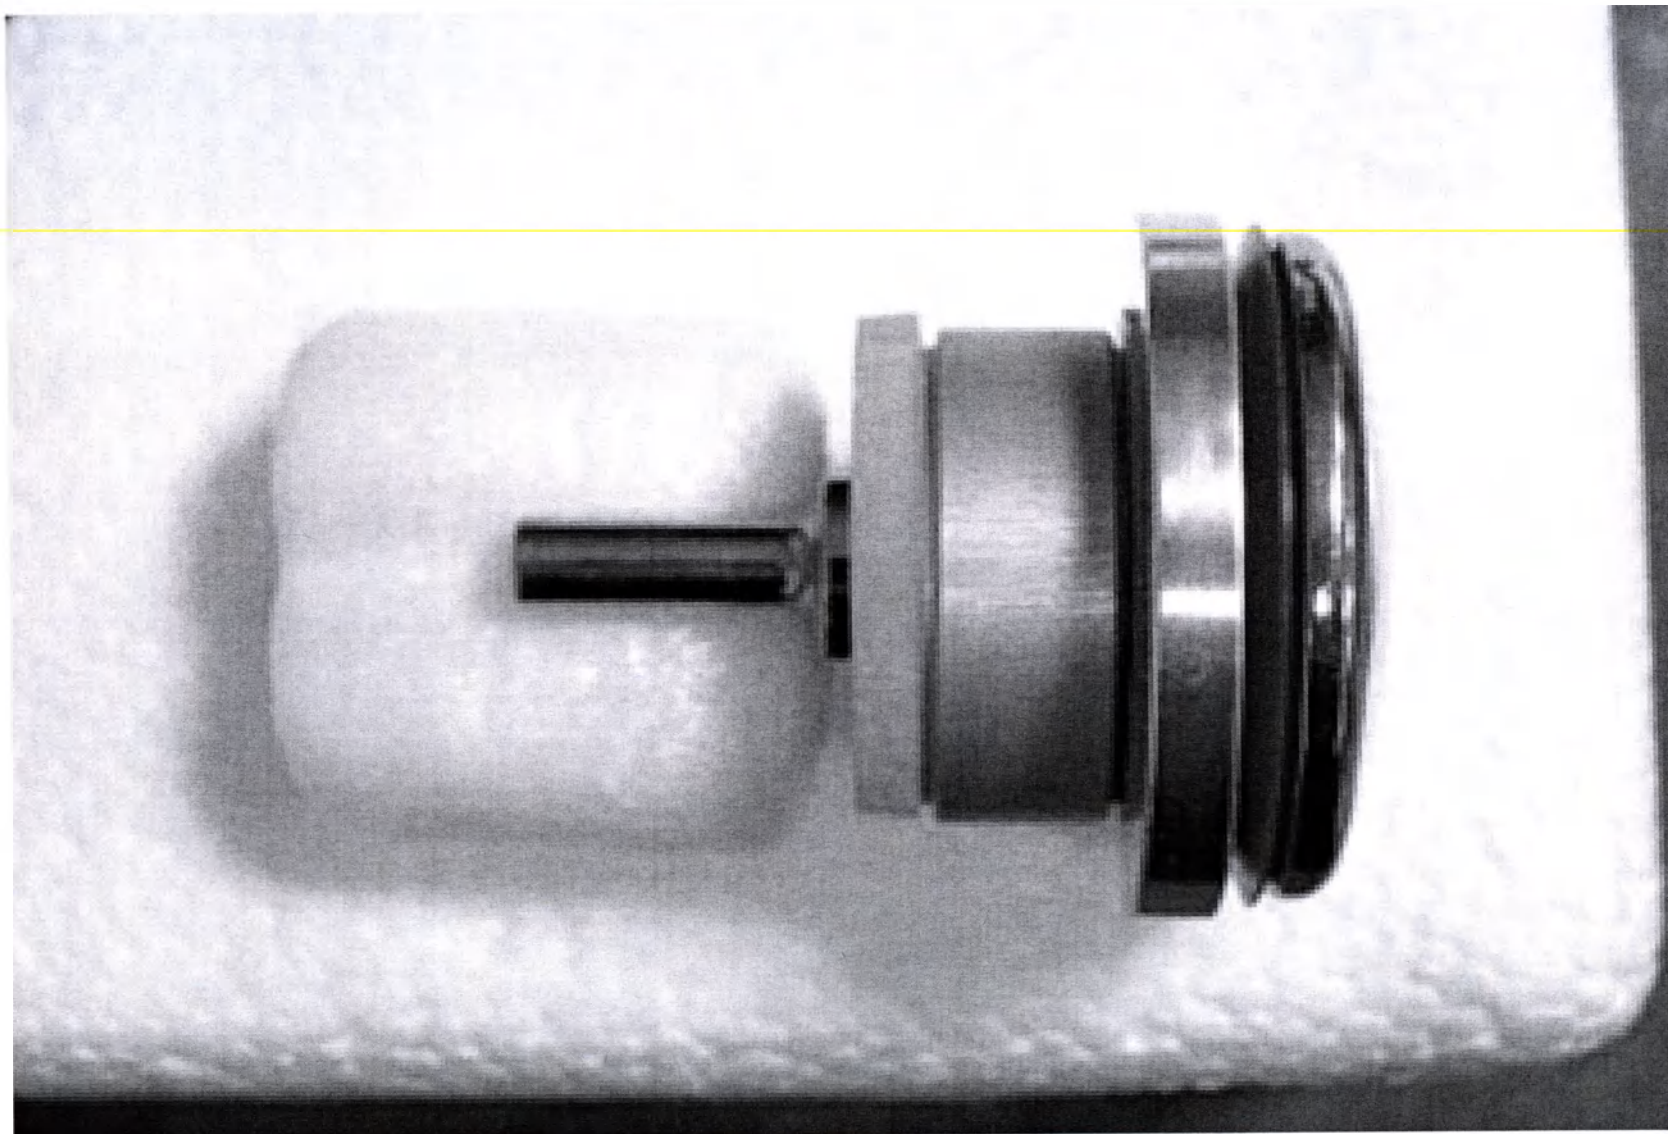


24. Головка D-Actor диаметром 35 мм Т

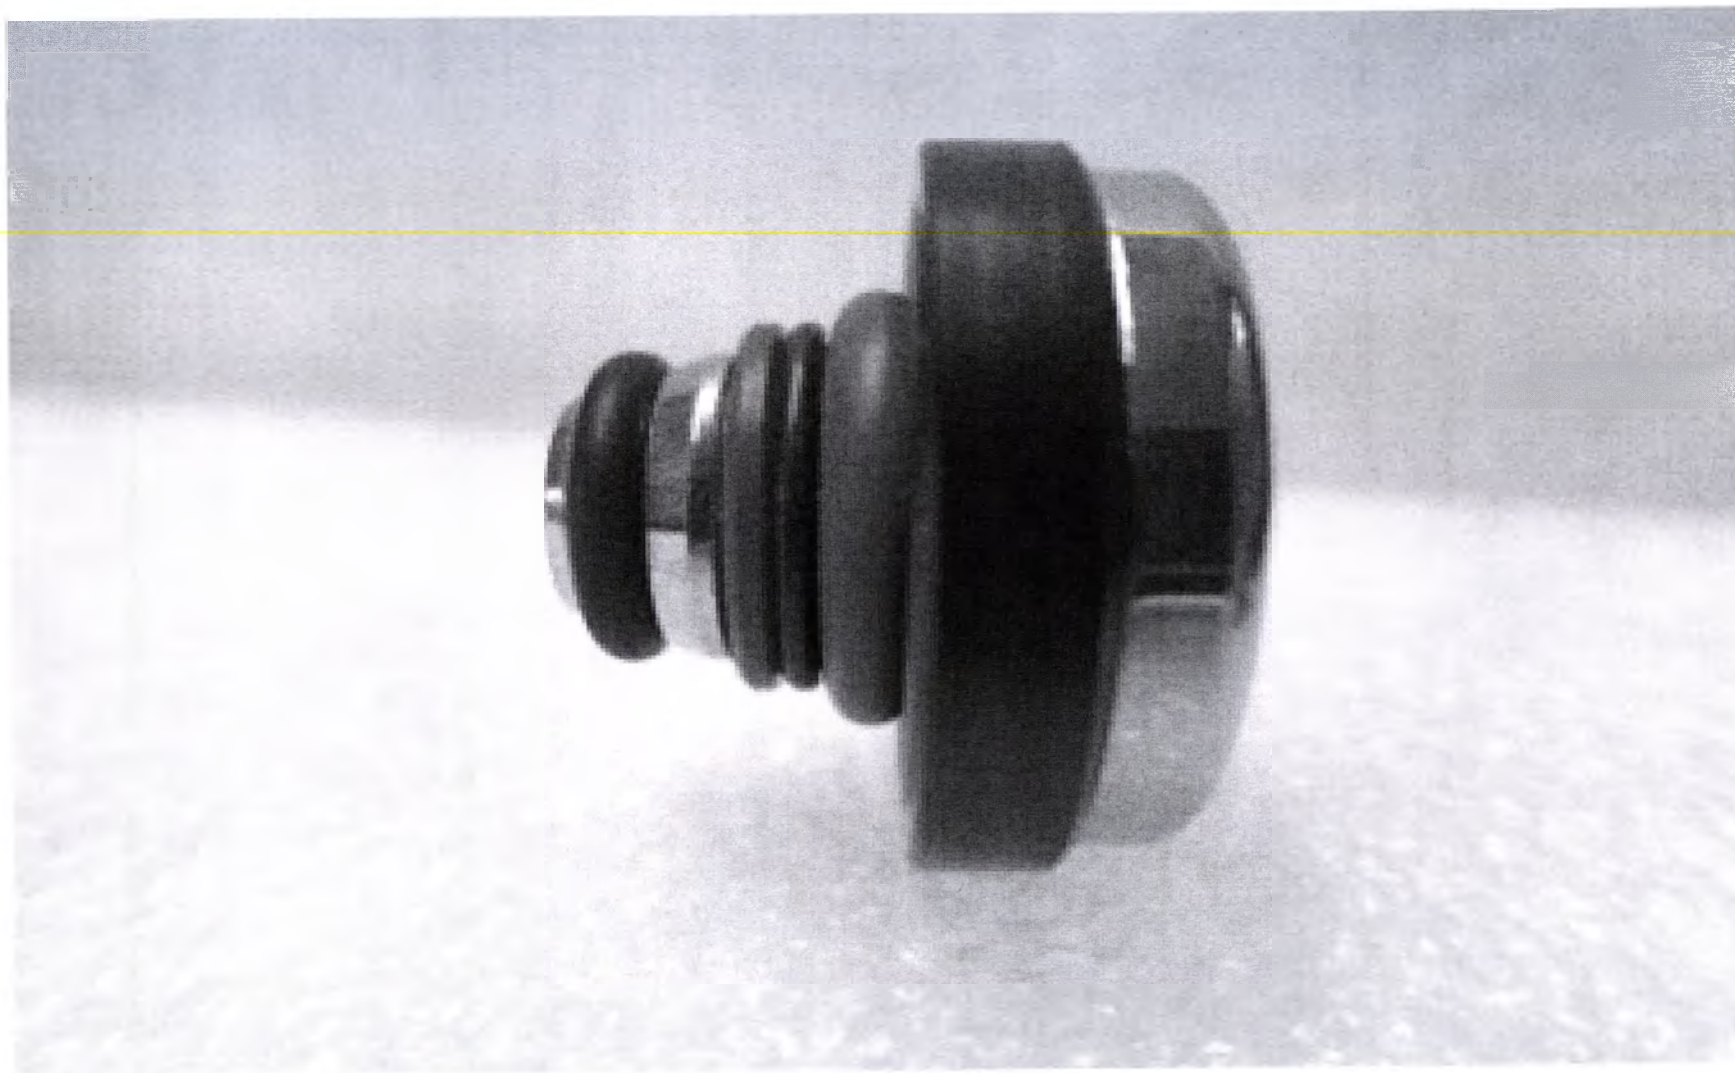




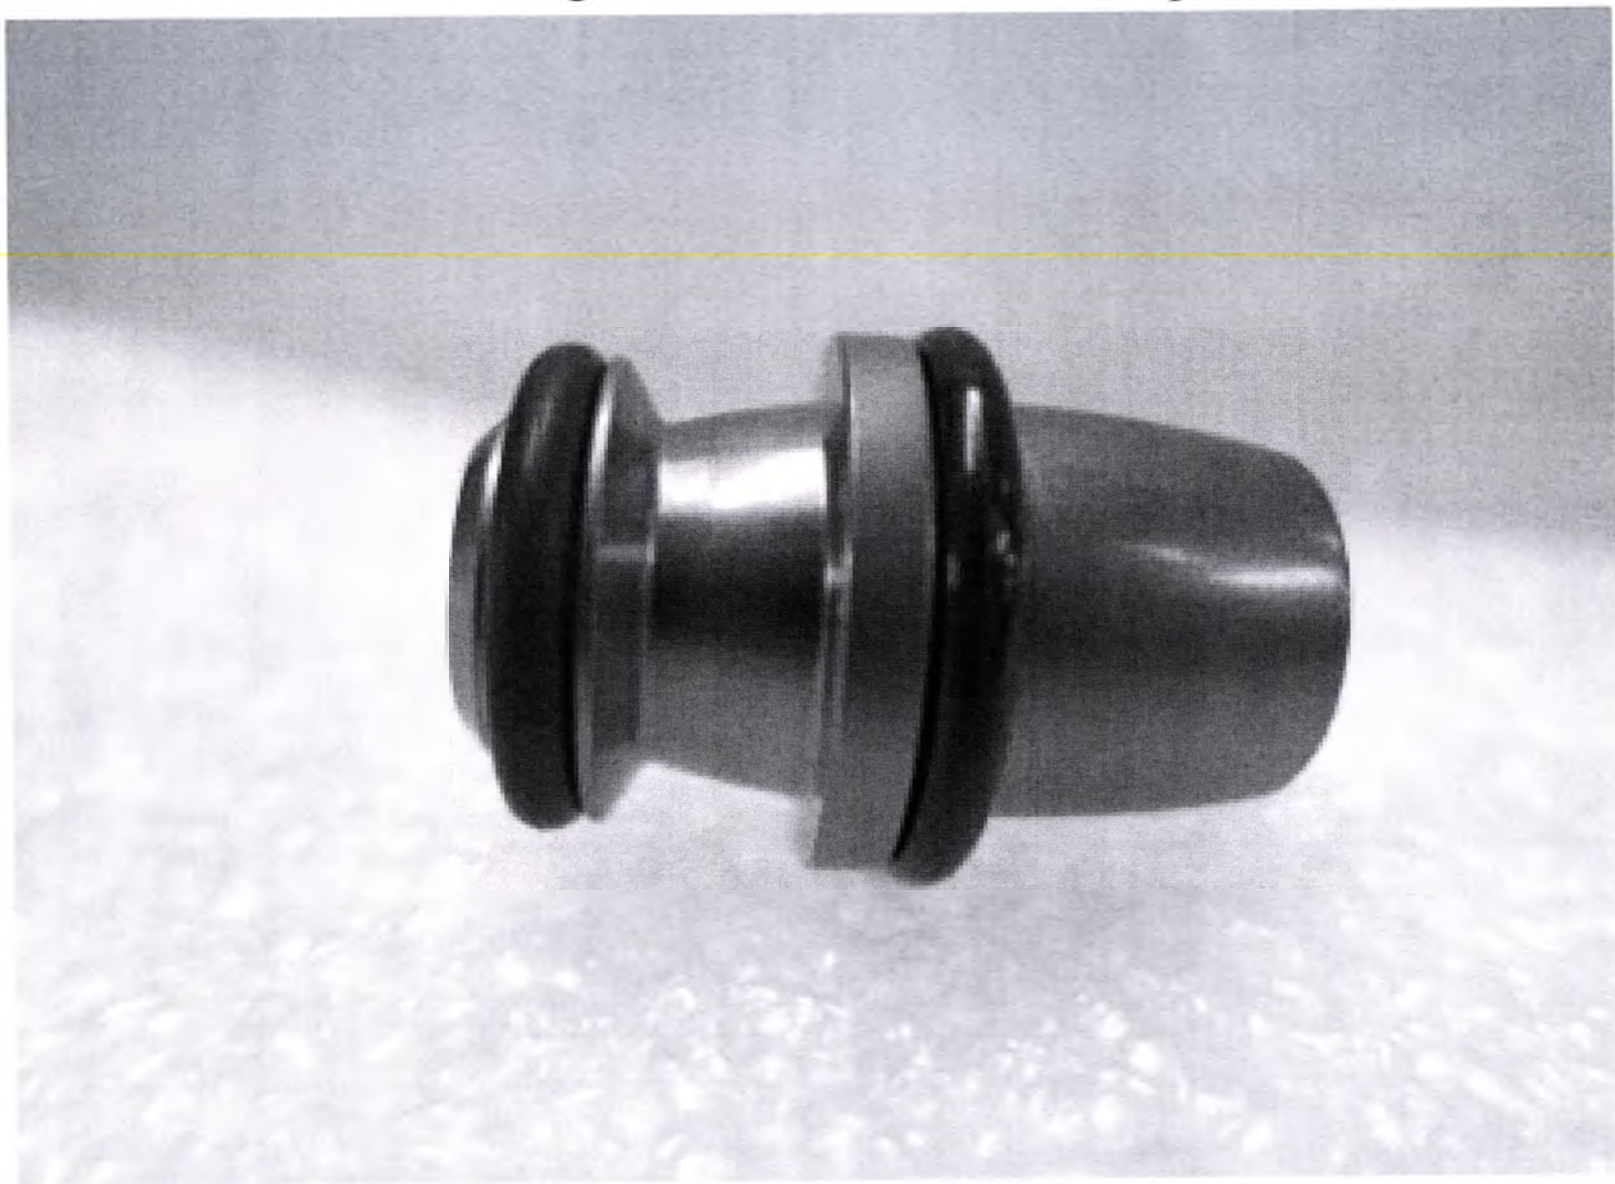

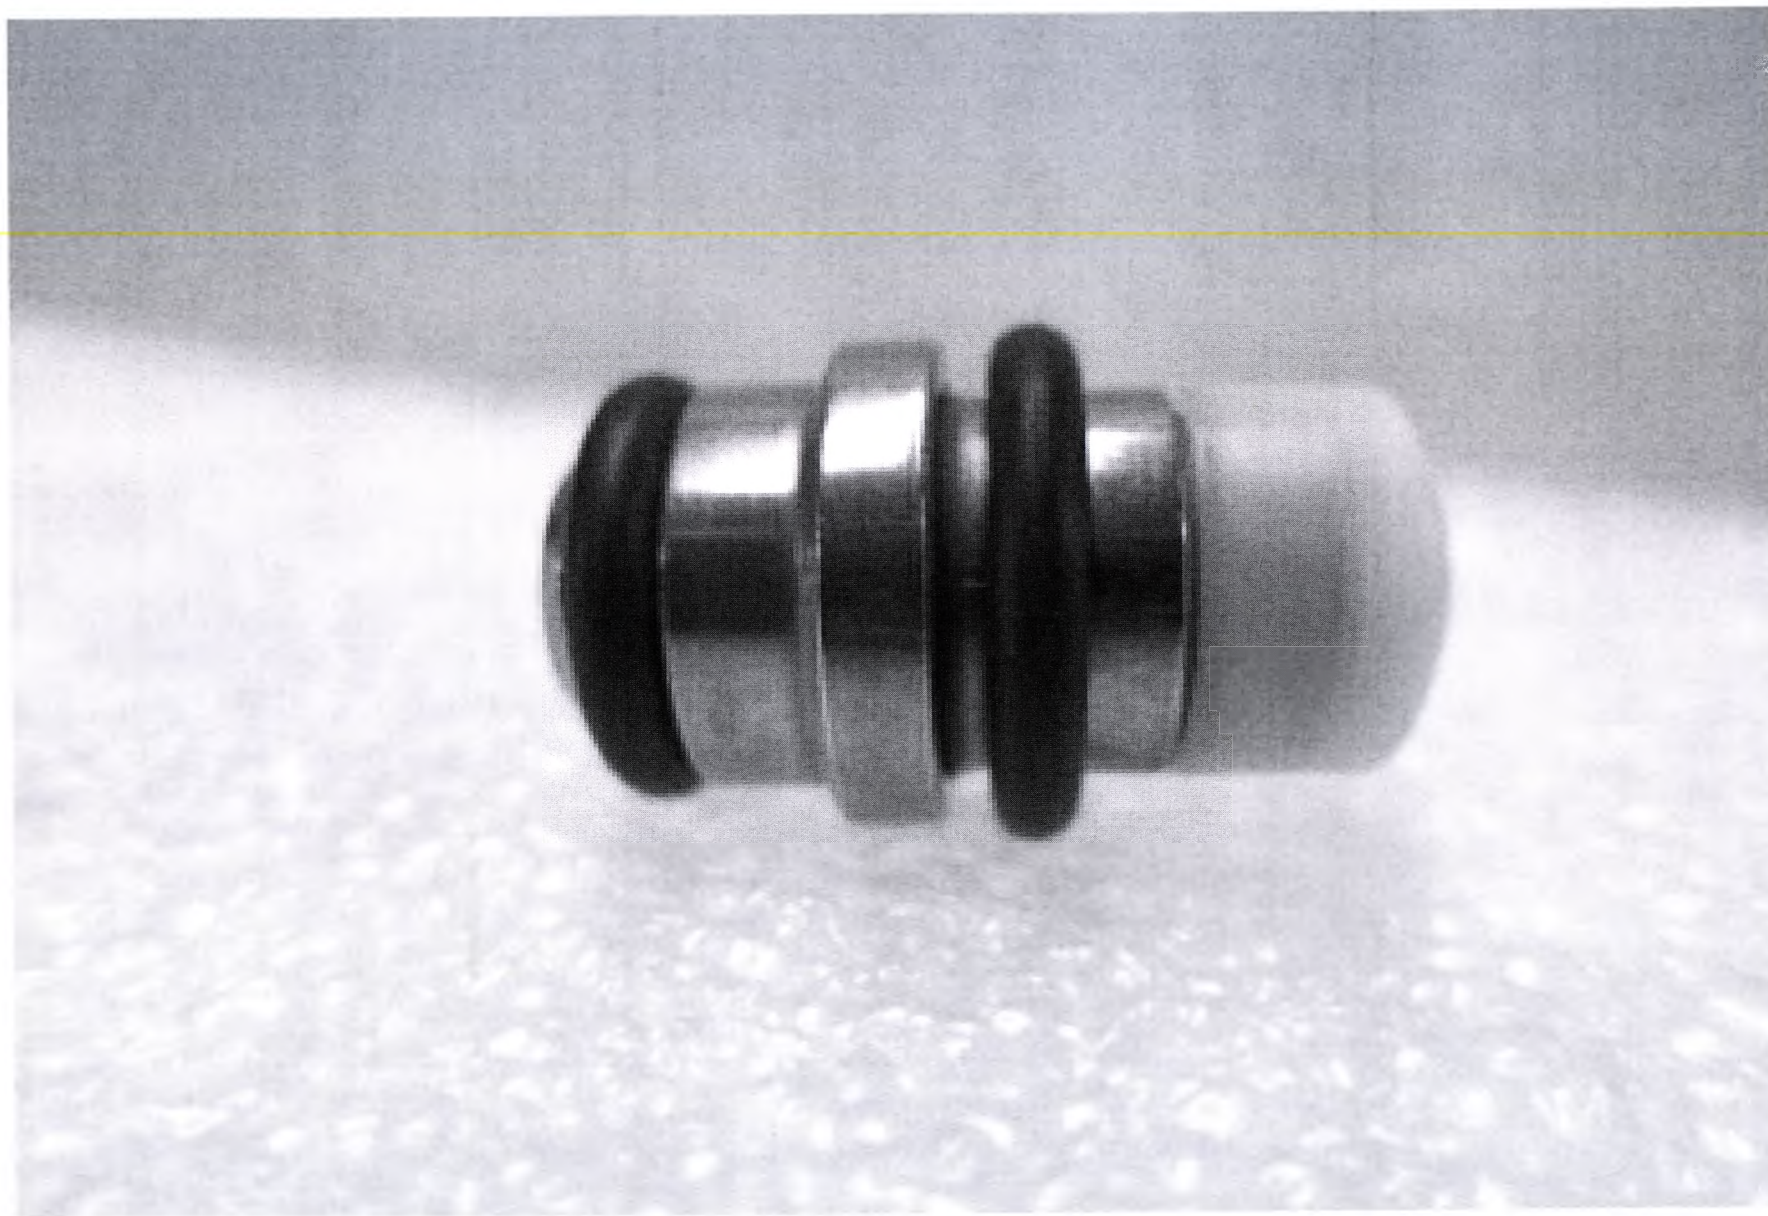


28. Головка шарообразная




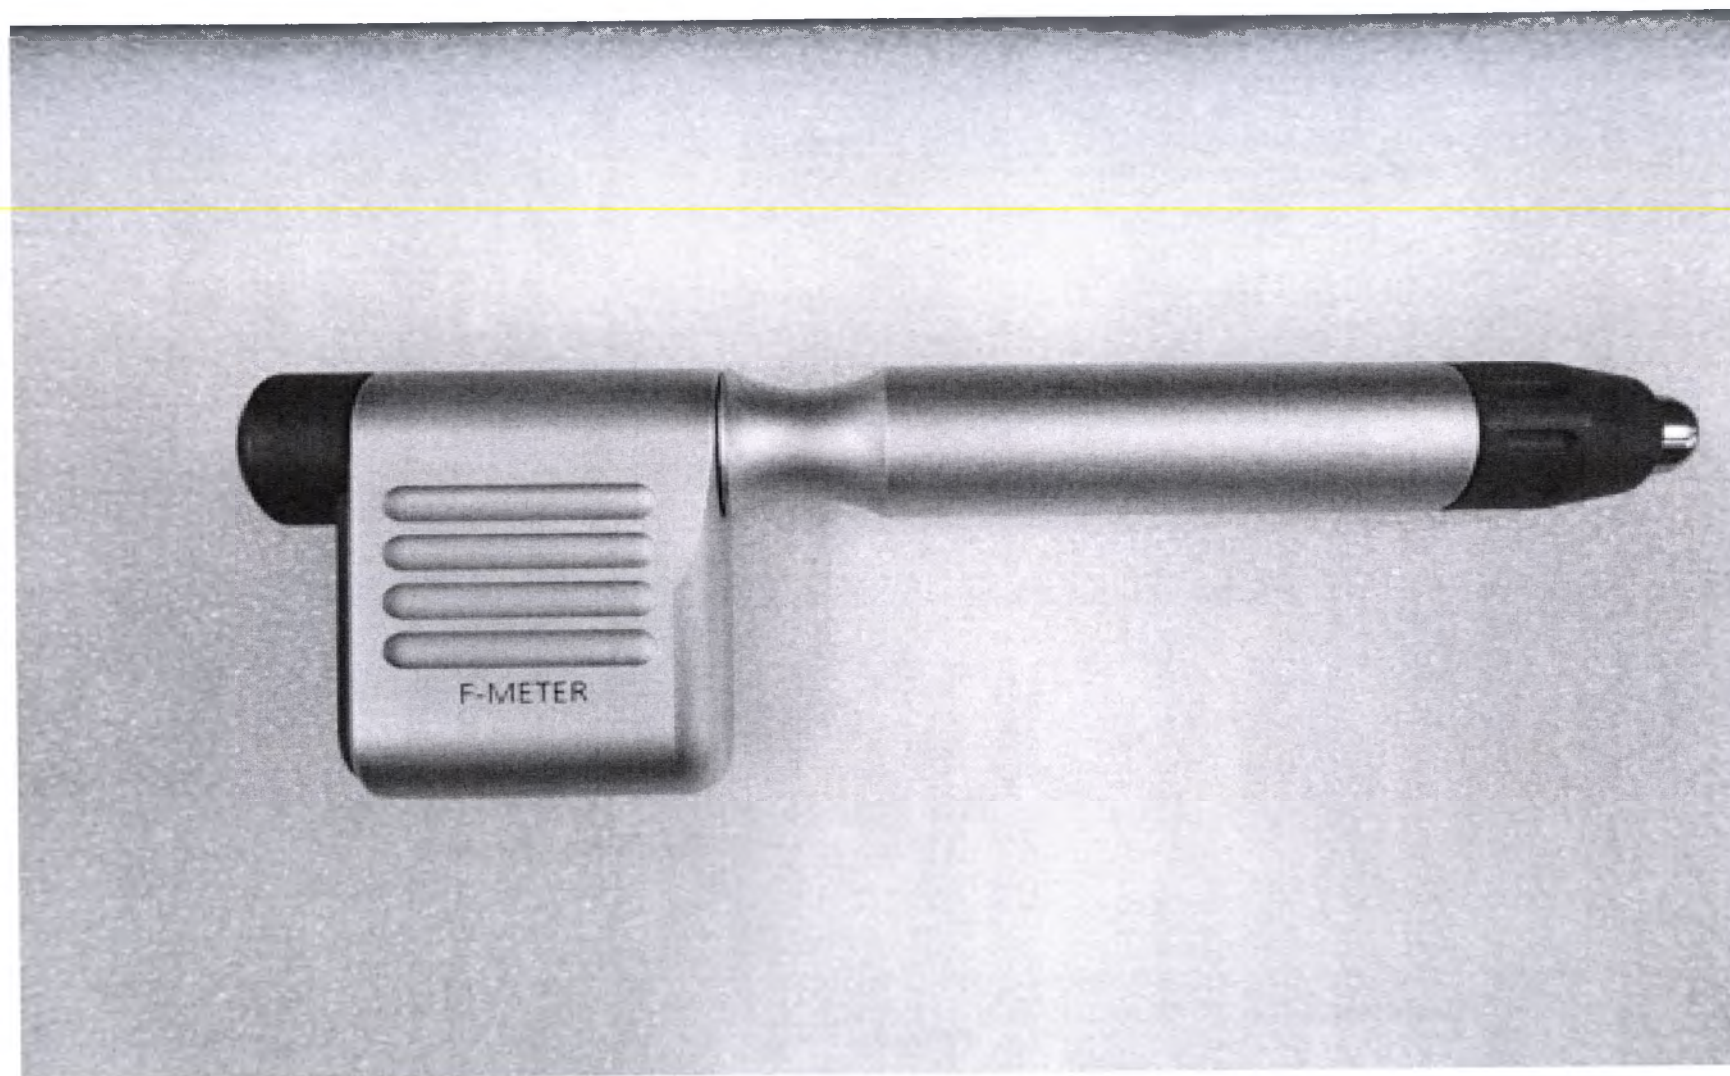




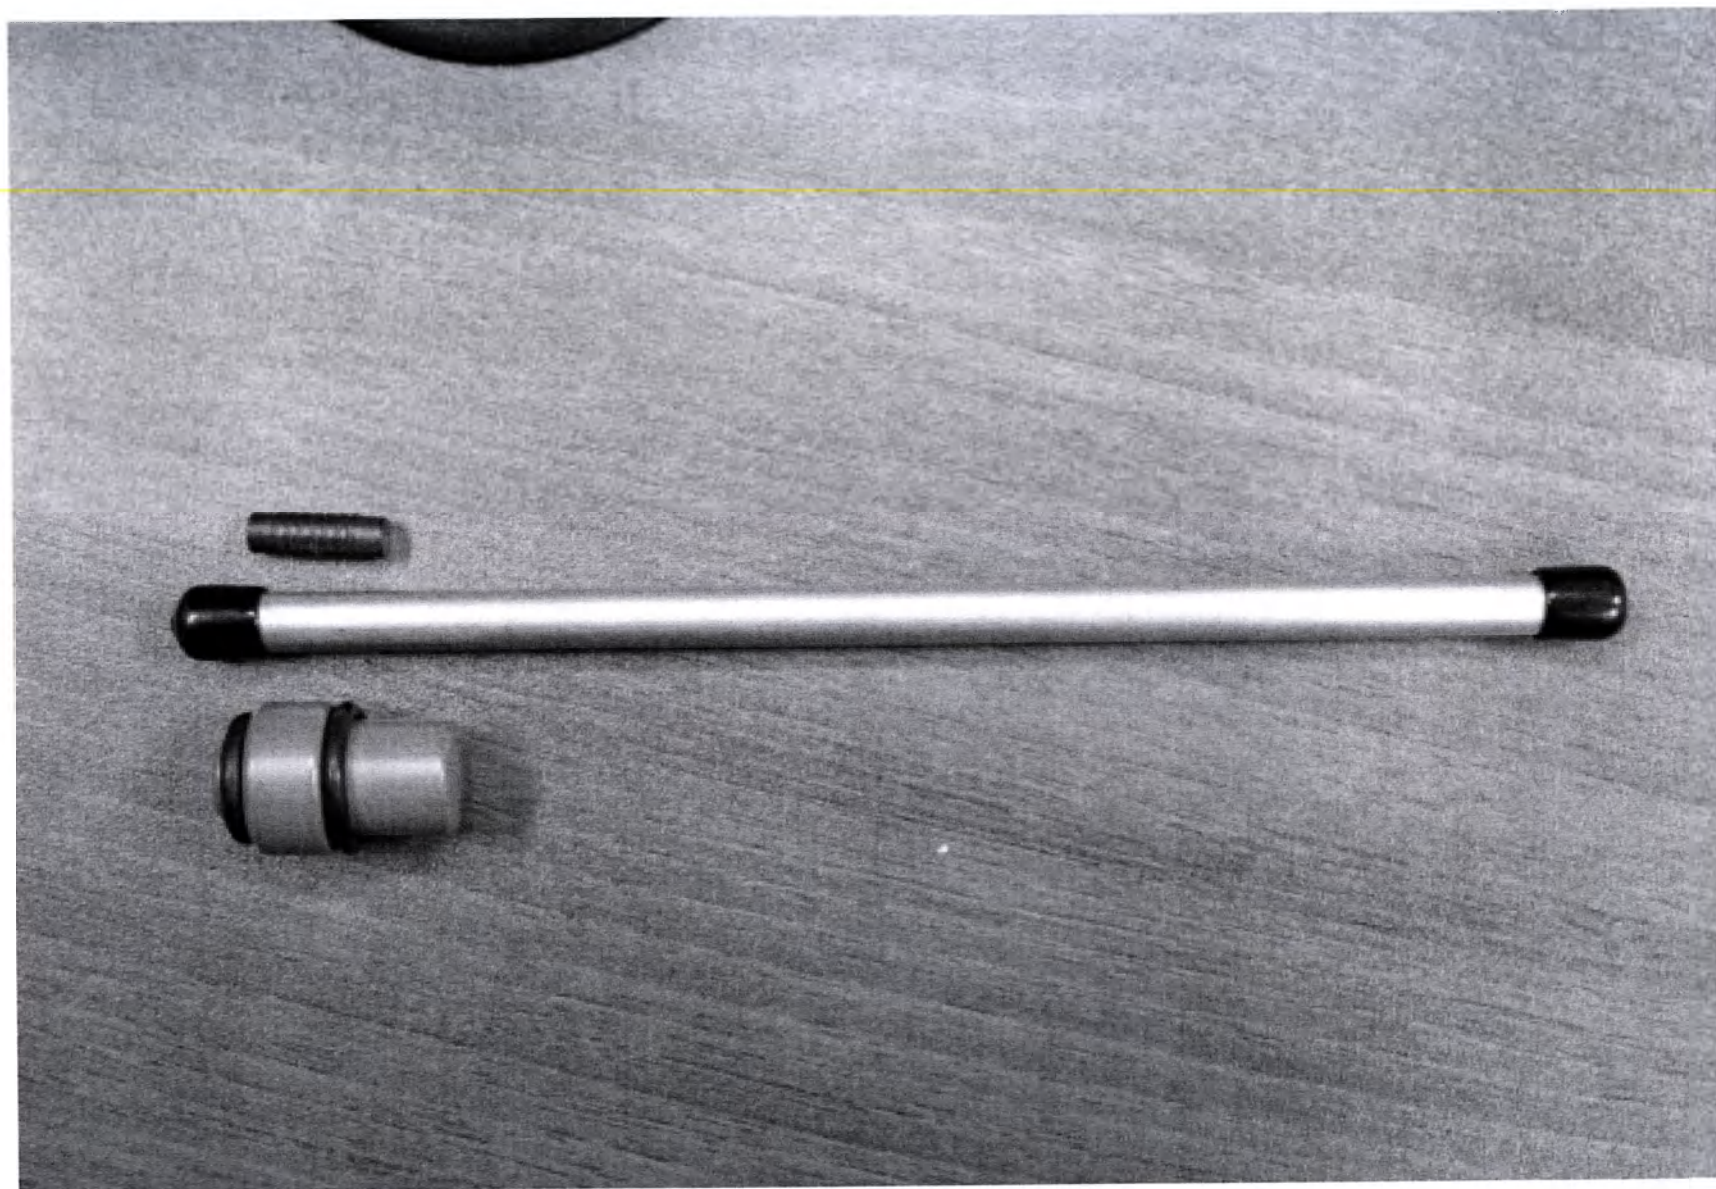




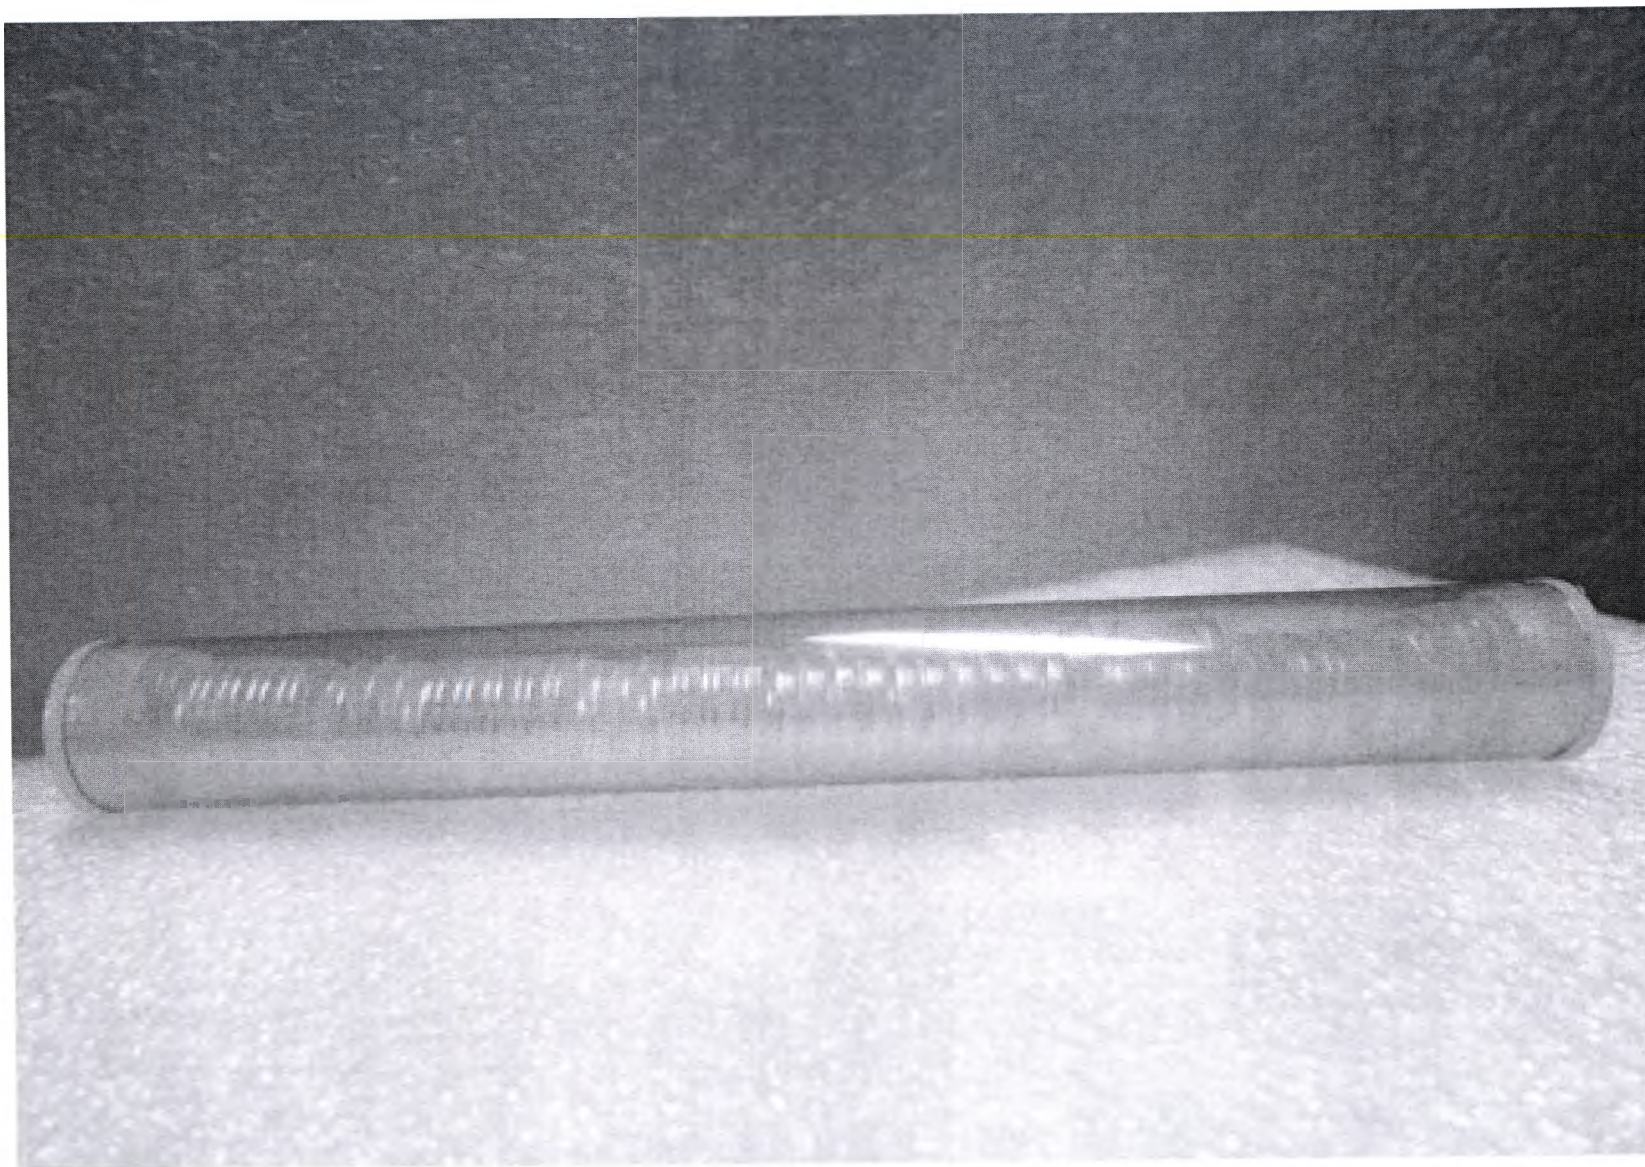

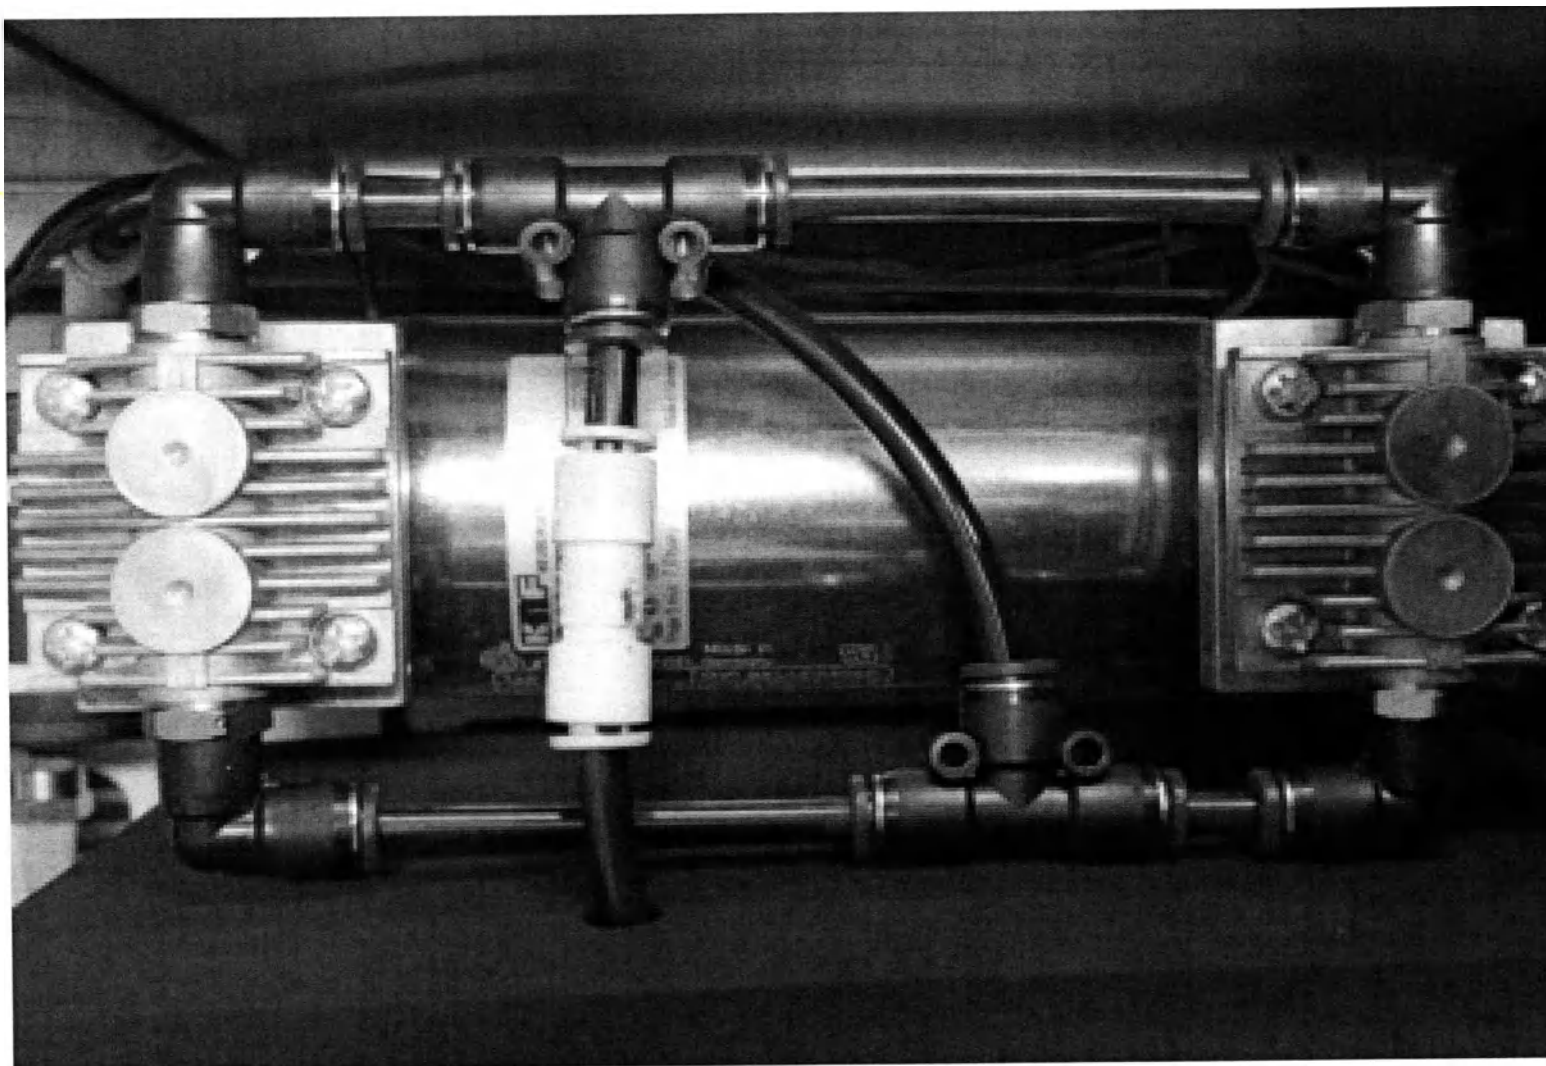




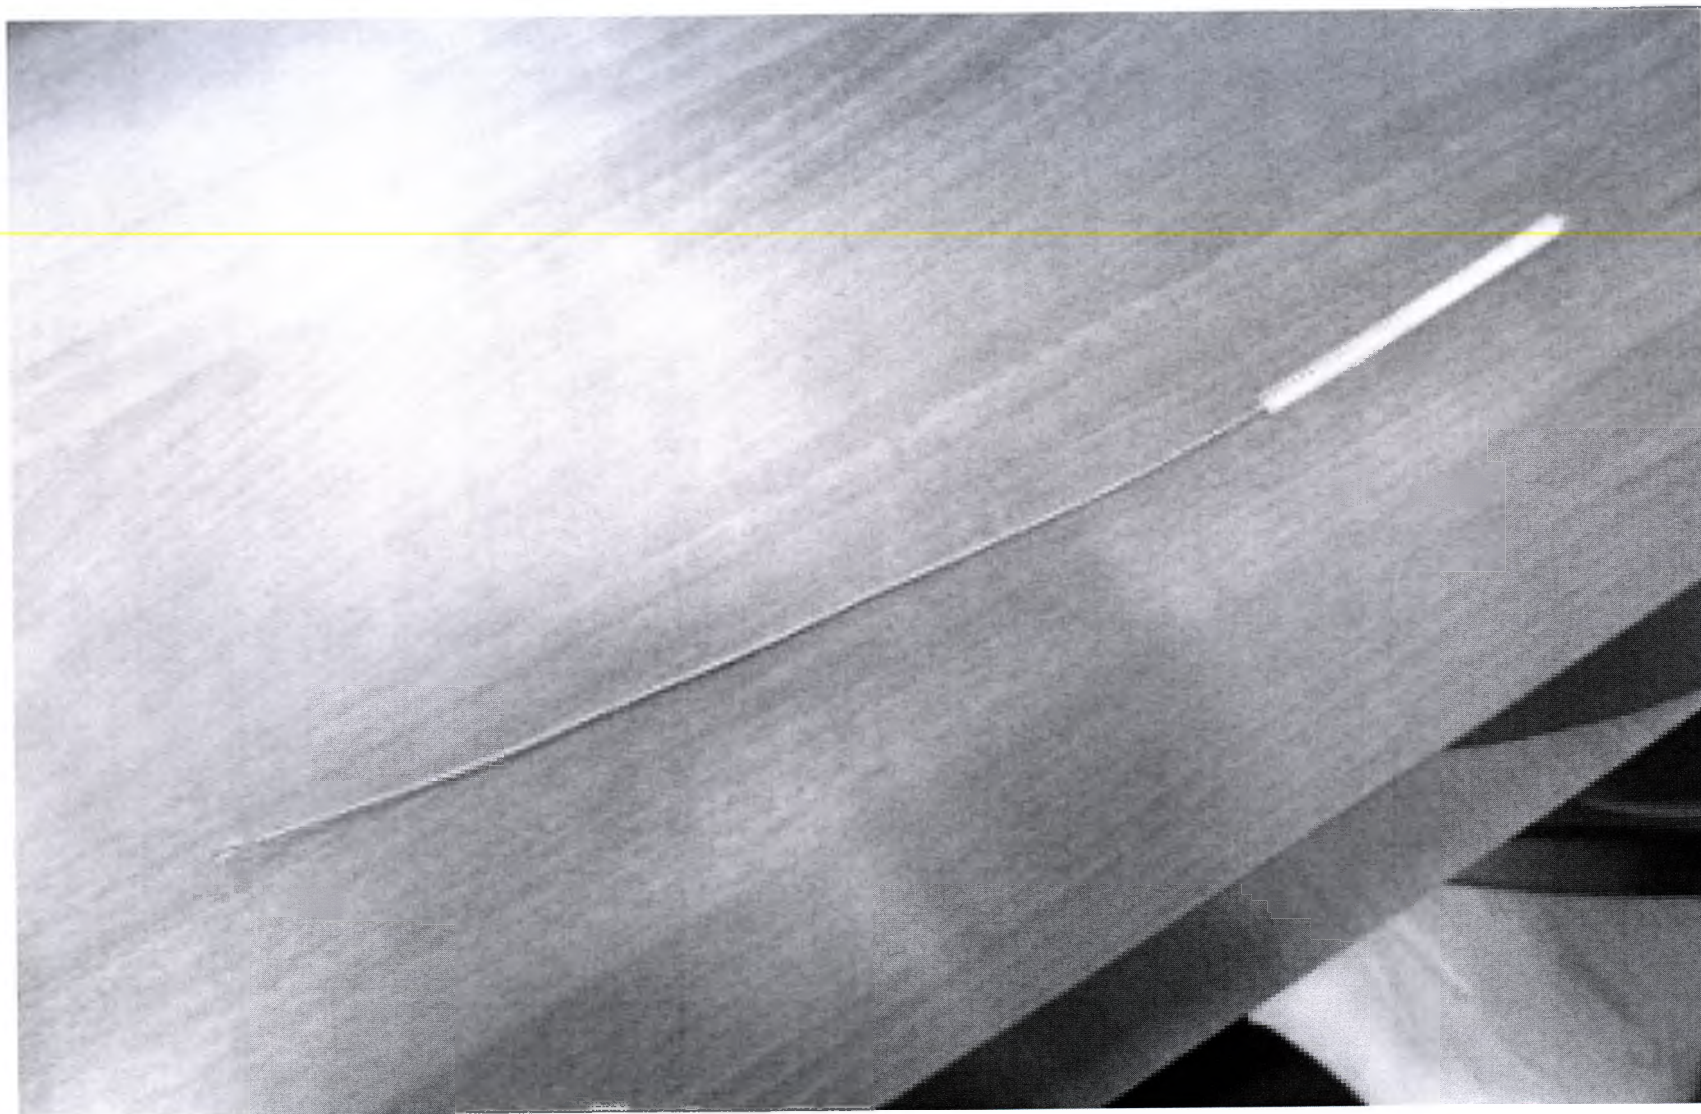

37.Тележка аппаратная



38.Чемодан транспортировочный с колёсами и выдвижной ручкой

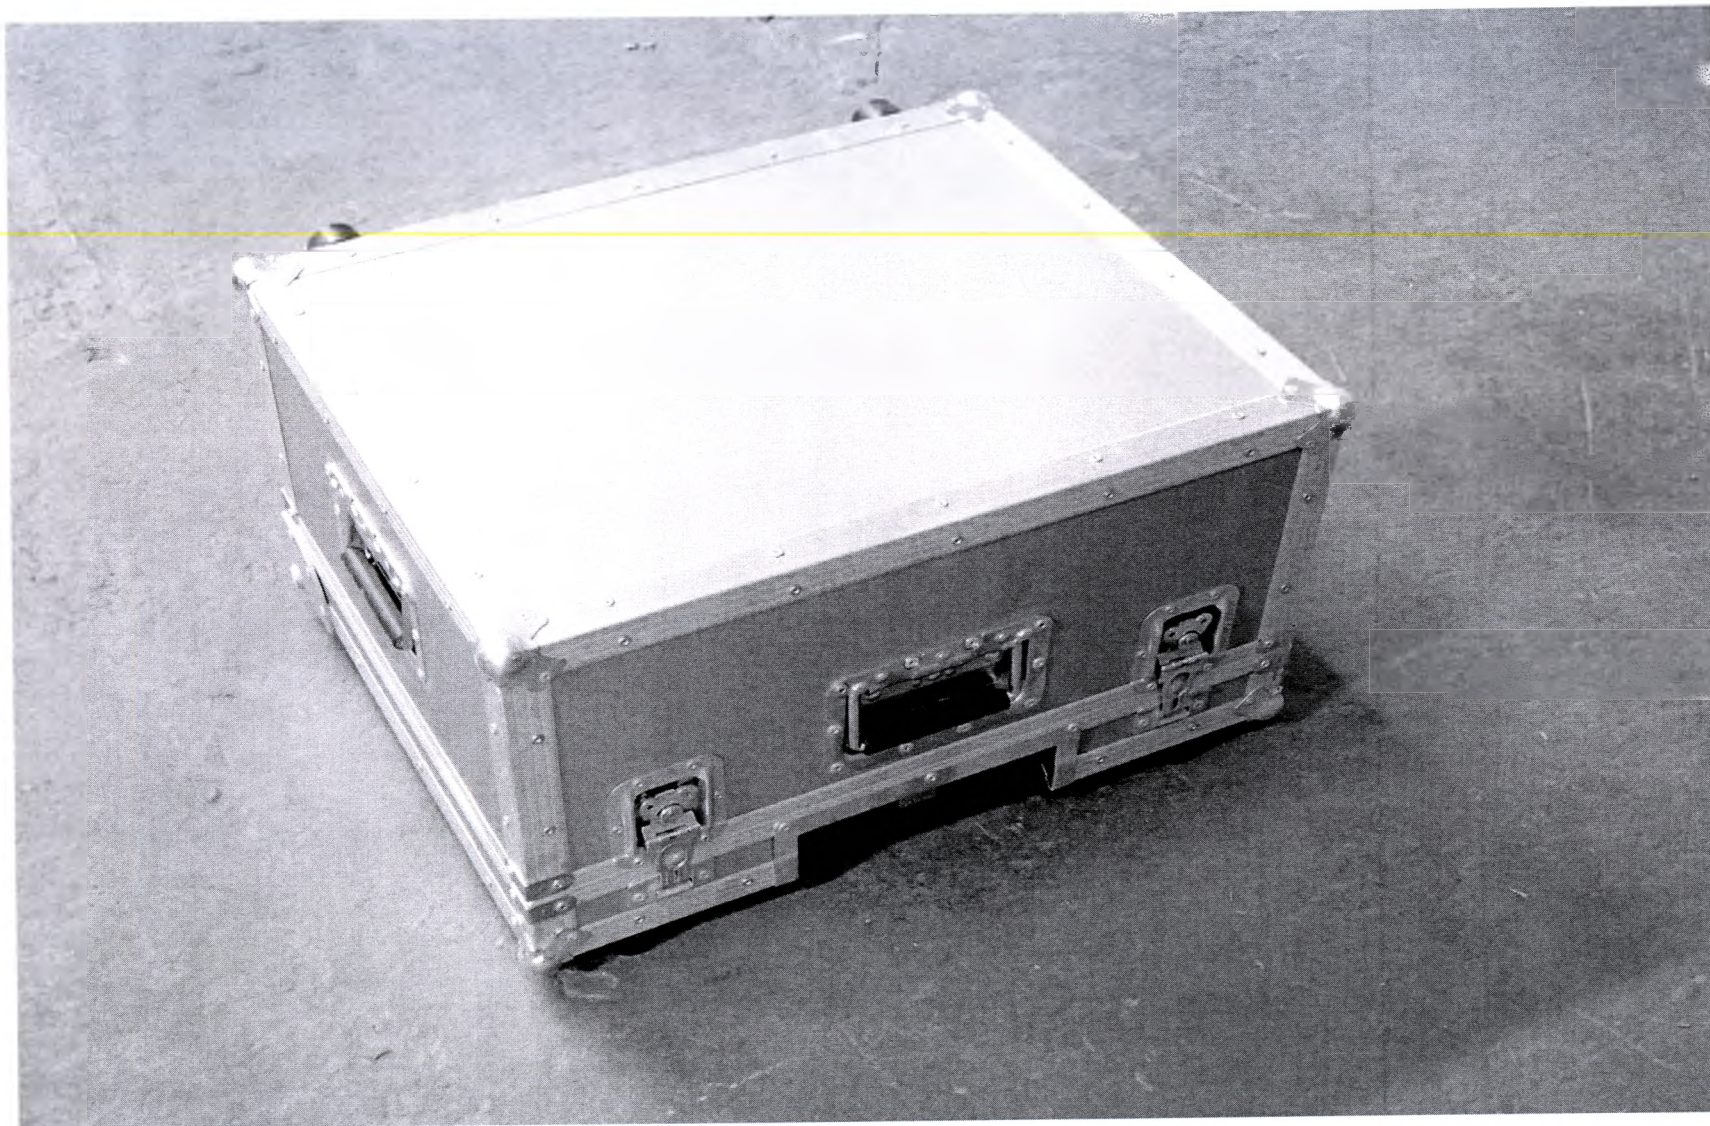



ПРИЛОЖЕНИЕ

Аппарат для ударно – волновой терапии ShockMaster 300 с принадлежностями:

I. Аппарат для ударно – волновой терапии ShockMaster 300 в составе:

1. Блок управления
2. Аппликатор
3. Держатель аппликатора
4. Ключ аппликатора
5. Головка диаметром 15 мм
6. Головка D-Actor диаметром 20 мм Т
7. Фиксатор головок
8. Гель контактный
9. Трубка направляющая металлическая
10. Сердечник ударный металлический
11. Сетевой шнур
12. Ручка - стилус для управления через сенсорный экран.
13. Руководство по эксплуатации
14. Защитный противоскользящий коврик


II. Принадлежности:

1. Держатель аппликатора V- Actor – 1 шт.
2. Аппликатор (не более 2 шт.).
3. Аппликатор V-Actor (не более 2 шт.).
4. Трубка направляющая металлическая (не более 5 шт.).
5. Сердечник ударный металлический (не более 5 шт.).
6. Сердечник ударный МА-Х (не более 5 шт.).
7. Головка диаметром 6 мм (не более 3 шт.).
8. Головка диаметром 10 мм (не более 3 шт.).
9. Головка диаметром 15 мм (не более 3 шт.).
10. Головка диаметром 15 мм CERAMAX (не более 3 шт.).
11. Головка D-Actor диаметром 20 мм S (не более 5 шт.).
12. Головка D-Actor диаметром 20 мм Т (не более 5 шт.).
13. Головка диаметром 25 мм (не более 3 шт.).
14. Головка диаметром 30 мм (не более 3 шт.).
15. Головка D-Actor диаметром 35 мм S (не более 5 шт.).
16. Головка D-Actor диаметром 35 мм Т (не более 5 шт.).
17. Головка диаметром 40 мм (не более 3 шт.).
18. Головка глубокого воздействия Deep Impact (не более 3 шт.).
19. Головка фокусирующая (не более 3 шт.).

20. Головка шарообразная (не более 3 шт.).
21. Фиксатор головок (не более 6 шт.).
22. Индикатор боли F-METER (не более 2 шт.).
23. Комплект сменных частей аппликатора (не более 10 шт.).
24. Комплект сменных частей МАХ (не более 5 шт.).
25. Расширенный комплект сменных частей аппликатора – 1 шт.
26. Колпачки защитные одноразовые (не более 100 шт.).
27. Компрессор – 1 шт.
28. Фильтр воздушный 5 мкм с прокладками (не более 3 шт.).
29. Щётка для чистки принадлежностей —(не более 5 шт.)
30. Тележка аппаратная – 1 шт.
31. Чемодан транспортировочный с колёсами и выдвижной ручкой – 1 шт.
- Кофр транспортировочный – 1 шт.

Генеральный директор

ООО «Группа АСВОМЕД»
(должность)

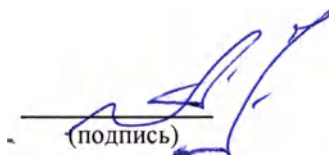
(подпись)

А. В. Чиняев
(И.О.Фамилия)

" 08 мая 20 16 г.





Протестировано и
протестировано
44 места.

