

REF

D-2184

набор реагентов для иммуноферментного
выявления иммуноглобулинов класса G
к капсидным антигенам VCA
вируса Эпштейна-Барр
в сыворотке (плазме) крови

ВектоВЭБ-VCA-IgG

LOT 91

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами VCA ВЭБ	1 шт.		50
2. Положительный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	1,5 мл	91
3. Отрицательный контрольный образец, инактивированный	1 фл.	3,0 мл	91
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	91
5. Раствор для предварительного разведения сывороток	1 фл.	10,0 мл	956
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	91
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	2 фл.	по 28,0 мл	2867
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	30493
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1349

Принадлежности:


Пленки для заклеивания планшета	2 шт.
Ванночки для реагентов	2 шт.
Наконечники для дозаторов	16 шт.
Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов	1 шт.

«27.07.2020»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Вектор-БЕЛ»

БЕКТОР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA
вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgG)» № 2

АО «Вектор-Бест»



BEKTOP
БЕСТ

REF **D-2184**

Σ
12x8

LOT

91

ТУ 9398-592-23548172-2016

ПУ № РЗН 2017/5607 от 11.04.2017



2020-09-22



2021-09-22

ВектоВЭБ-VCA-IgG

IVD




21842209210009100399

Для профессионального применения

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита C и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgG)» № 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

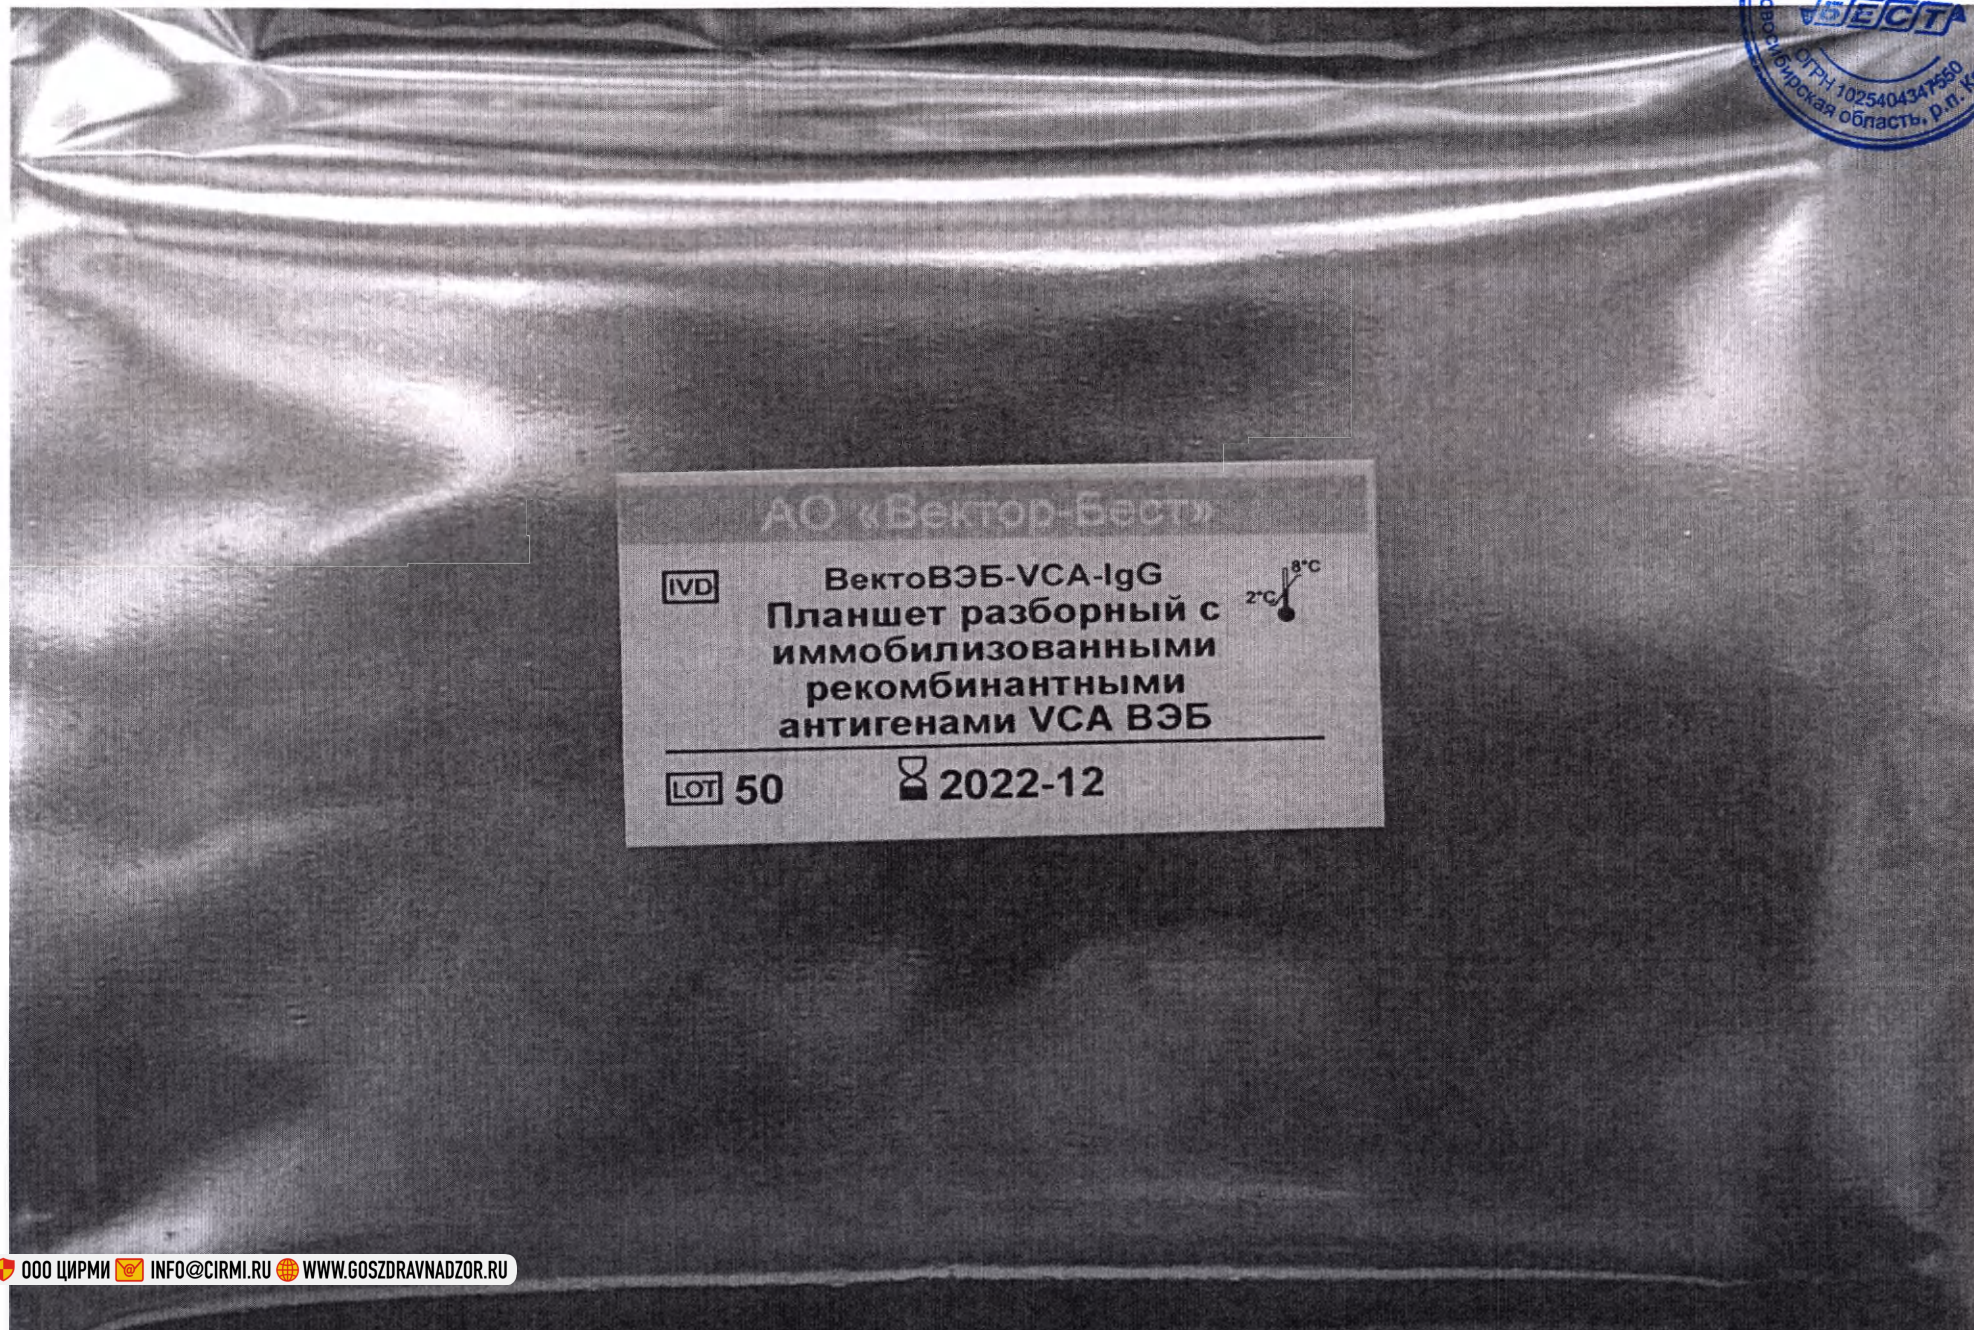


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgG)» № 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgG)» № 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

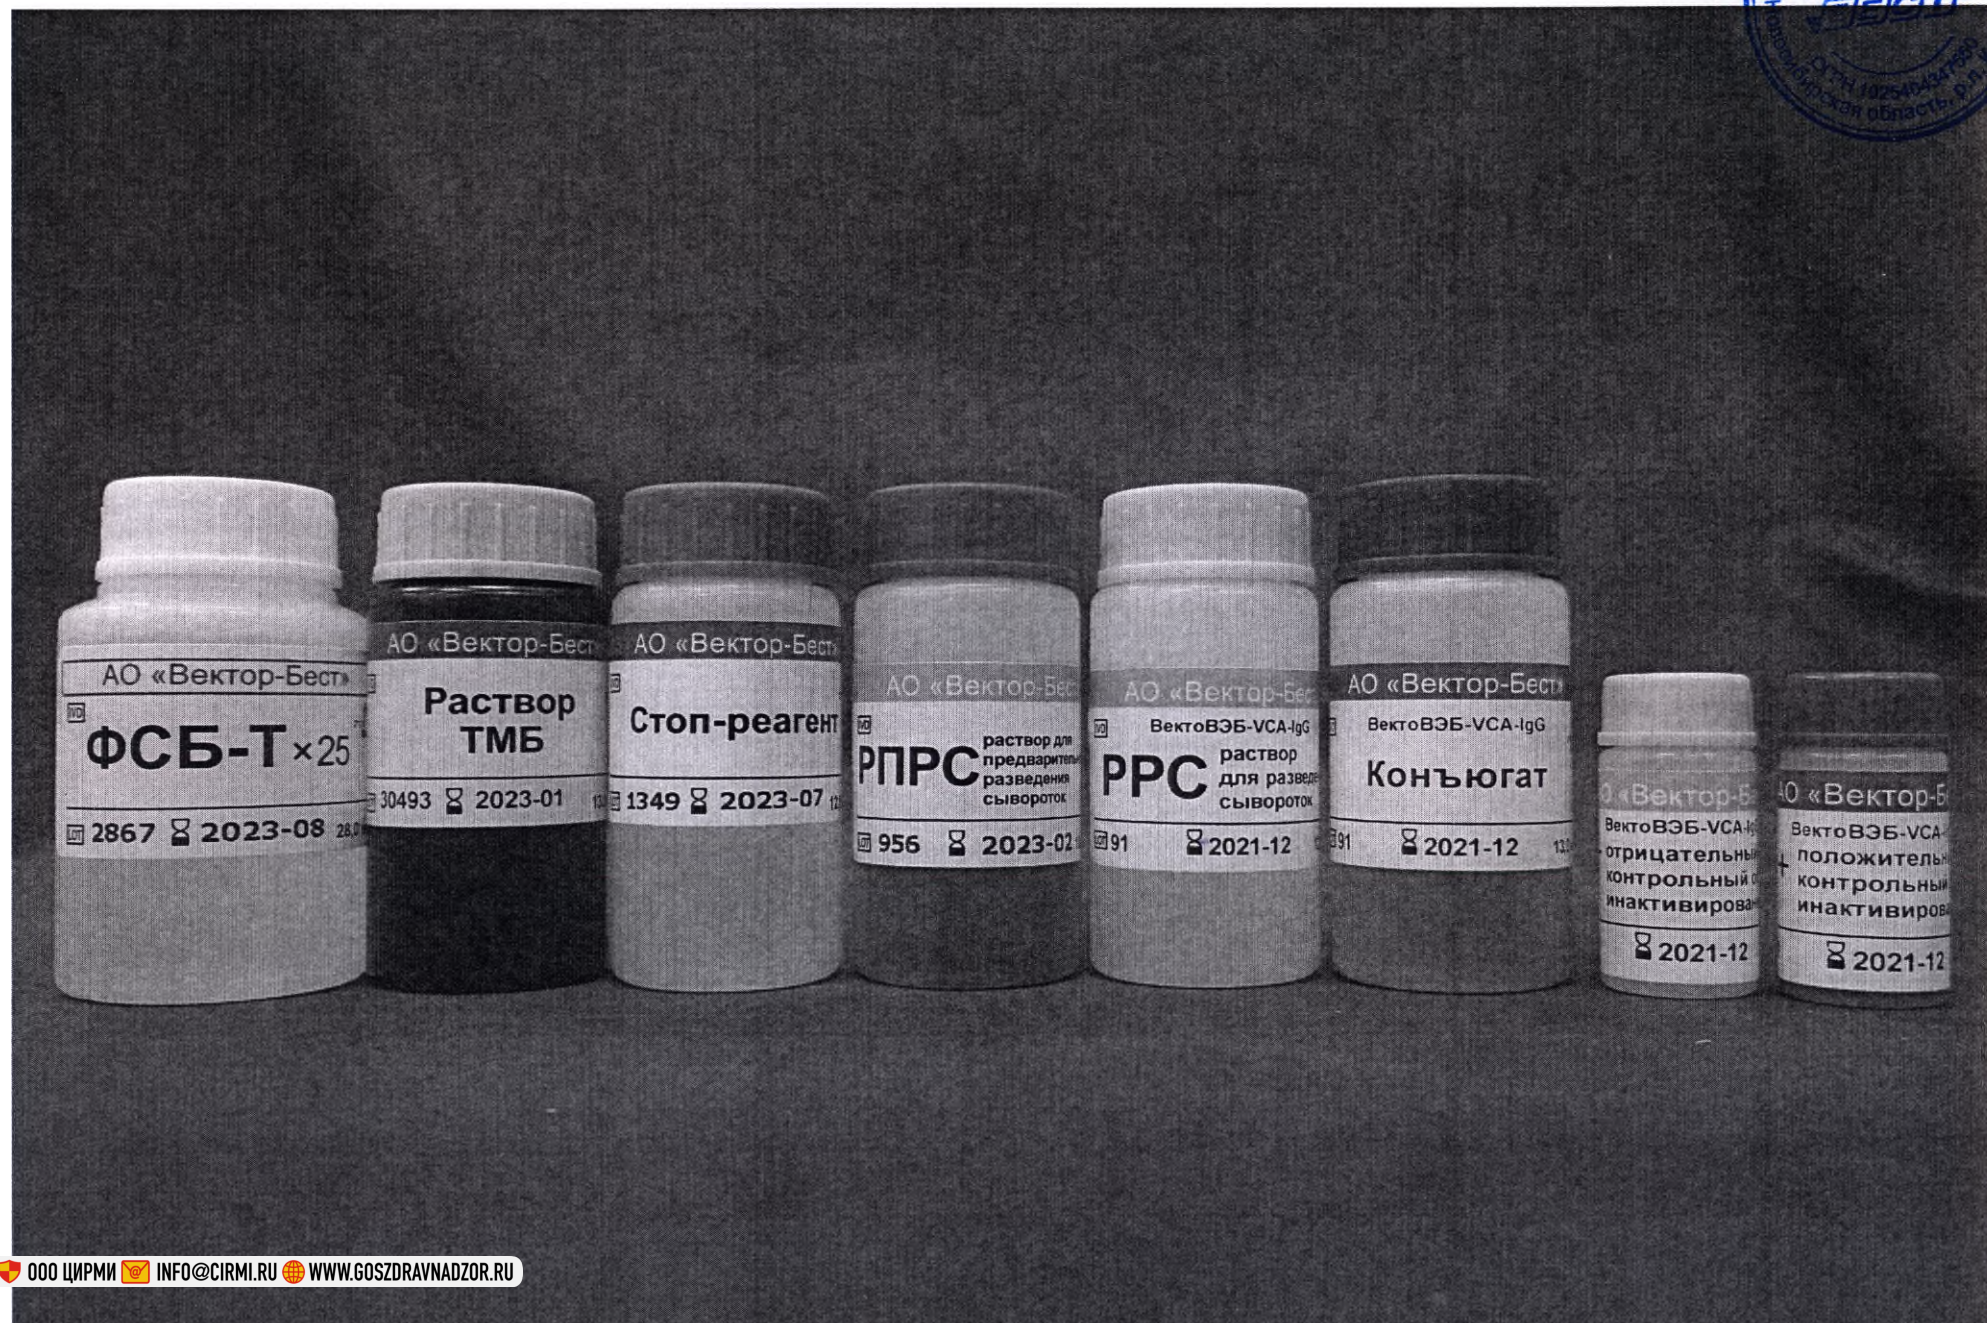

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидным антигенам VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови (ВектоВЭБ-VCA-IgG)» № 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

