





Автоматический анализатор для биохимического
и иммунотурбидиметрического анализа VitaRay 300


Тумба

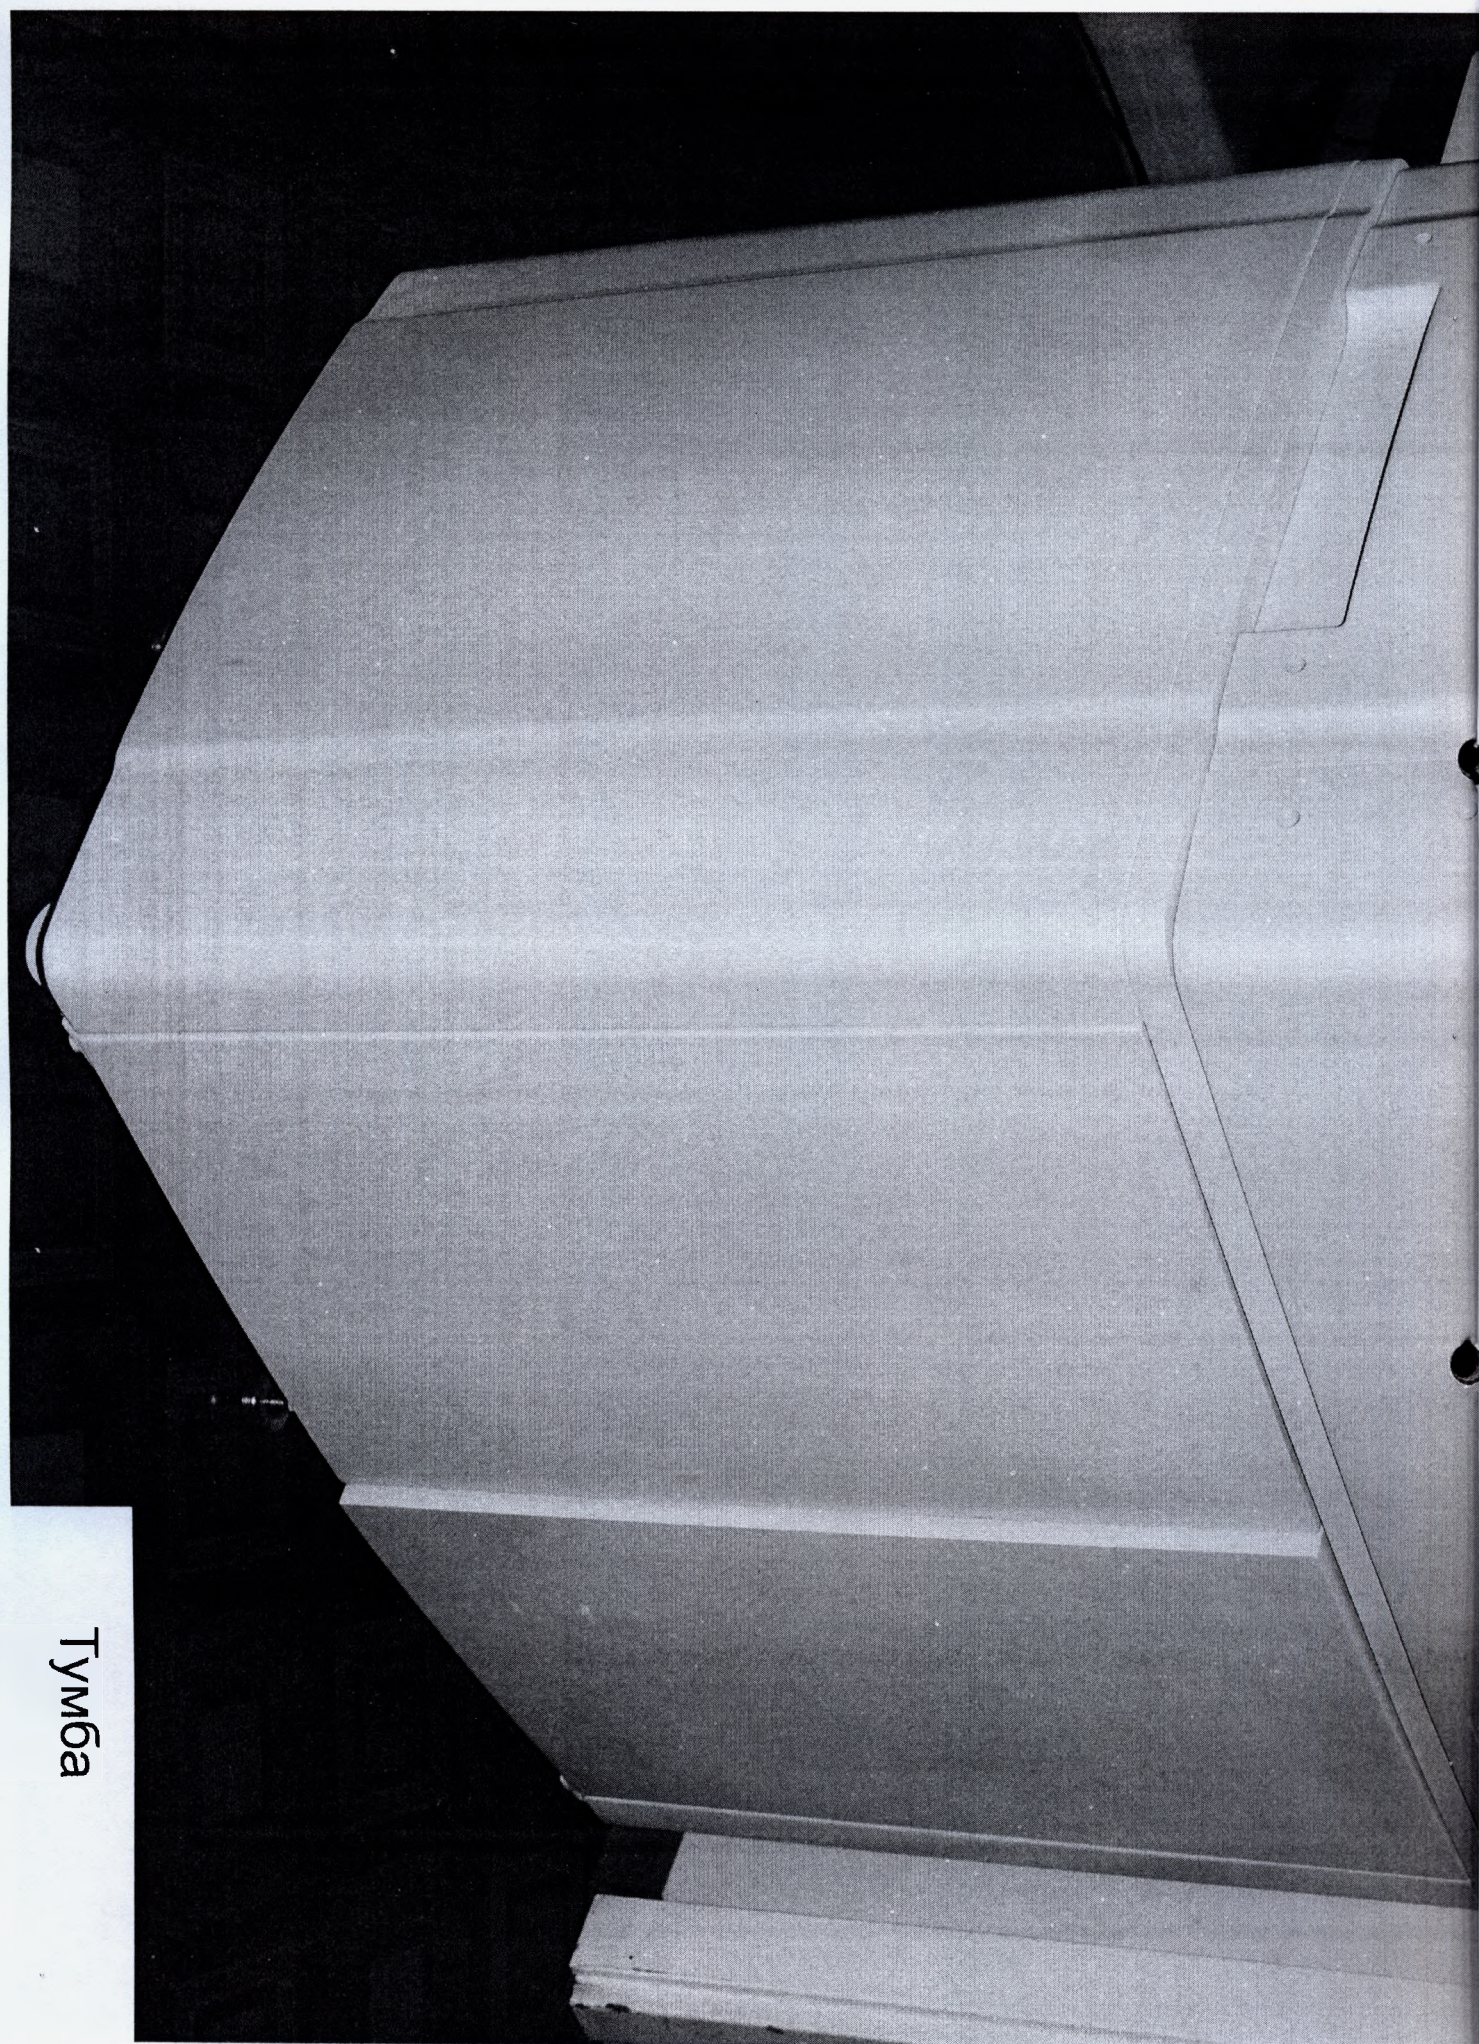

Тумба

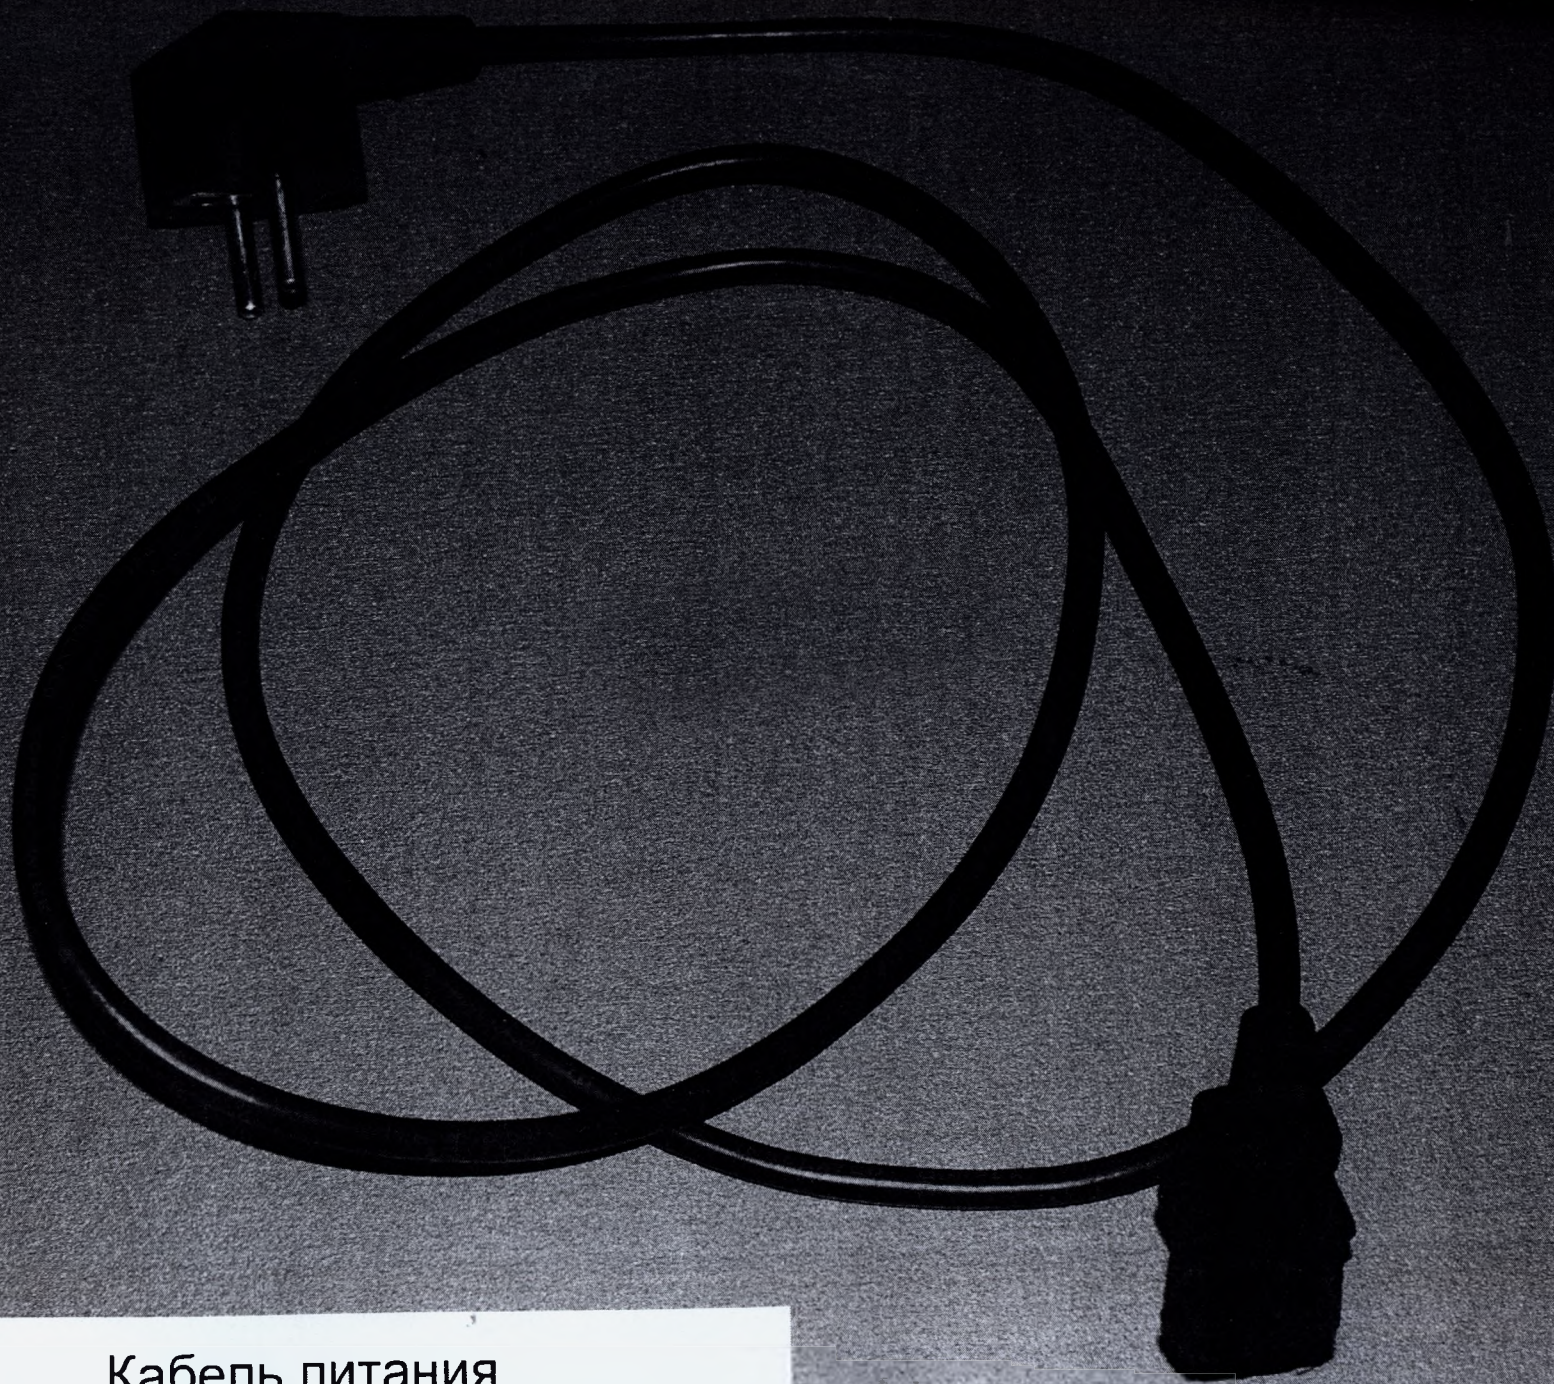


Кабель питания

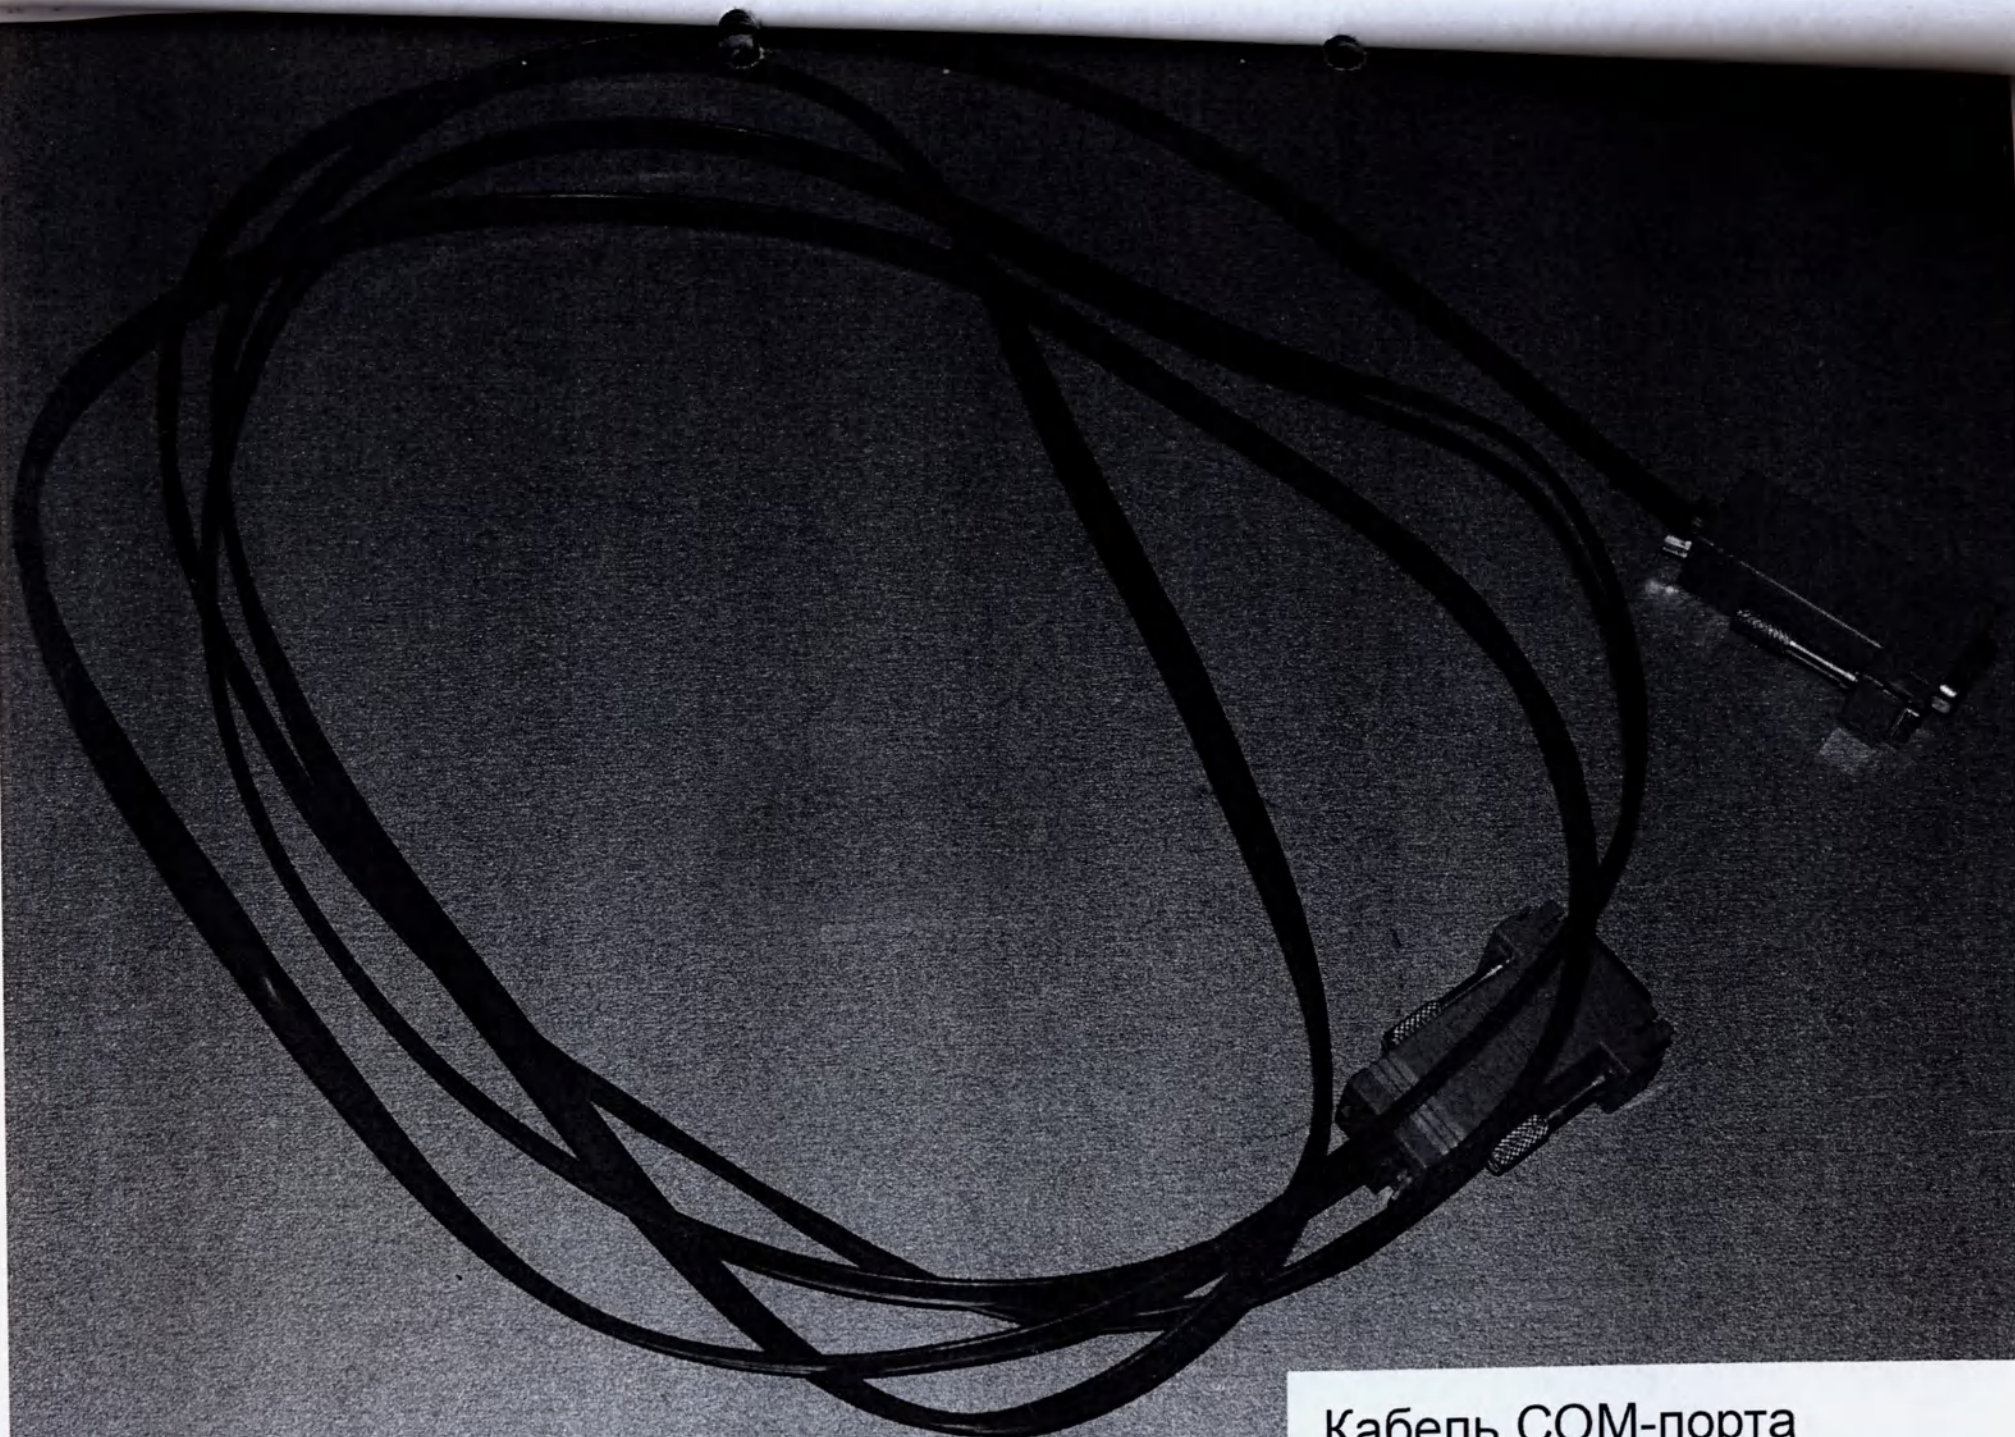

Кабель COM-порта

-4-

Предохранитель

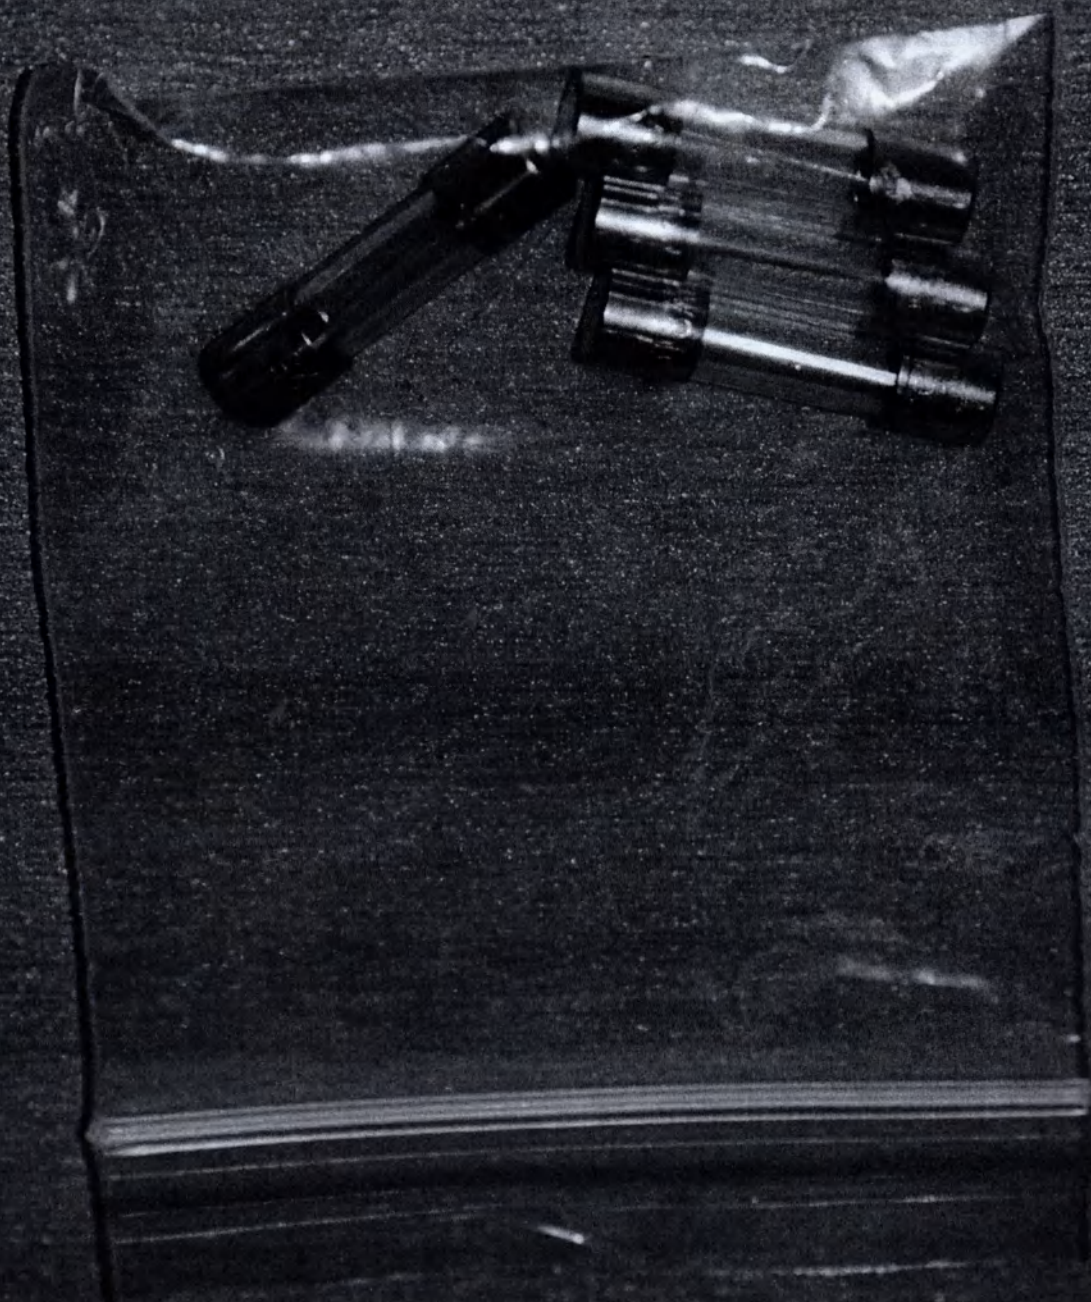





Флакон для реагентов 25 мл



Флакон для реагентов 50 мл

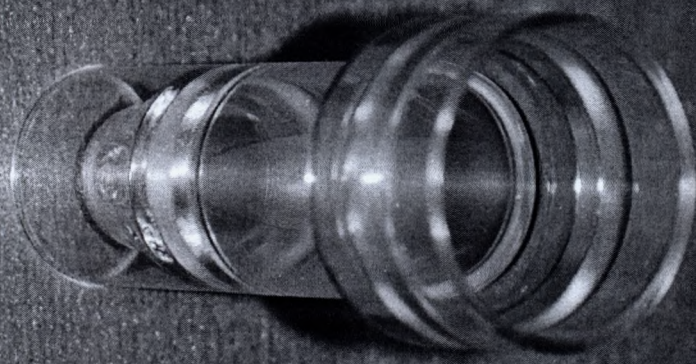

Чашки для образцов

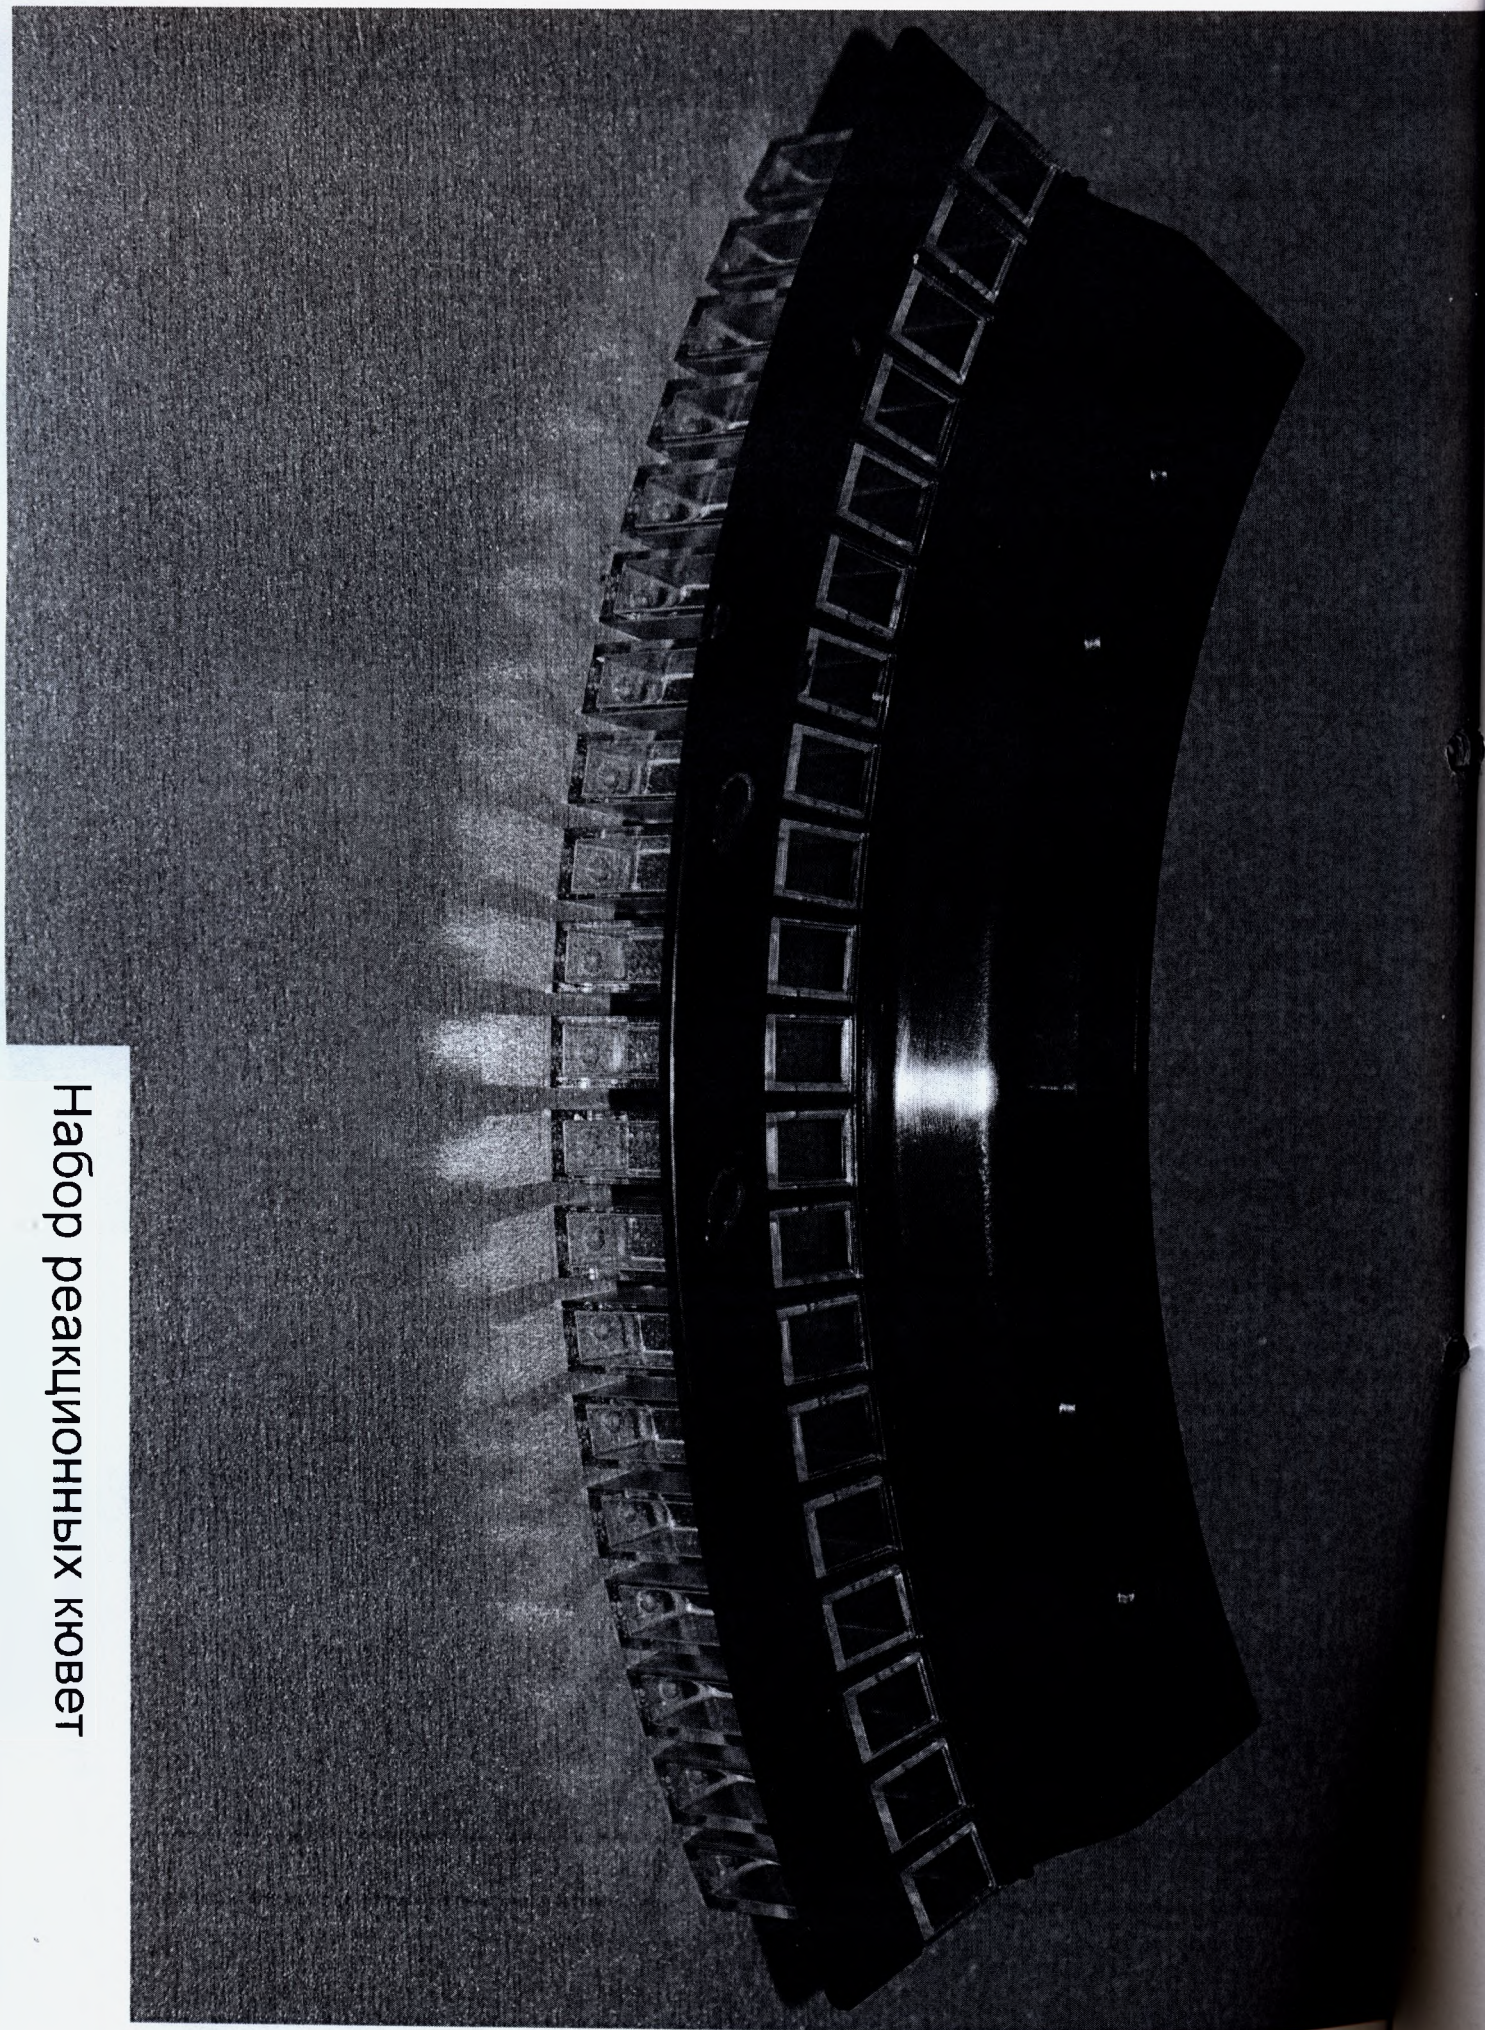

Набор реакционных кювет




Канистра для отходов, 25 л


Канистра для воды, 25 л

Канистра для детергента, 5 л


-10-

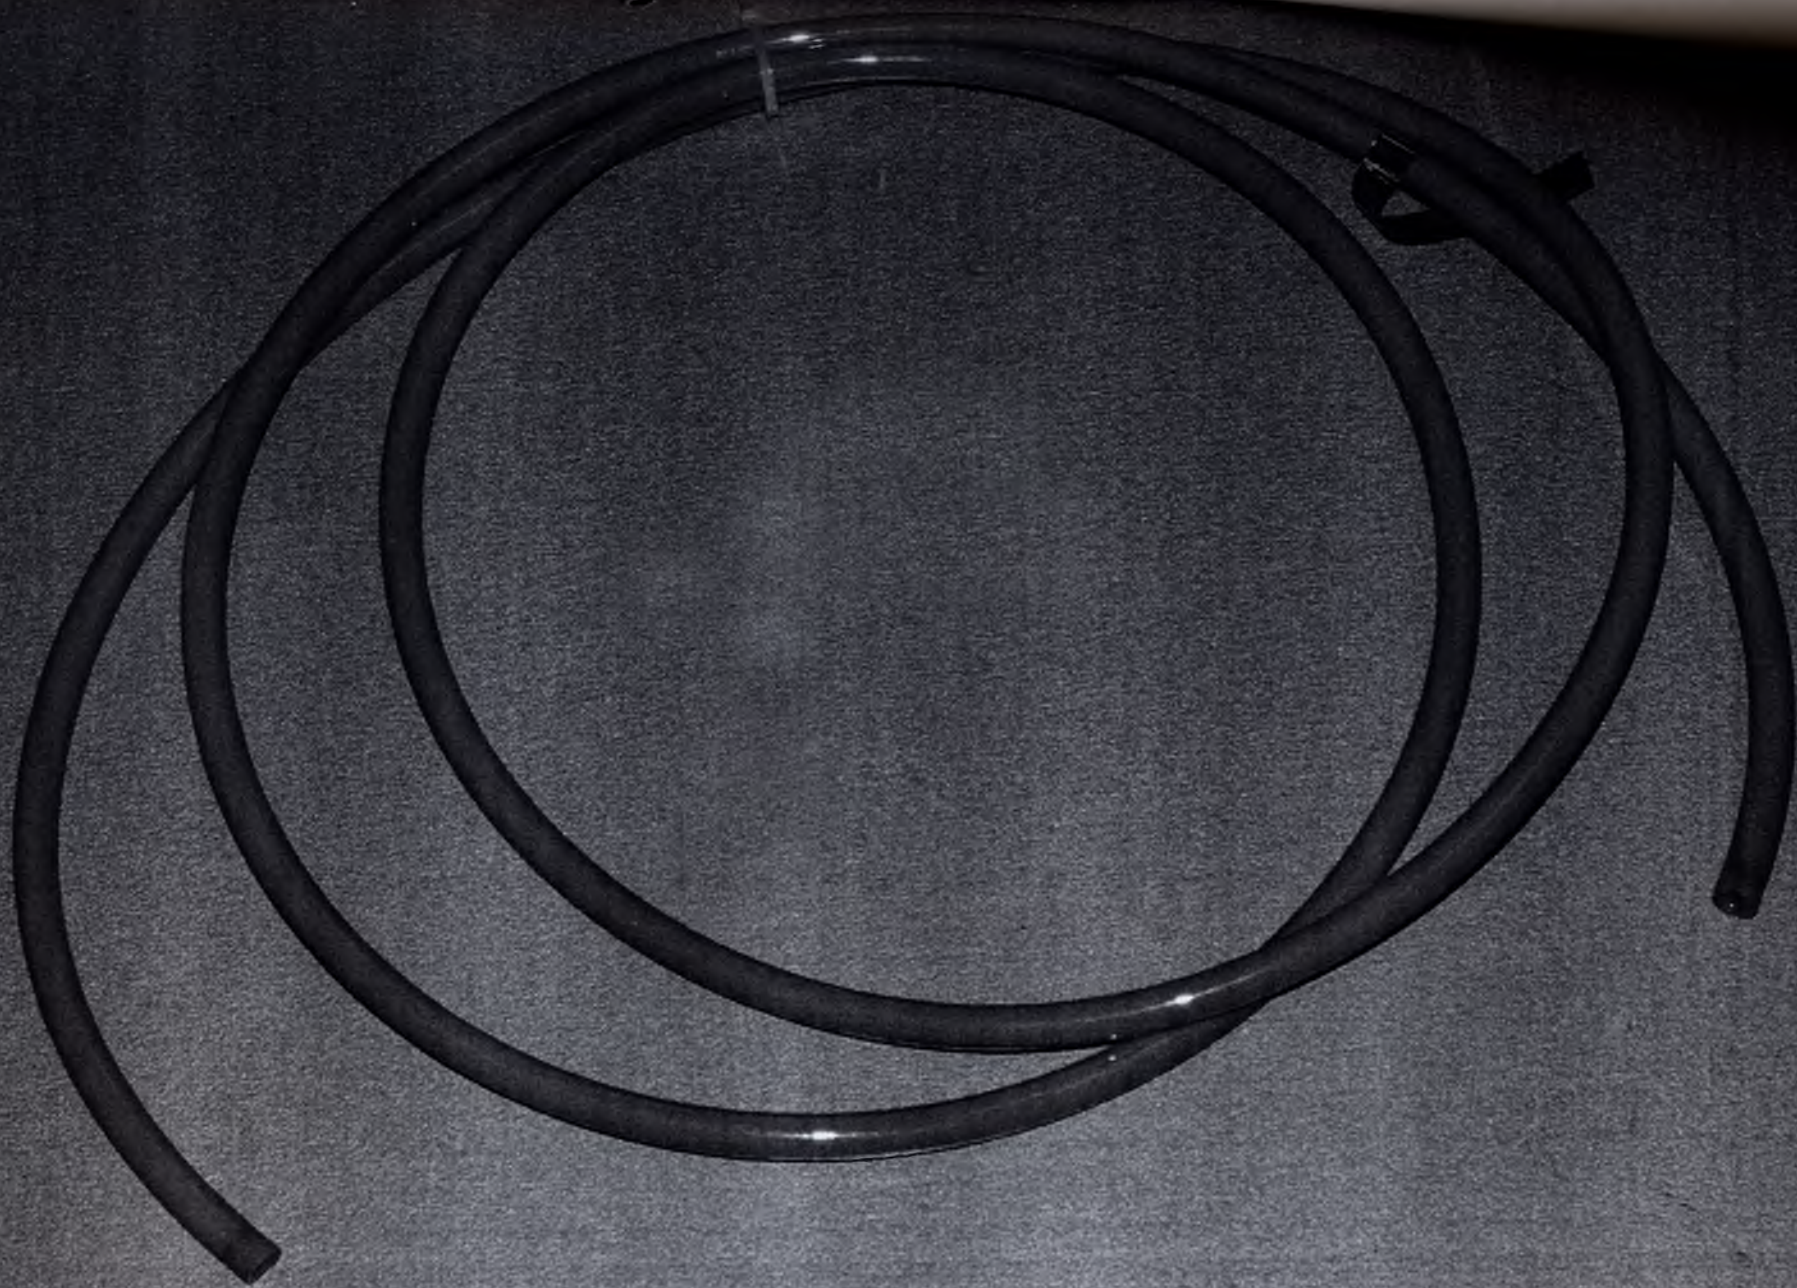

Трубка слива отходов

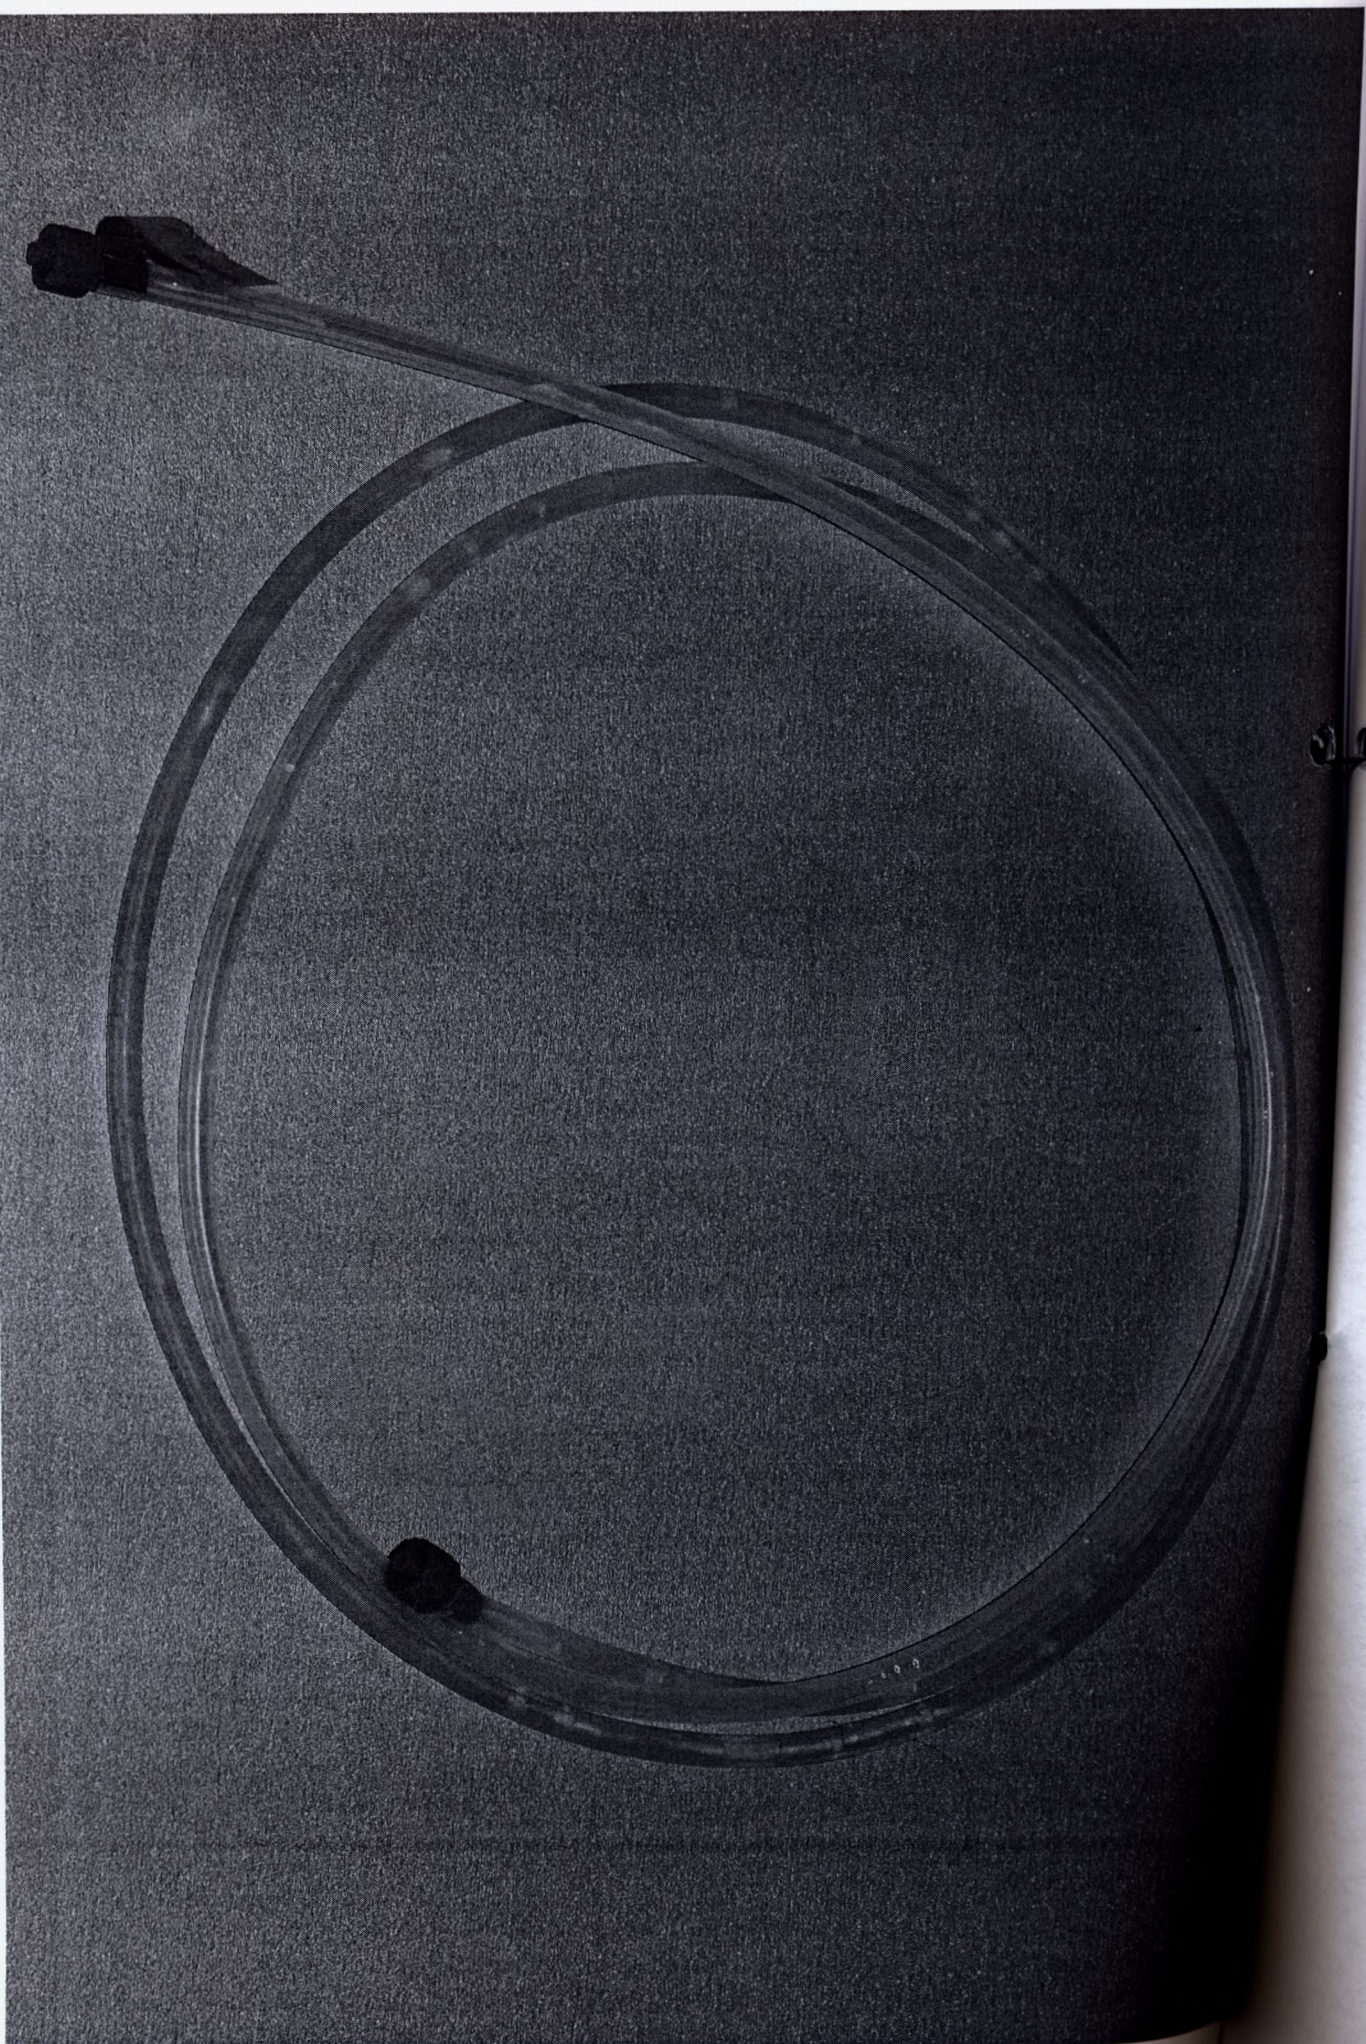

Трубка для детергента

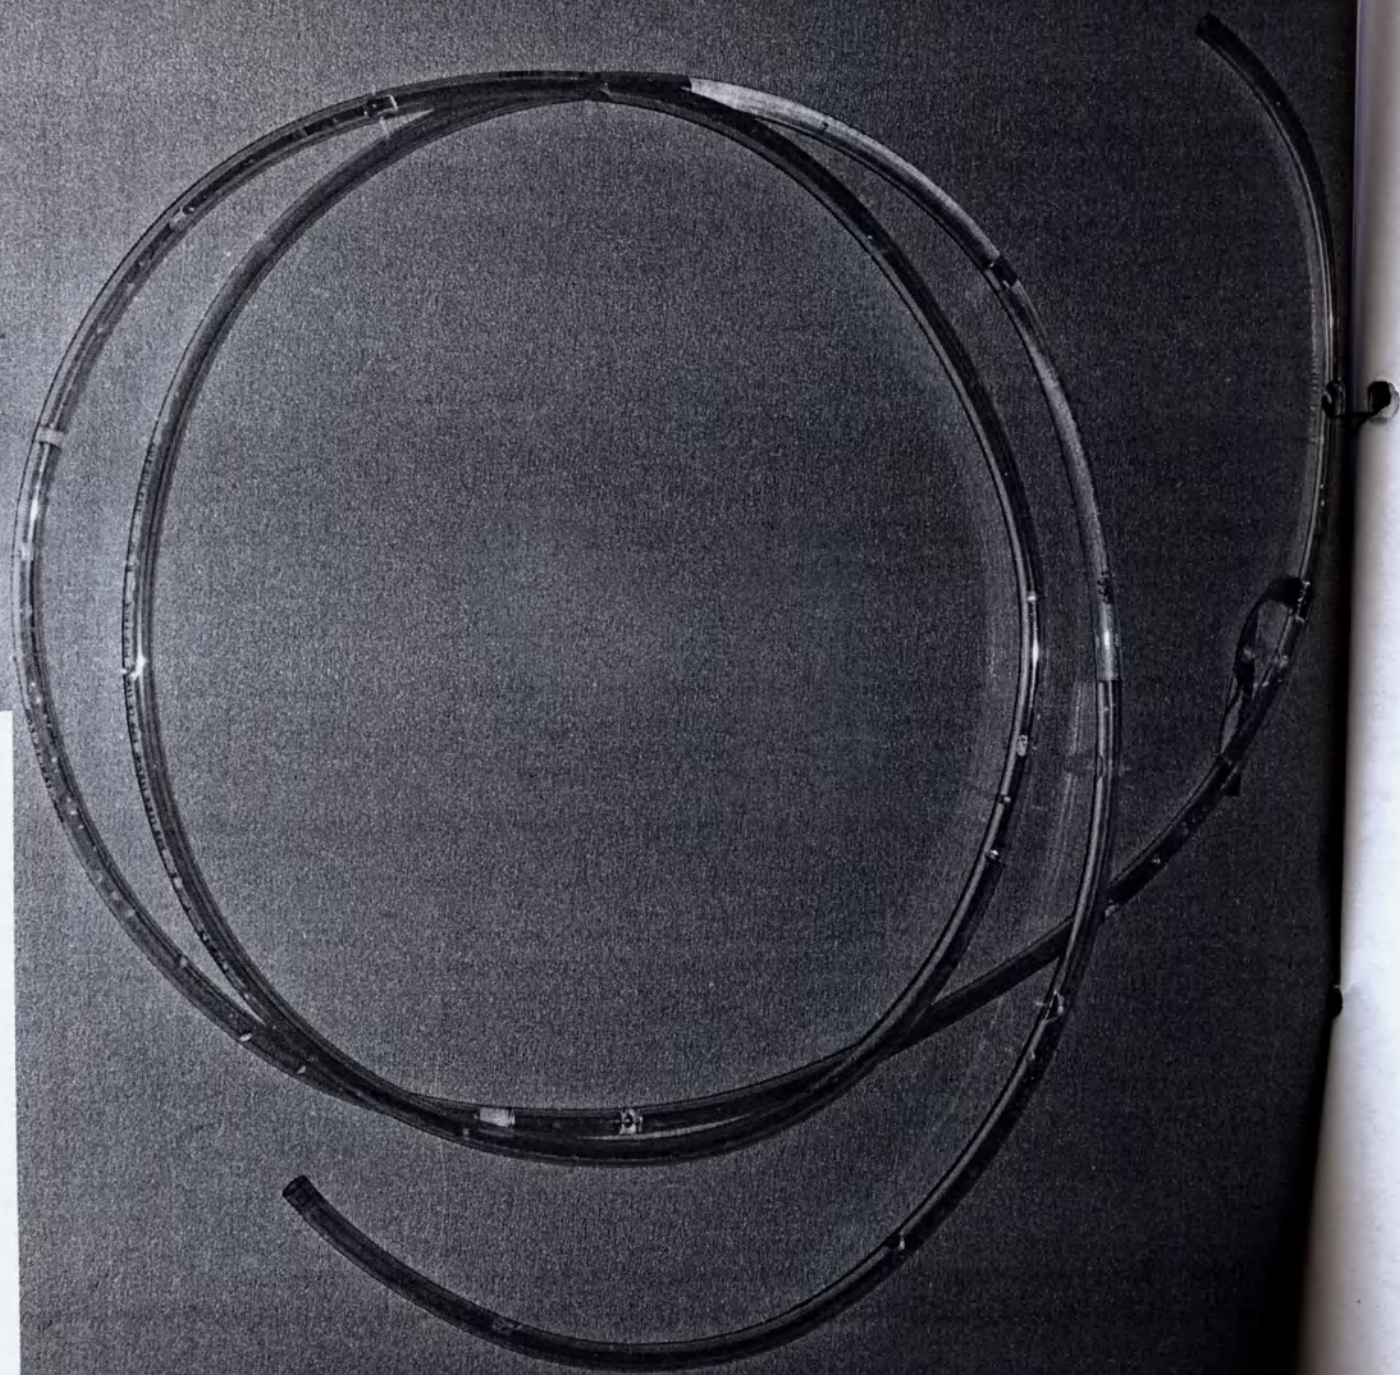

Трубка для дистиллированной воды




Пластиковая гофрированная трубка

Кабель датчика уровня



Кабель датчика уровня жидкости

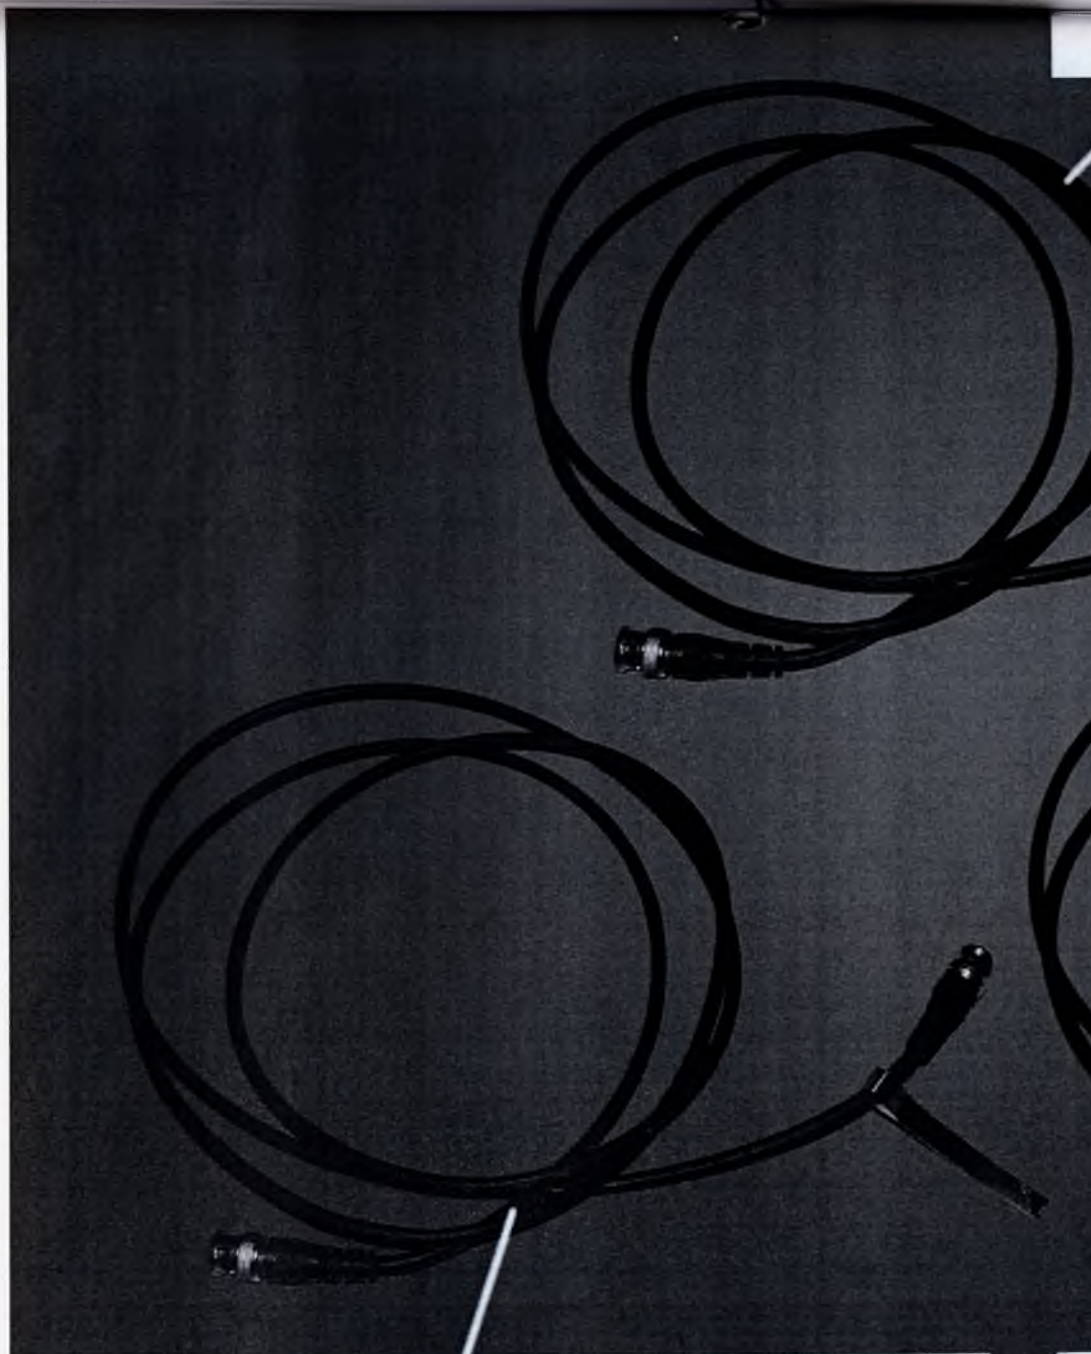

Кабель датчика уровня жидкости

Отвертка






Шестигранный ключ




Игла для образцов

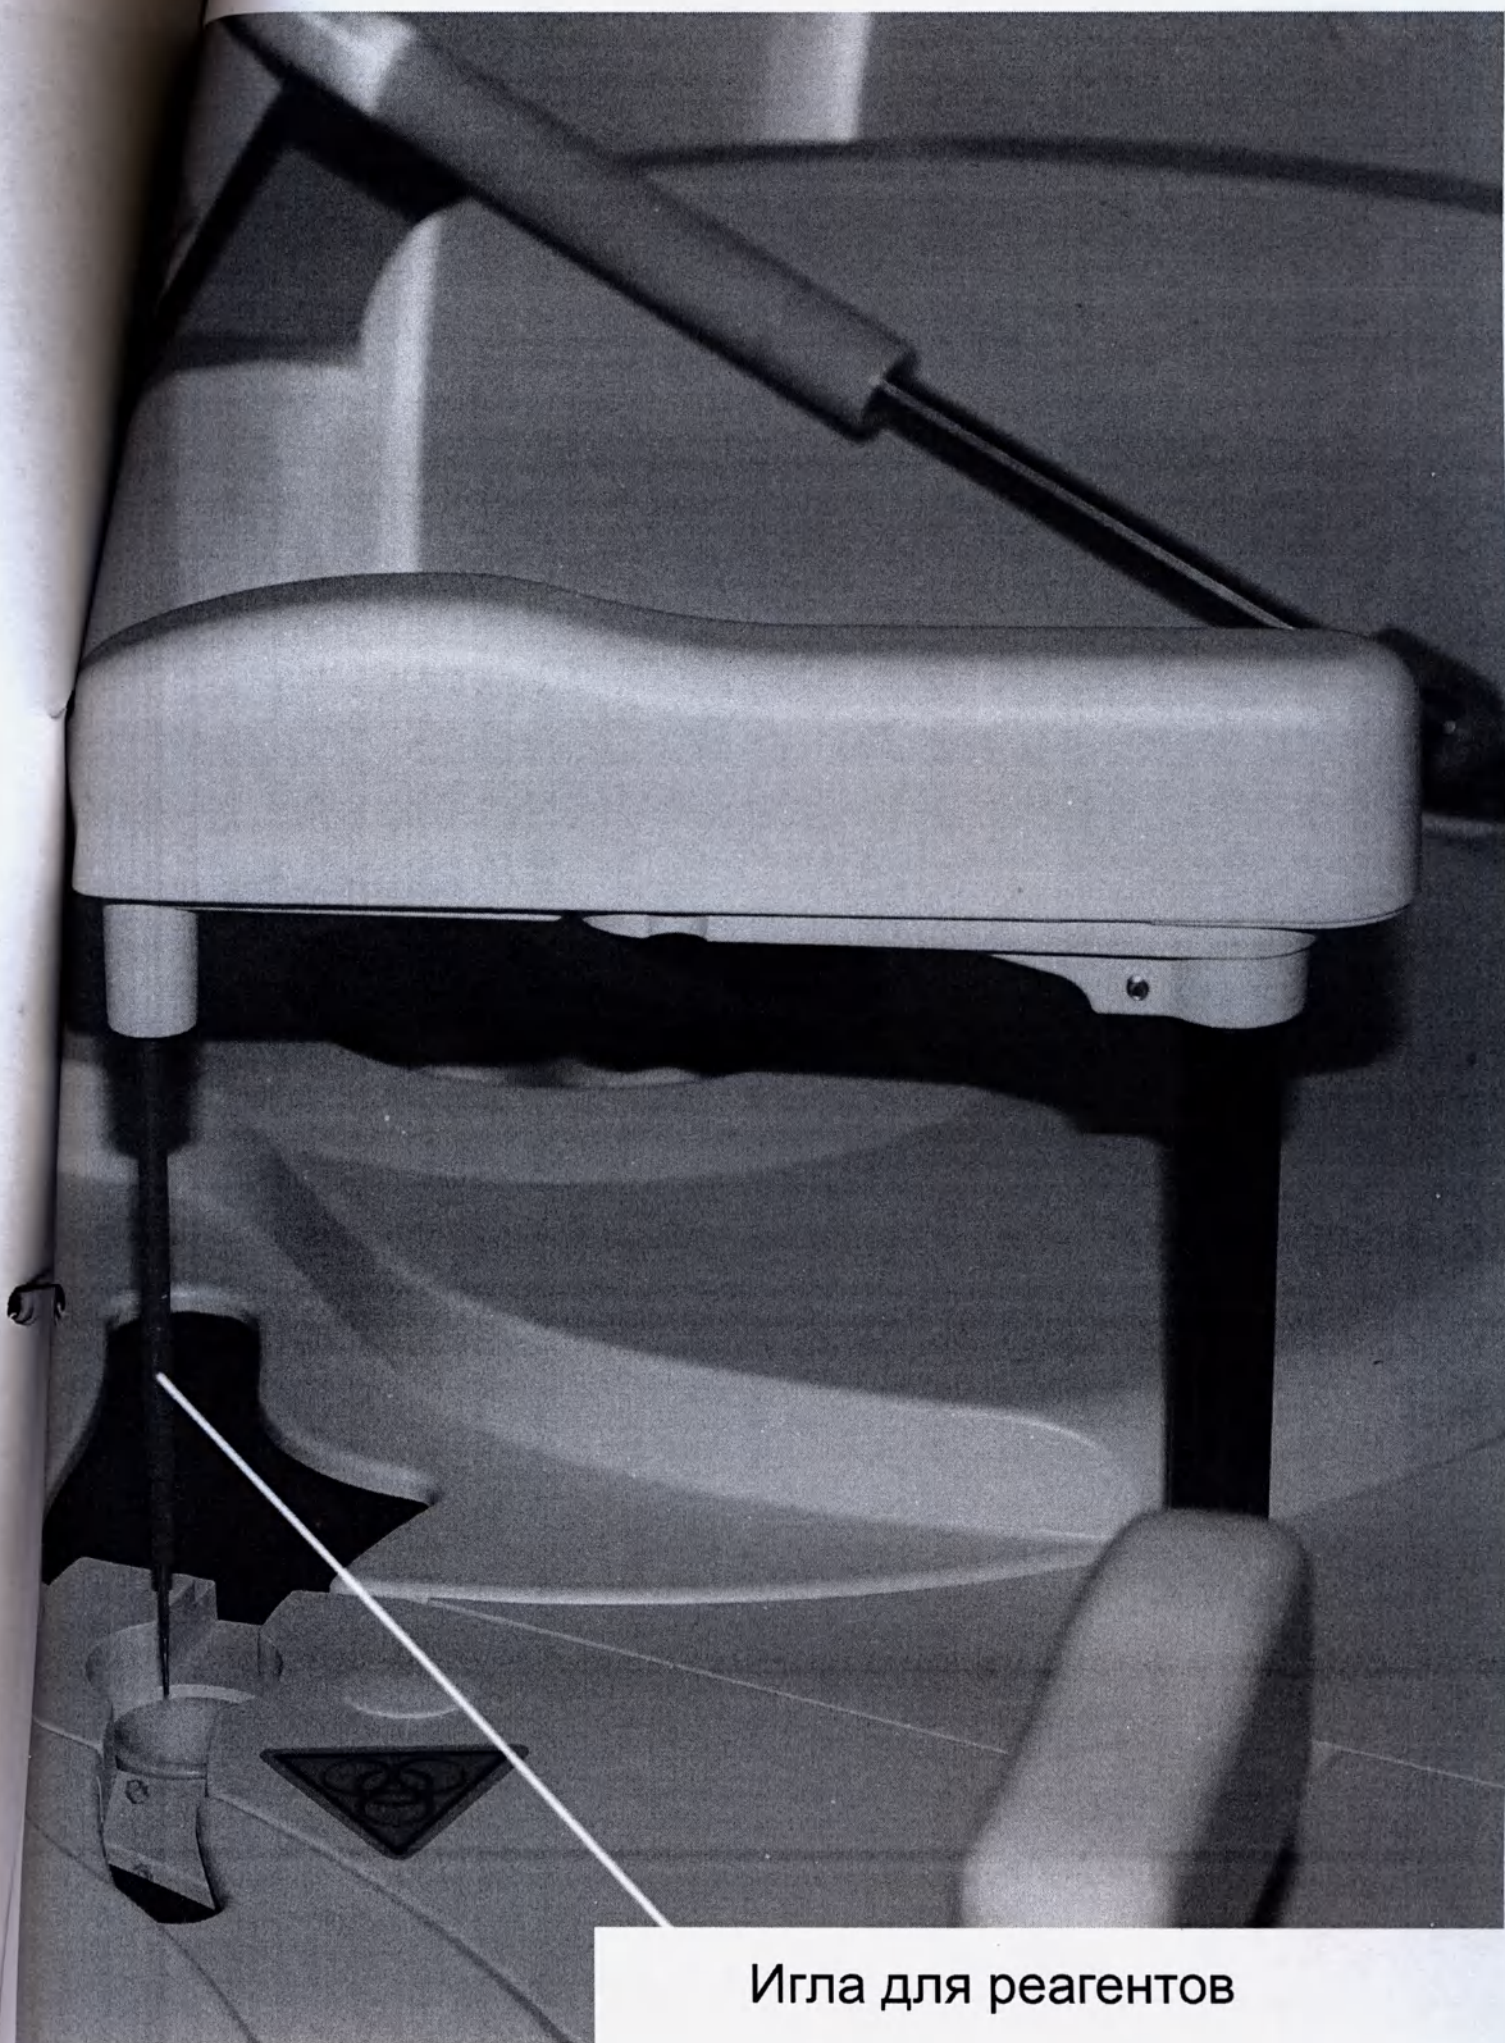

Игла для реагентов




Мешалка для реагентов

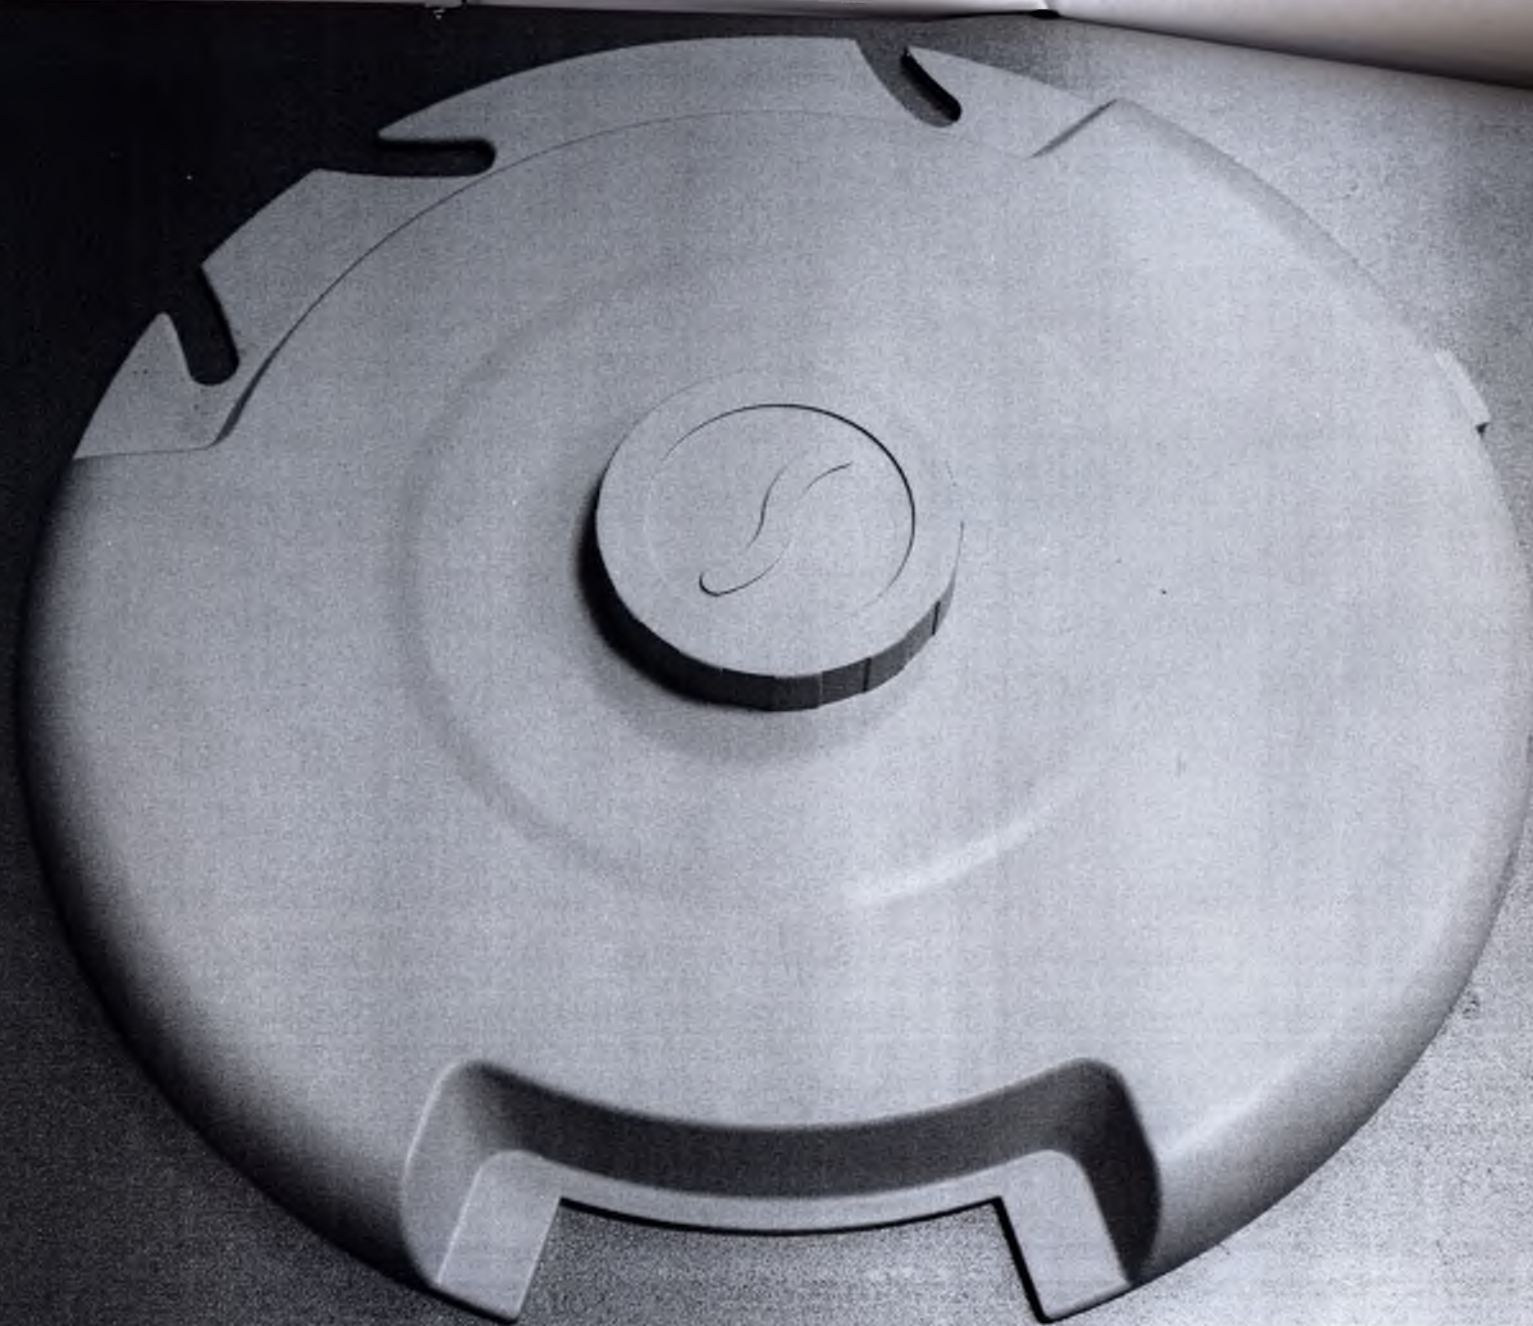


Крышка реакционного отсека

21-

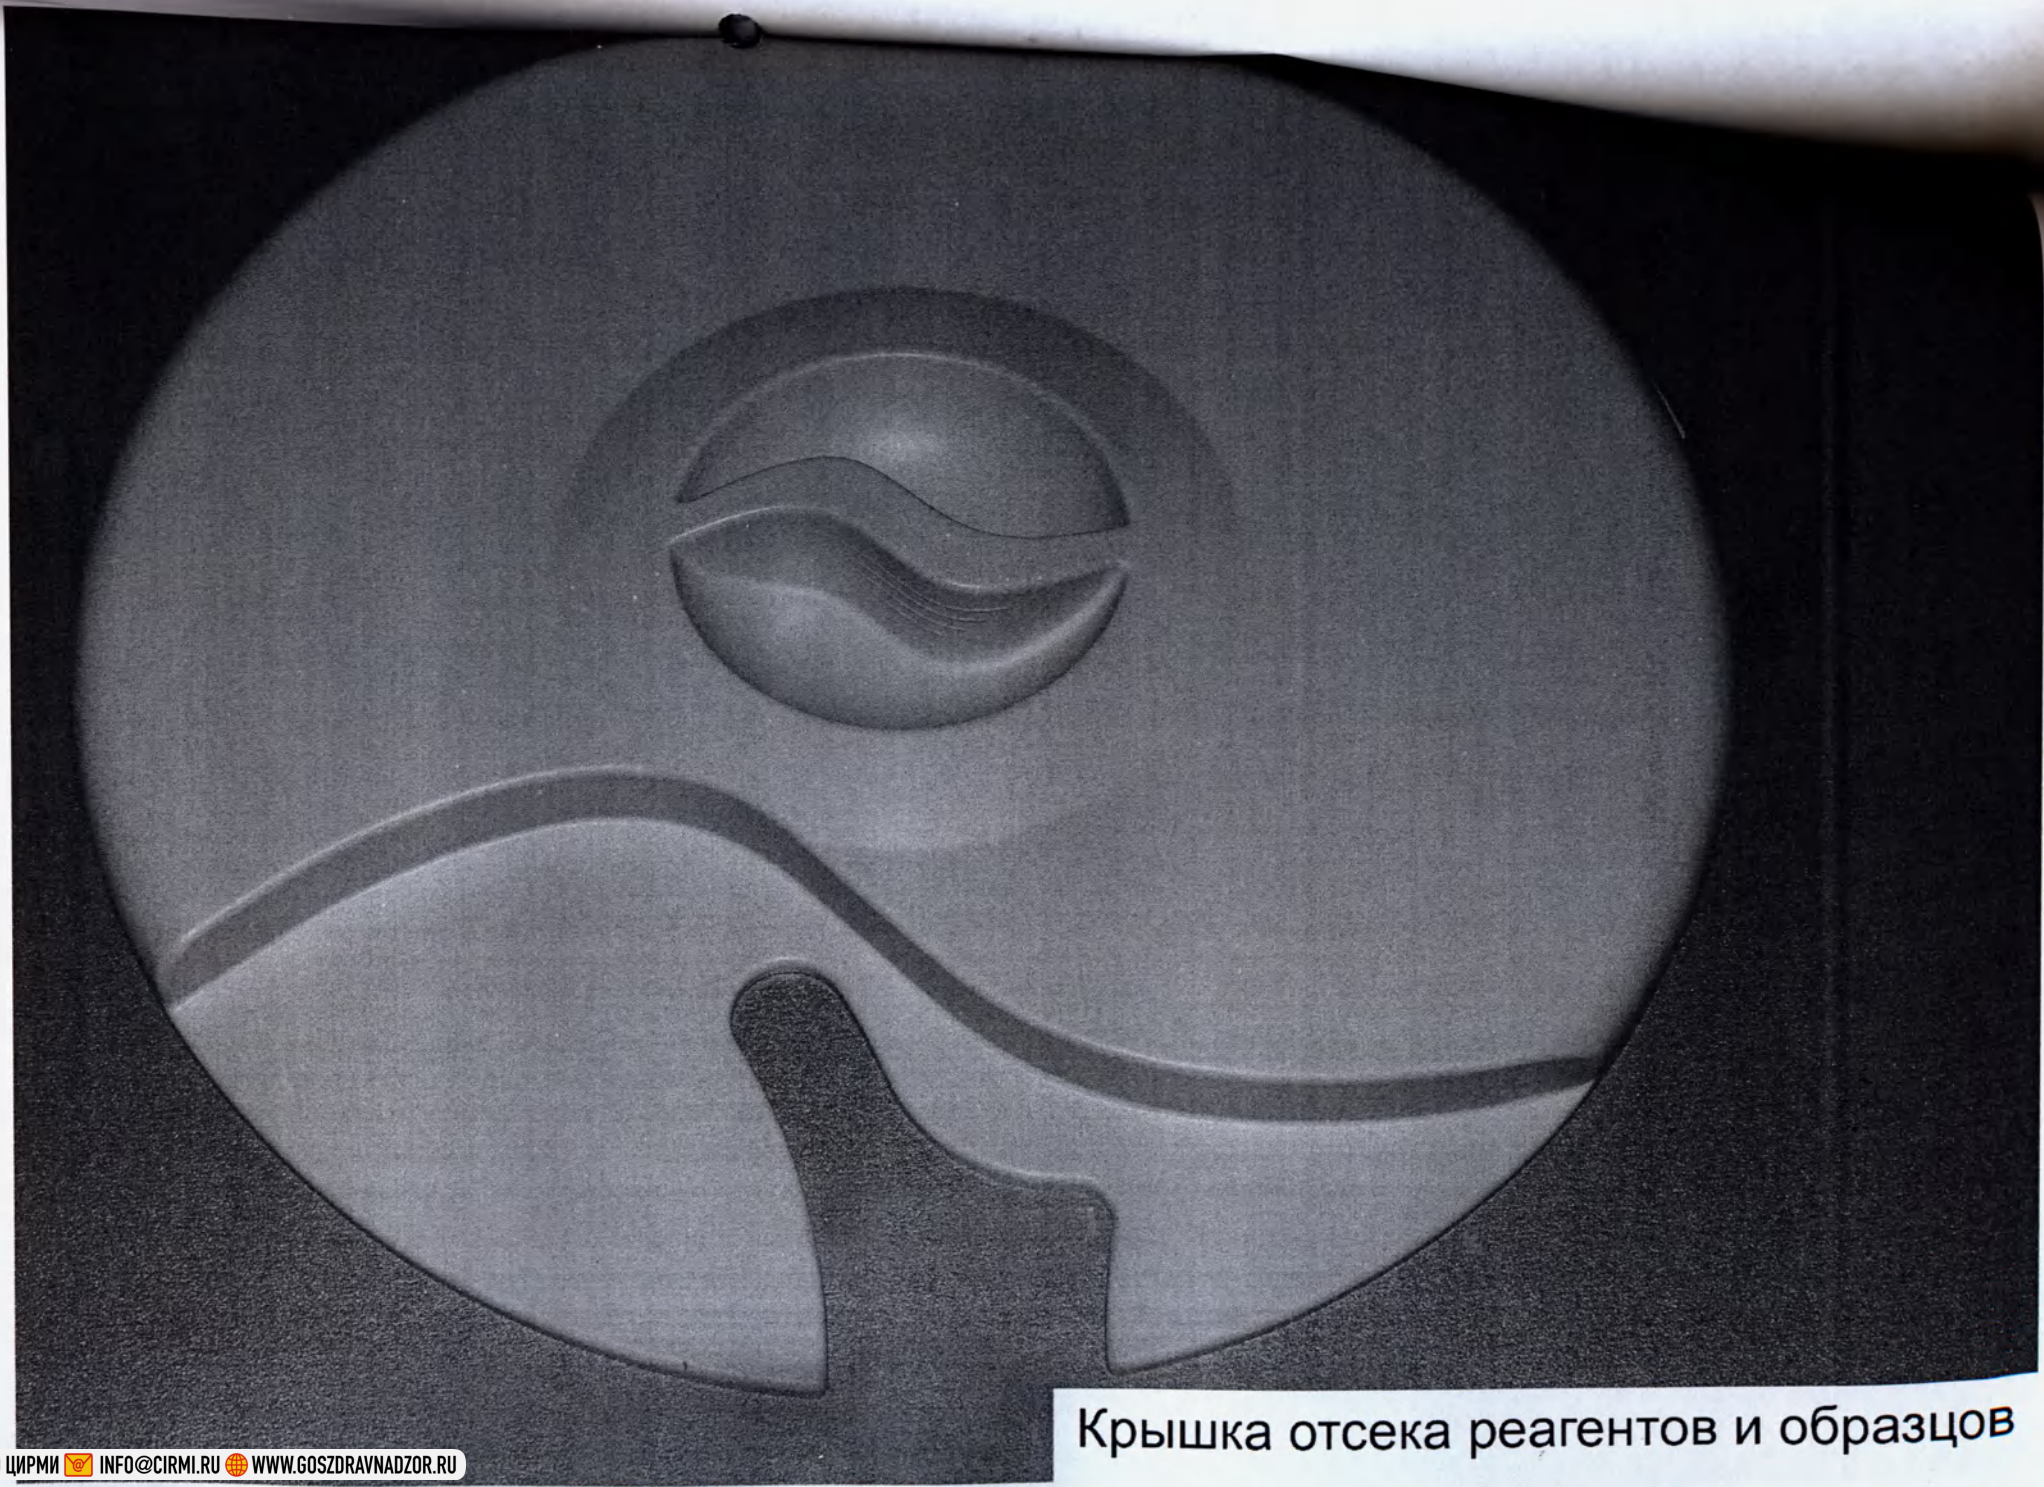

Крышка отсека реагентов и образцов

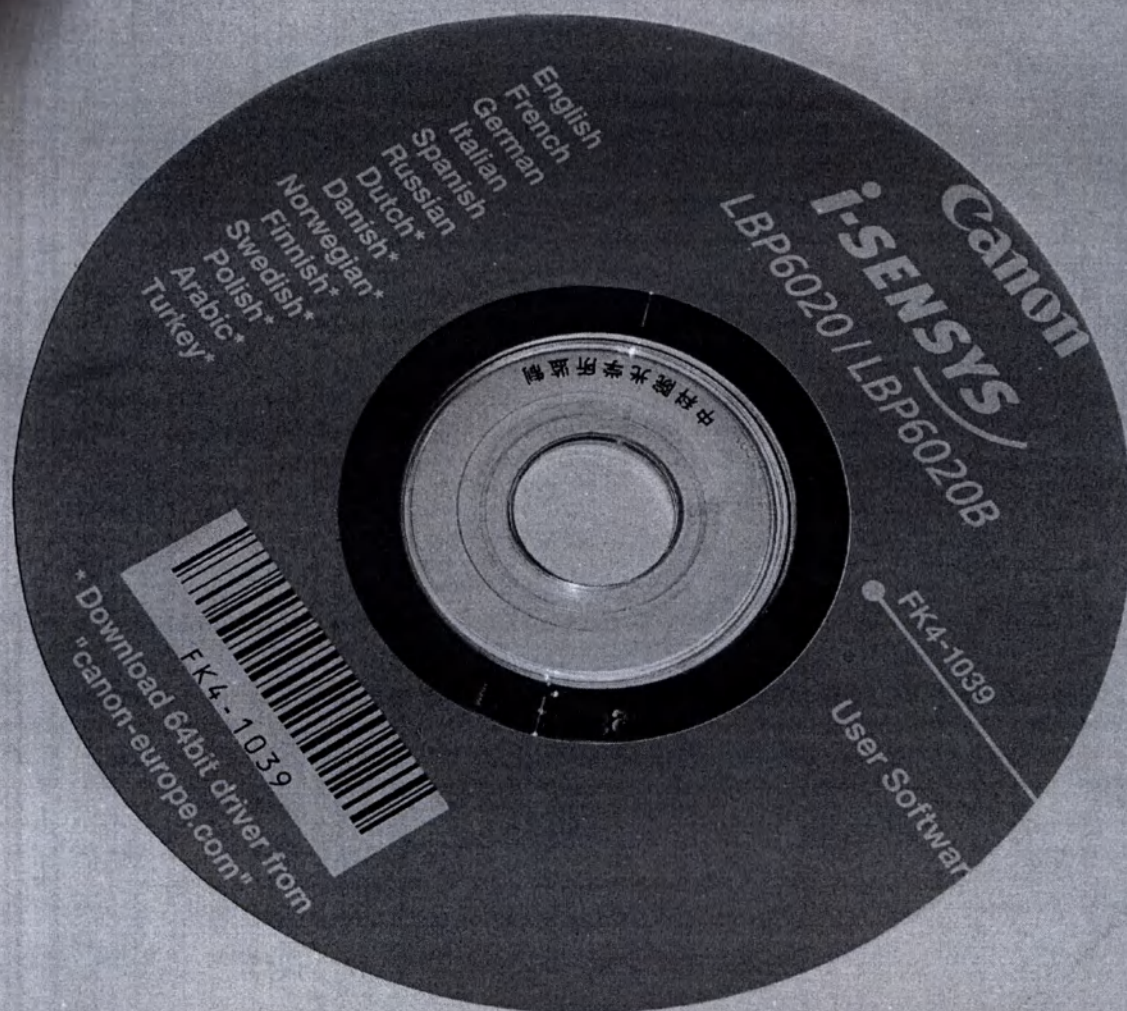

Программный CD

Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего 22 листа(ов)

Ген. директор

Схолль-Энгбертс Е.Н.

