

16

ОКП 94 4220

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ИПС»



[Handwritten signature]

Ревенко К.В.

« » 2013 г.

Фотографические изображения

Система рентгенографическая «GAMMA 1C plus» с принадлежностями

Соответствует требованиям национальных стандартов:
ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 50267.0.3-99,
ГОСТ Р 50267.0.4.-99, ГОСТ Р 50267.28-95, ГОСТ Р 50267.32-99,
ГОСТ ИЕС 60601-2-7-2006, ГОСТ ИЕС 60601-1-1-2011,
ГОТР Р 50723-94, ГОСТ Р МЭК 60825-1-2009
и технической документации изготовителя

онсоль управления.




монитор цветной для получения снимков и управления перемещениями аппарата.




Станция рабочая компьютерная.




Стойка "Виску", вертикальная.

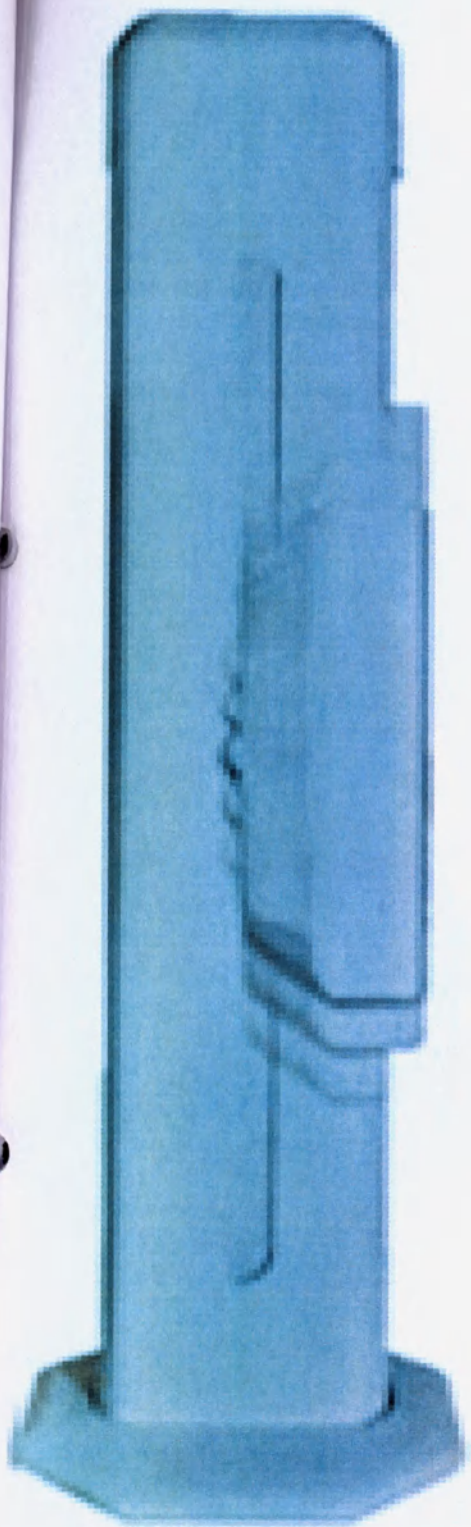


Детектор рентгеновского излучения, плоский.

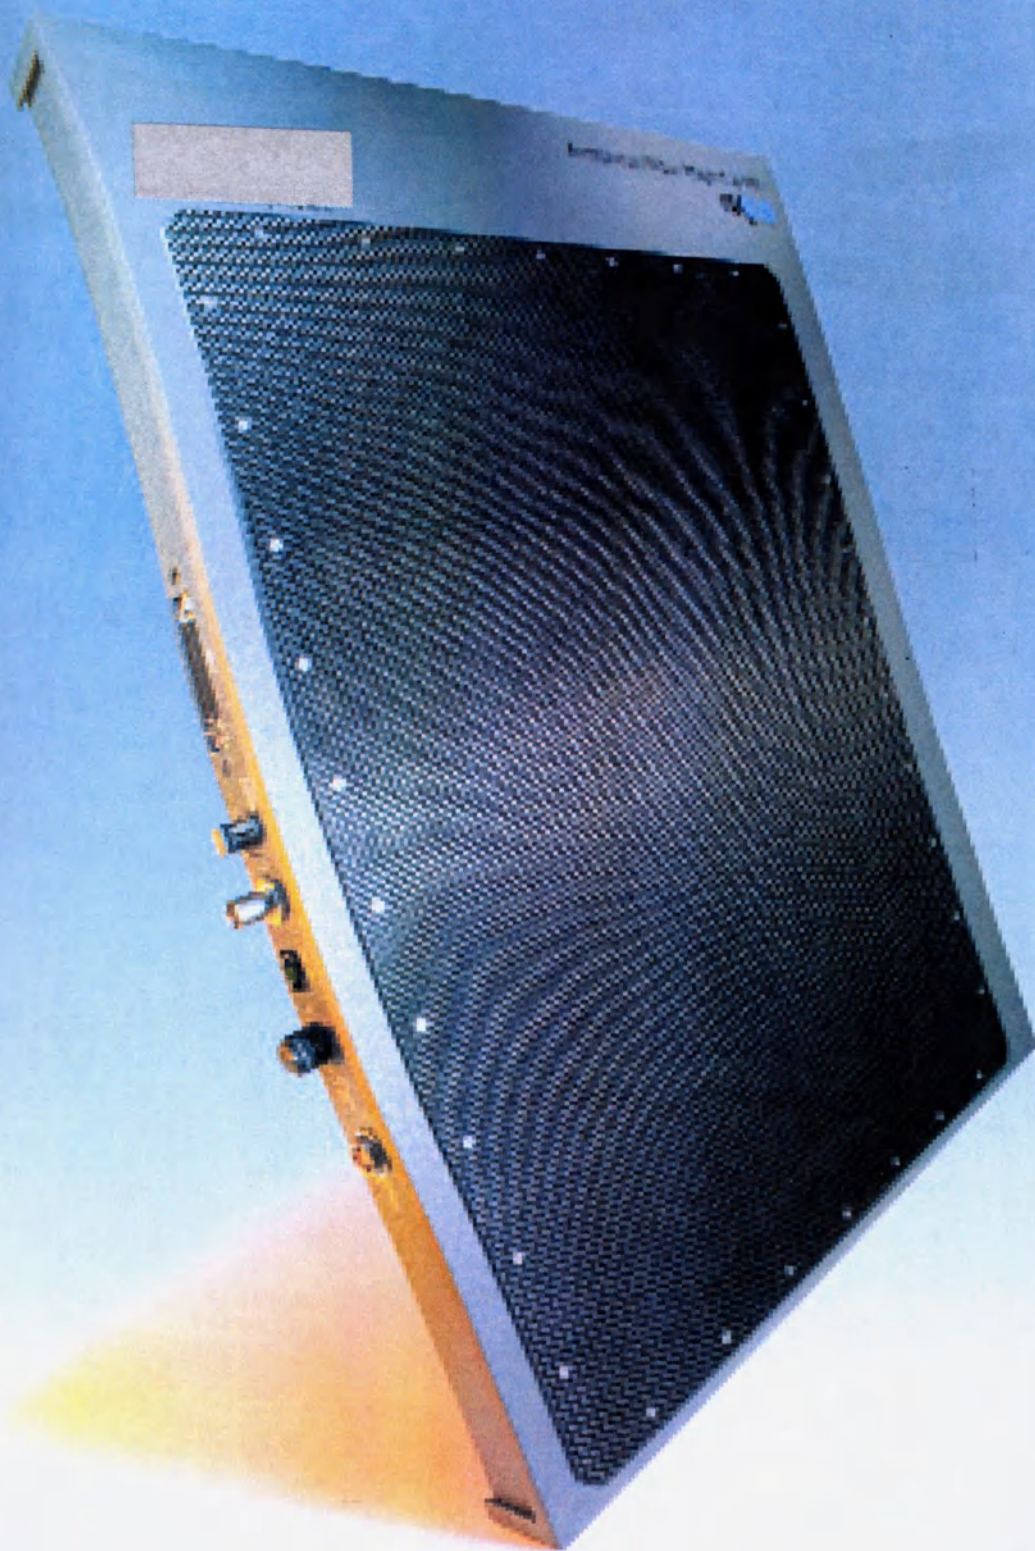


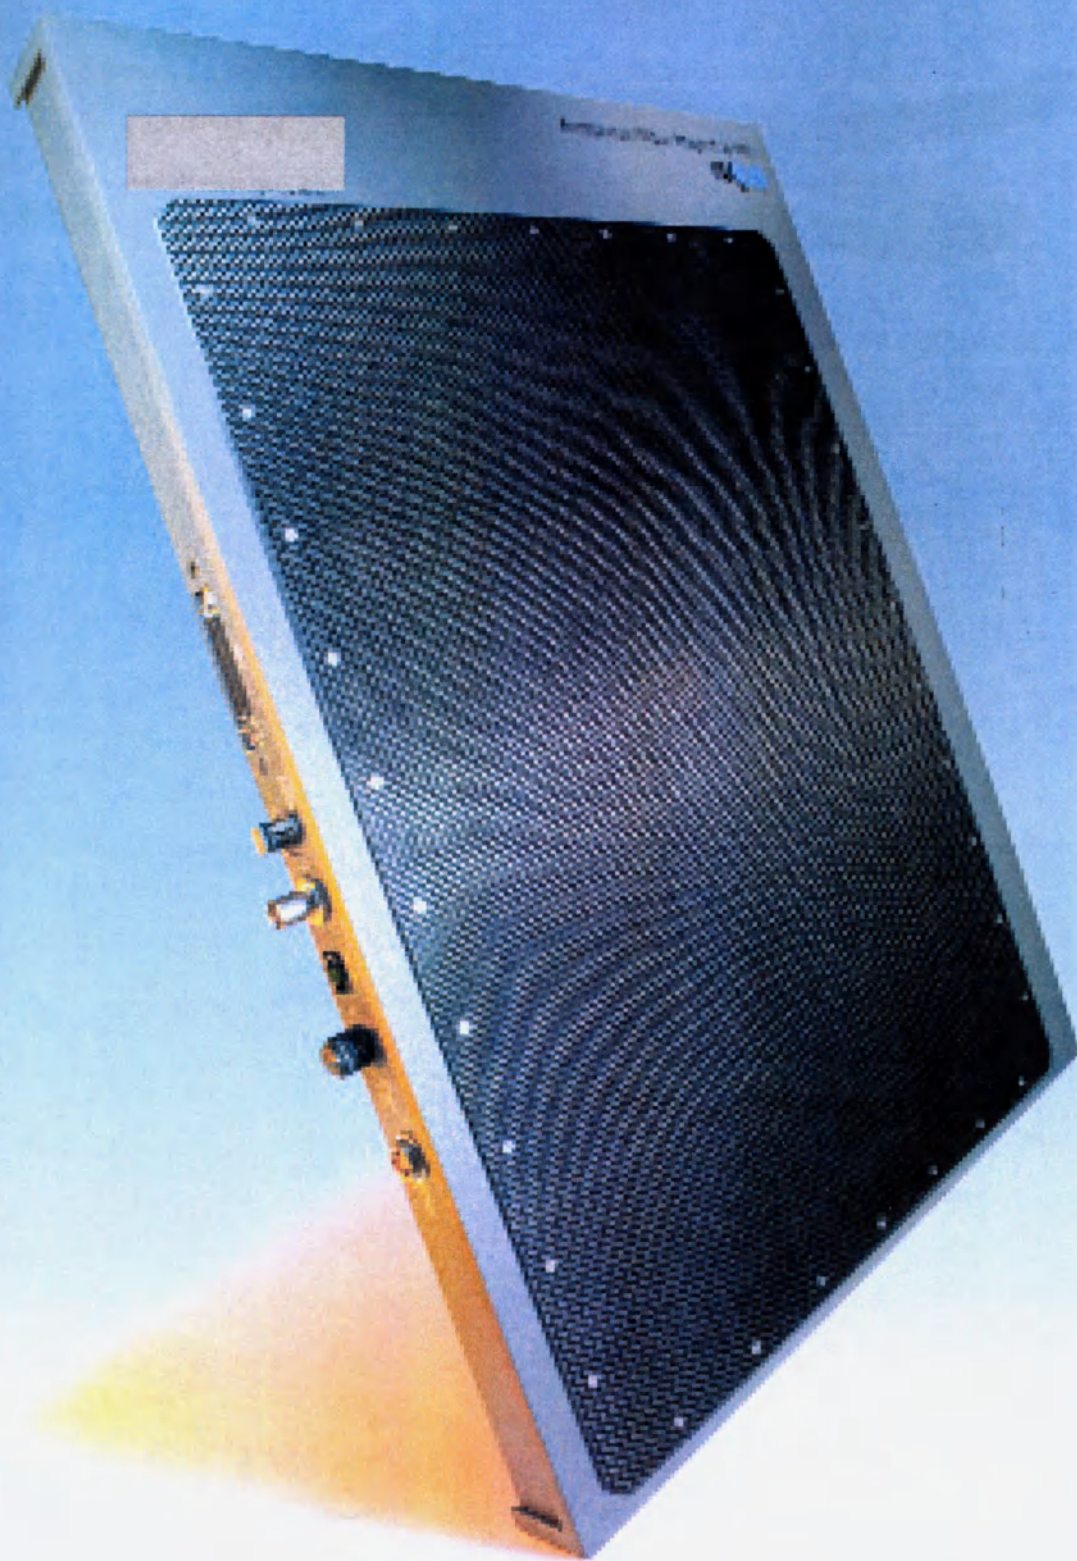


Подвес потолочный.

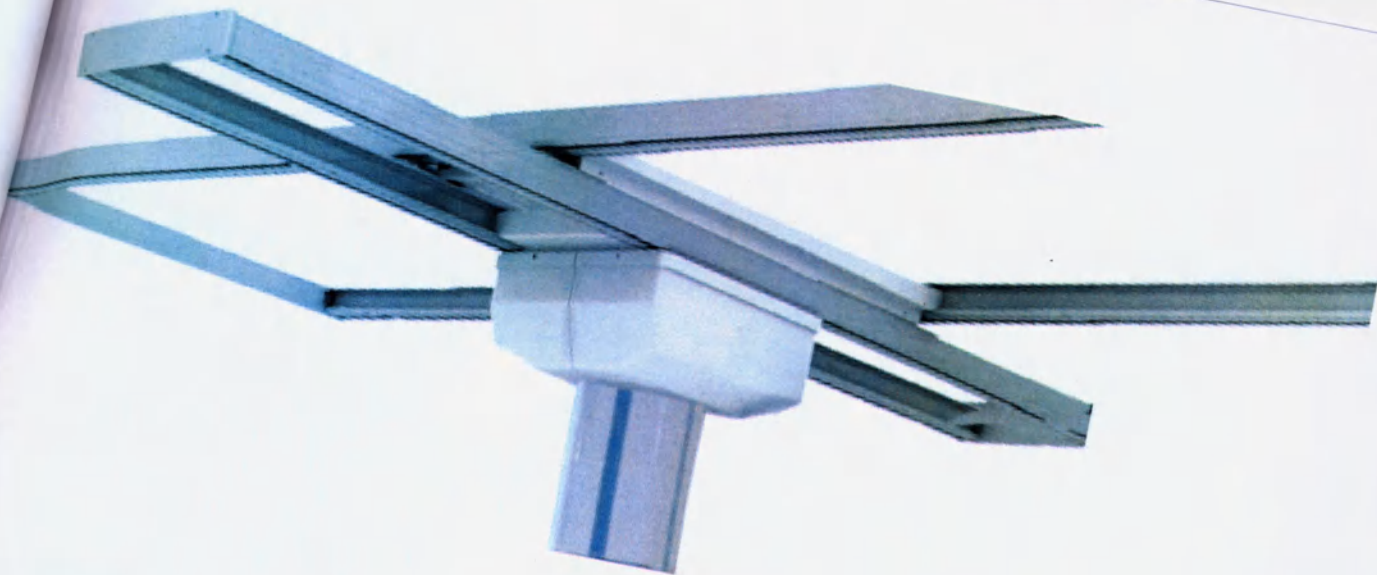

Рельсы для потолочного подвеса, не более 4 шт.

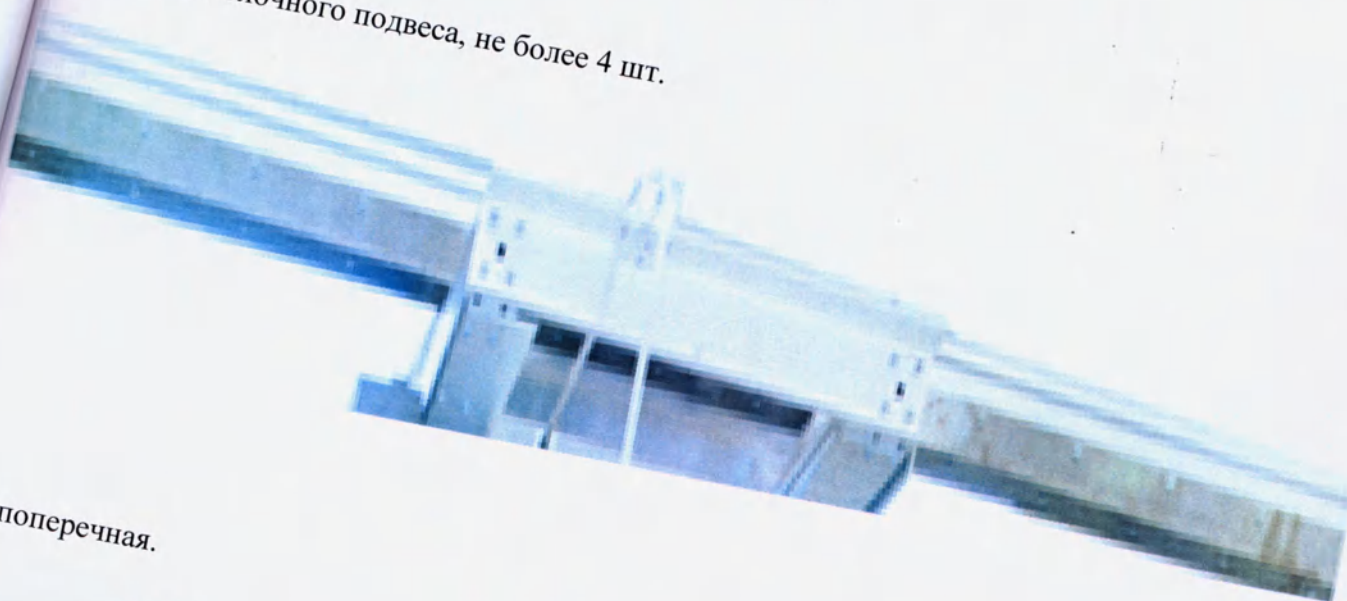

Балка поперечная.

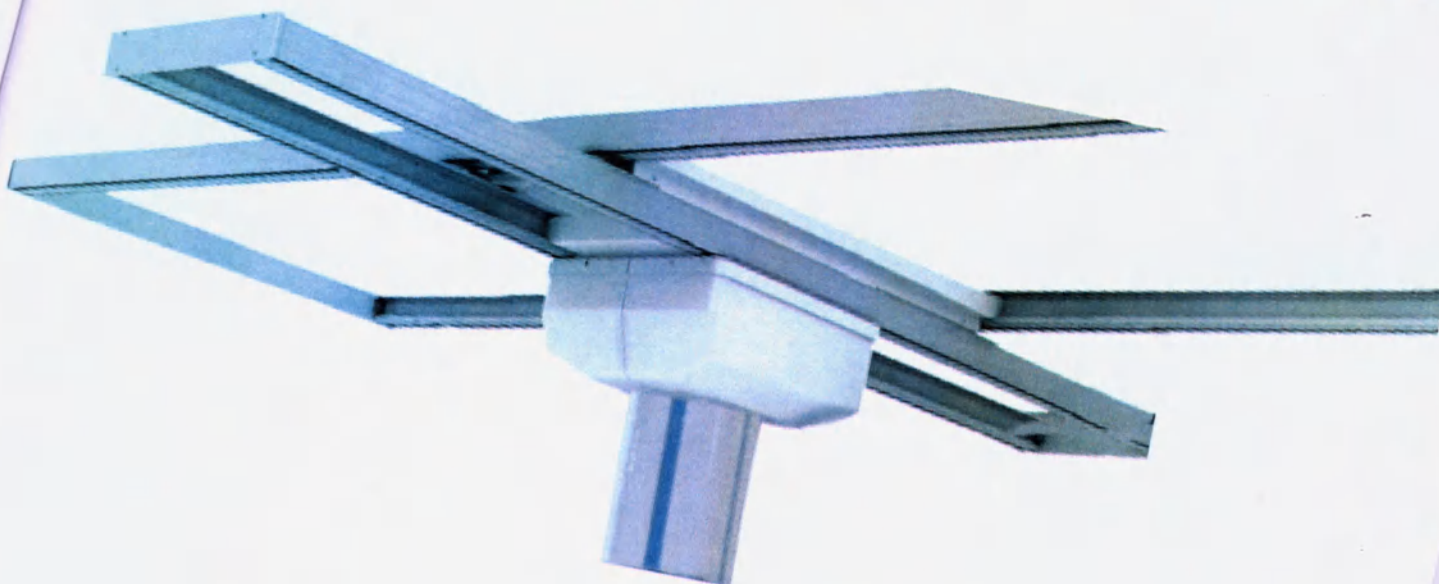


компьютер планшетный с сенсорным экраном для управления аппаратом.




и высоковольтные, не более 2 шт.




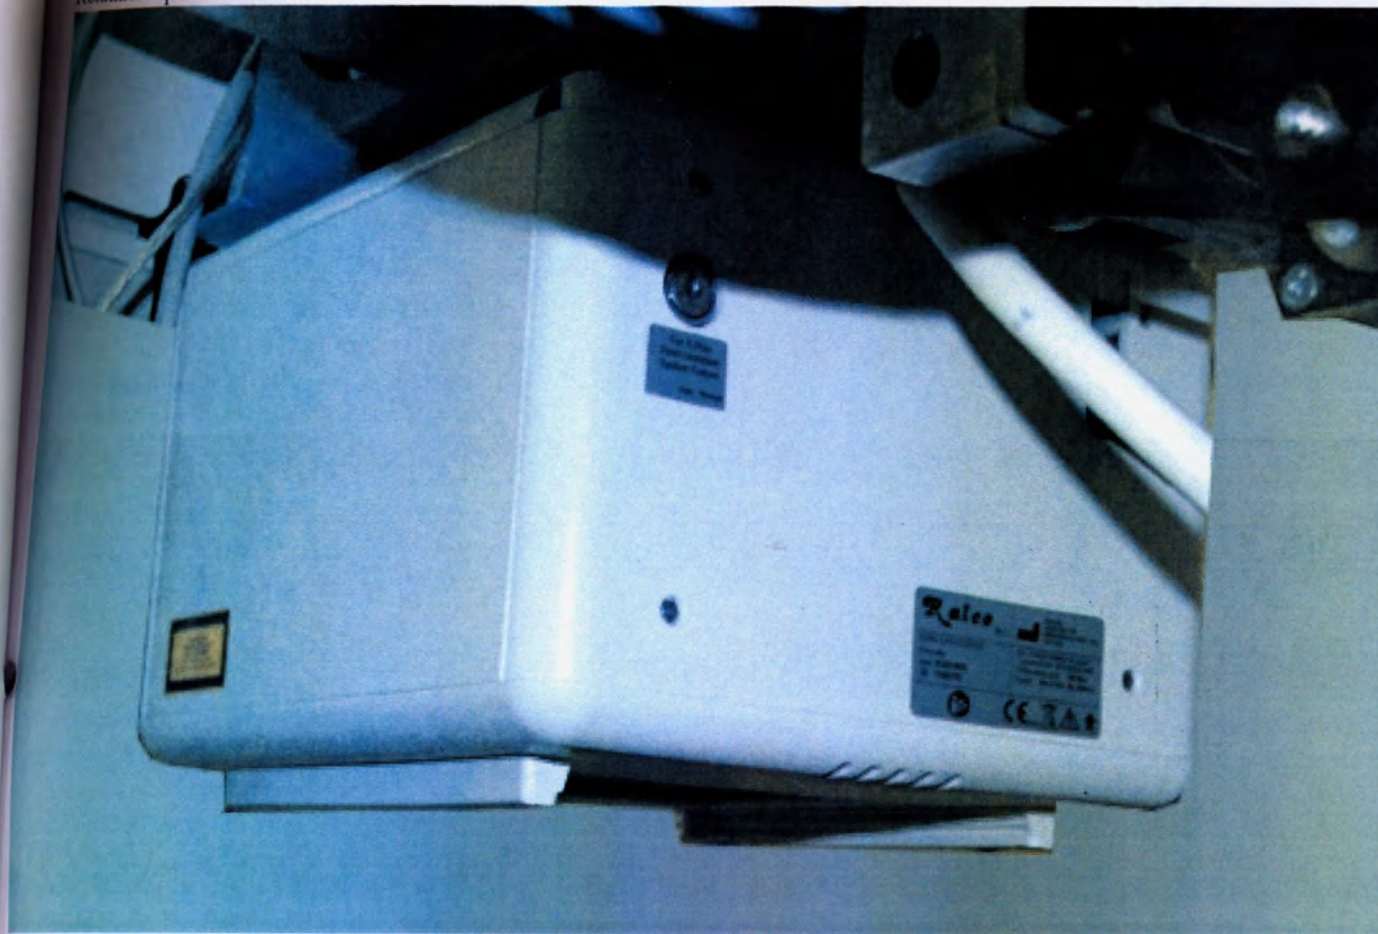

Стол рентгенопрозрачный с электроприводом.

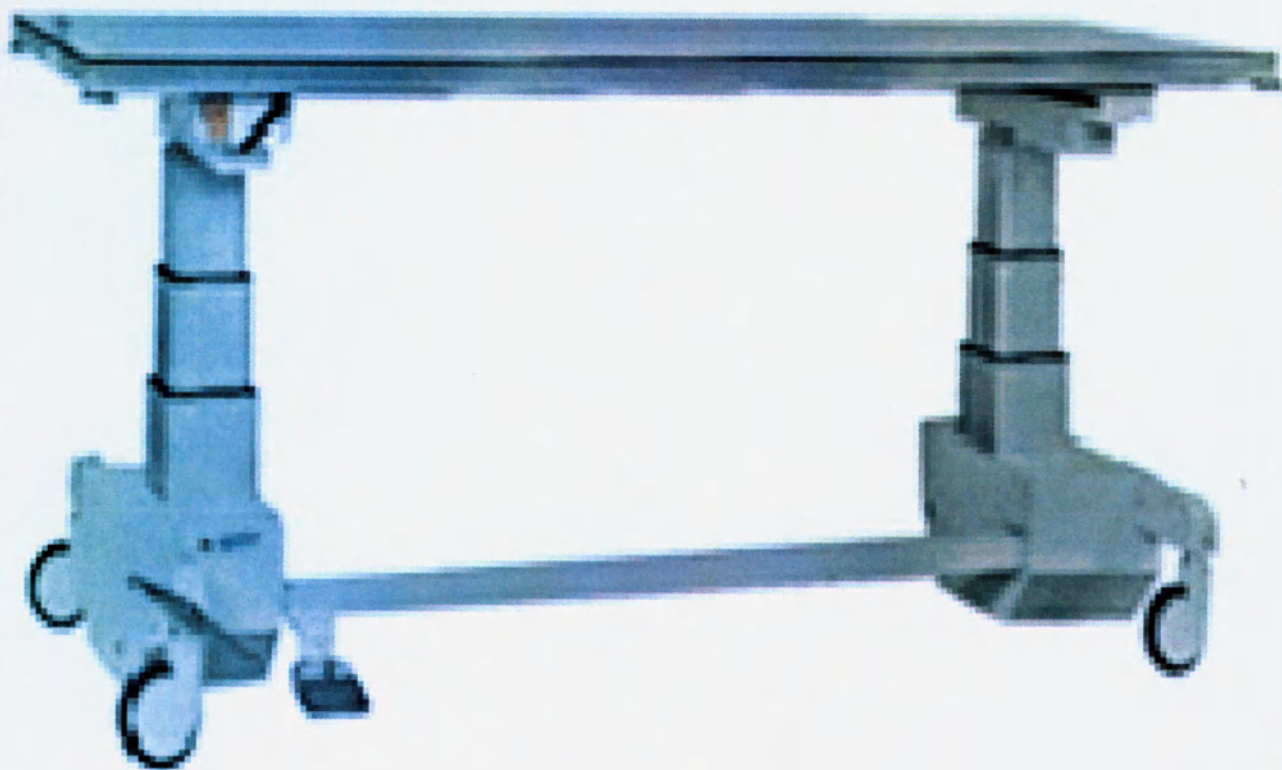

Генератор рентгеновский высокочастотный 45-80 кВт инверторного типа с микропроцессорным управлением.

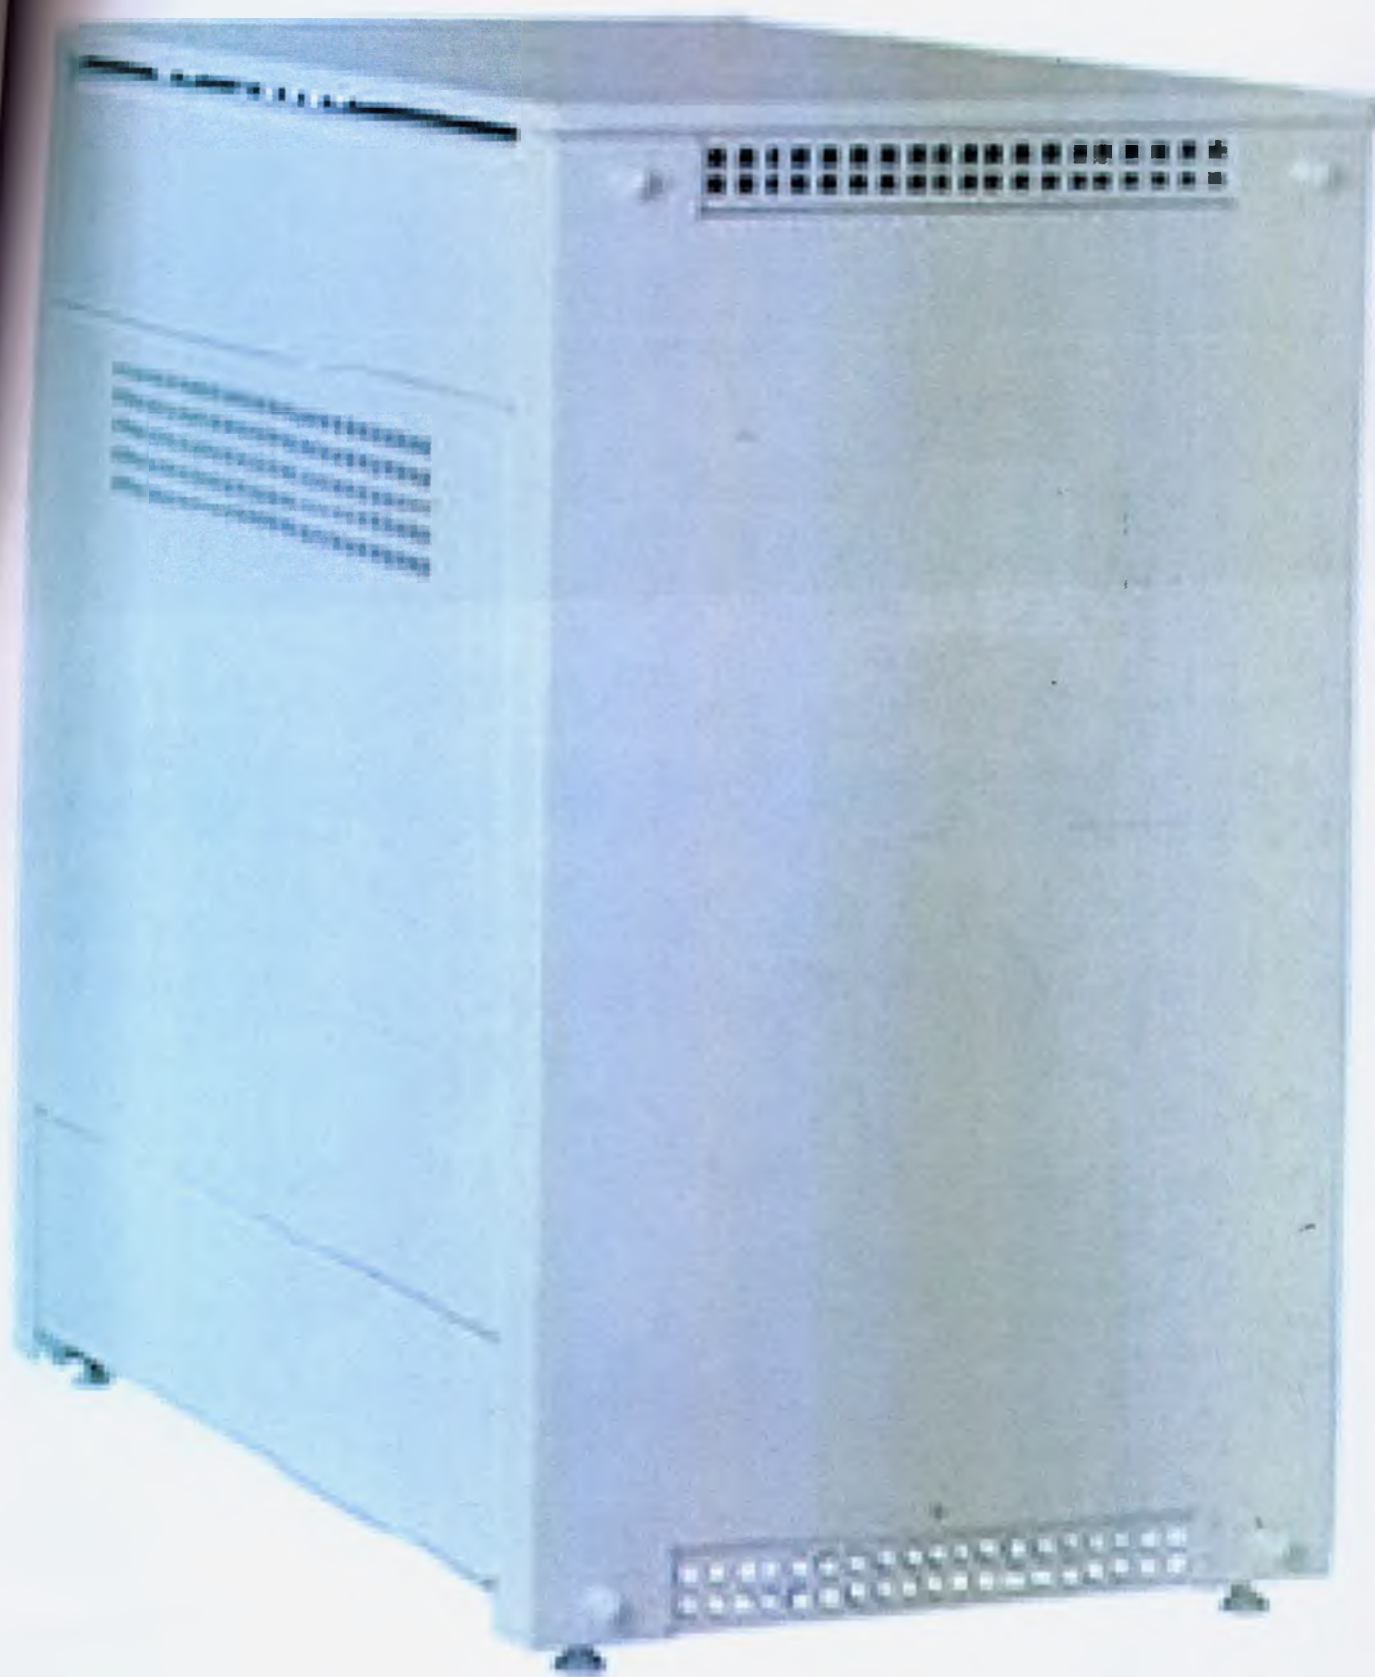





Мышь компьютерная.




Принадлежности:

Автоэкспониметр рентгеновского излучения с тремя ионизационными камерами.

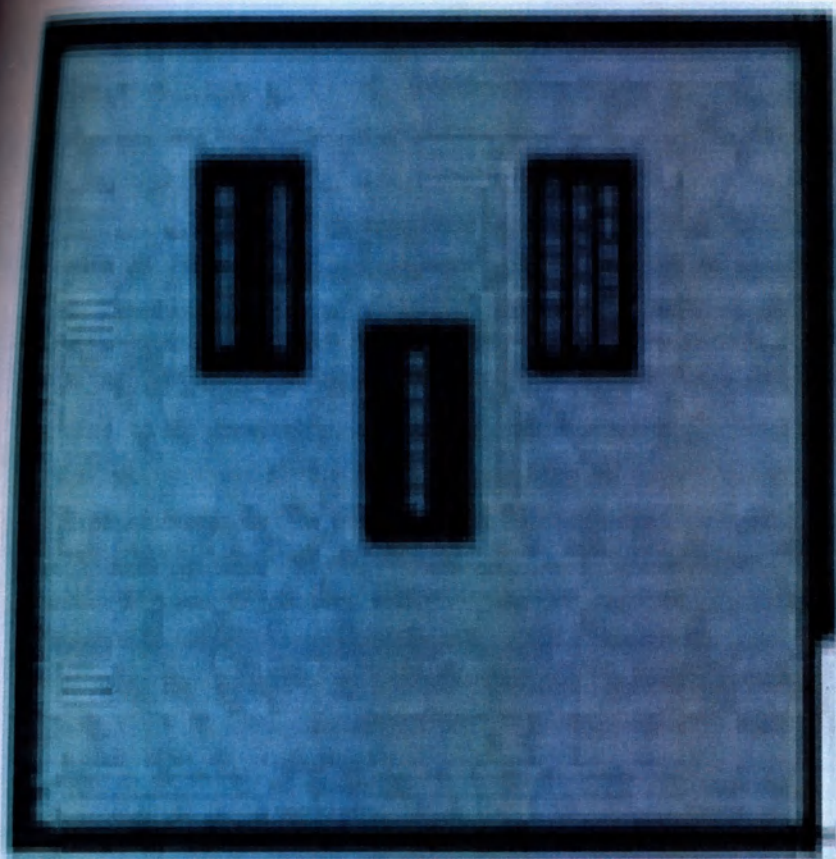


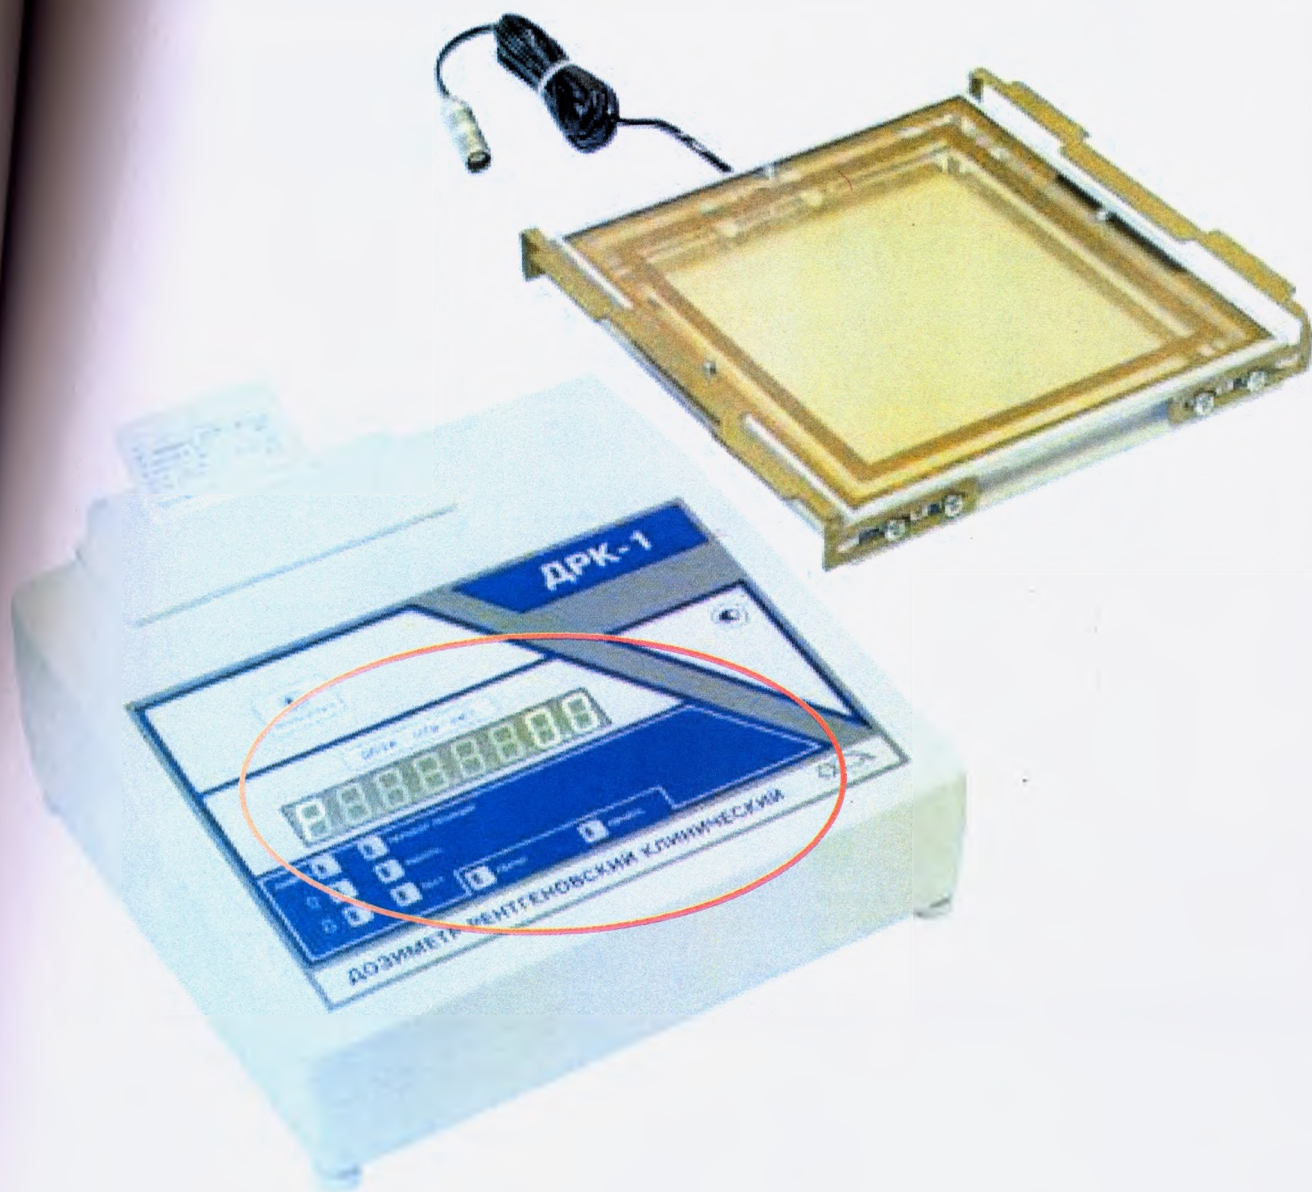

Дозиметр, регистрирующий.

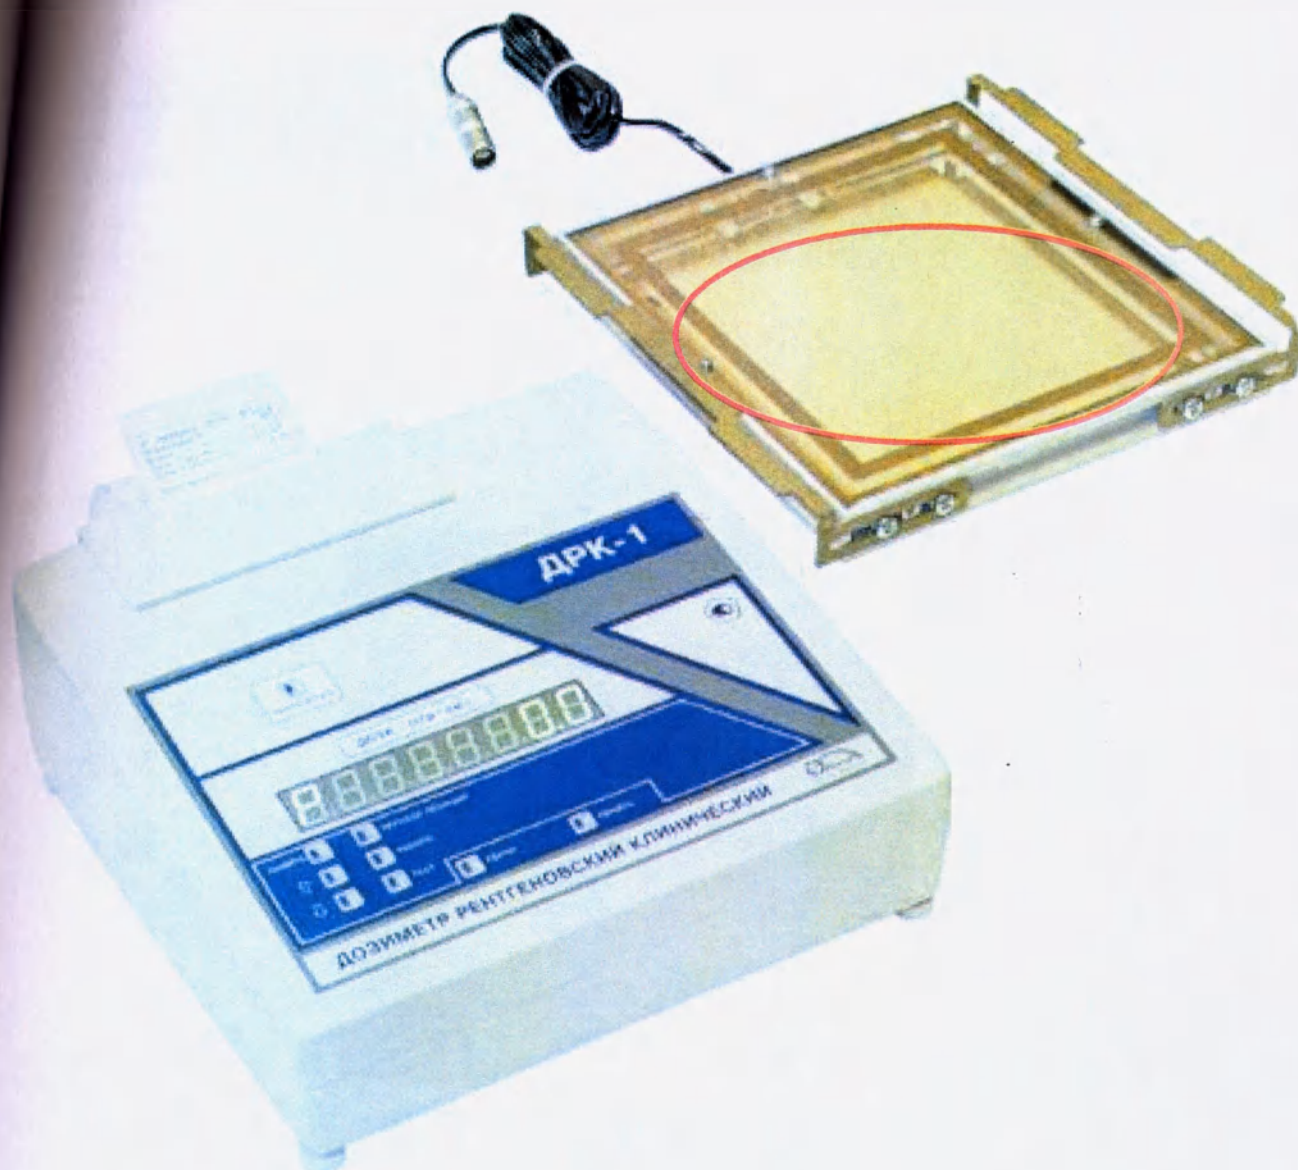


ТермодруINTER для дозиметра.

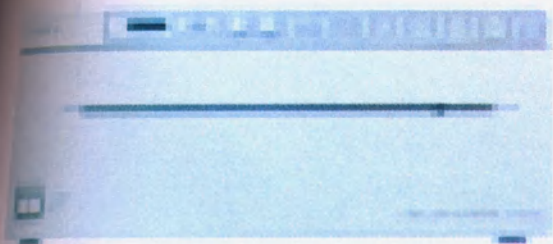

Термобумага - 1 уп. /100 шт.






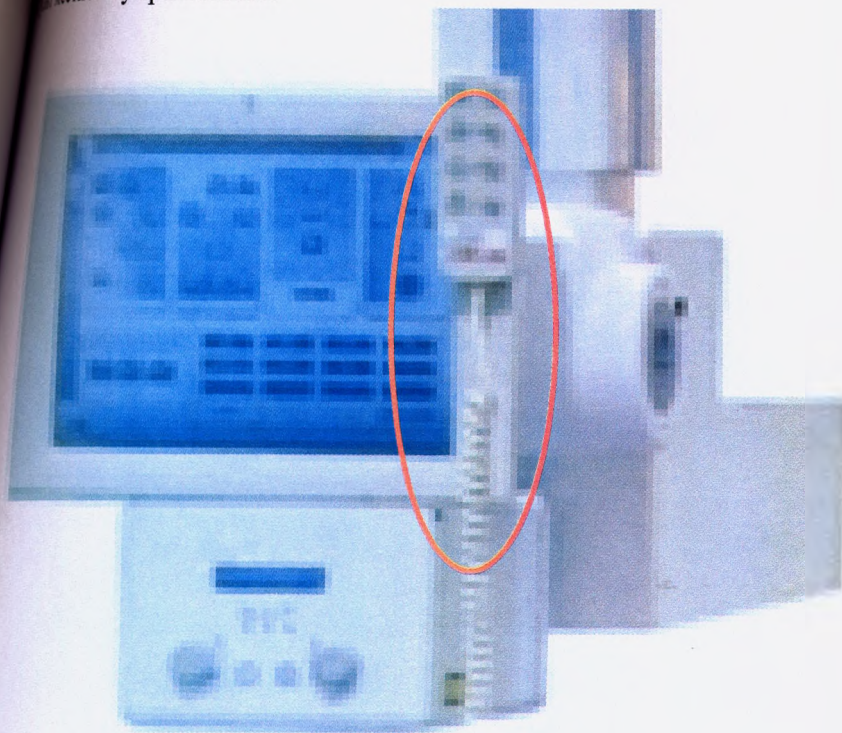


Экран сенсорный пульта управления генератором и аппаратом.



держатель.

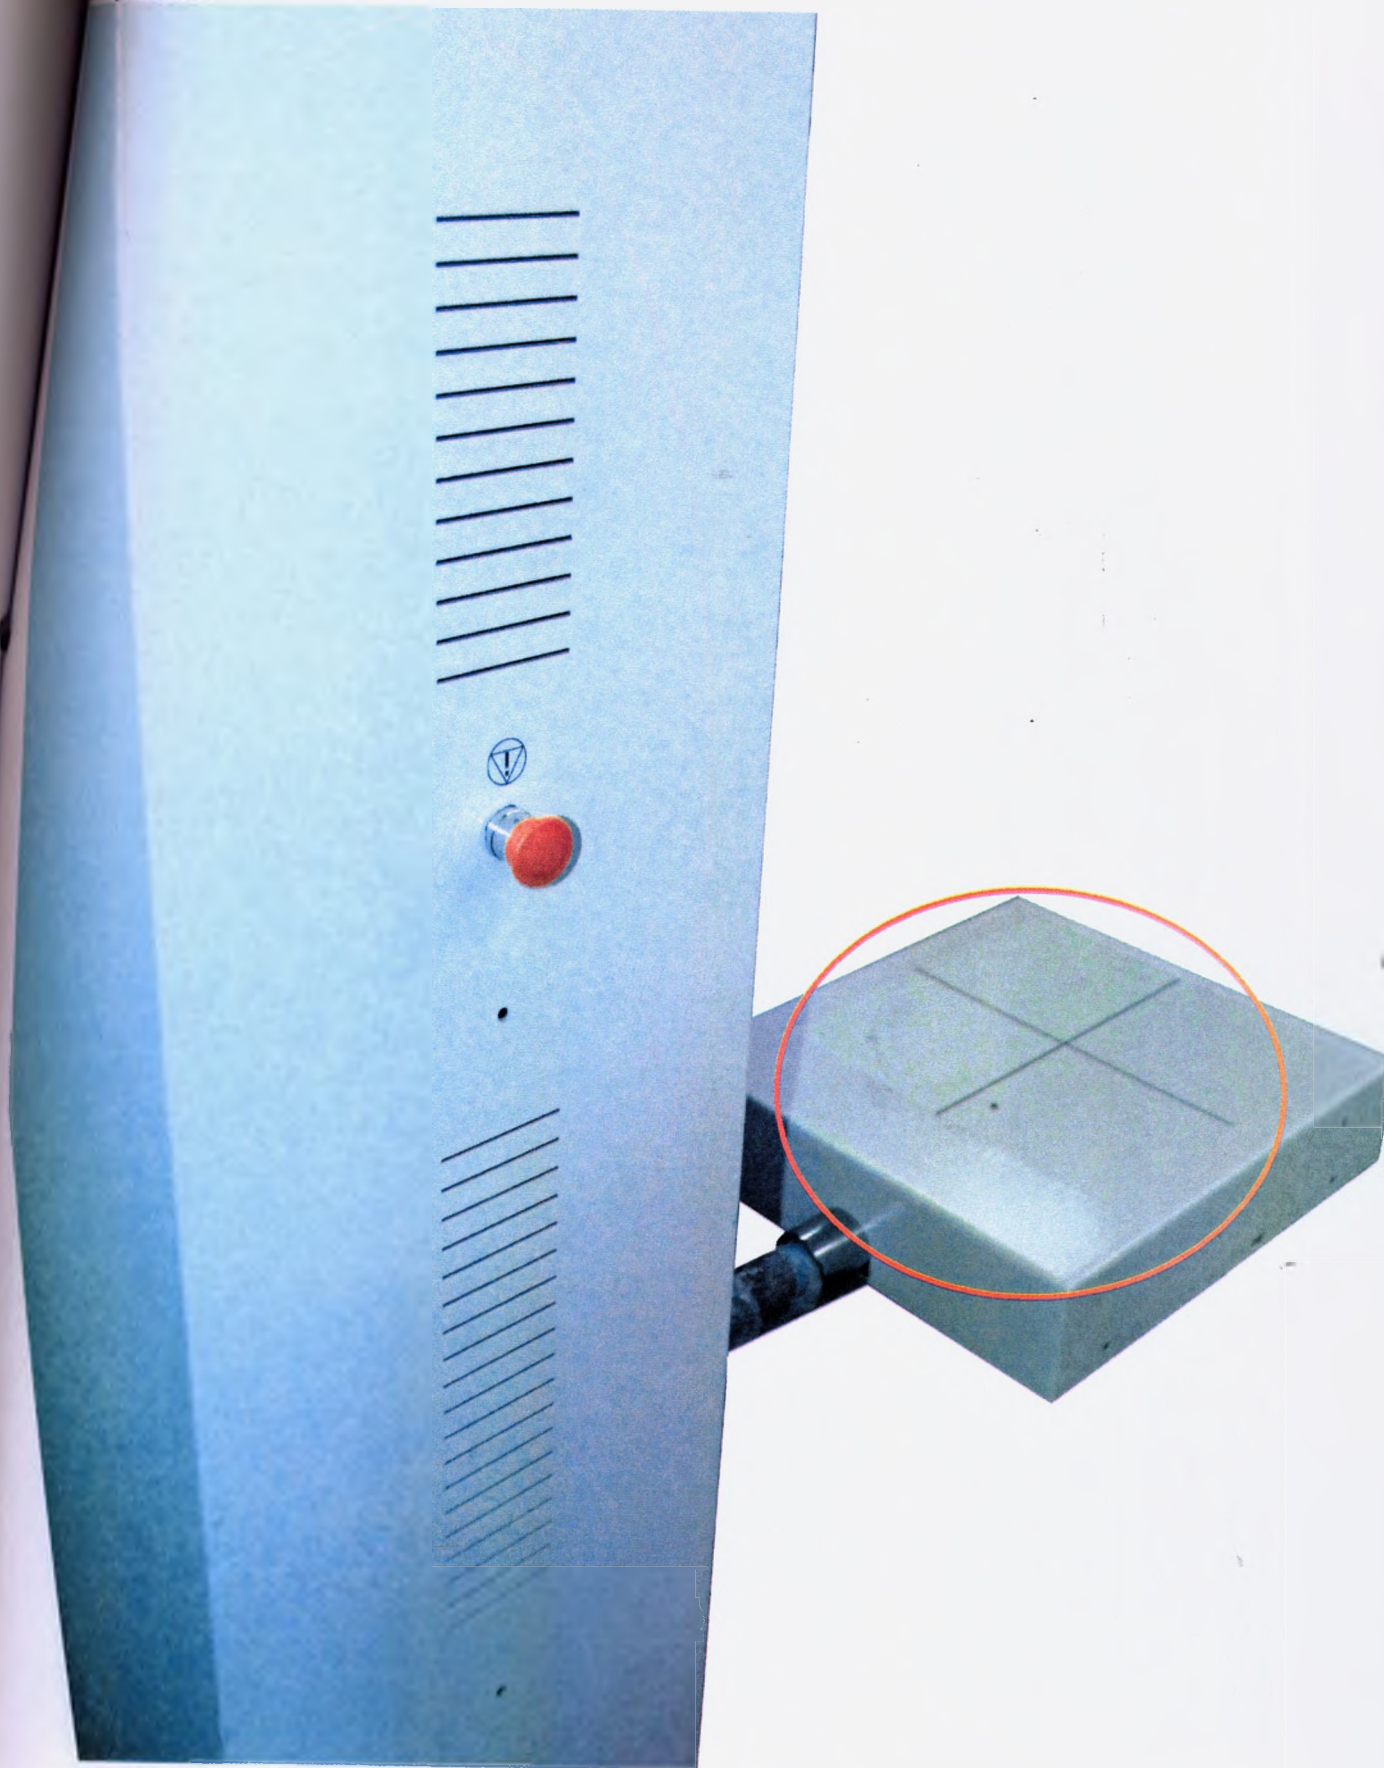

ручка "Busky" вертикальная, дополнительная.

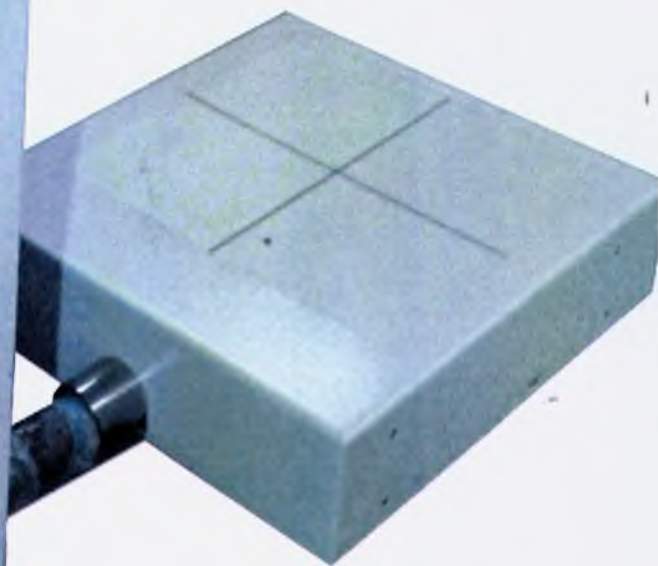


и-сервер для хранения и дублирования информации.




медицинский.



Кожух рентгеновской трубки.

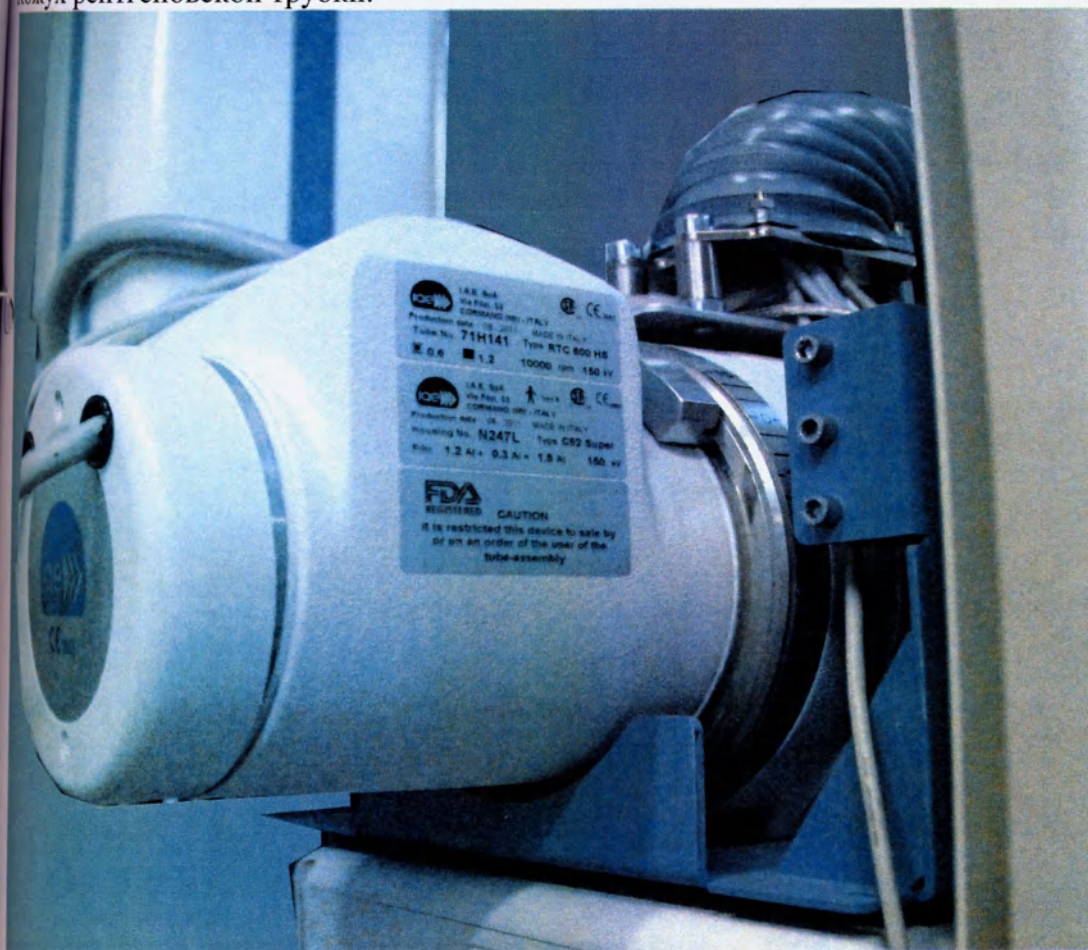


...жний рентгеновской трубки.

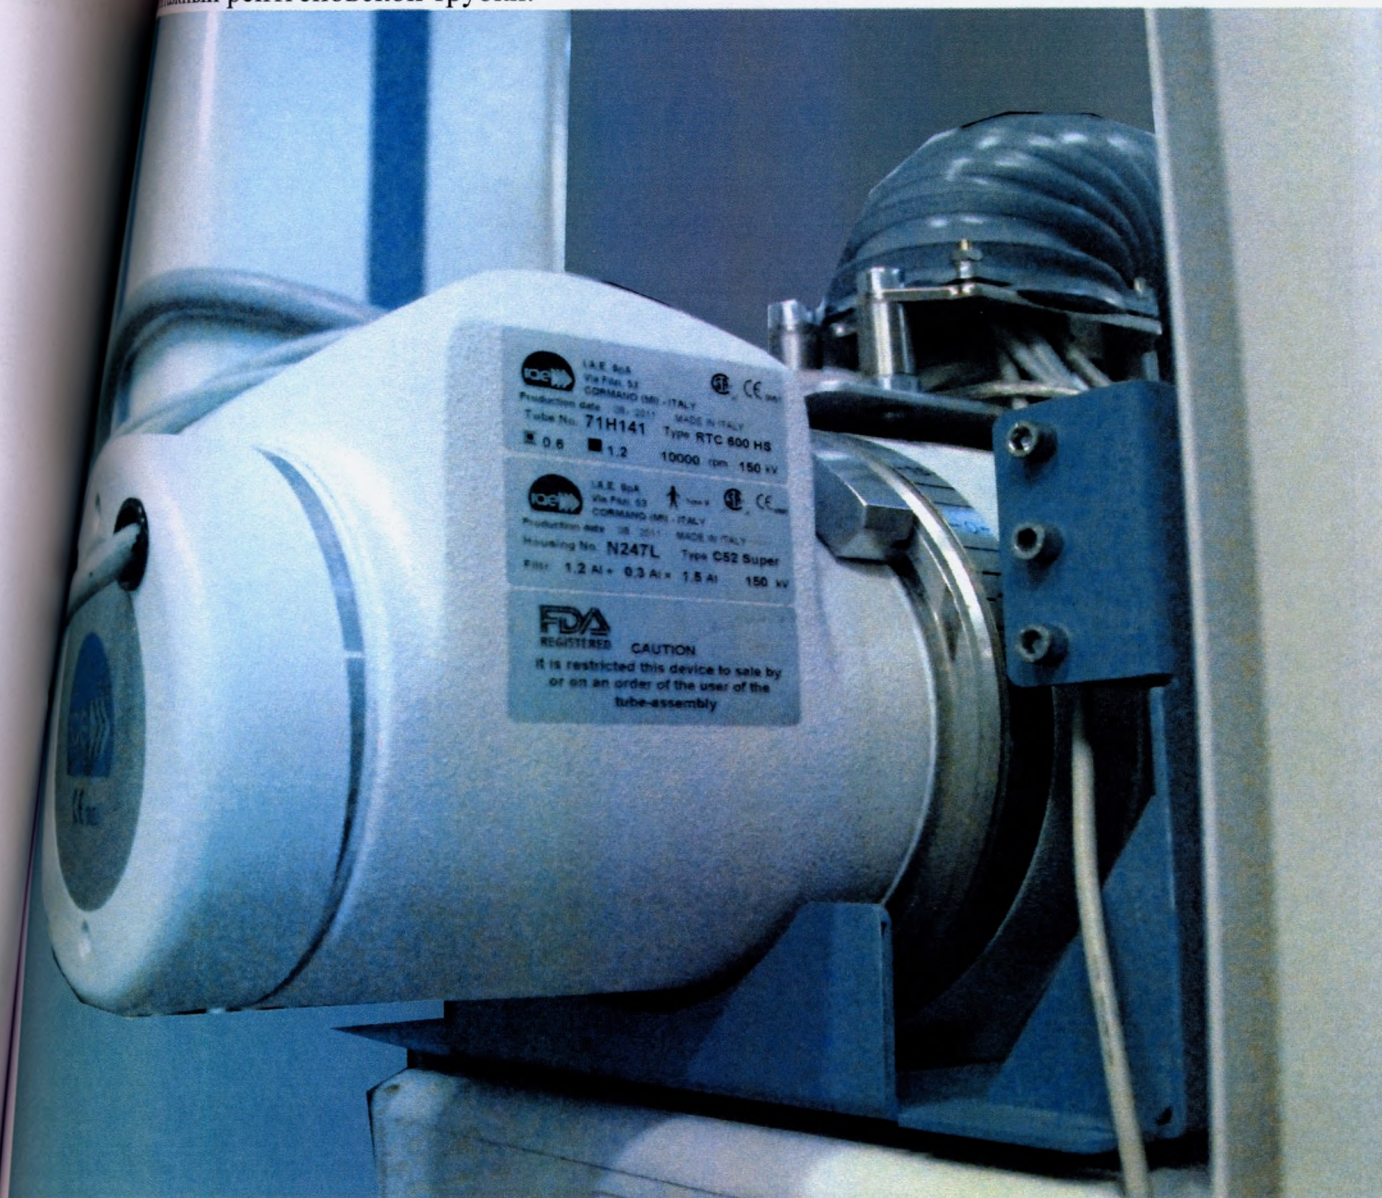

Кабель высоковольтный.




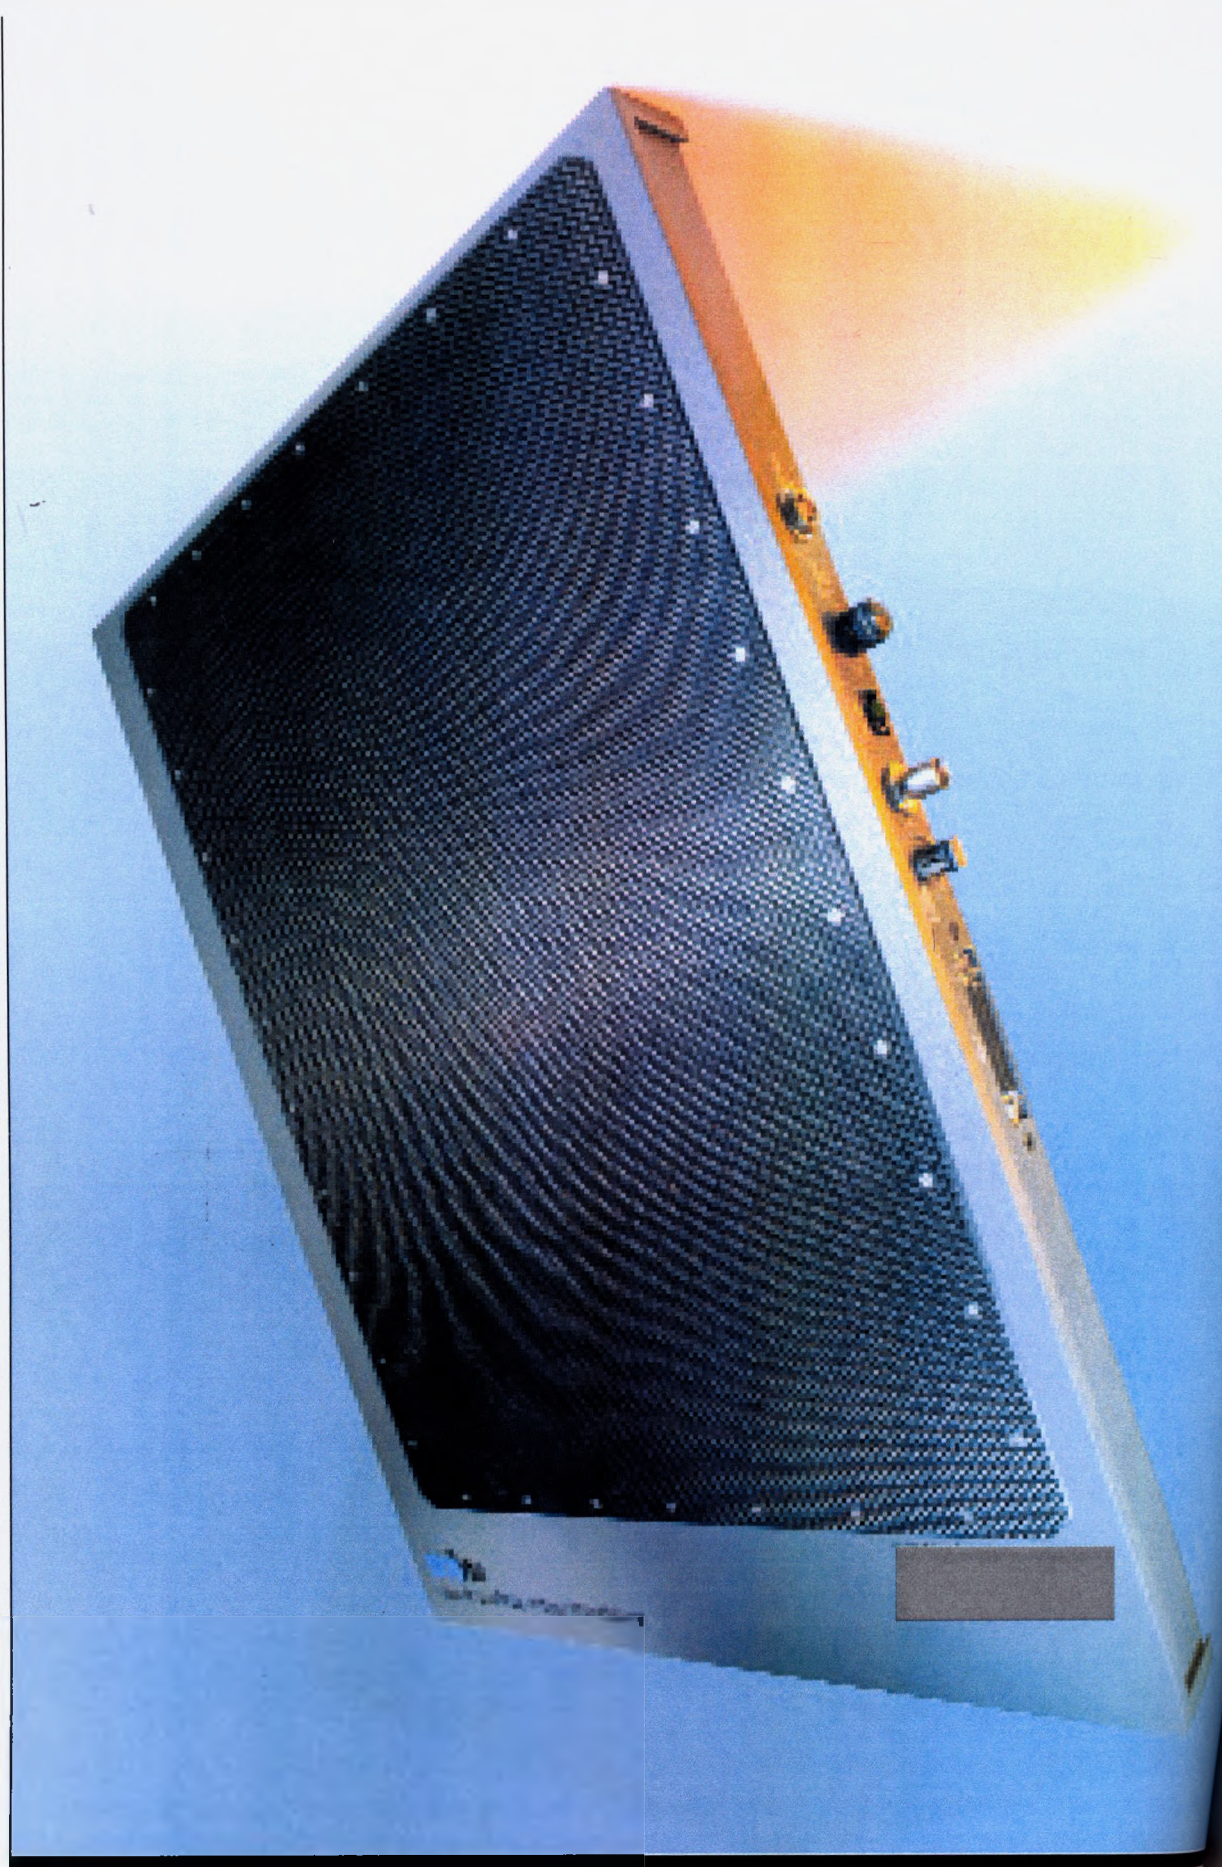

мотор разделительный.



Рельсы для потолочного подвеса трубки, не более 4 шт.

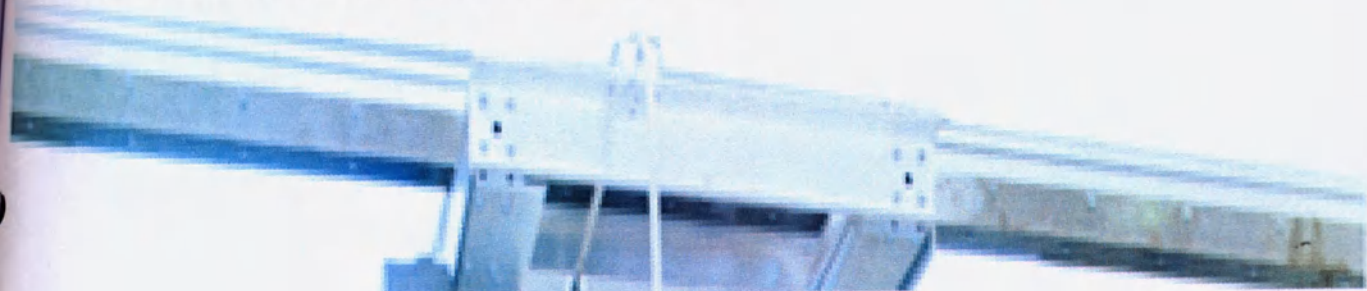

CD/DVD.




дски для записи медицинской информации, не более 50 шт.



DVD-R диски для записи медицинской информации, не более 50 шт.



лизатор напряжения.

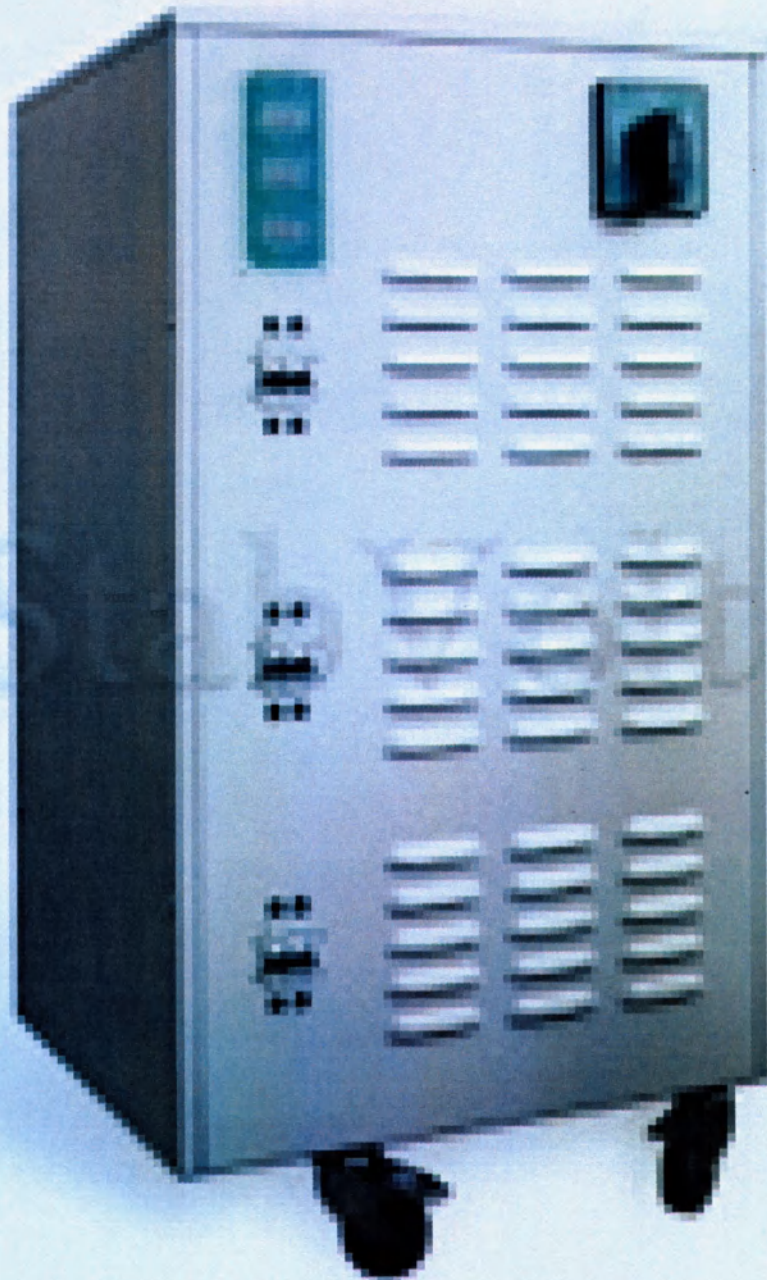

бесперебойного питания UPS.



лазерный для печати медицинских изображений в формате DICOM.




медицинский.




тенозащитное.



и рентгенозащитного стекла.

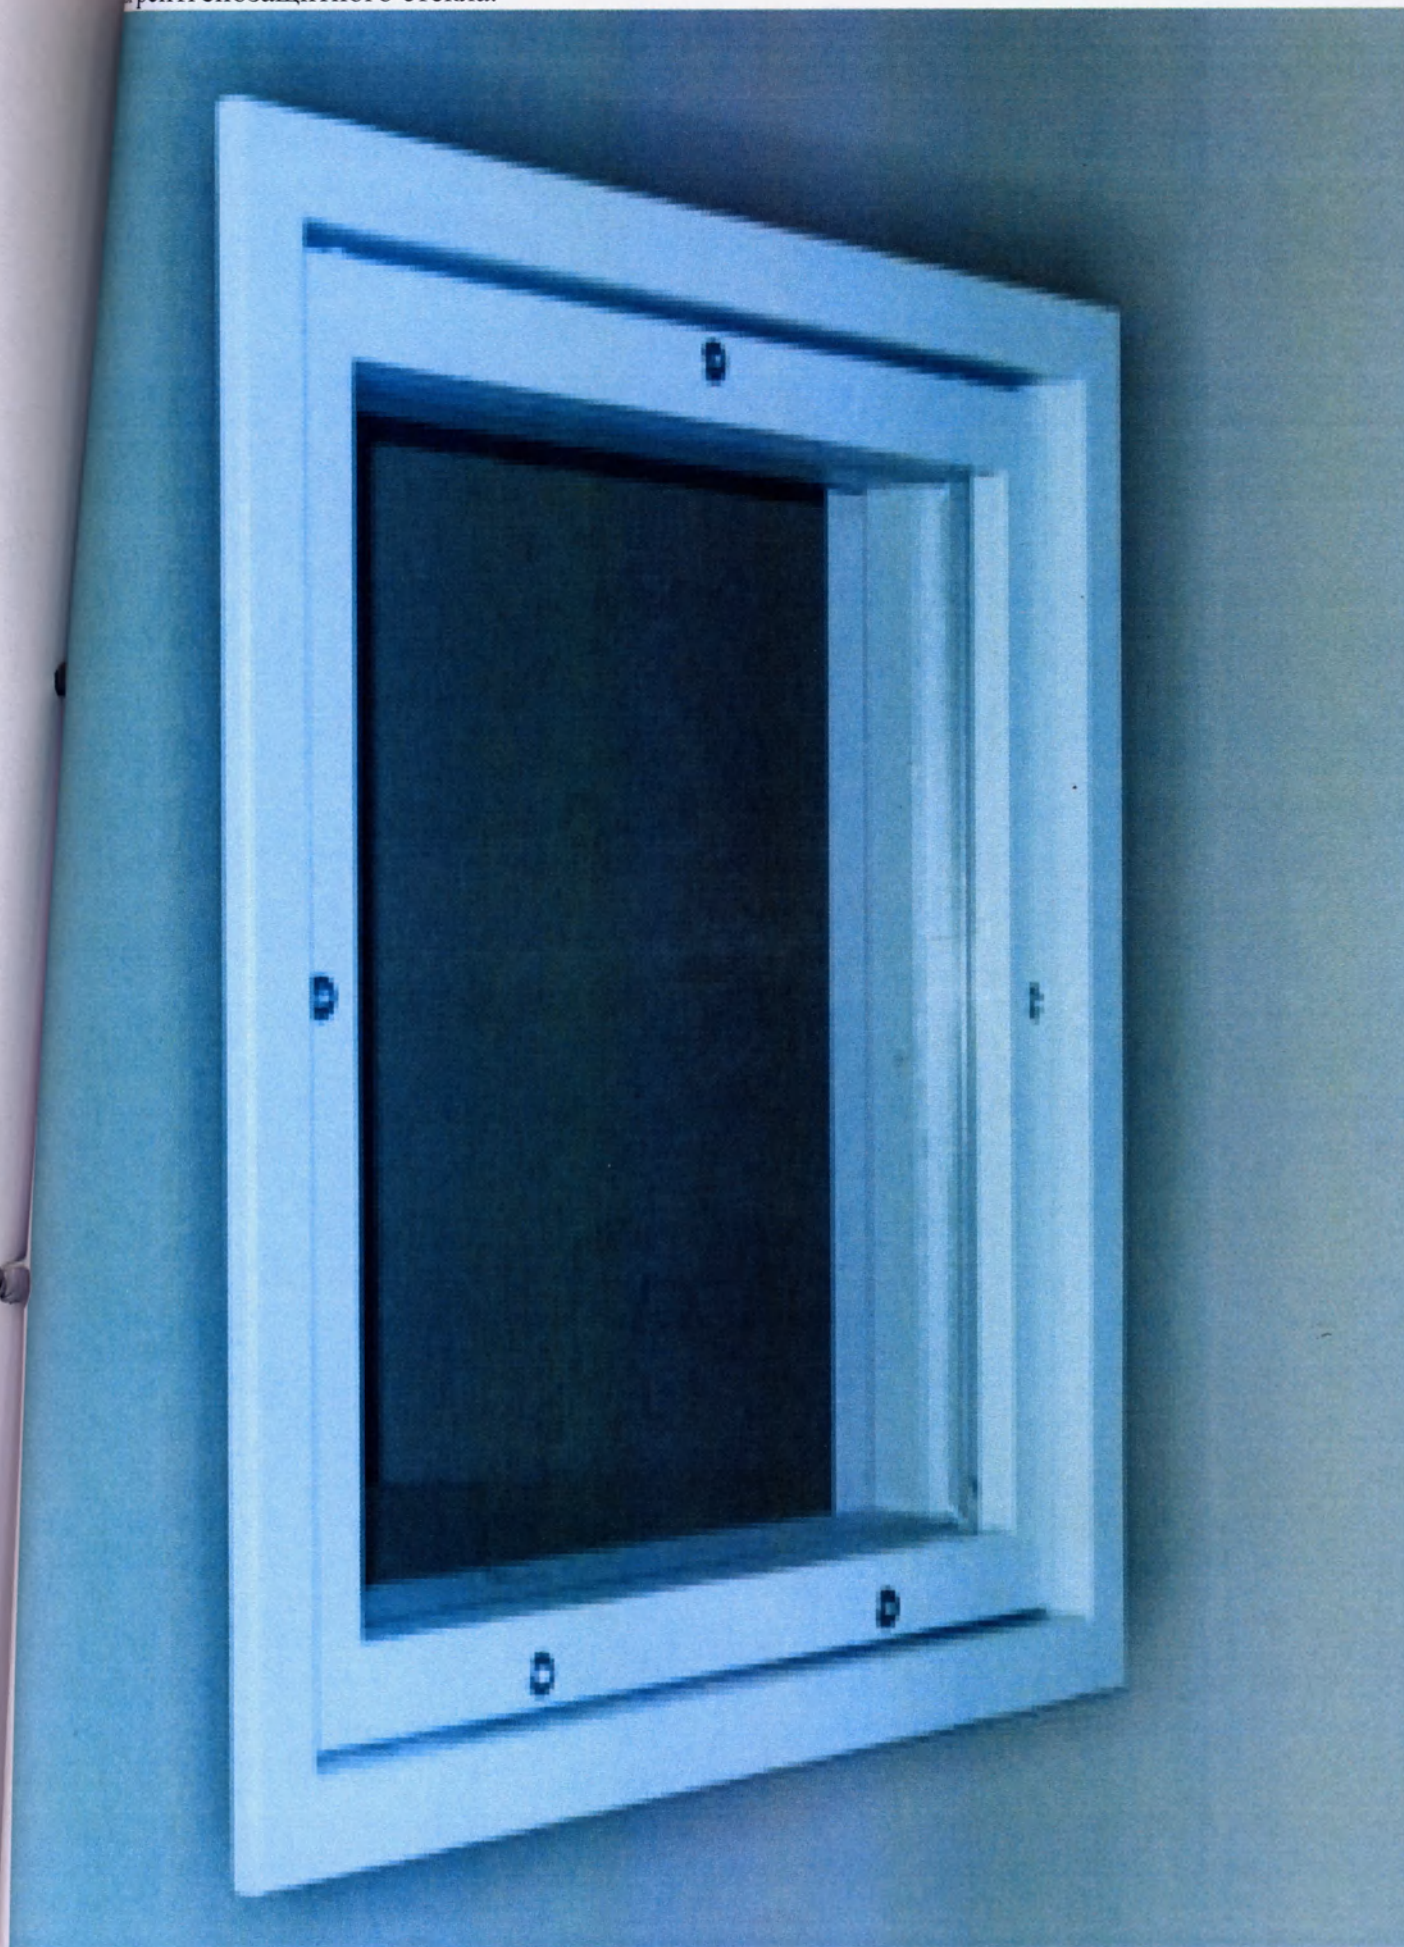

питания, дополнительный.

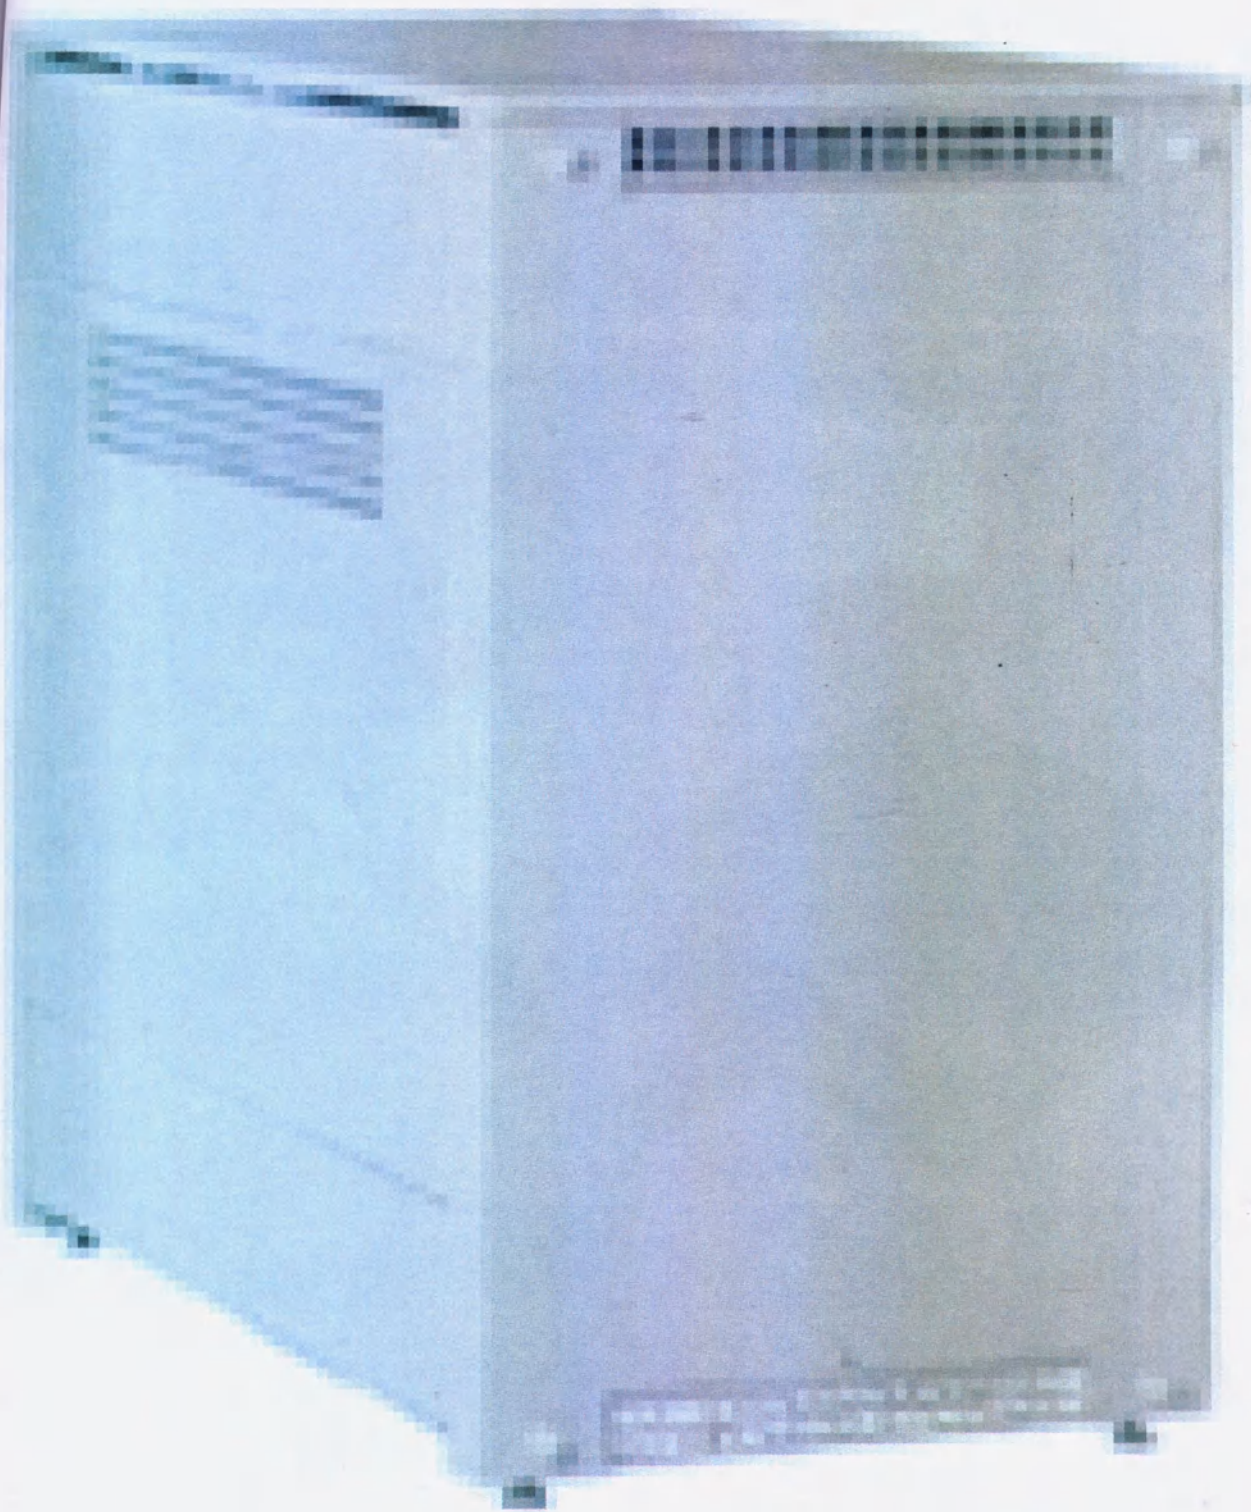

Стойка с электроприводом, вертикальная.

