
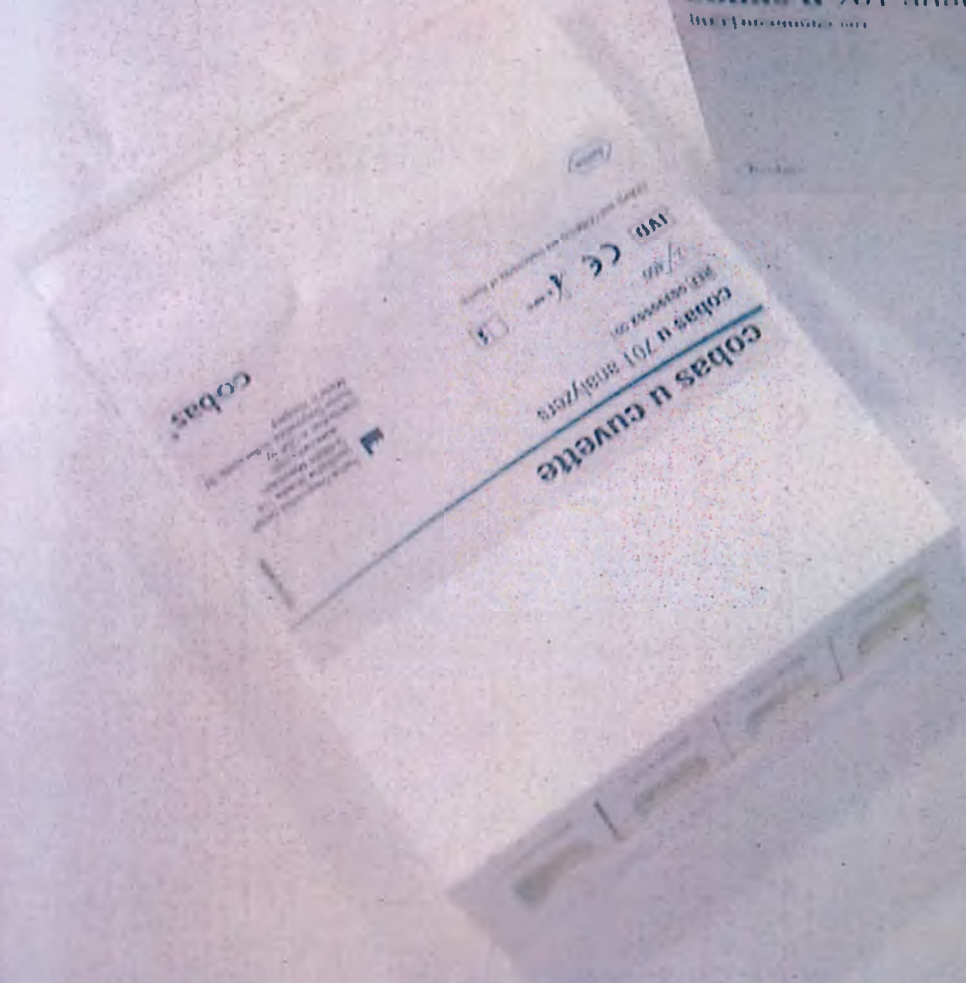


Фотографические изображения

Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701

Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701

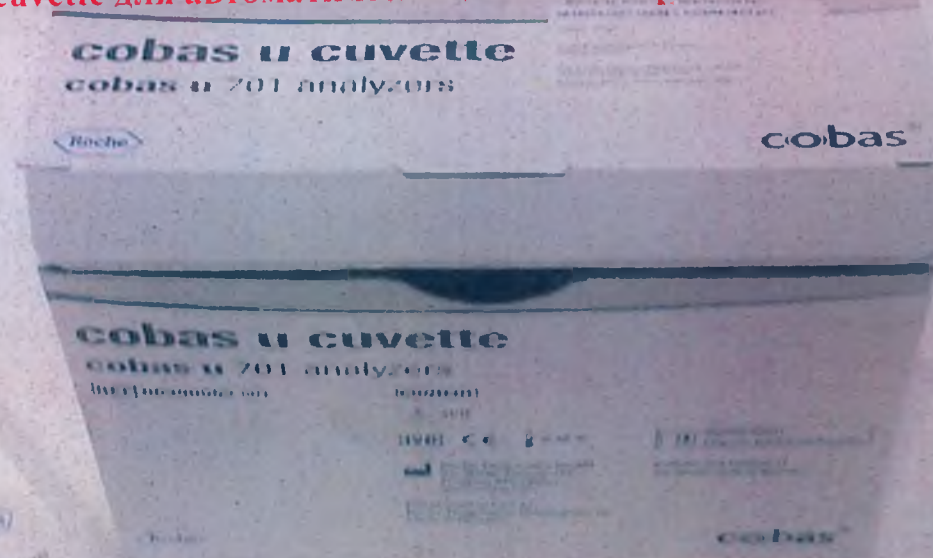

Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701

cobas u cuvette

cobas u 701 analyzers

REF 06390552 001

CONTENT

Σ / 400

IVD

CE

2-40 °C



06390552001

<http://e-labdoc.roche.com>



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
www.roche.com

COBAS and COBAS U
are trademarks of Roche.

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Hungary

Roche

cobas®

Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701

cobas u cuvette

cobas u 701 analyzers

REF 06390552 001

Σ 400


IVD

CE

2-40°C



COBAS and COBAS U are trademarks of Roche.



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
www.roche.com

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Hungary

cobas®

Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701



Кассета cobas u cuvette для автоматического анализатора осадка мочи cobas u 701



cobas u cuvette

cobas u cuvette

06390552 001

06390552001 V 2



<http://e-labdoc.roche.com>

English

Precautions and warnings

For in vitro diagnostic use.
Exercise the normal precautions required for handling all laboratory reagents.
Disposal of all waste material should be in accordance with local guidelines.

Method Sheet Download

The box at the top of this document shows the product code together with the respective document version.
Please go to <http://e-labdoc.roche.com> to download this document.
The website displays either the version listed here or, if available, any later version that is also valid for this product code. If you have no internet access, please contact your local Roche affiliate to obtain the document free of charge.

US Users



06390552001

<https://usdiagnostics.roche.com>

In case of problems, please contact US Technical Support (1-800-428-2336) to obtain the document.

Deutsch

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

In-vitro-Diagnostikum

Die beim Umgang mit Laborreagenzien üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten.

Die Entsorgung aller Abfälle ist gemäß den lokalen Richtlinien durchzuführen.

Download von Methodenblättern

Der eingetragte Text am Beginn des Dokumentes zeigt den Produkt-Code sowie die dazugehörige Version des Dokumentes.
Dieses Dokument kann von der folgenden Webseite heruntergeladen werden: <http://e-labdoc.roche.com>.

Die Website zeigt die hier referenzierte Version oder aber, falls bereits verfügbar, eine ebenfalls für diesen Produkt-Code gültige höhere Version. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, erhalten Sie bei Ihrer Roche Vertretung das Dokument kostenlos.

Français

Précautions d'emploi et mises en garde

Pour diagnostic in vitro

Observer les précautions habituelles de manipulation en laboratoire.

L'élimination de tous les déchets doit être effectuée conformément aux dispositions légales.

Téléchargement de fiches techniques

Le cadre en haut de la page montre le code du produit et la version du document.
Ce document est téléchargeable sur <http://e-labdoc.roche.com>.

La site affiche la version indiquée ci-dessus ou toute autre version ultérieure disponible correspondant au code du produit. Si vous n'avez pas accès à Internet, veuillez contacter le représentant Roche de votre pays. Vous obtiendrez le document gratuitement.

Español

Medidas de precaución y advertencias

Solo para uso diagnóstico in vitro


Observe las medidas de precaución usuales para la manipulación de reactivos.

Eliminar los residuos según las normas locales vigentes.

Descargar la metodología

La página en la parte superior de la página indica el código del producto junto con la versión del documento.
El documento puede descargarse a través de <http://e-labdoc.roche.com>.

2014-03 V 1



13

cobas u 701

cobas®

La página web muestra la versión aquí indicada o, en su caso, una versión ulterior que corresponde al código del producto. Si no tiene acceso a Internet, sírvase contactar a su representante de Roche para recibir un documento gratuito.

Italiano

Precauzioni e avvertenze

Per uso diagnostico in vitro

Observare le precauzioni normalmente adottate durante la manipolazione dei reagenti di laboratorio.

Lo smaltimento di tutti i rifiuti deve avvenire secondo le direttive locali.

Scaricamento della metodica

Nel box riportato all'inizio di questo documento è indicato il codice prodotto insieme alla versione della rispettiva metodica.
Per scaricare tale metodica, andare a <http://e-labdoc.roche.com>.
Il sito Web indica la versione riportata qui o, se disponibile, una versione più alta, anche valida per questo codice prodotto. Se non è possibile di alcun accesso Internet, rivolgetevi al rappresentante locale di Roche per ottenere il documento gratuitamente.

Português

Precauções e avisos

Para utilização em diagnóstico in vitro

Respeite as precauções normais de manuseamento de reagentes laboratoriais.

Elimine todos os resíduos de acordo com os regulamentos locais.

Download de folhas de método

A caixa de texto no topo deste documento apresenta-lhe a referência do produto juntamente com a versão do respectivo documento.
Para obter a versão correspondente da folha de método consulte: <http://e-labdoc.roche.com>.
O website apresenta a versão indicada neste documento ou, se disponível, qualquer versão posterior também válida para esta referência de produto.
Caso não disponha de acesso à Internet, contacte o responsável da Roche para receber o documento em questão sem custos adicionais.

Dansk

Forsikringsregler og advarsler

Til in vitro-diagnostisk brug

Udvis de normale forsikringsregler, der kræves ved håndtering af alle laboratoriereagenser.

Bortskaffelse af alt affaldsmateriale skal ske i overensstemmelse med lokale retningslinjer.

Downloadning af metodeblade

Følg øverst på dette dokument angiver katalognummeret samt dokumentets versionsnummer.
Gå til <http://e-labdoc.roche.com> for at downloade dette dokument.
Webbladet viser enten den version, der er angivet her, eller, hvis de findes, eventuelle senere versioner, som også gælder for dette katalognummer. Hvis du ikke har adgang til Internet, kan du få et gratis eksemplar af dokumentet ved at kontakte det lokale Roche-kontor.

Svenska

Försiktighetsåtgärder och varningar

För in vitro-diagnostisk användning

Iakttag de normala försiktighetsåtgärder som gäller för all hantering av laboratoriereagens.

Allt avfall ska hanteras enligt lokala riktlinjer.

Hedjaddning av metodblad

Följ överst i detta dokument anger katalognumret samt dokumentets versionsnummer.
Gå till <http://e-labdoc.roche.com> för att ladda ner detta dokument.
Webblatsen visar antingen den version som är angiven här eller, om så finns, eventuella senare versioner som också gäller för detta katalognummer. Om du inte har tillgång till Internet kan du få ett gratis exemplar av dokumentet om du kostnadsfritt erhåller ett exemplar av dokumentet.

