


...овная атравматическая с нитью «Оптилен» (Optilene).

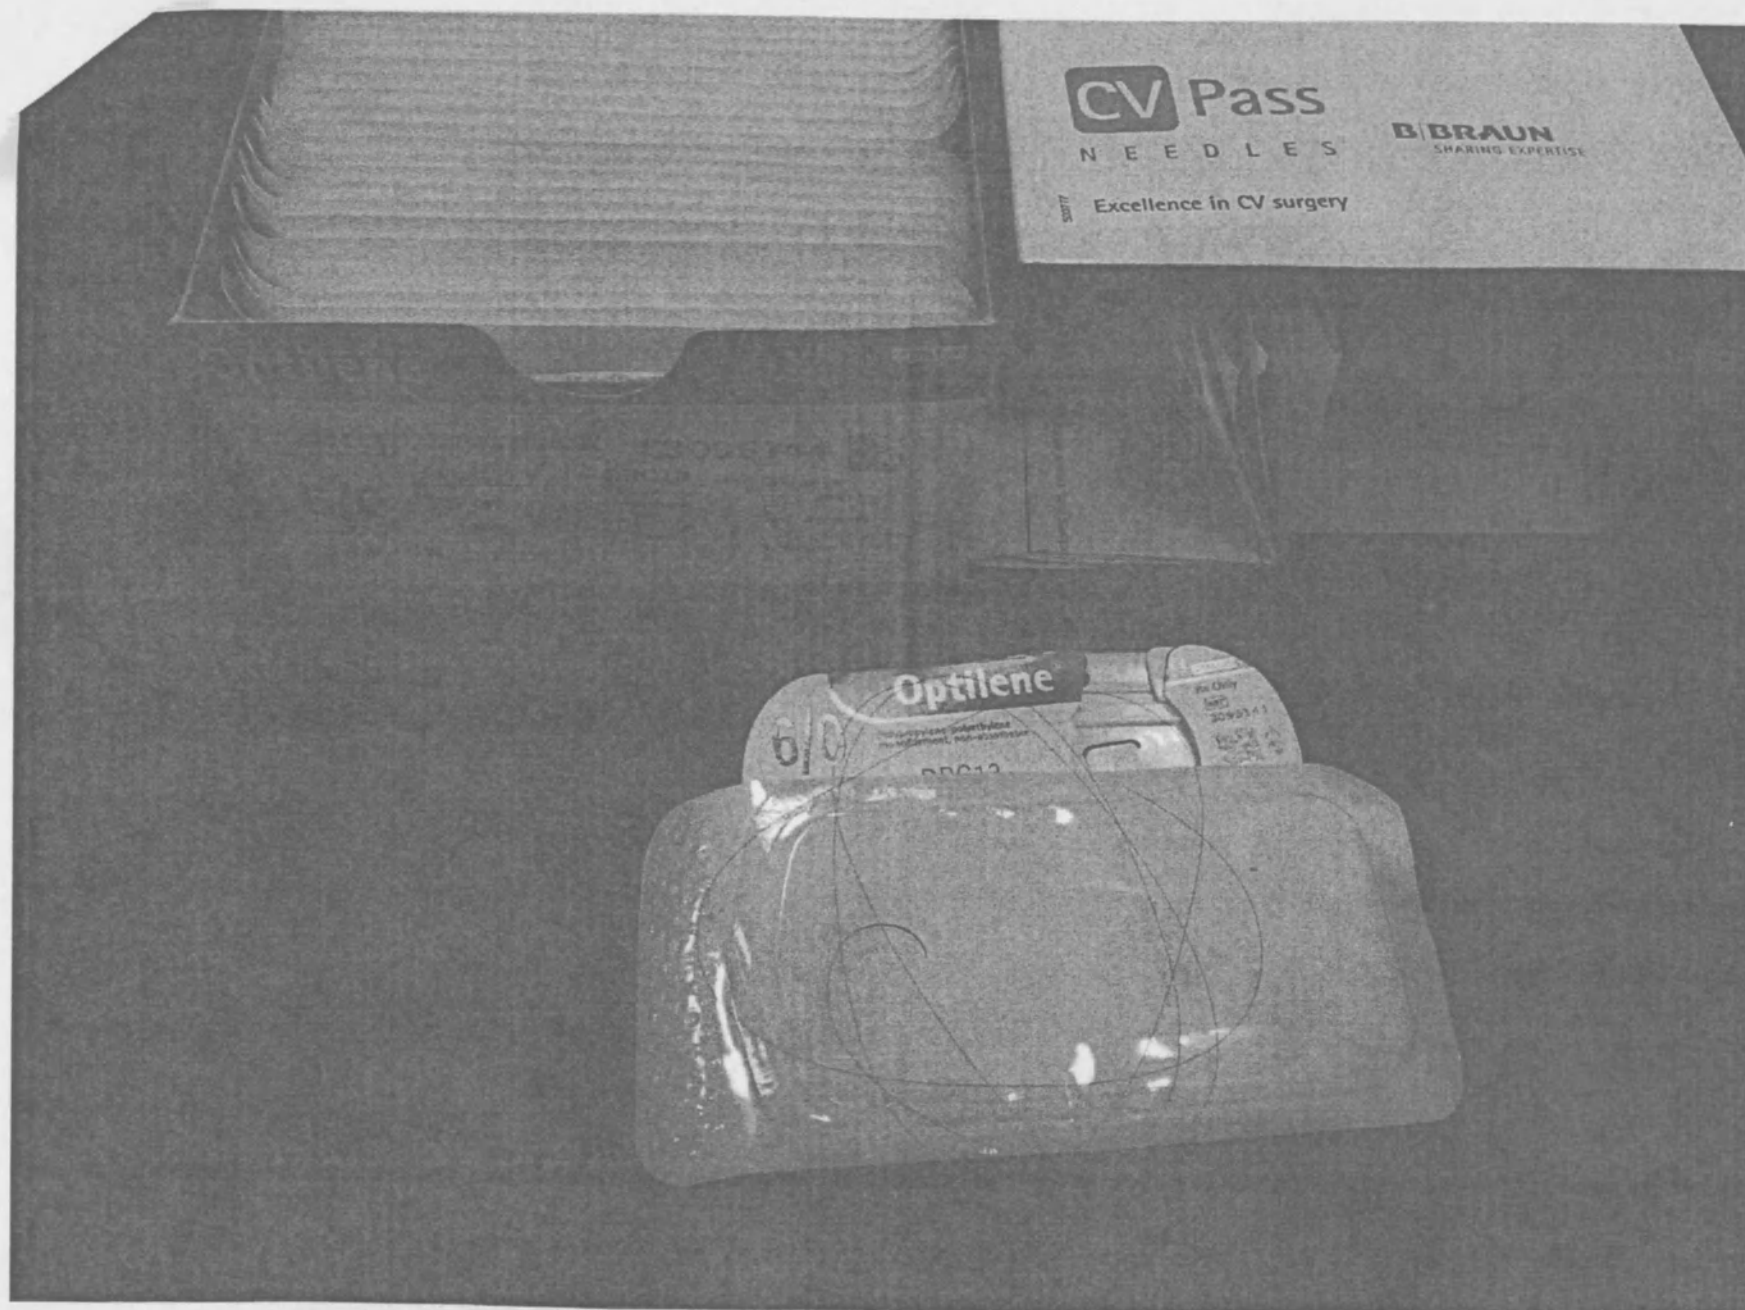

Основная атравматическая с нитью «Оптилен» (Optilene) и с прокладкой из ПТФЭ.

CV Pass

NEEDLES

Excellence in CV surgery

B BRAUN

3/0

C3090495

CE

Optilene®


Benennung

Optilene® ist ein Marken- und Handelsname für
Polypropylen-Nähte, die für die Herz- und
Gefäßchirurgie verwendet werden. Optilene®
Nähte sind aus einem hochfesten, nicht
absorbierbaren Material gefertigt und sind
für die Herz- und Gefäßchirurgie geeignet.
Die Nähte sind in verschiedenen Stärken
verfügbar und können mit verschiedenen
Nadeln kombiniert werden. Optilene®
Nähte sind für die Herz- und Gefäßchirurgie
geeignet und werden in der Regel für die
Herz- und Gefäßchirurgie verwendet.


Anwendungsbereich

Optilene® ist ein Marken- und Handelsname für
Polypropylen-Nähte, die für die Herz- und
Gefäßchirurgie verwendet werden. Optilene®
Nähte sind aus einem hochfesten, nicht
absorbierbaren Material gefertigt und sind
für die Herz- und Gefäßchirurgie geeignet.
Die Nähte sind in verschiedenen Stärken
verfügbar und können mit verschiedenen
Nadeln kombiniert werden. Optilene®
Nähte sind für die Herz- und Gefäßchirurgie
geeignet und werden in der Regel für die
Herz- und Gefäßchirurgie verwendet.

шовная атравматическая (2 шт.) с нитью «Оптилен» (Optilene).

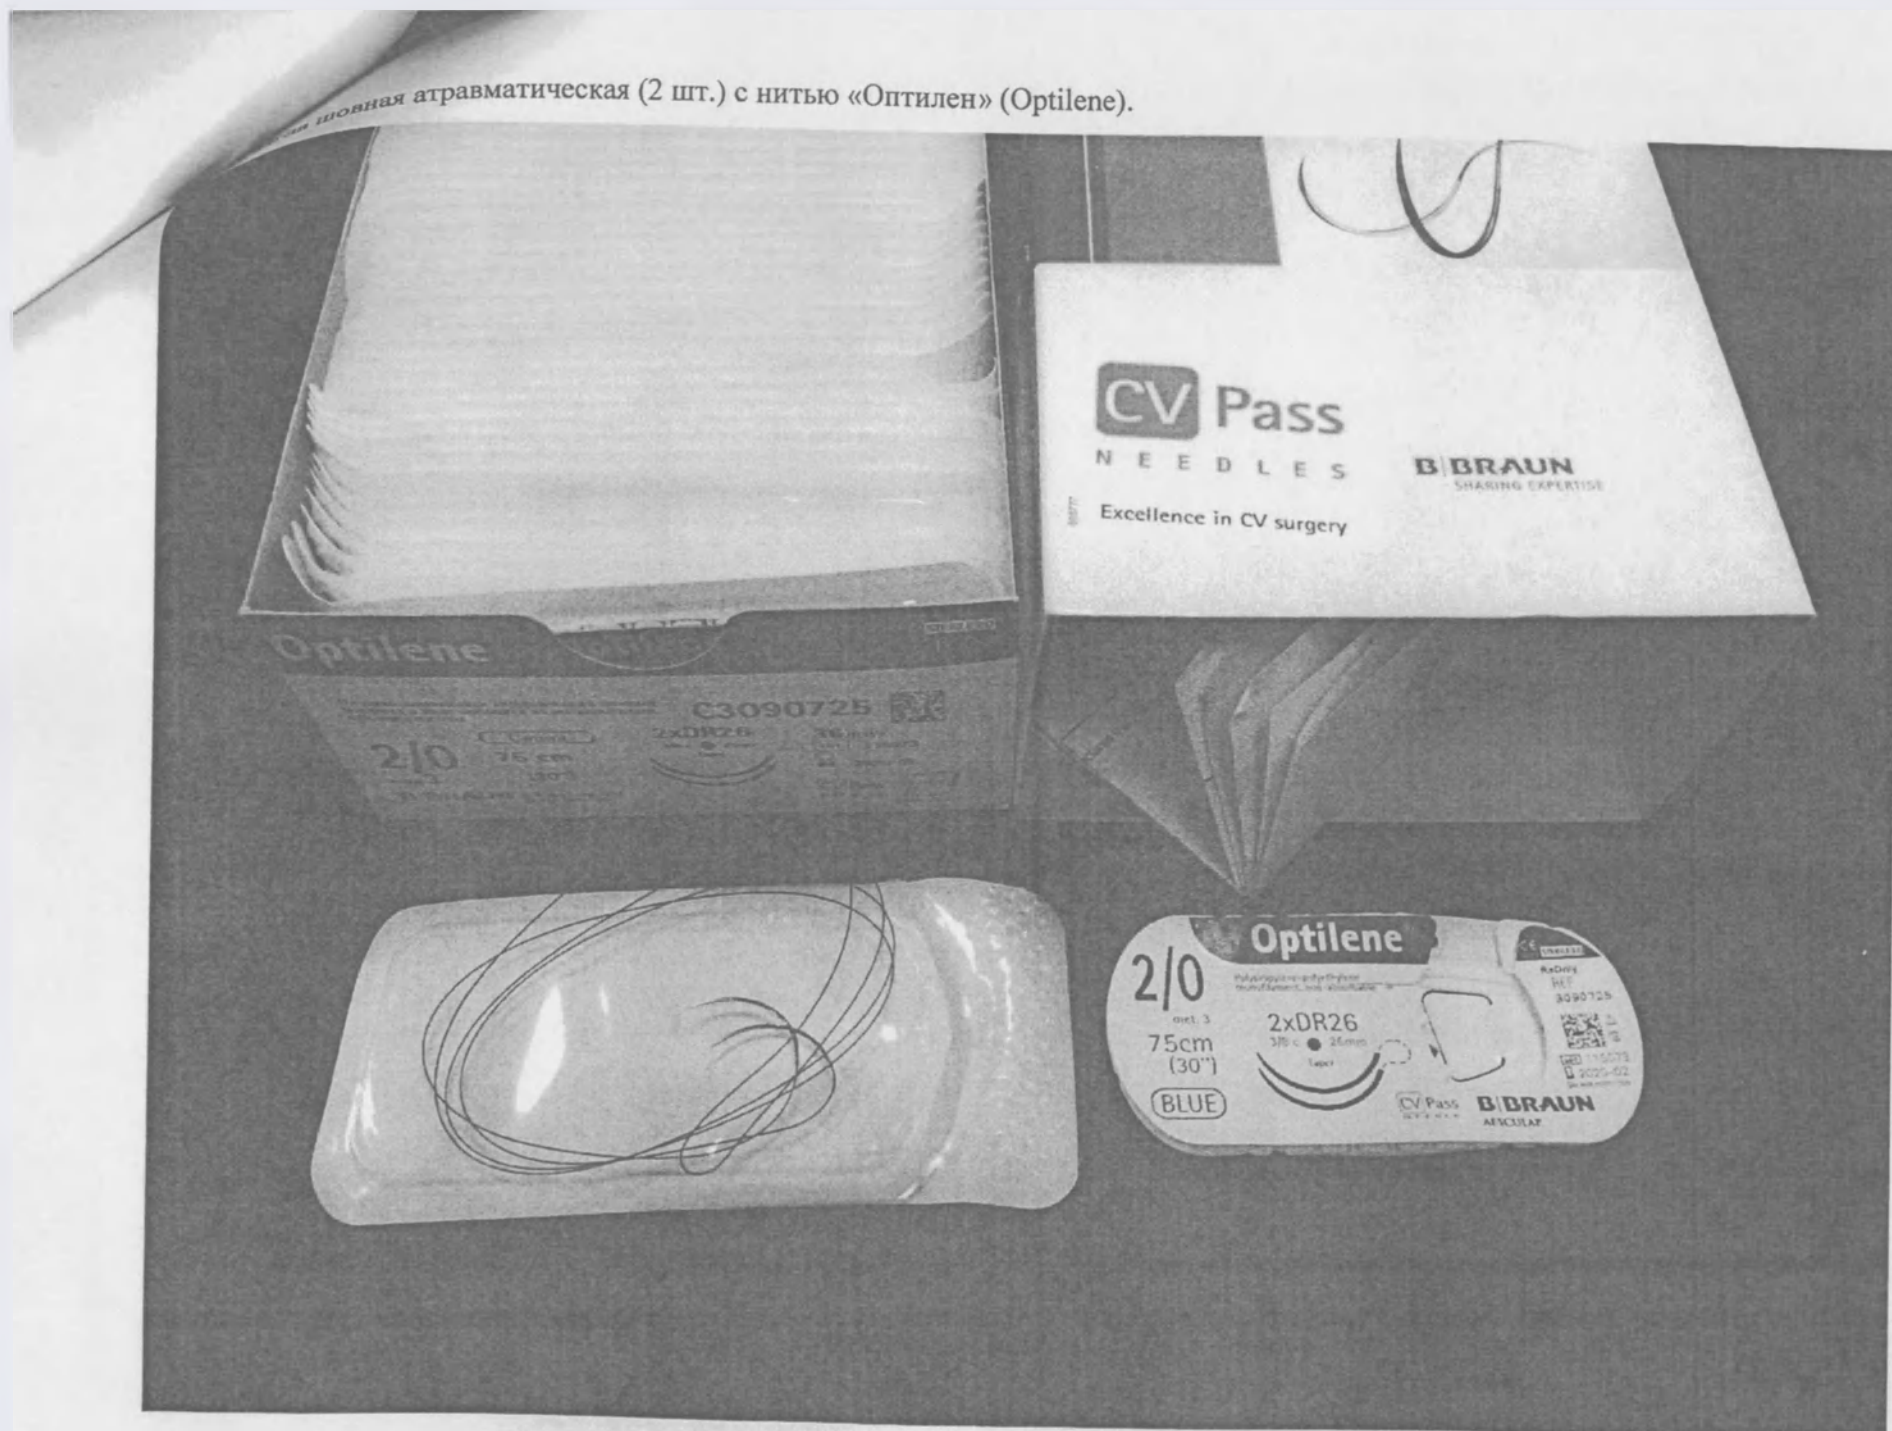


4. Нить шовная атравматическая (2 шт.) с нитью «Оптилен» (Optilene) и с прокладкой из ПТФЭ.

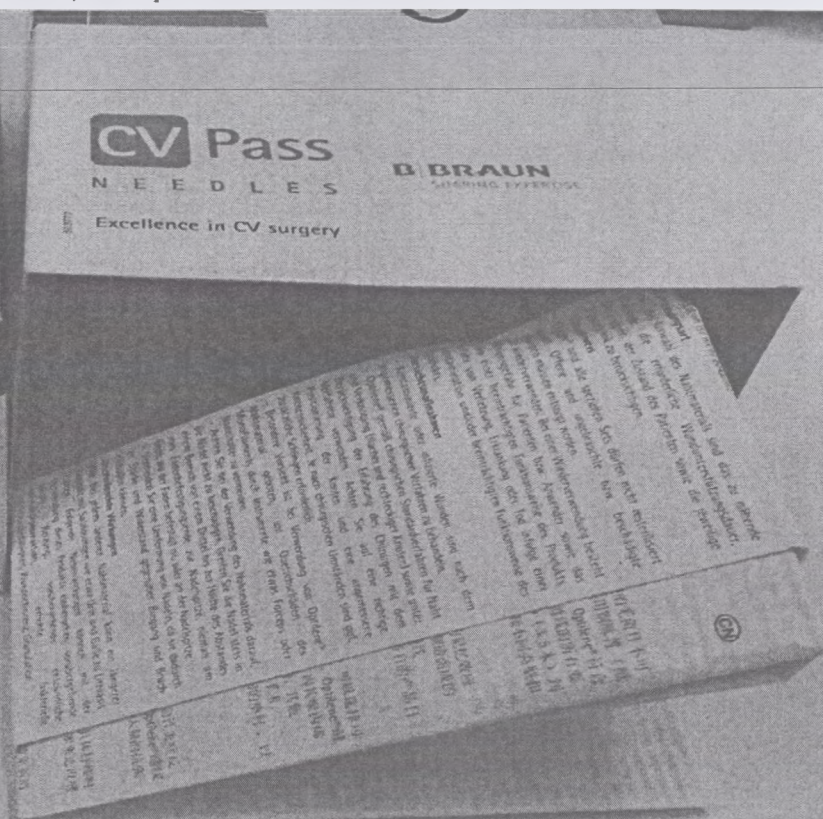

Внимание! При использовании нити «Оптилен» необходимо соблюдать следующие правила:

- 1. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию высоких температур, так как это может привести к изменению ее свойств.
- 2. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию агрессивных химических веществ.
- 3. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения.
- 4. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию радиации.
- 5. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию электрических разрядов.
- 6. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию механических нагрузок.
- 7. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию влаги.
- 8. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 9. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию микроорганизмов.
- 10. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию пыли.
- 11. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию грязи.
- 12. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию жира.
- 13. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию крови.
- 14. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию мочи.
- 15. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию слез.
- 16. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию пота.
- 17. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию слюны.
- 18. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию слезоточивого раствора.
- 19. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию антисептика.
- 20. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию дезинфеканта.
- 21. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию стерилизанта.
- 22. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию газа.
- 23. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию пара.
- 24. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию жидкого азота.
- 25. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию сухого льда.
- 26. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию вакуума.
- 27. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию высокого давления.
- 28. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию низкого давления.
- 29. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию ударов.
- 30. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию вибрации.
- 31. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию шума.
- 32. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию света.
- 33. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию тепла.
- 34. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию холода.
- 35. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию перепадов температуры.
- 36. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию влажности.
- 37. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию сухости.
- 38. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 39. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию азота.
- 40. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 41. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 42. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 43. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 44. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 45. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 46. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 47. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 48. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 49. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.
- 50. Нить «Оптилен» не должна подвергаться воздействию кислорода.

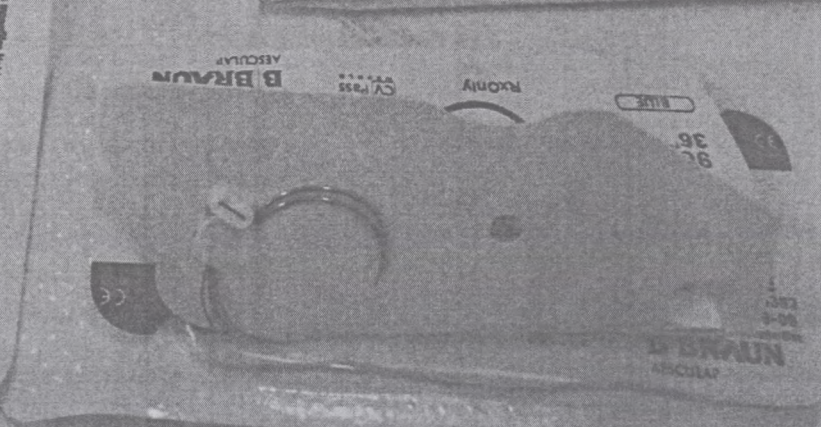

шовная атравматическая с нитью синтетической монофиламентной нерассасывающейся «Оптилен»
примере артикулярного номера C3090538

Макет этикетки потребительской упаковки:

Optilene

Оптилен. Игла шовная атравматическая с нитью синтетической монофиламентной нерассасывающейся

C3090538

7/0 **75 cm** **(30")**

metric **0,5**

B | BRAUN B. Braun Surgical SA
08191 Rubí, Spain

Синий

DRC10
3/8 с 10mm
Taper Microtip

36 штук

LOT **115361**

2020-08

CV Pass
NEEDLES

RacePack®

CE 0123

STERILE

017

Макет стикера потребительской упаковки:

RUS Арт. № **C3090538**

Описание Оптилен. Игла шовная атравматическая с нитью синтетической монофиламентной нерассасывающейся

Номер и дата Рег. уд. № xxxx/xxxxx от дд.мм.гггг

Уполномоченная организация (импортер) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал»,
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10, тел. (812)320-40-04

Производитель: B. Braun Surgical S.A., Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubí (Barcelona), Spain.
«Б.Браун Сурджикал С.А.», Карретера де Террасса, 121, 08191 Руби (Барселона), Испания

PG

атравматическая с нитью синтетической монофиламентной нерассасывающейся «Оптилен»
с прокладкой из ПТФЭ
артикулярного номера C3090492

Макет этикетки потребительской упаковки:

Optilene

CE 0123

STERILIZED



Оптилен. Игла шовная атраматическая с нитью
синтетической монофиламентной
нерассасывающейся и с прокладкой из ПТФЭ

C3090492



Синий

3/0

metric 2


PTFE PLEDGETS

FIRM 3x3x1.5mm

20cm (8")

DR22

3/8 c 22mm
Taper

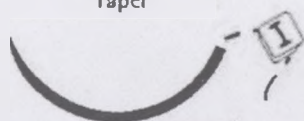

36 штук

LOT 115281


2020-07

017

B BRAUN

B. Braun Surgical SA
08191 Rubi, Spain

CV Pass
NEEDLES



RacePack®

Макет стикера потребительской упаковки:

RUS

Арт. № C3090492



Описание

Оптилен. Игла шовная атраматическая с нитью синтетической
монофиламентной нерассасывающейся и с прокладкой из ПТФЭ

Номер и дата

№ xxxx/xxxxx от дд.мм.гггг

Рег. уд.

Уполномоченная организация (импортер) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал»,
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10, тел. (812)320-40-04

Производитель: B. Braun Surgical S.A., Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona), Spain.
«Б.Браун Сурджикал С.А.», Каррета де Терраса, 121, 08191 Руби (Барселона), Испания

атравматическая (2 шт.) с нитью синтетической монофиламентной нерассасывающейся
регулярного номера C3090725

Макет этикетки потребительской упаковки:

CE 0123 STERILE

Оптилен. Игла шовная атравматическая (2 шт.)
с нитью синтетической монофиламентной
нерассасывающейся

C3090725

2/0 **75 cm** **36 штук**
metric 3 (30")

Синий

2xDR26
3/8 c 26mm
Taper

LOT 115361
2020-08

B BRAUN B. Braun Surgical SA
08191 Rubí, Spain

CV Pass
NEEDLES

RacePack®

Макет стикера потребительской упаковки:

RUS Арт. № C3090725 **PG**

Описание Оптилен. Игла шовная атравматическая (2 шт.) с нитью
синтетической монофиламентной нерассасывающейся

Номер и дата Рег. уд. № xxxx/xxxxx от дд.мм.гггг

Уполномоченная организация (импортер) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал»,
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10, тел. (812)320-40-04

Производитель: B. Braun Surgical S.A., Carretera de Terrassa, 121, 08191 Rubí (Barcelona), Spain.
«Б.Браун Сурджикал С.А.», Каррета де Терраса, 121, 08191 Руби (Барселона), Испания

ПЕРЕВОД МАРКИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

«Игла шовная атравматическая с нитью синтетической монофиламентной нерассасывающейся
«Оптилен» (Optilene)»


Игла шовная атравматическая с нитью синтетической монофиламентной нерассасывающейся «Оптилен» (Optilene)

На примере артикуляционного номера С3090538

Перевод маркировки индивидуальной упаковки:

Optilene

CE 0123 

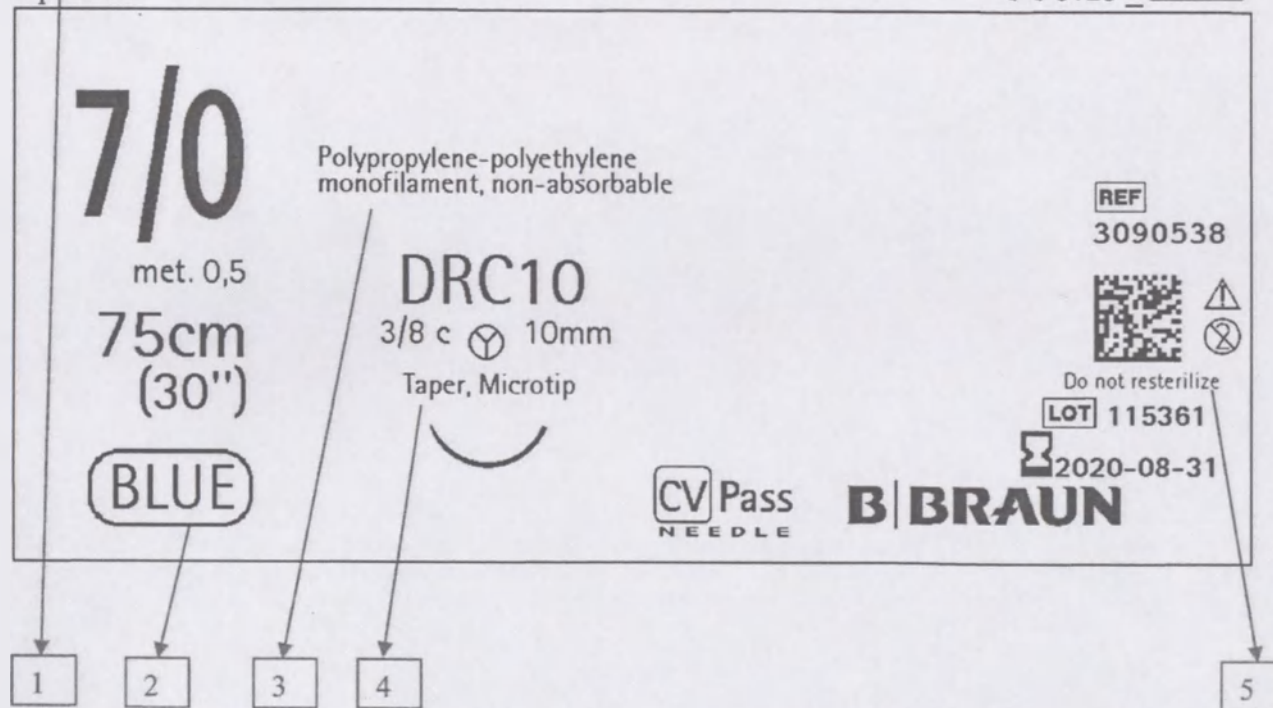

где,

1 – Оптилен;

2 – Синий;

3 – Игла шовная атравматическая с нитью синтетической монофиламентной нерассасывающейся;

4 – Колющая игла с коротким режущим острием;

5 – Символ «Не стерилизовать повторно».