

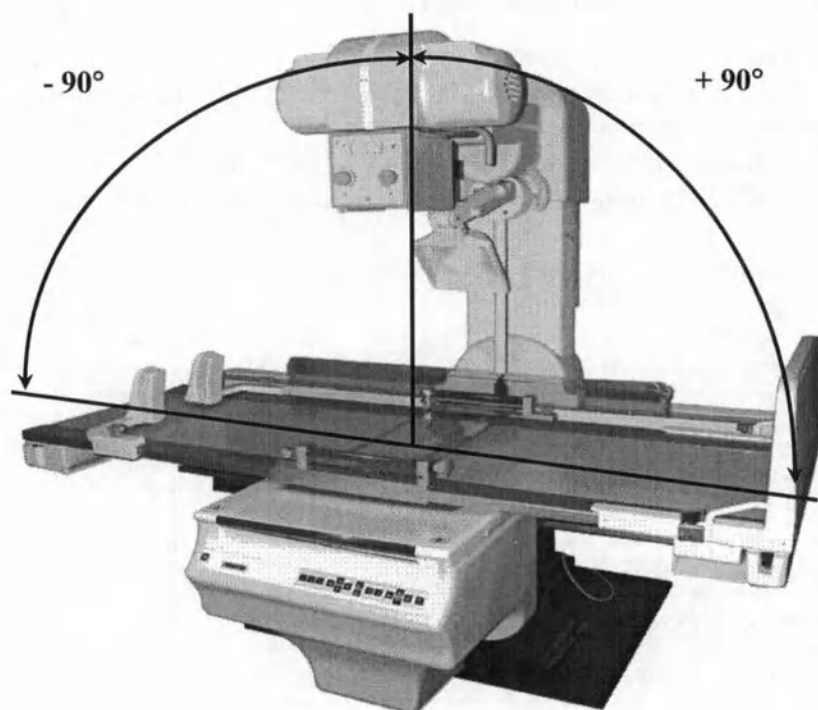


Рисунок 3.1 – Пределы поворота деки стола – штатива

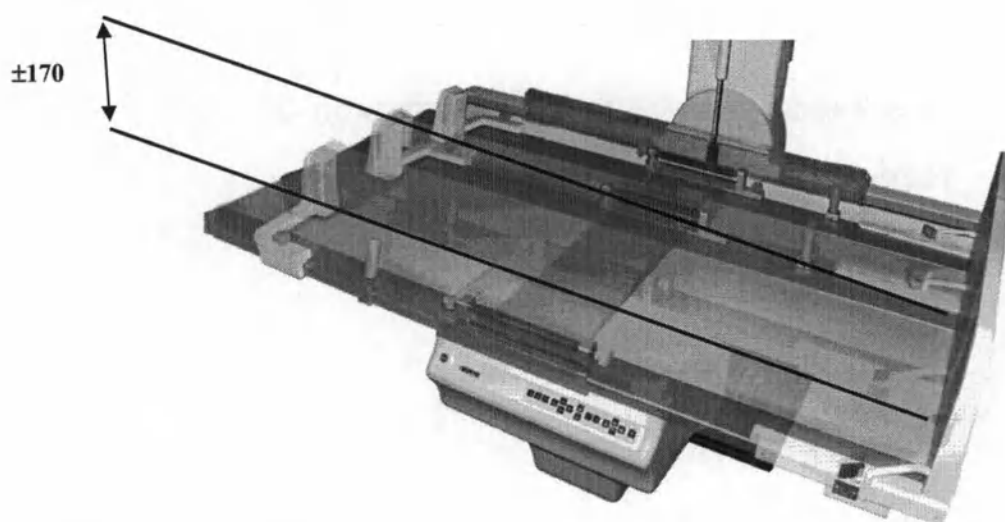


Рисунок 3.2 – Диапазон поперечного перемещения деки стола

3.4.2 Технические данные ЭСУ ТСШ

Размеры применяемых кассет

от 18х24 до 35х43 см

Коэффициенты вертикального деления
снимка

от 1 до 4 (в зависимости от типа
кассеты)

3.4.3 Технические данные колонны ТСШ

Продольное перемещение (только трубка, см. Рисунок 3.3)	1080 ± 10 мм
Продольное перемещение с ЭСУ	1240 ± 10 мм
Боковые проекции с коррекцией параллакса (см. Рисунок 3.4)	от $+(40 \pm 3)$ до $-(40 \pm 3)^\circ$
Мин. фокусное расстояние снимка (ФРС)	1150 мм
Макс. фокусное расстояние снимка	1500 мм
Диапазон перемещения компрессионного тубуса, мм	550 ± 10
Вращение трубки с фиксацией в положении 90°	$-18/180^\circ$, а именно: $-18^\circ / +18^\circ; +72^\circ; +90^\circ;$ $+180^\circ$

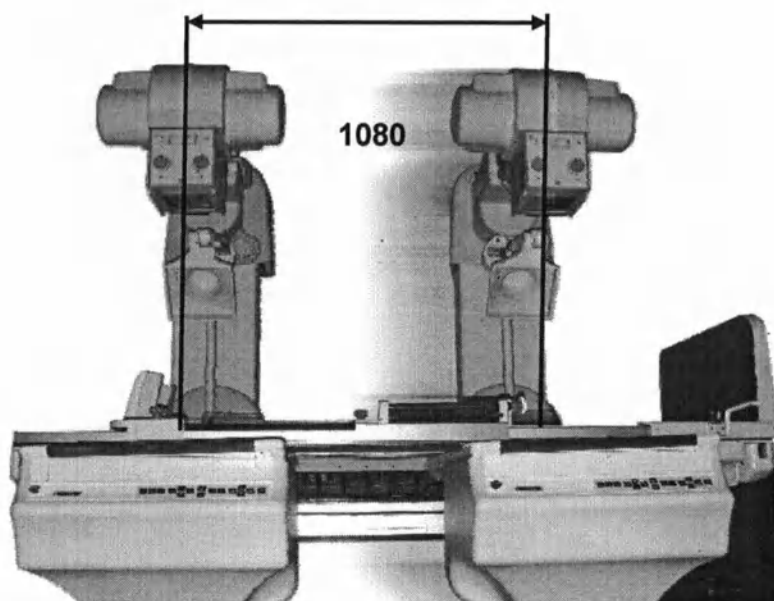


Рисунок 3.3 – Диапазон перемещения системы рентгеновский излучатель-приемник с электронно-оптическим блоком УРИ, вдоль деки стола

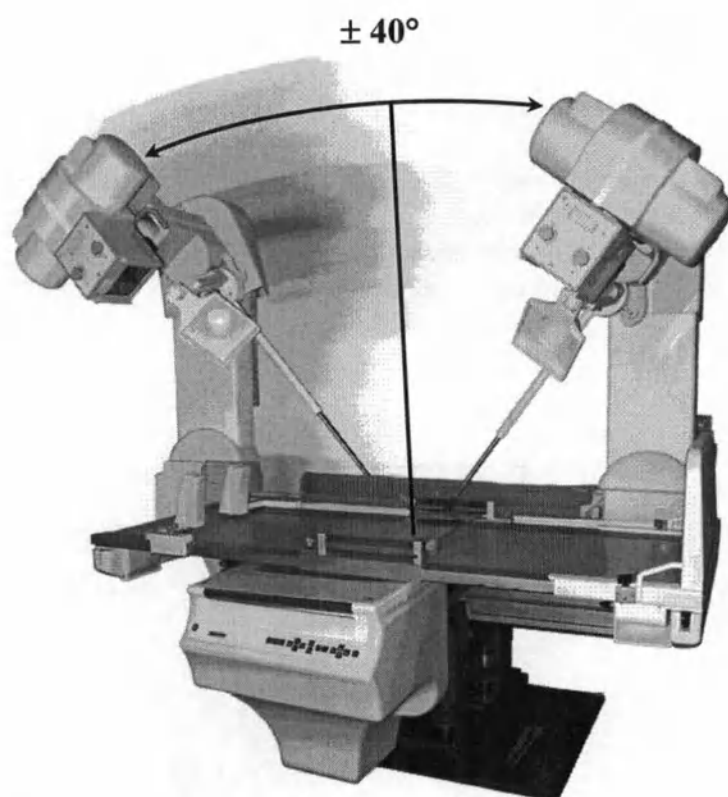


Рисунок 3.4 – Пределы наклона излучателя для получения наклонных проекций

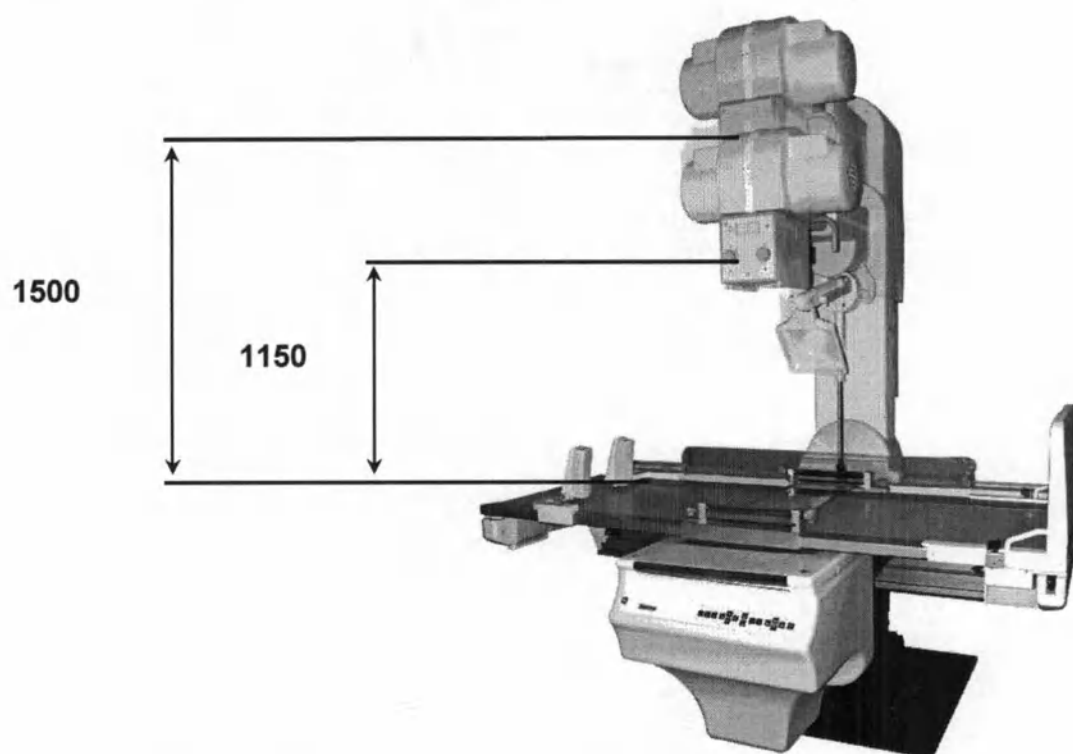


Рисунок 3.5 – Диапазон изменения фокусного расстояния