

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здоровоохранение»
Н.А. Горшкова



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro


«Анализатор автоматический биохимический Dimension ExL, с принадлежностями»,
производства «Сименс Хелскеа Диагностикакс Инк.» (Siemens Healthcare Diagnostics Inc.), США



Анализатор автоматический биохимический Dimension ExL 200




Анализатор автоматический биохимический Dimension ExL 200

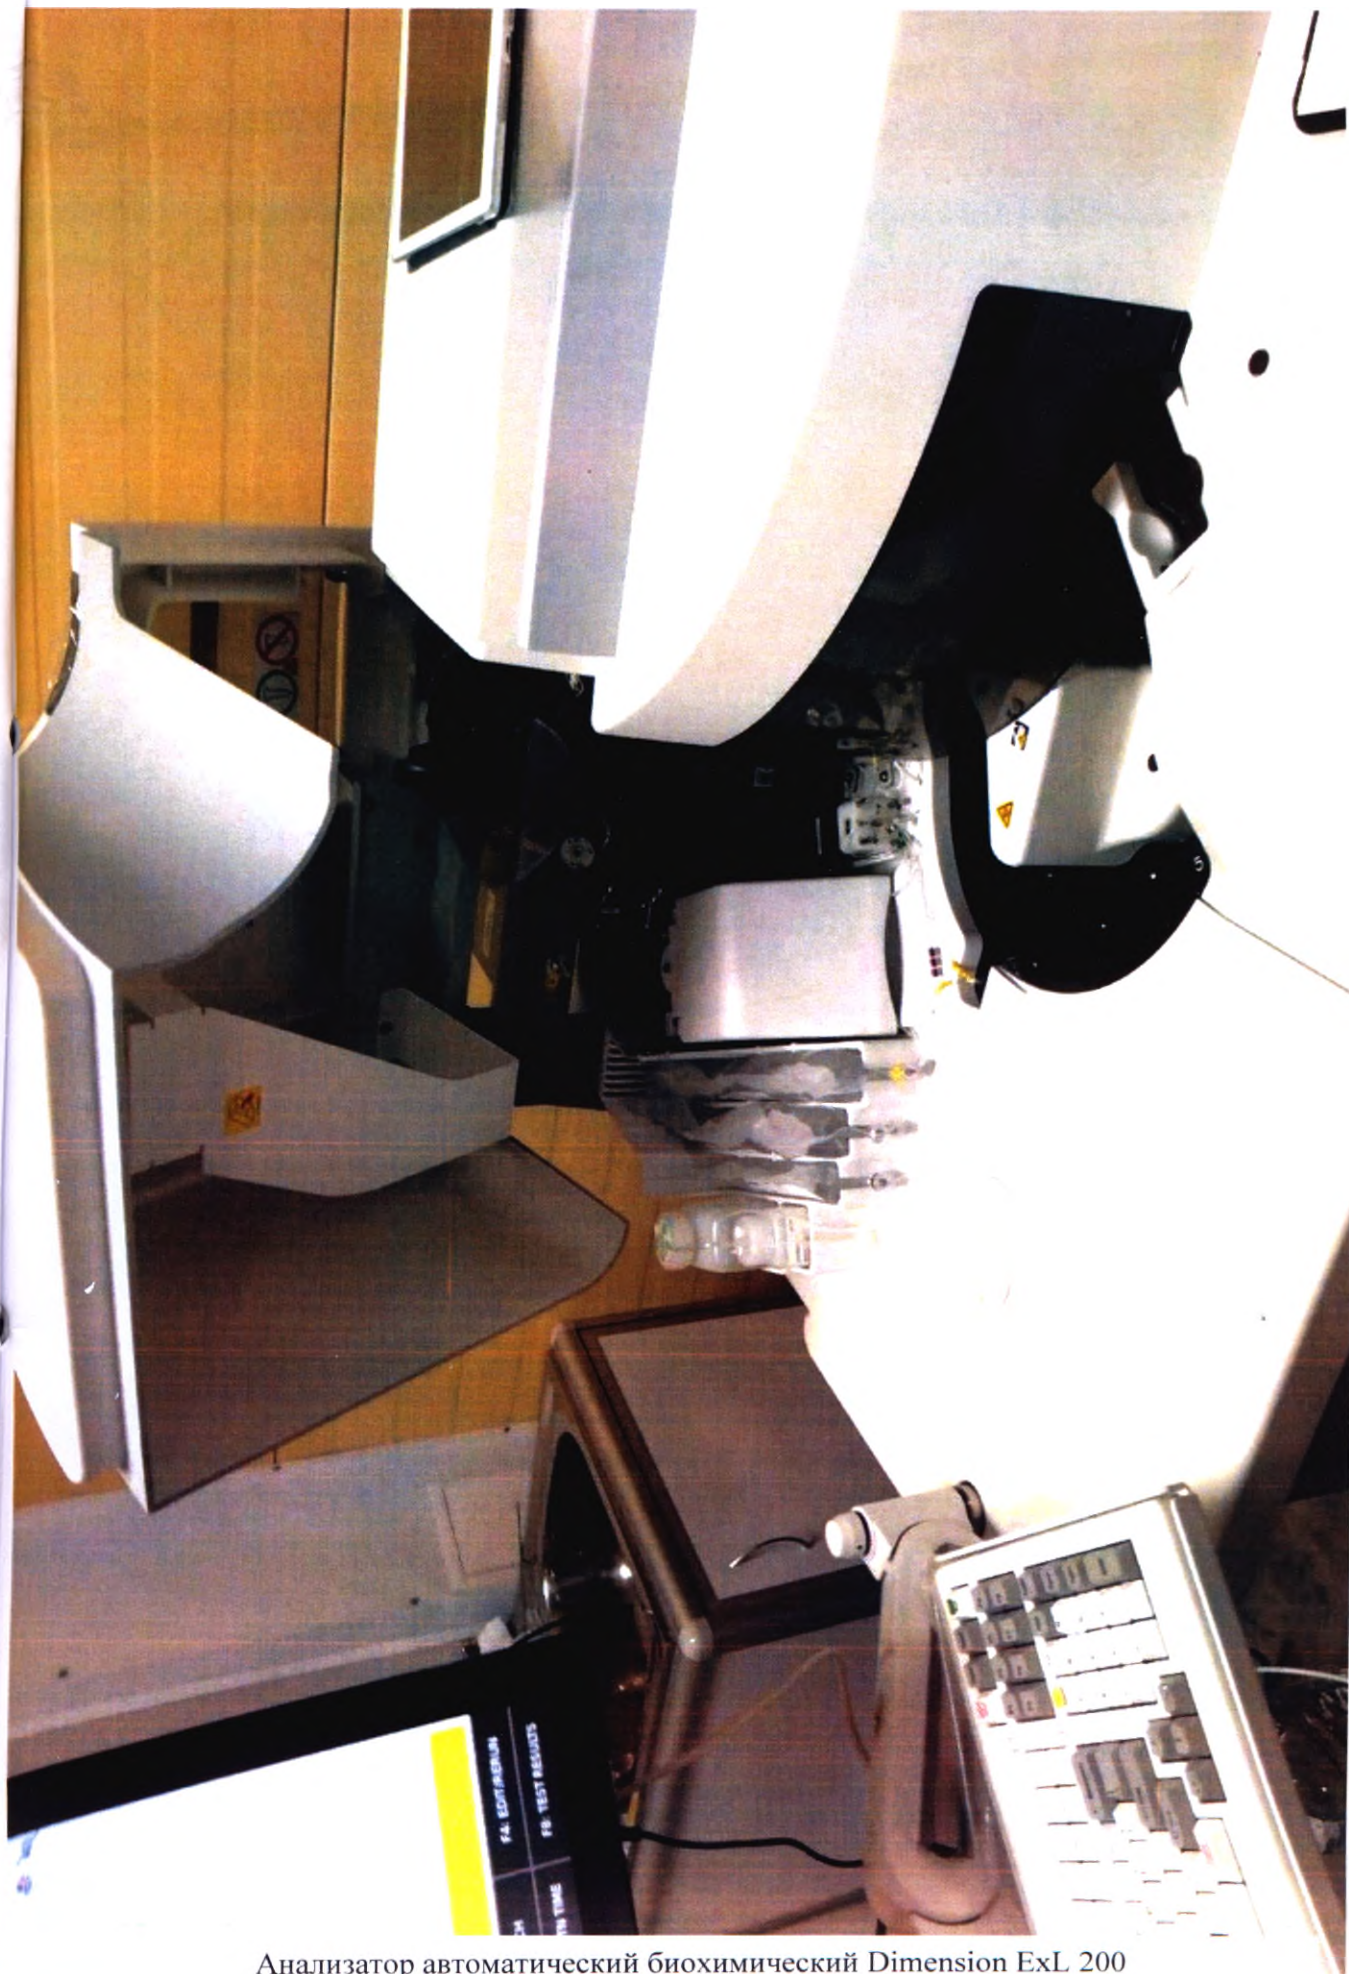


Анализатор автоматический биохимический Dimension ExL 200

Анализатор
биохимический автоматический
Dimension ExL 200
IVD SN DR 272615

Маркировка для РФ «Автоматический биохимический Dimension ExL 200»

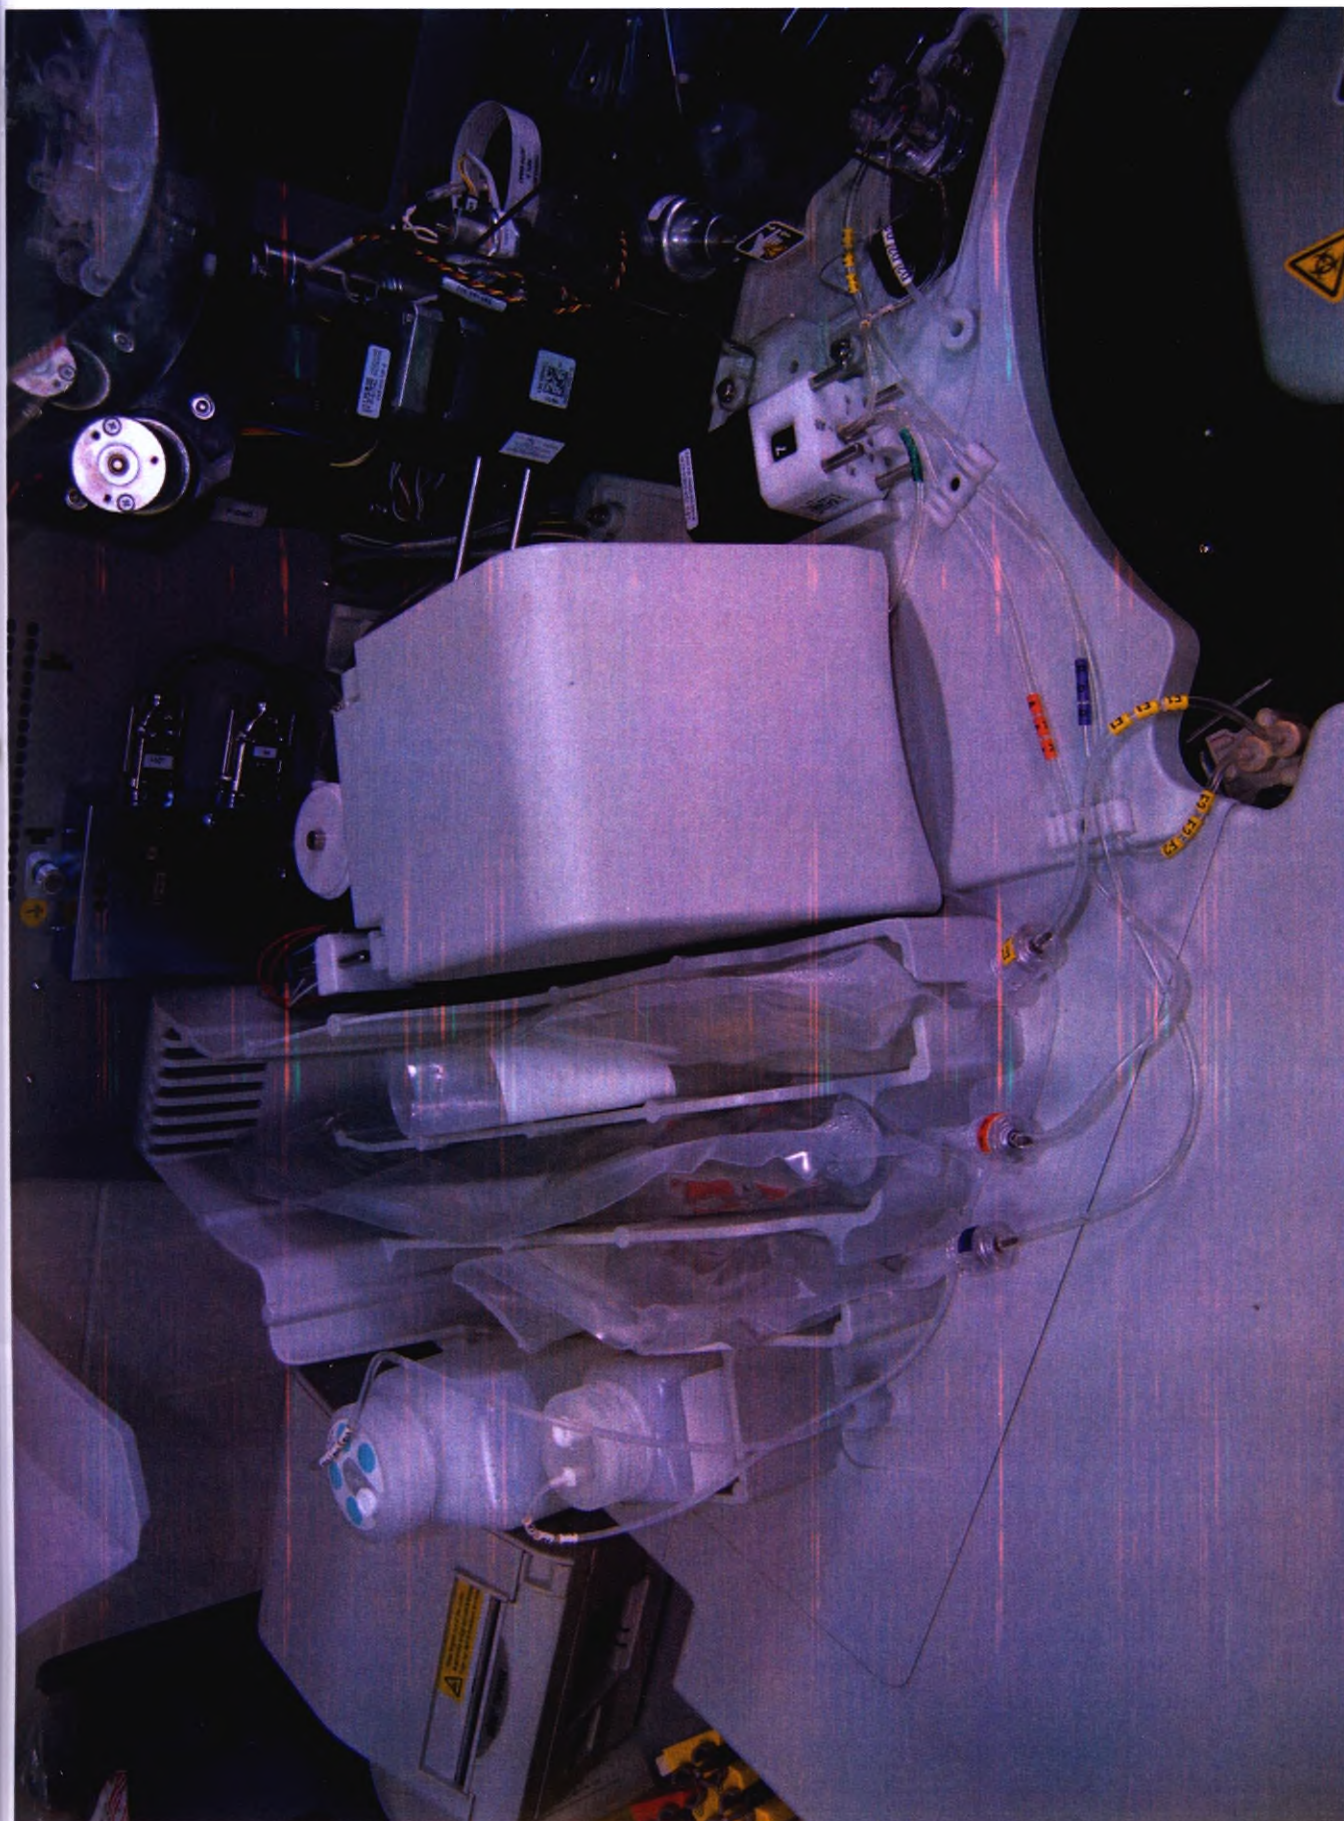


1. Область IMT (модуль интегрированного многосенсорного датчика (Integrated Multisensor Technology Module)). Общий вид, закрытый.

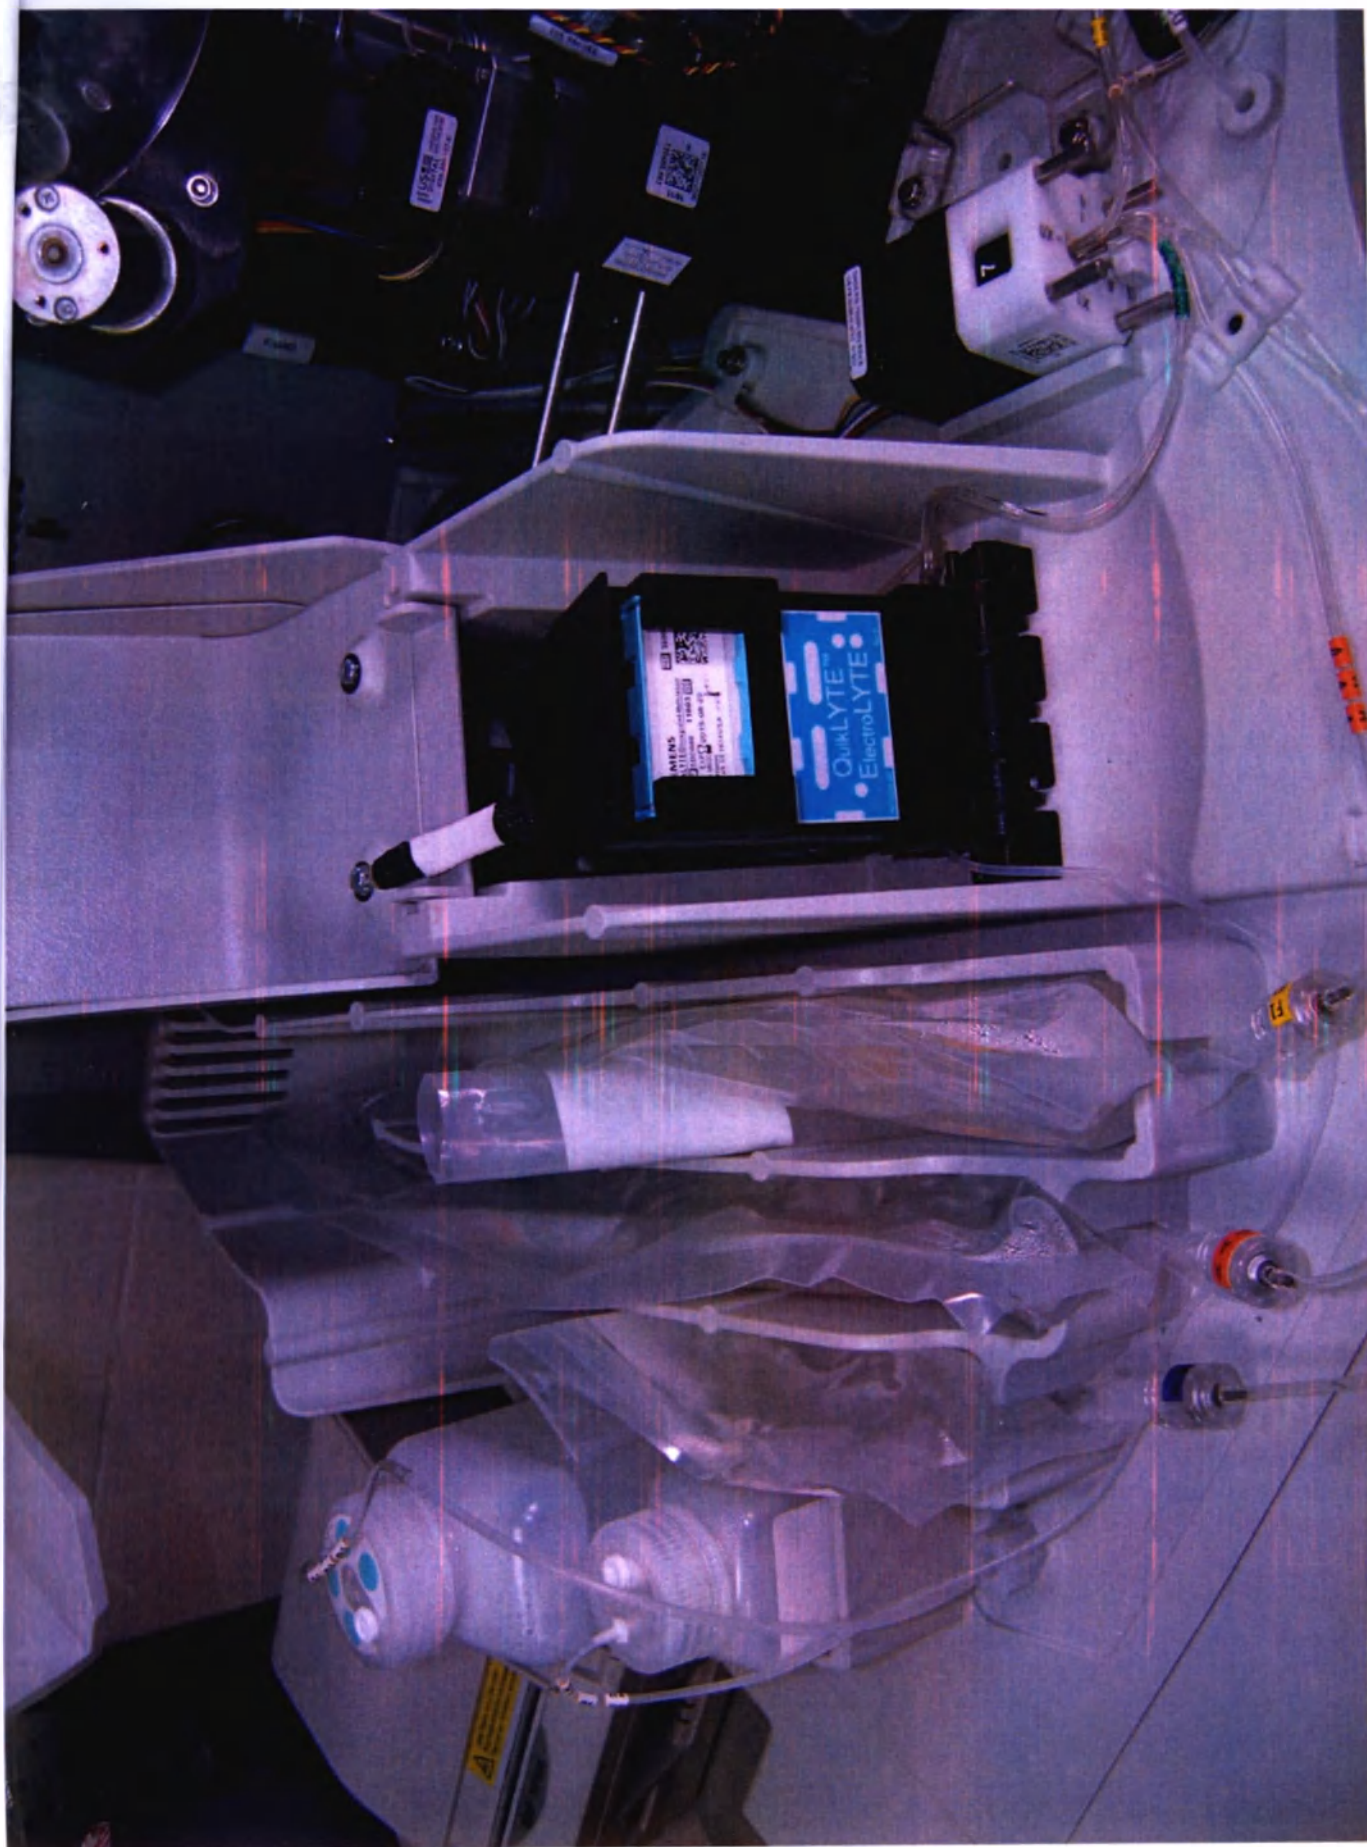


1 а). Область IMT (модуль интегрированного многосенсорного датчика (Integrated Multisensor Technology Module)). Общий вид, открытый.




2. Модуль LOCI (модуль гомогенного иммунологического анализа).

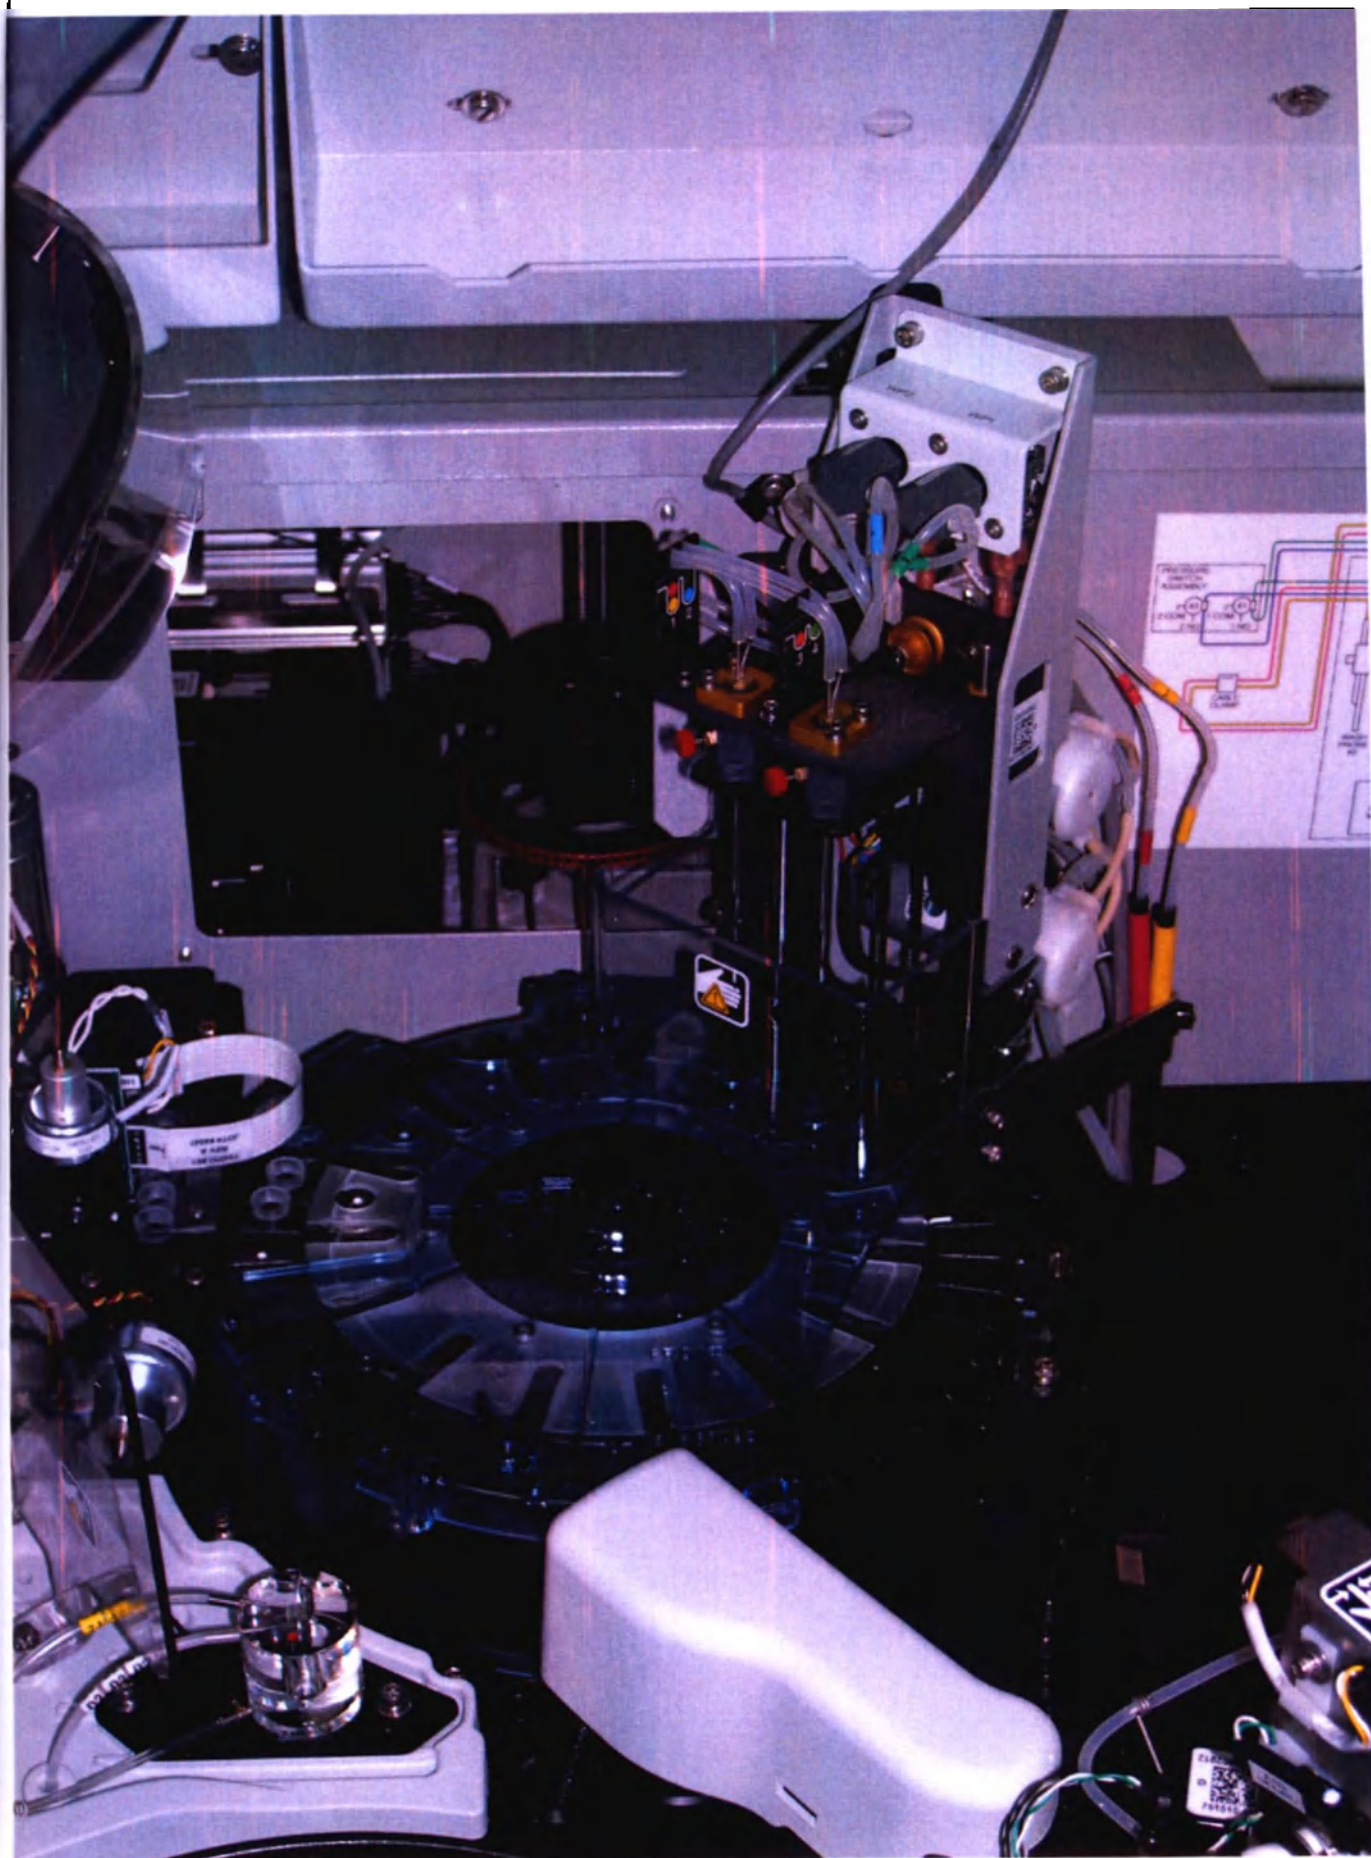


3. Область ГИА (модуль гетерогенного иммунологического анализа (Heterogeneous Immunoassay Module)).

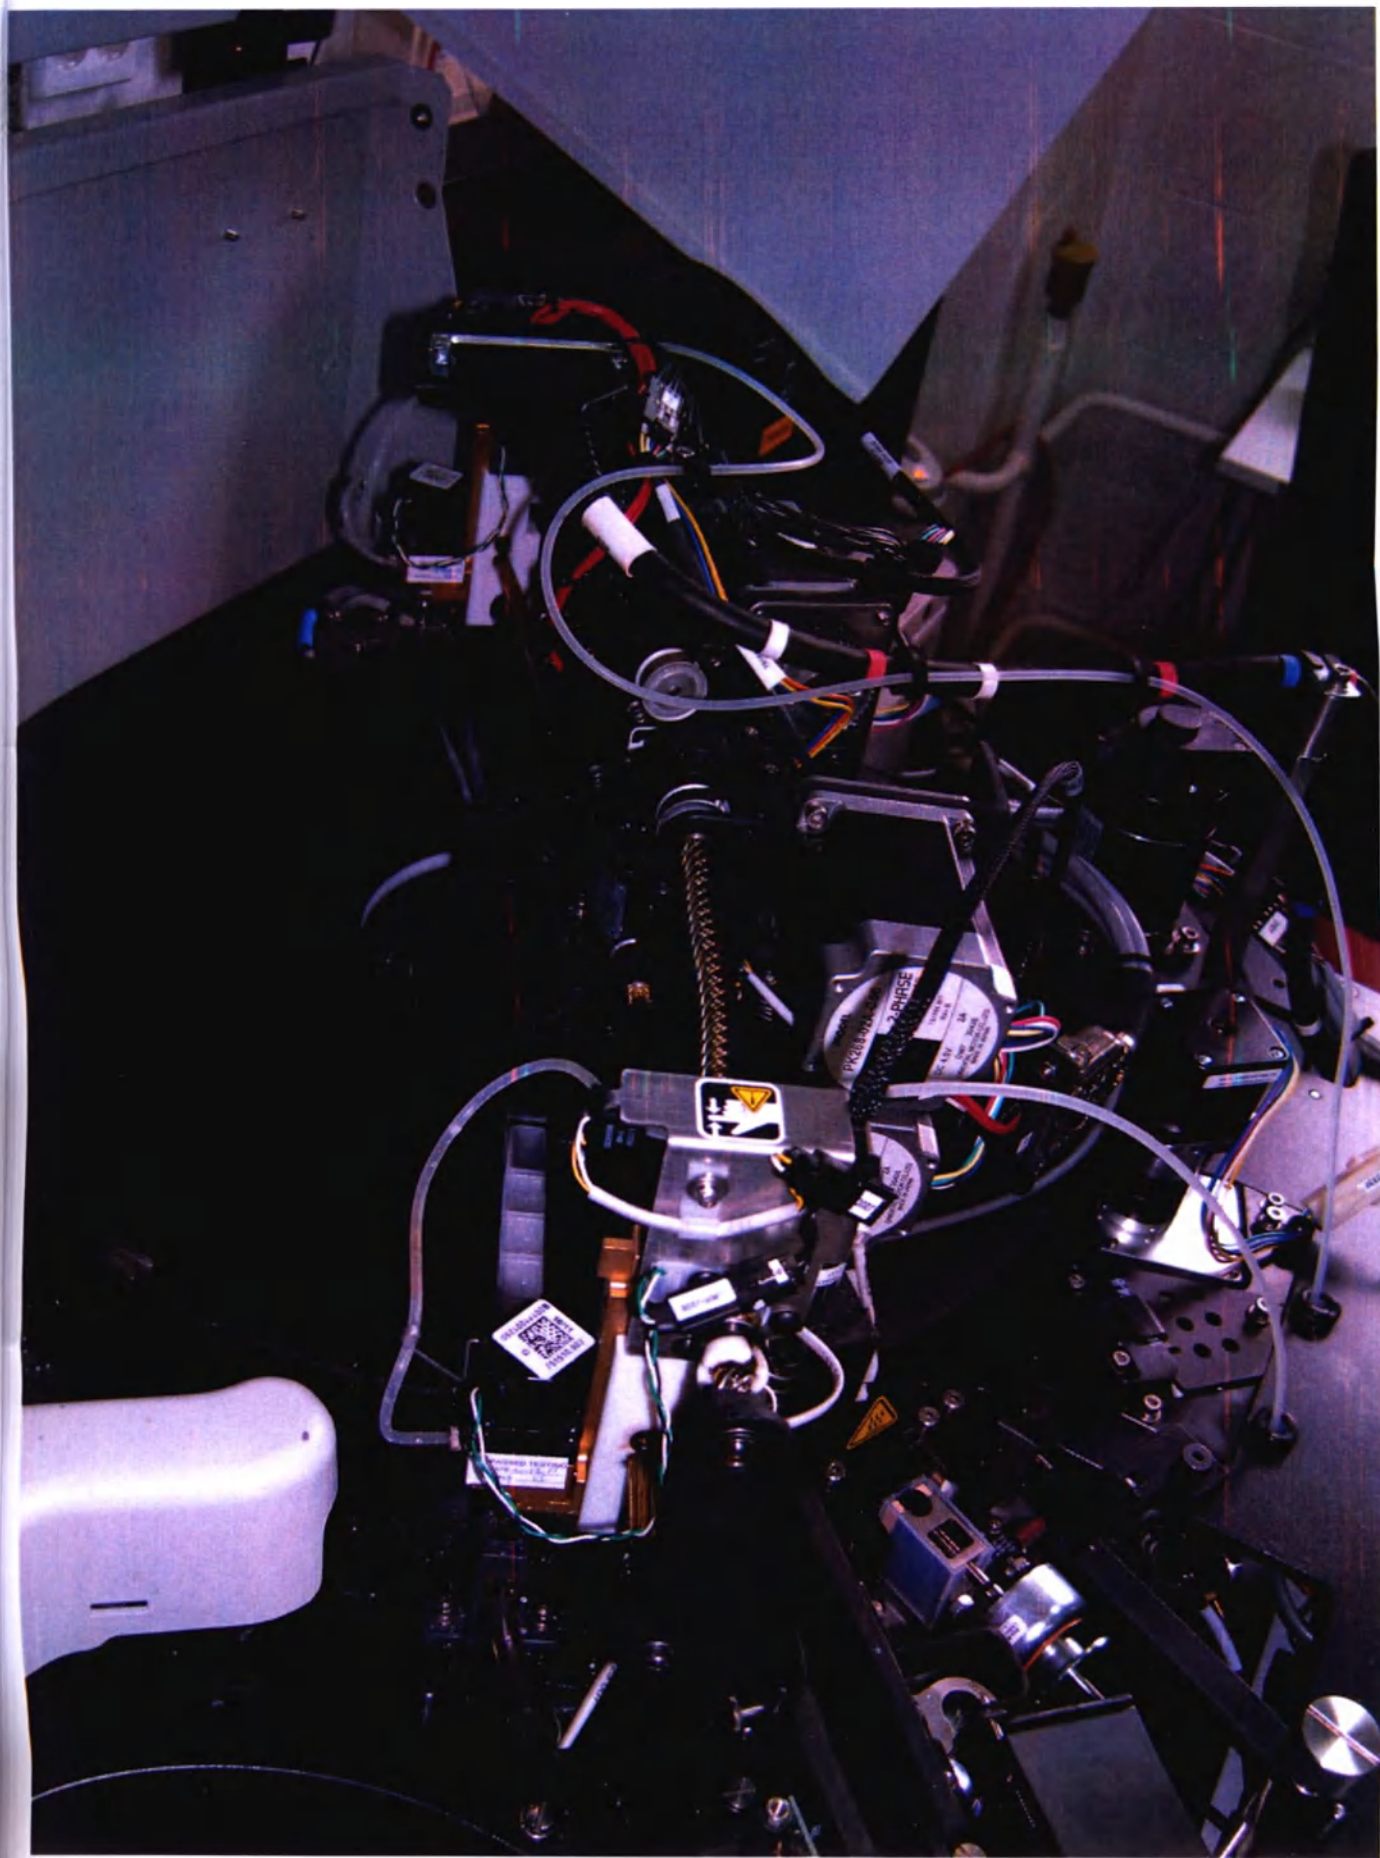


4. Модуль дозаторов реагентов. Общий вид.

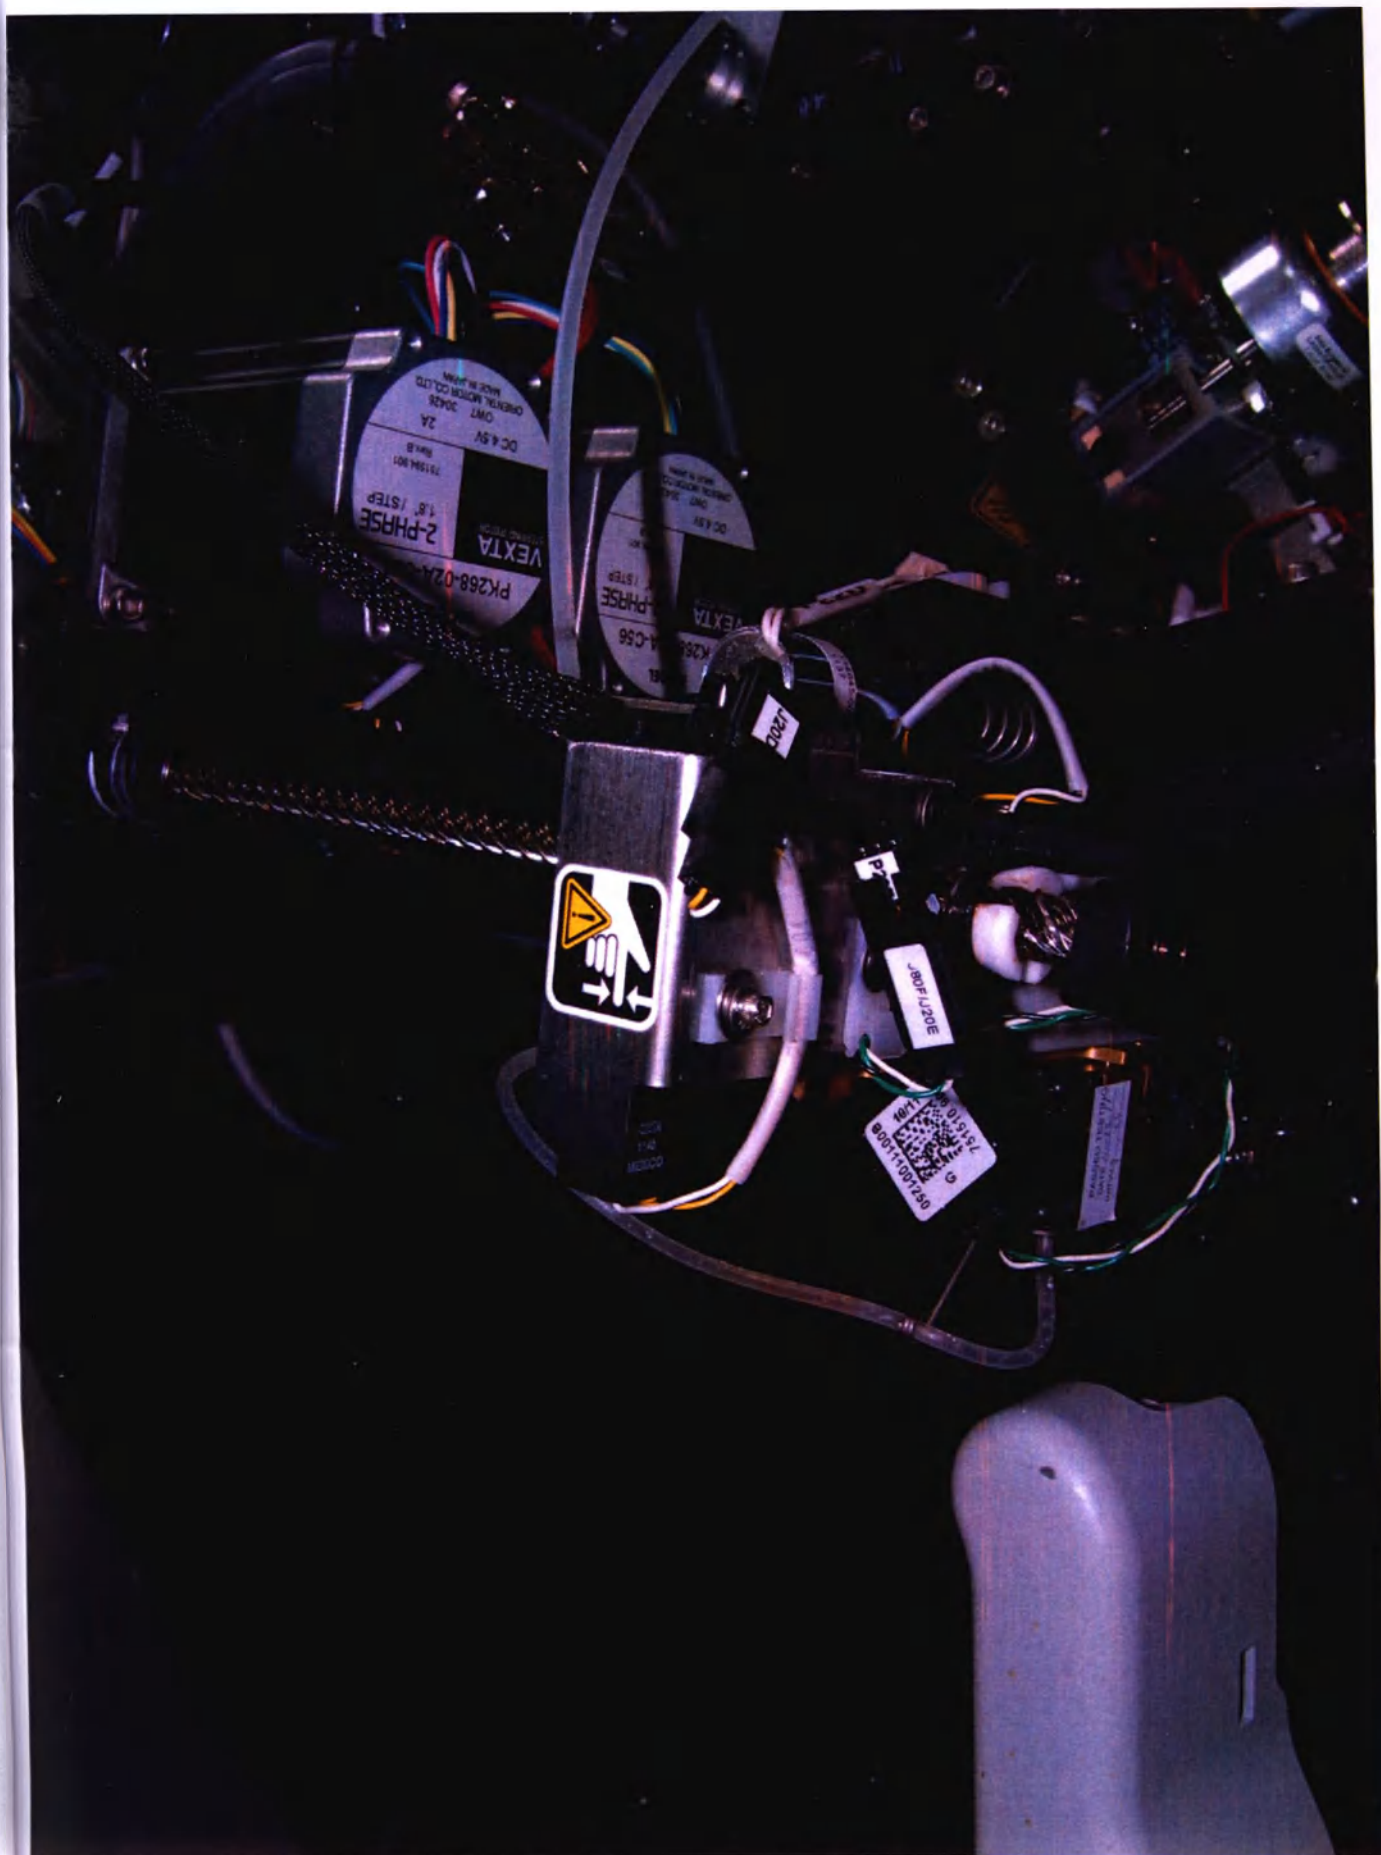

4.1. Модуль дозаторов реагентов. Вид при увеличении.

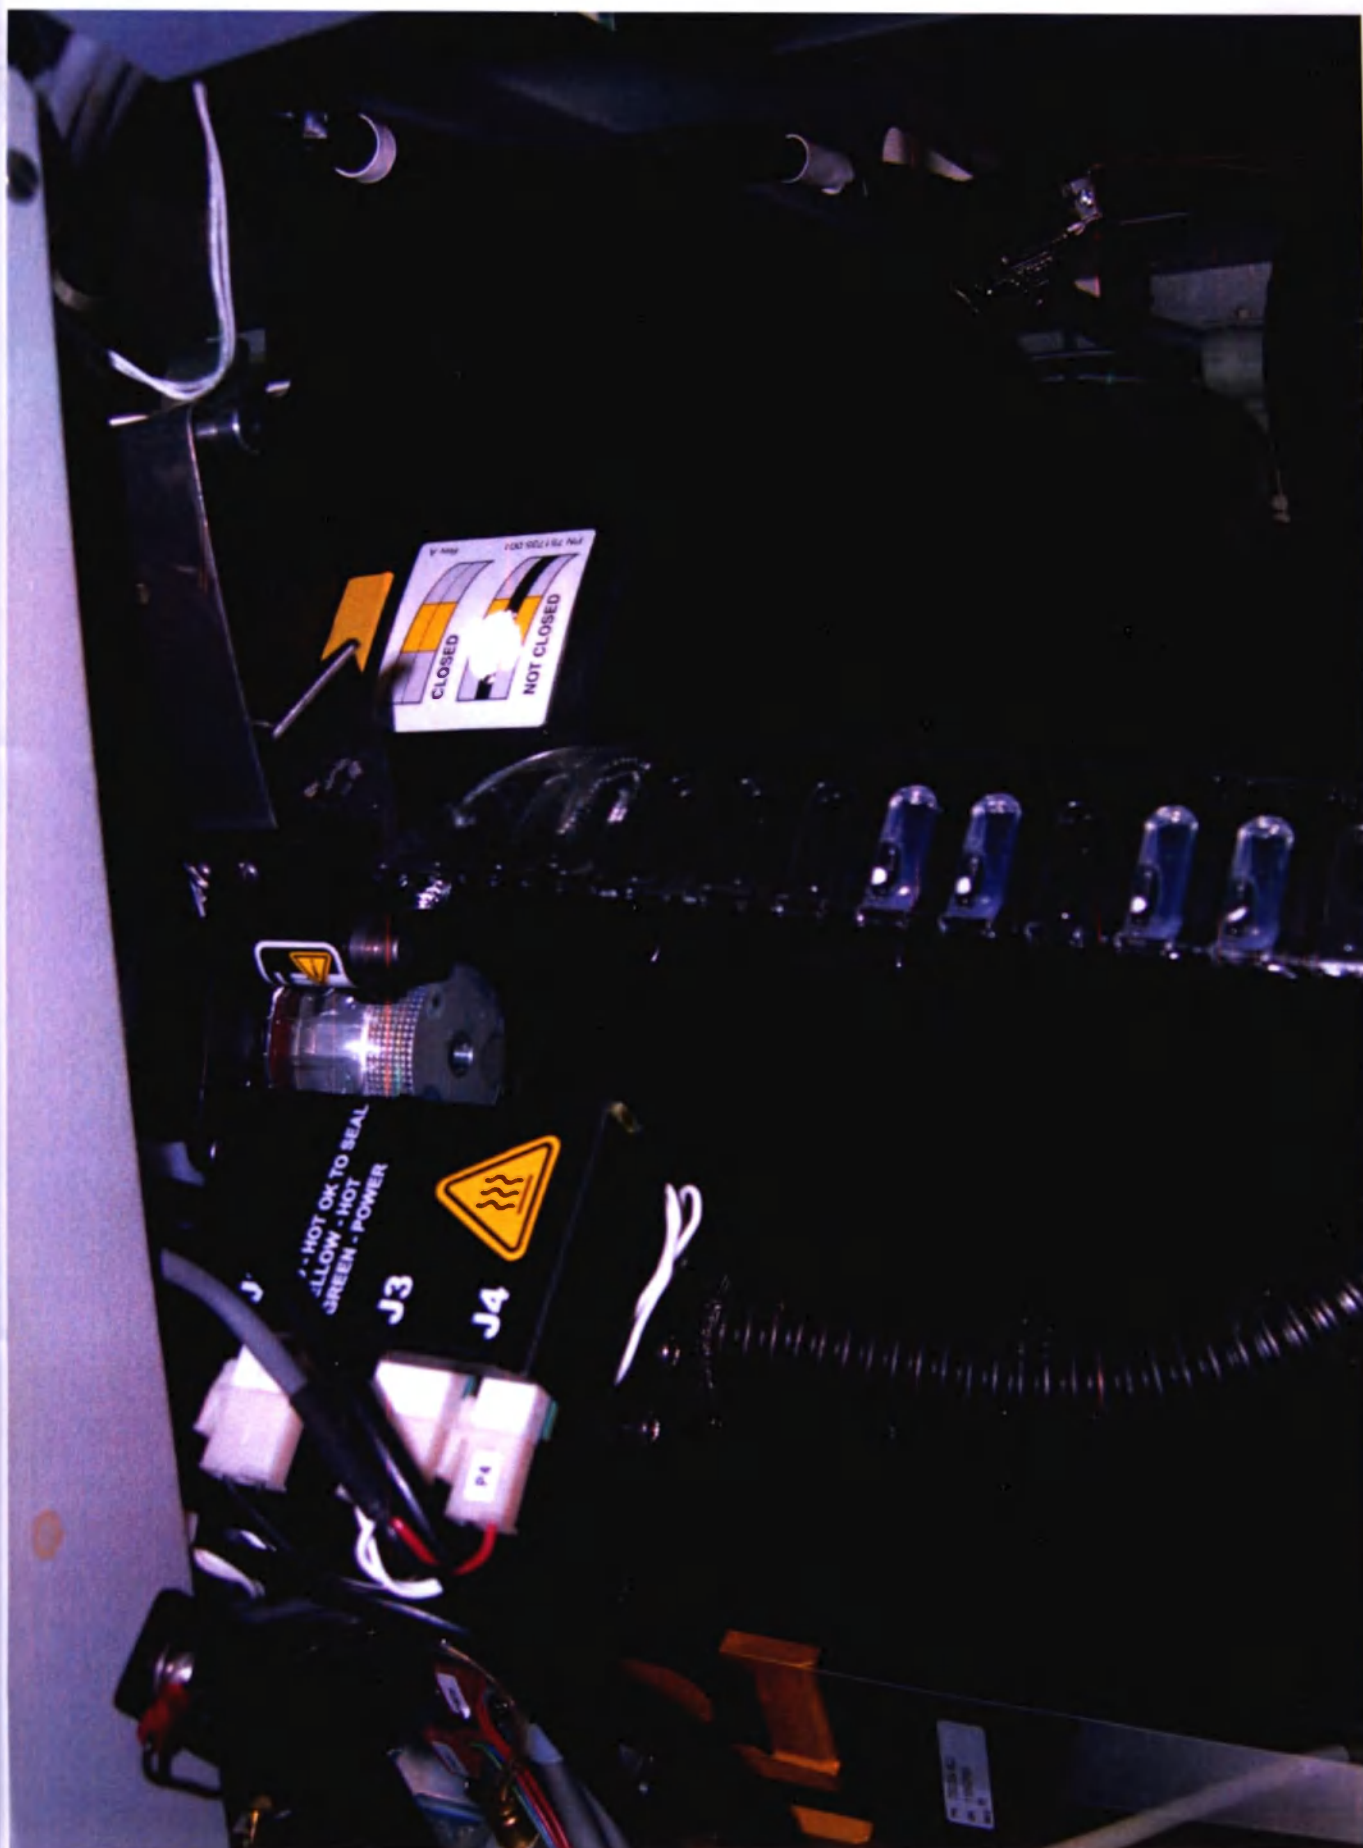


5. Область тепловой камеры.

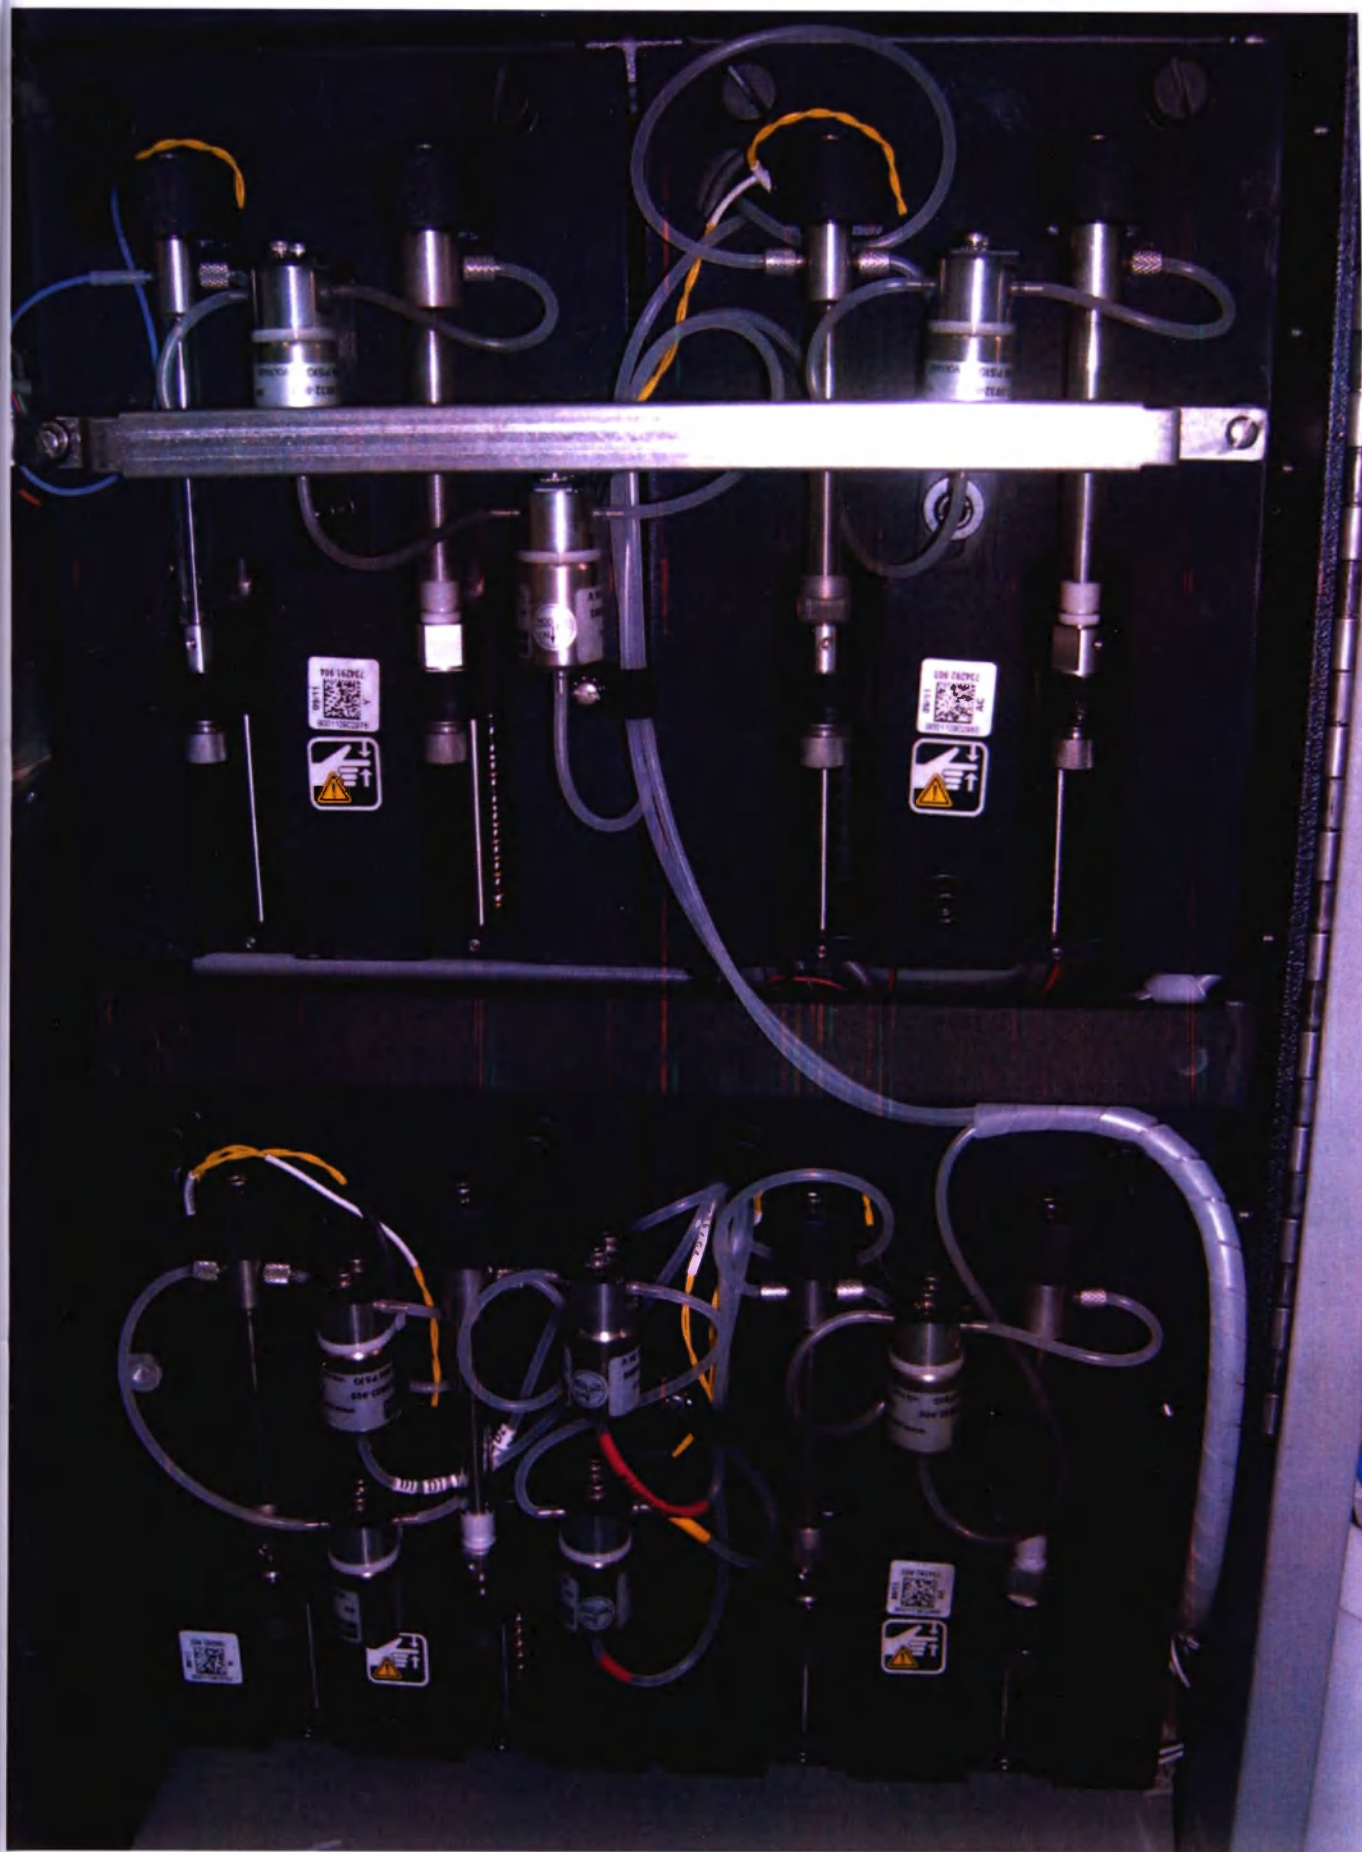


6. Панель насоса.




7. Контейнер для отработанных кювет.

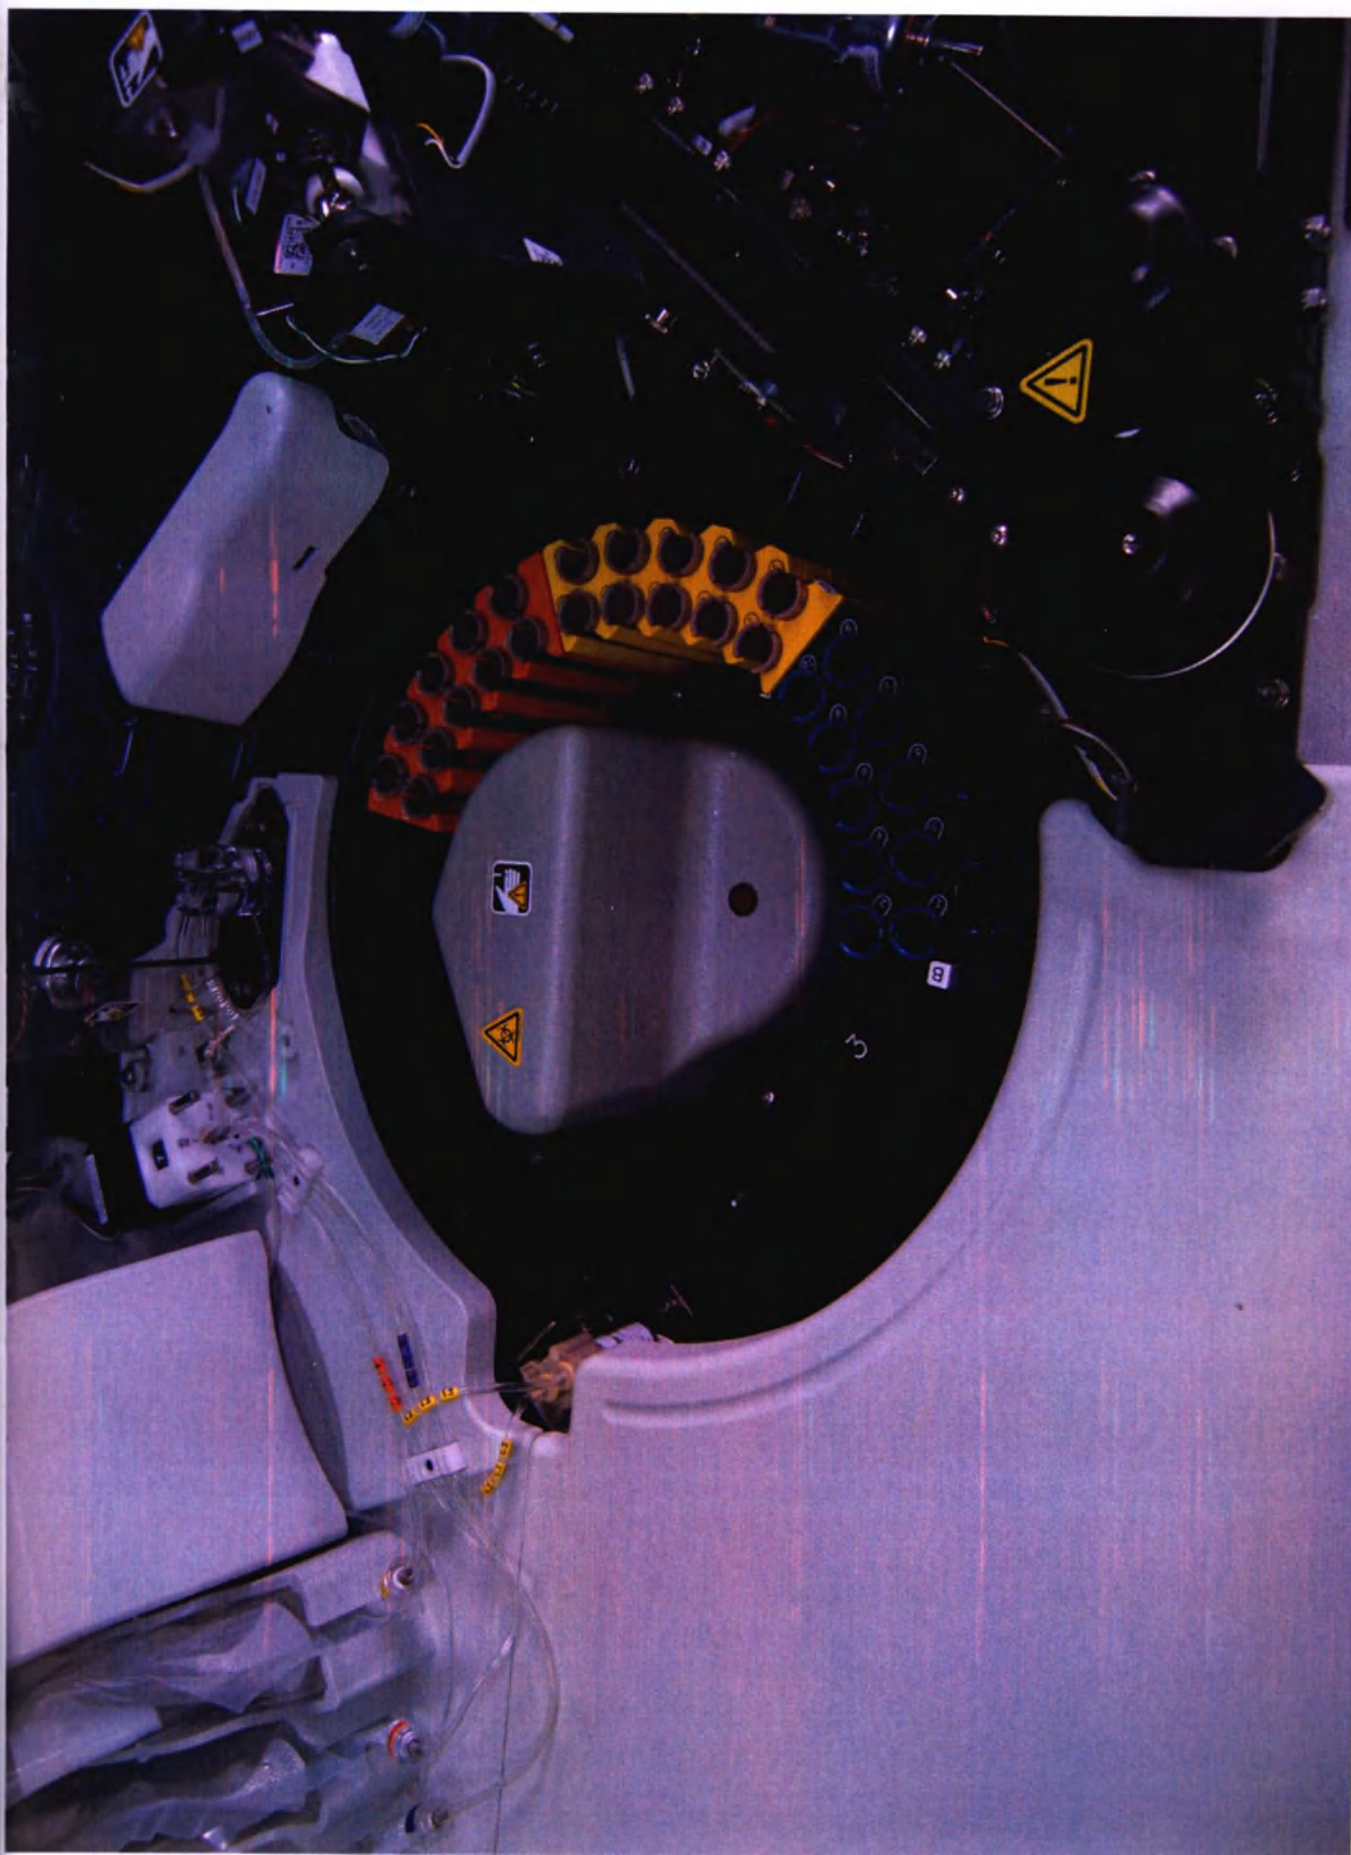


8. Загрузчик реагентных картриджей Flex.

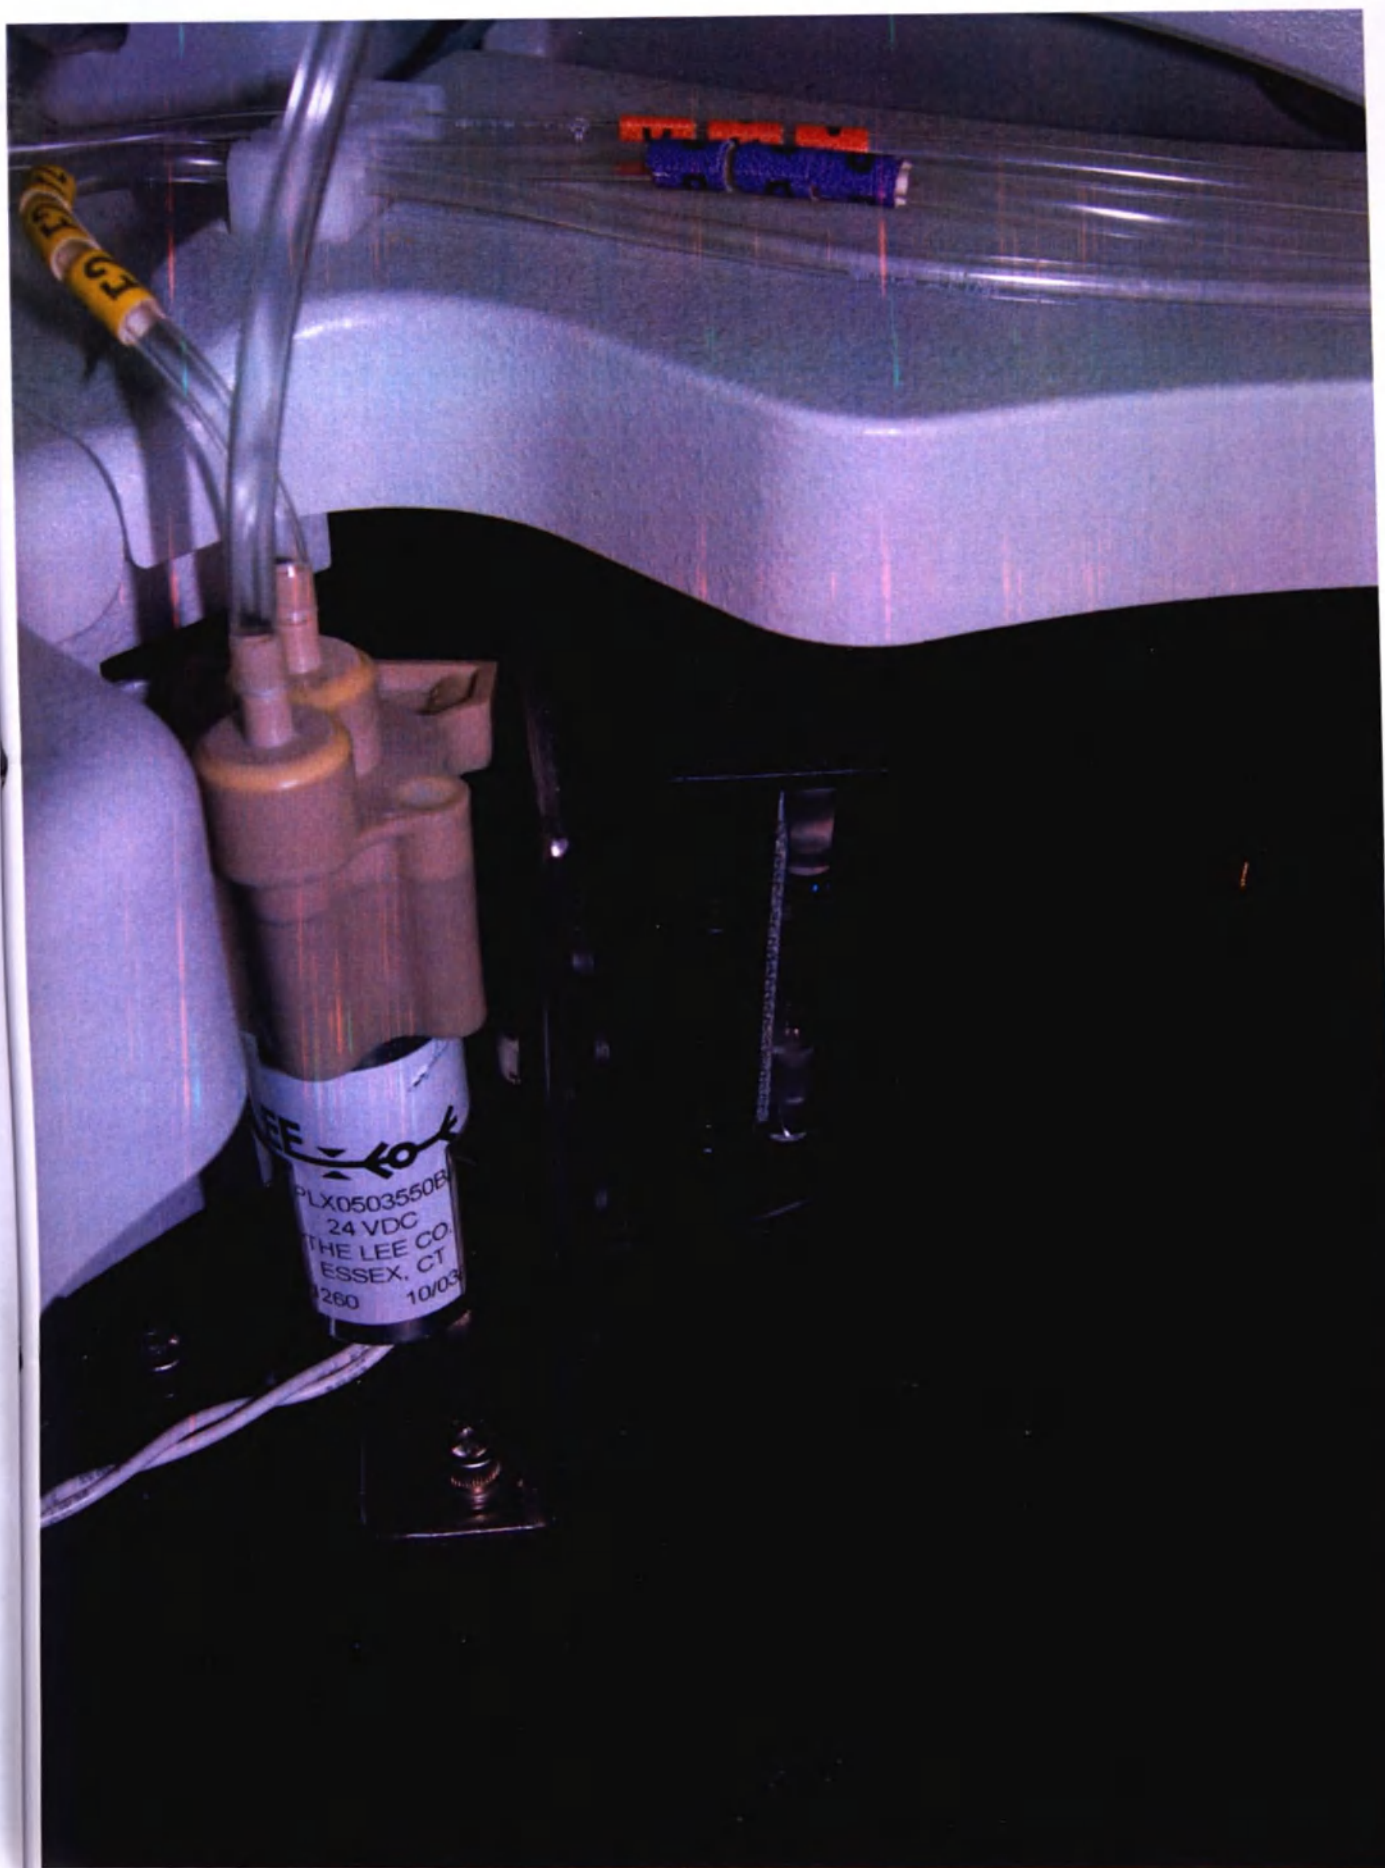


9. Сканер штрих-кодов внутренний.

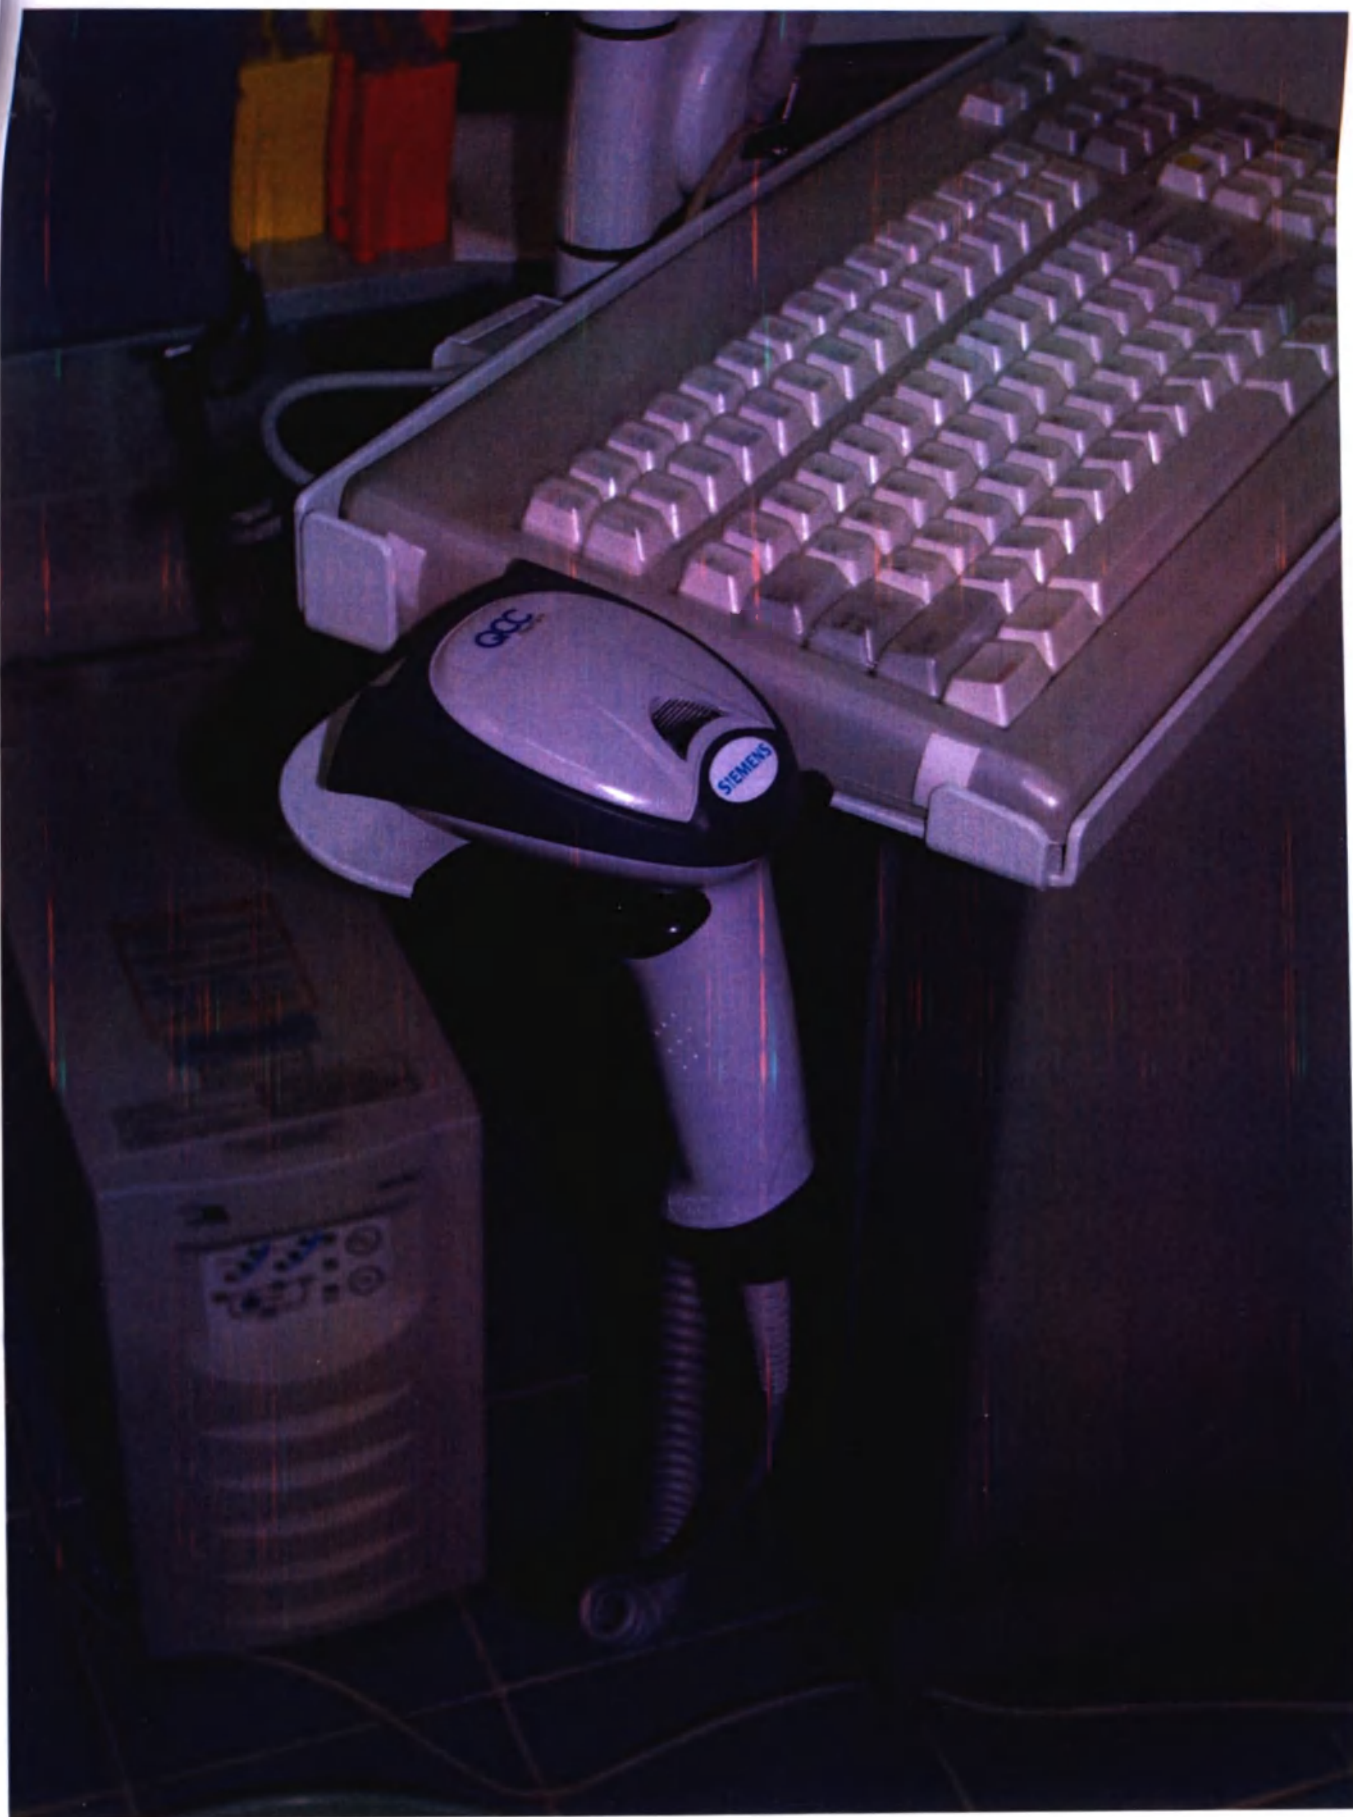


10. Сканер штрих-кодов внешний. Общий вид.

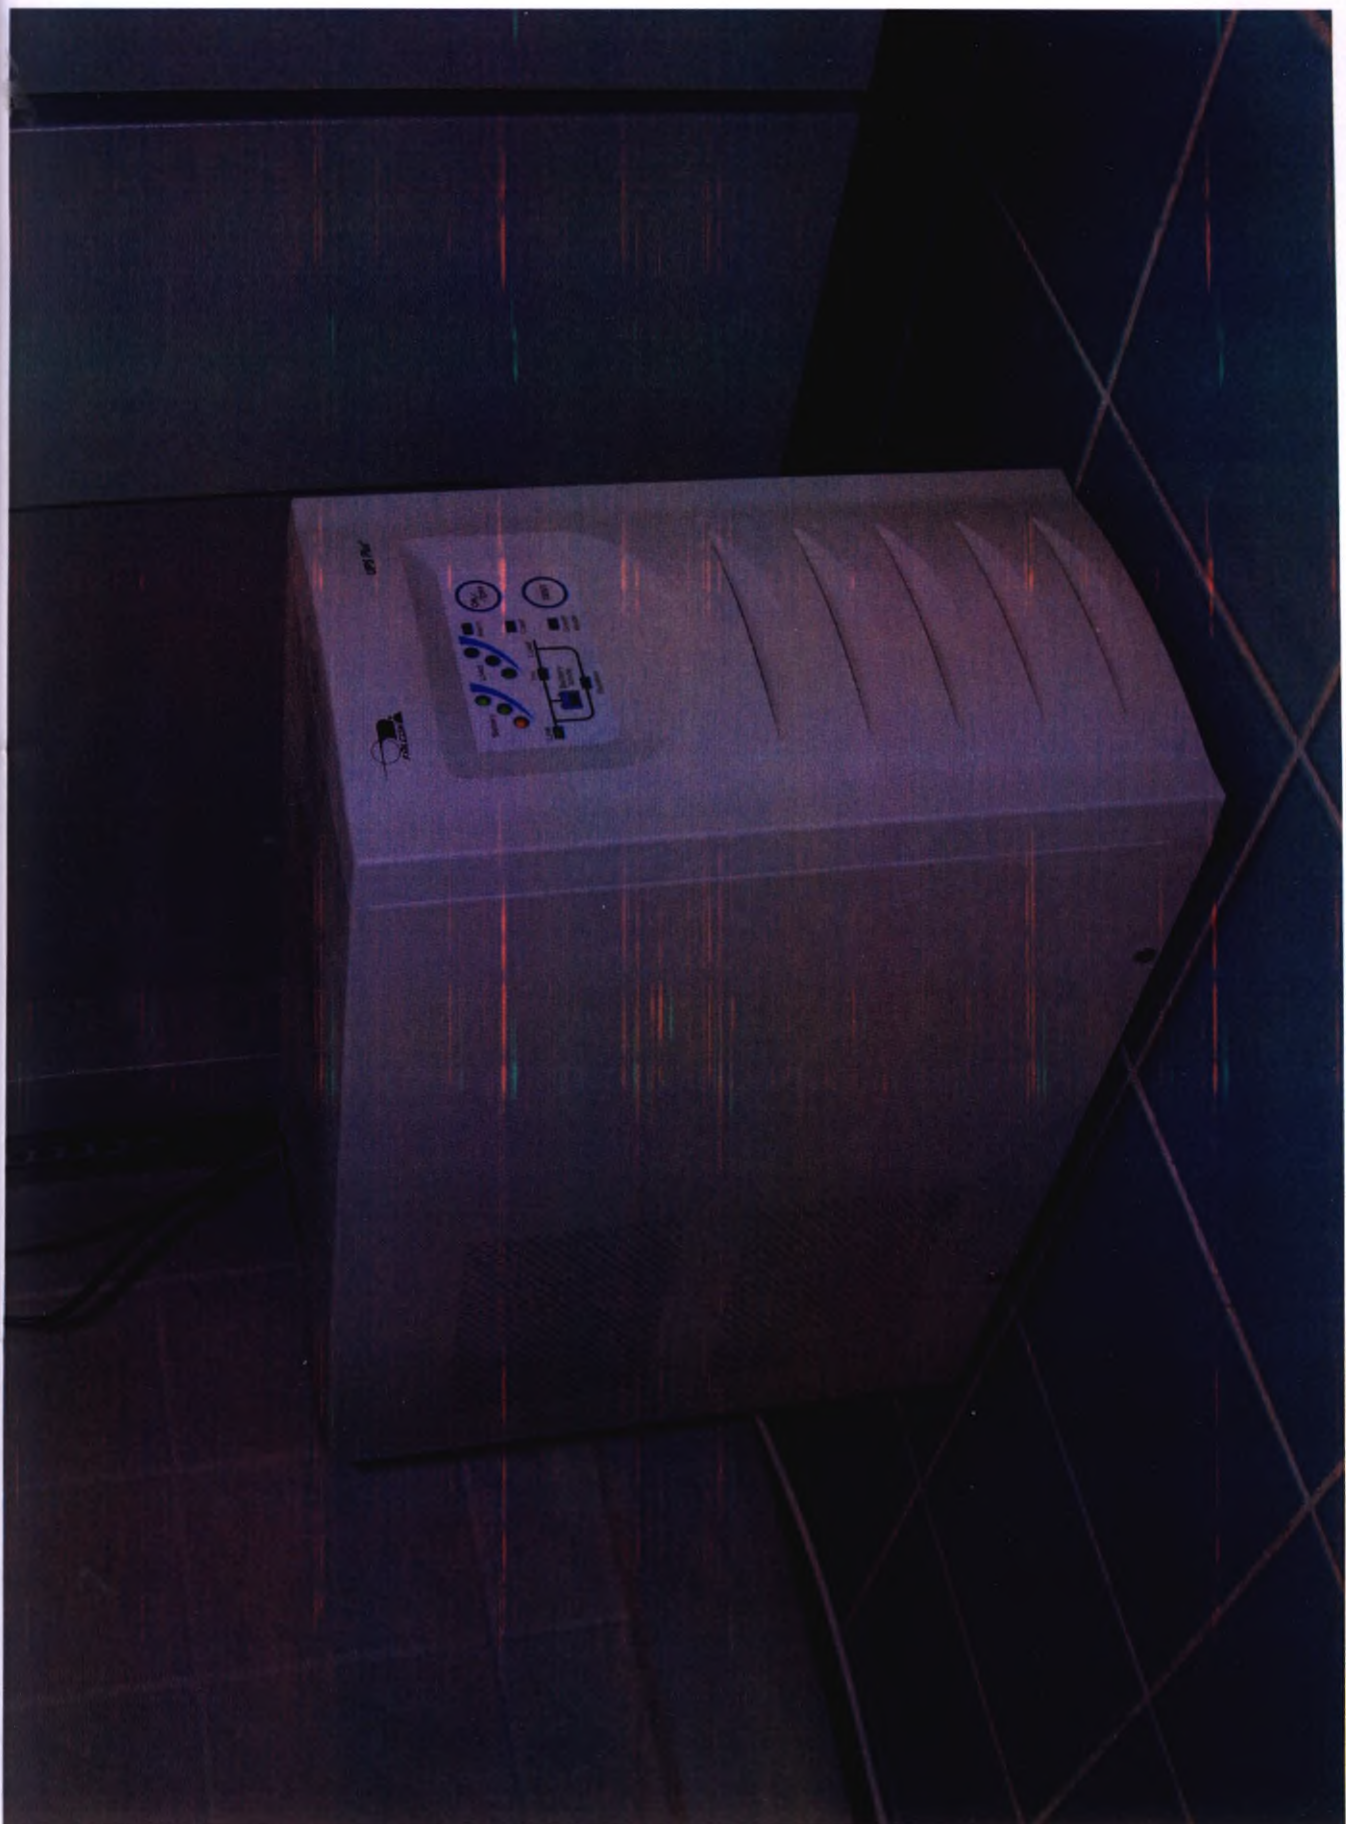

11. Источник бесперебойного питания.

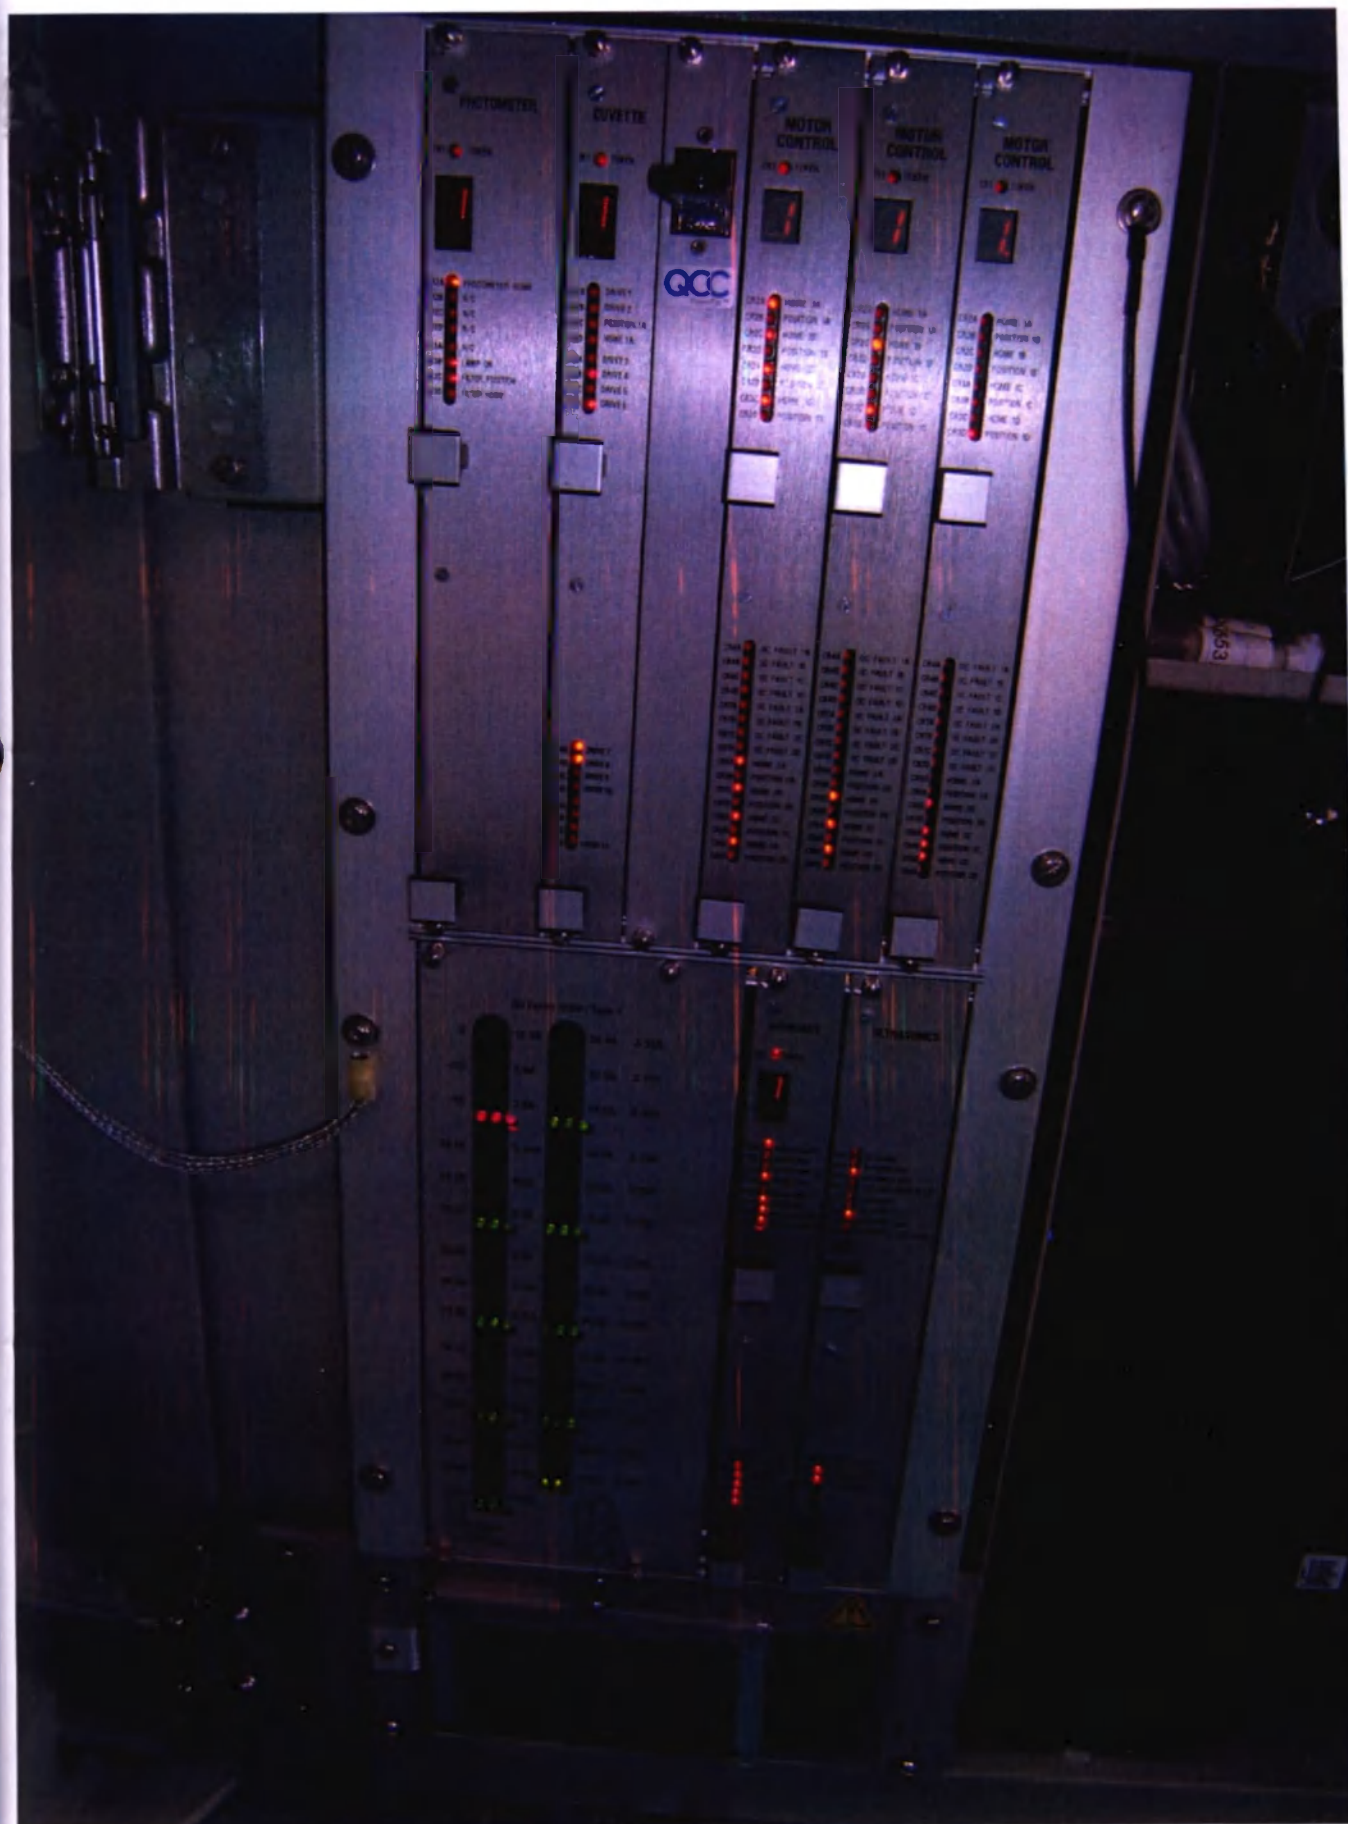


12. Блок платы управления.

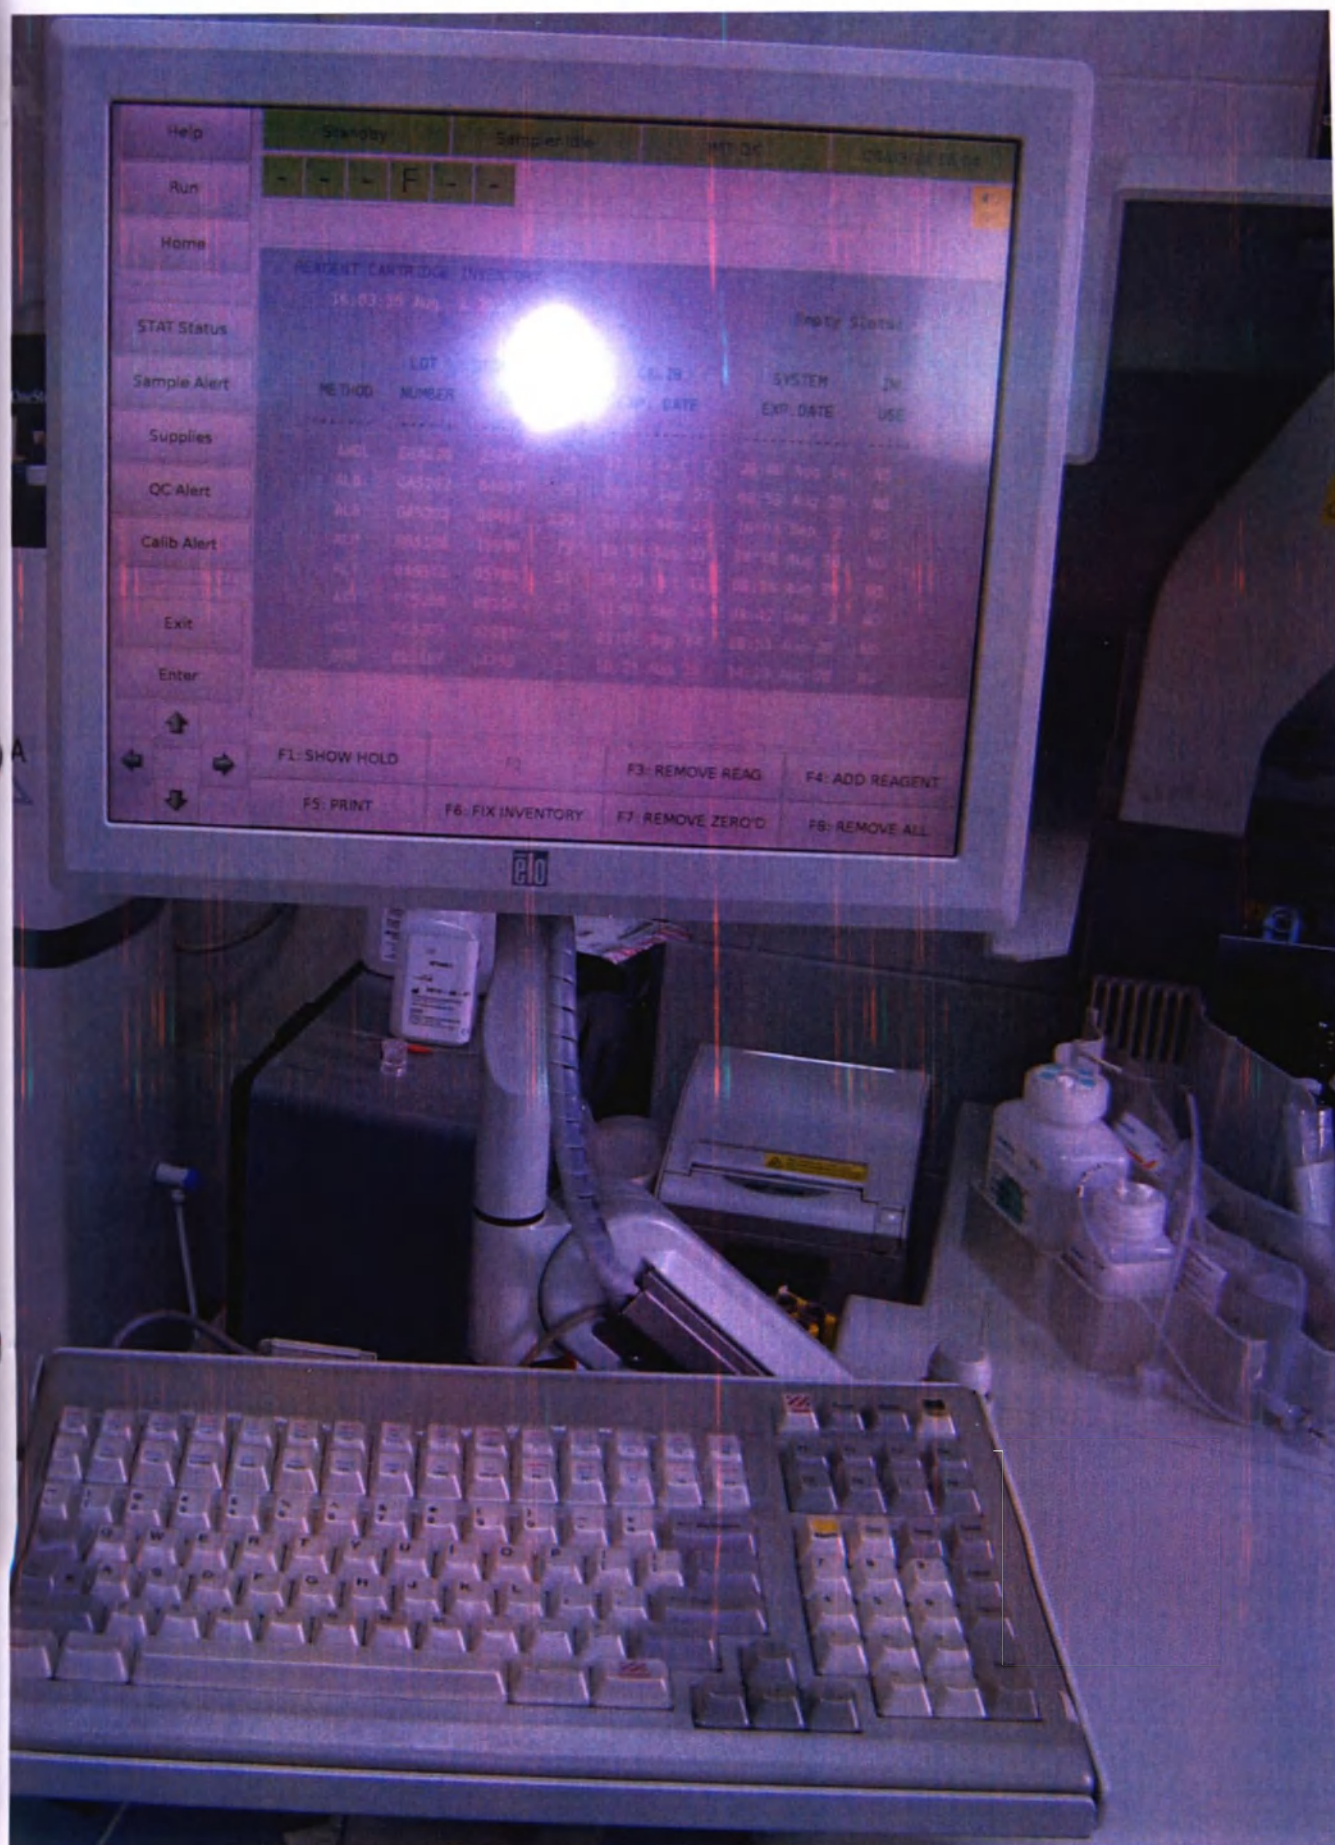

13. Сенсорный экран. Вид спереди.



13.1. Сенсорный экран. Вид сзади.

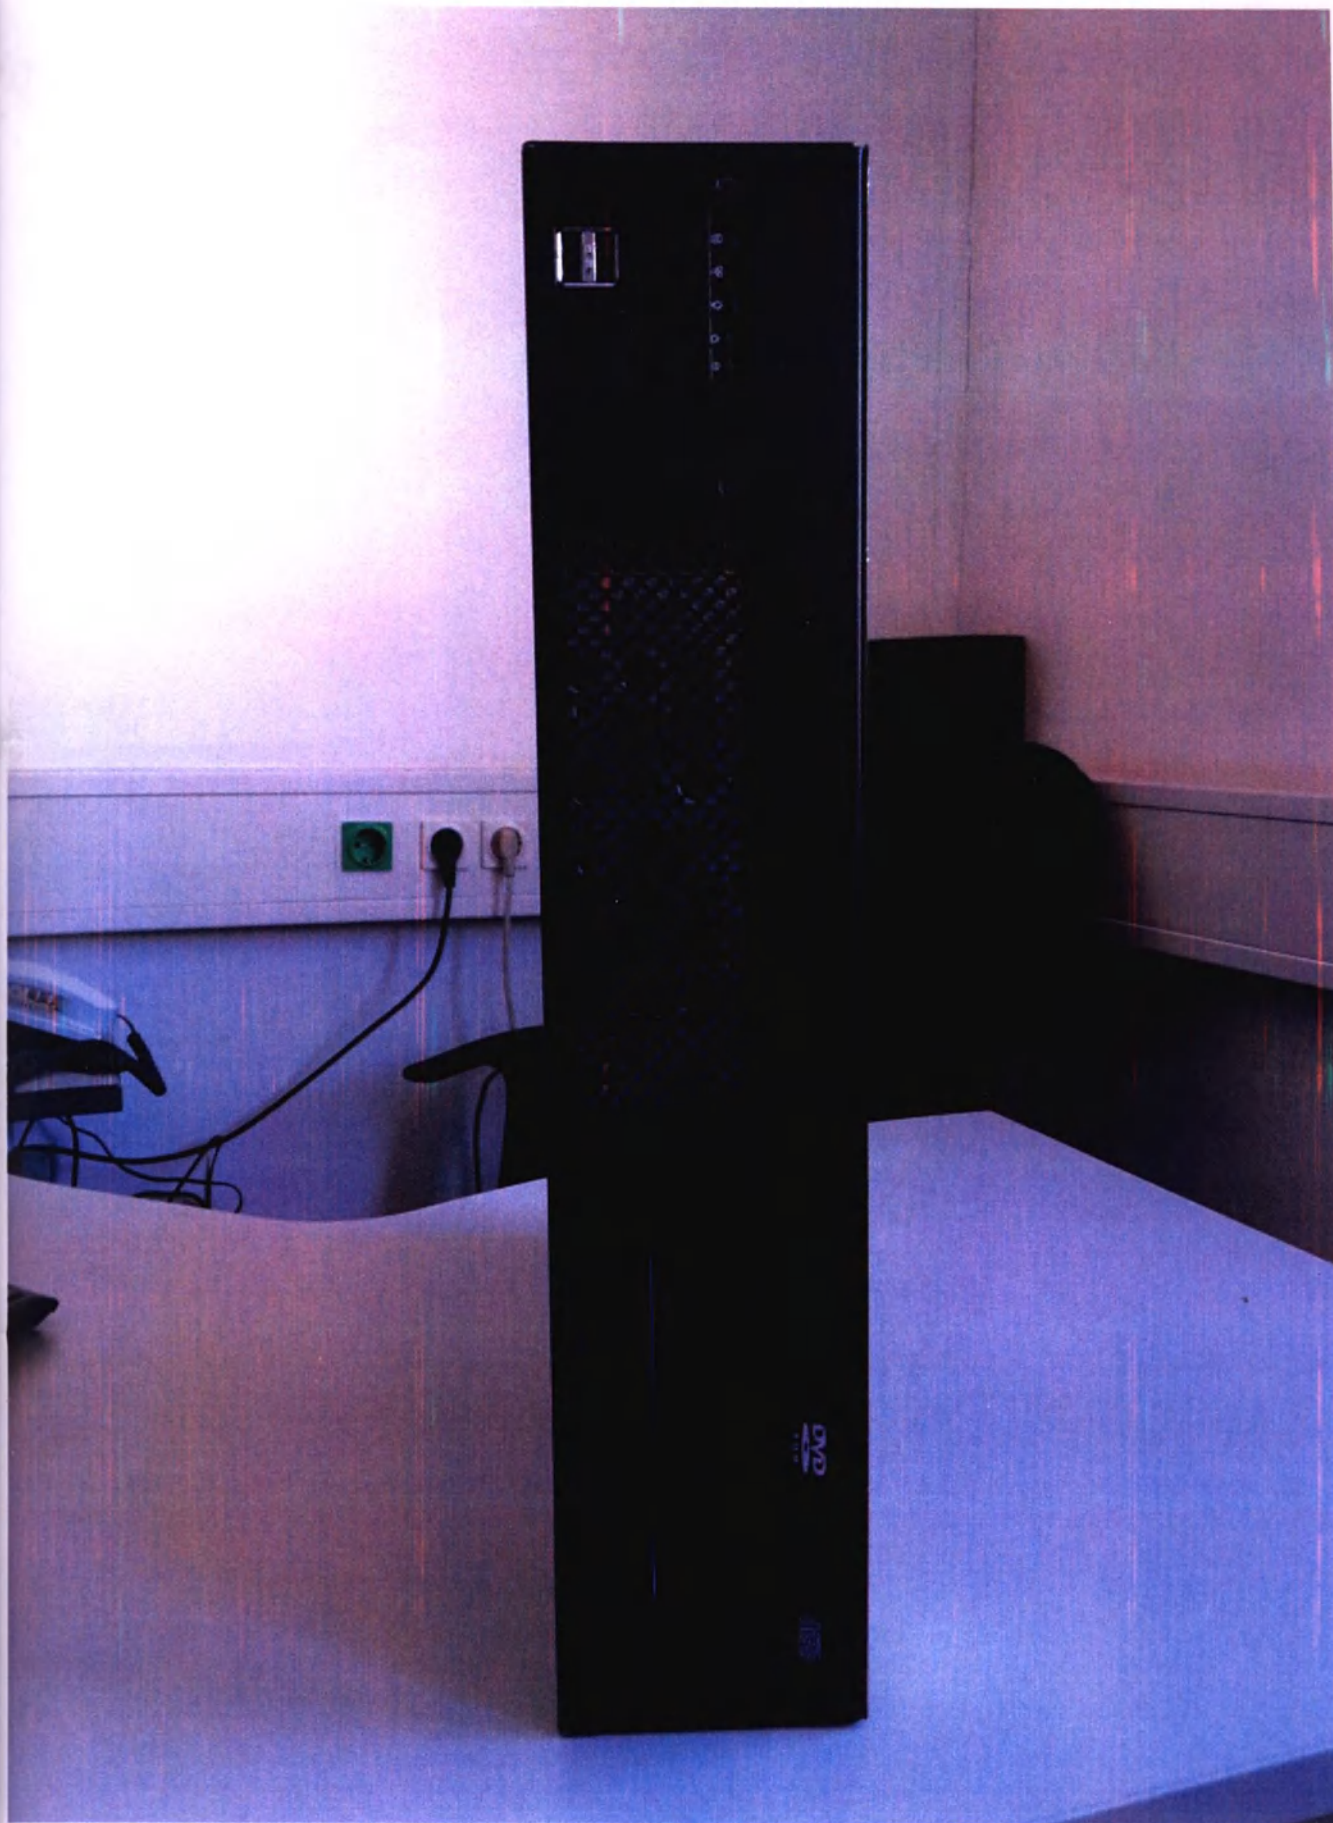

14. Компьютер. Вид спереди.



14.1. Компьютер. Вид сзади.

III. Принадлежности:



**Адаптер пробирок со
вставками**


1. Адаптер пробирок (со вставками) (Adapter, Modified, with Shelf)- 60 шт.



2. Адаптер пробирок (без вставок) (Adapter, Modified, no Shelf)- 60 шт.



1. Сегмент (Segment) - 12 шт.

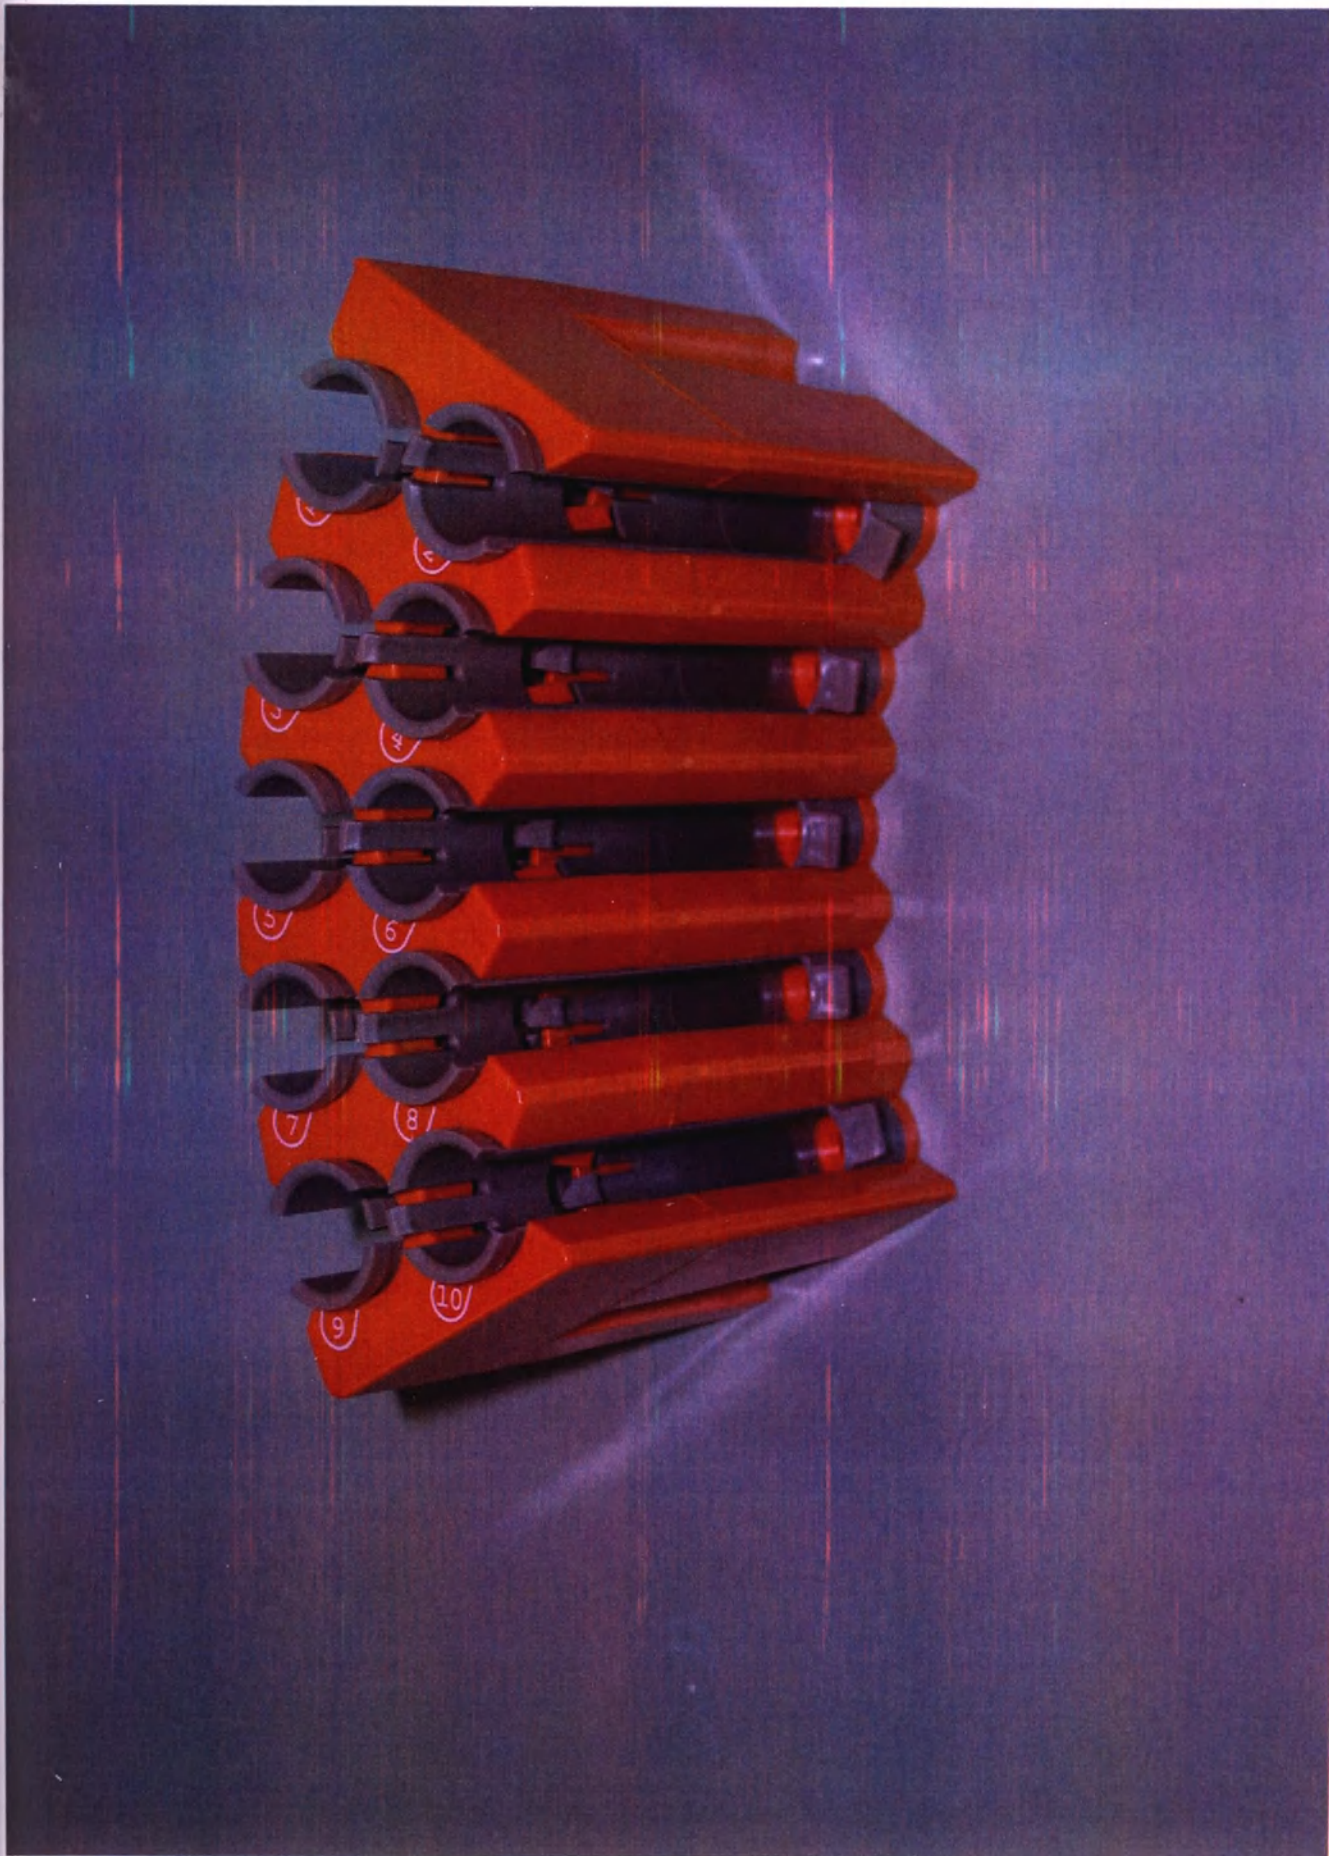

4. Сегмент (цветной) (Color Segment Kit) - 3 шт.



41. Сегмент (цветной) (Color Segment Kit) - 3 шт.



5. Картридж с плёнкой для кювет (Cuvette cartridge).



Анализатор автоматический биохимический Dimension ExL with LM.




1. Область IMT (модуль интегрированного многосенсорного датчика (Integrated Multisensor Technology Module)). Общий вид, закрытый.




1.1. Область IMT (модуль интегрированного многосенсорного датчика (Integrated Multisensor Technology Module)). Общий вид, открытый.



2. Модуль LOCI (модуль гомогенного иммунологического анализа). Общий вид.

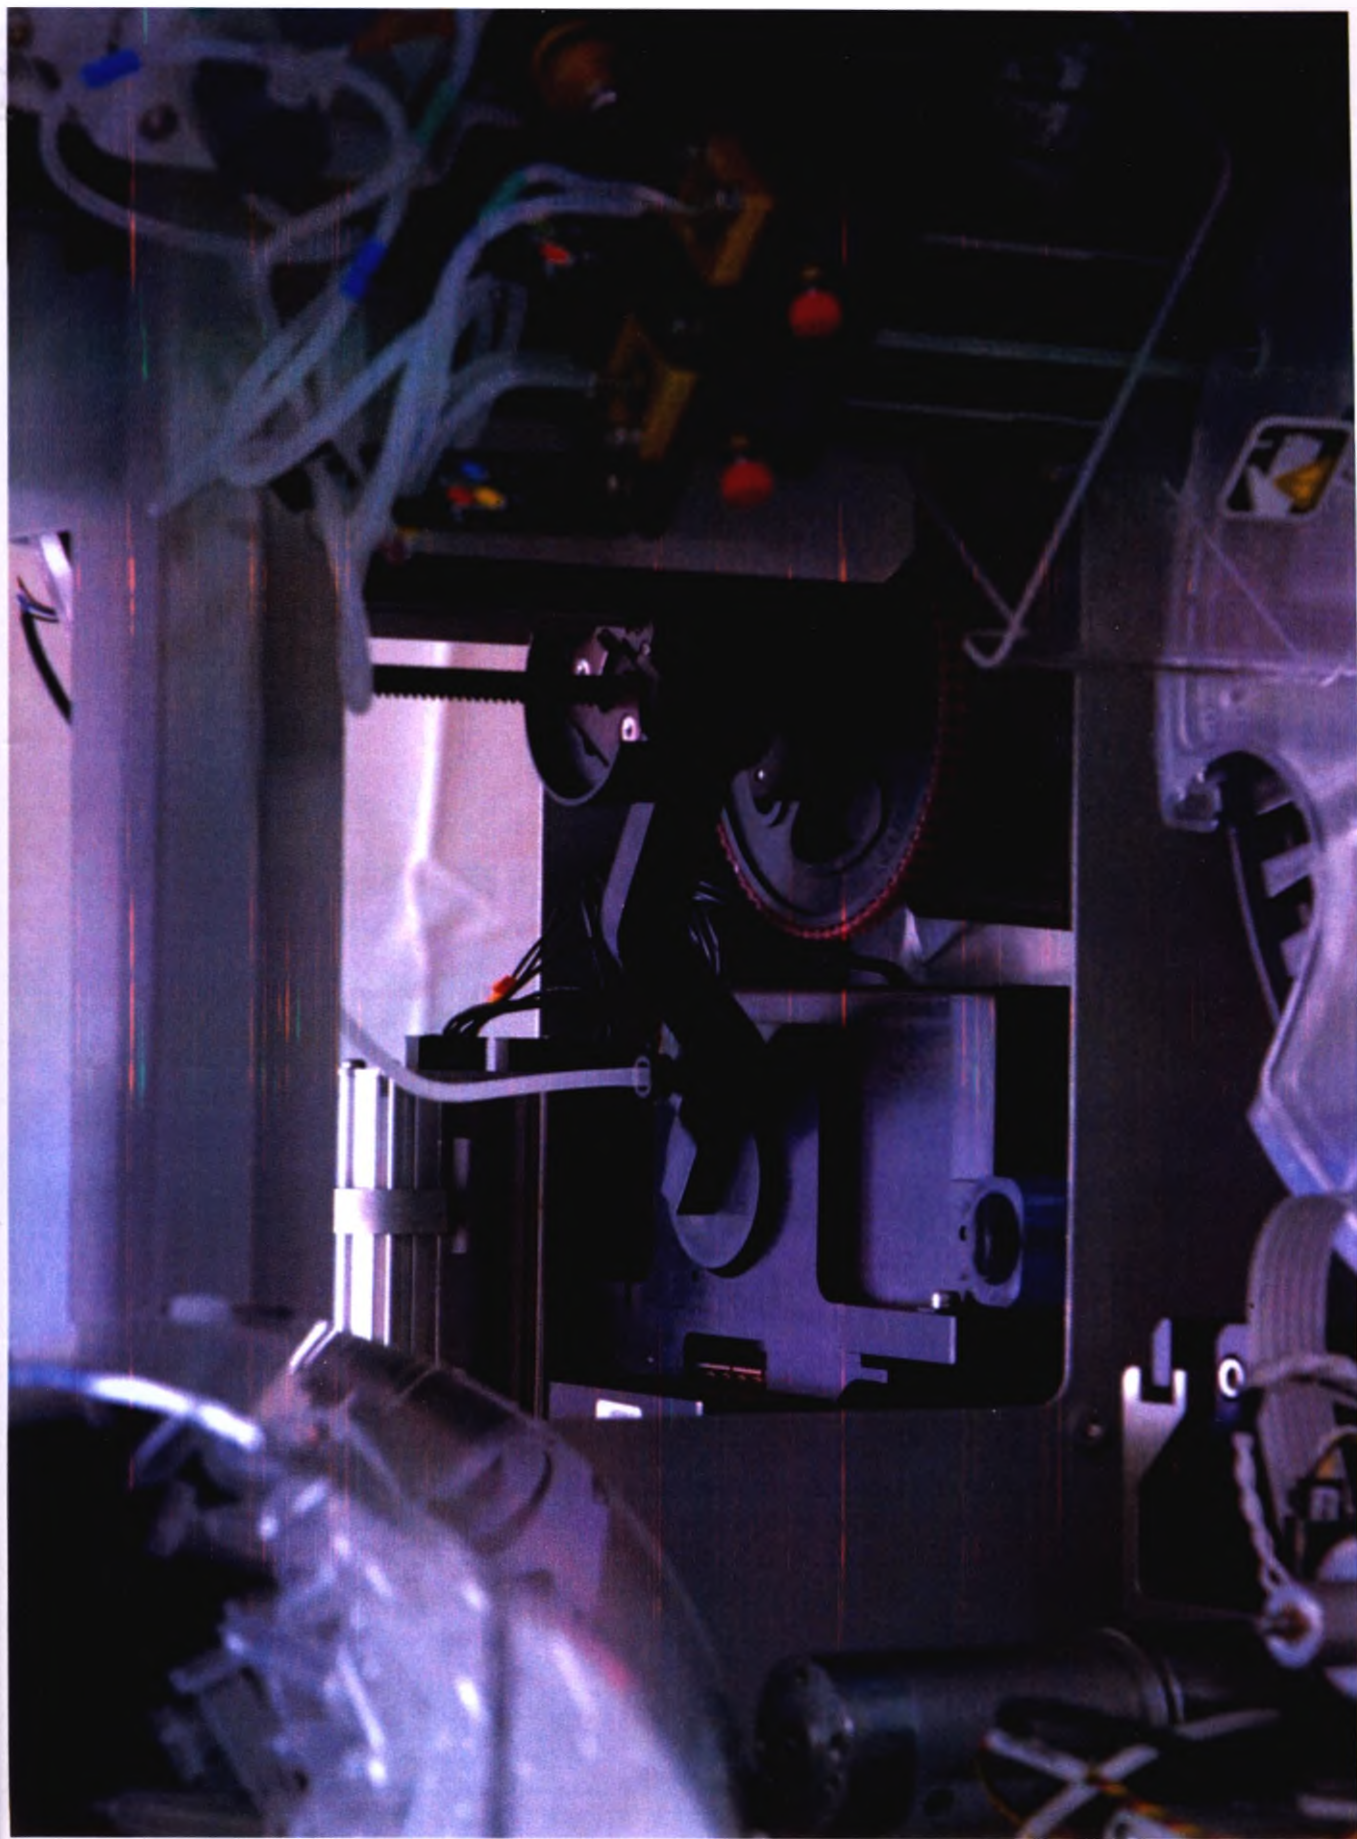


3. Модуль LOCI (модуль гомогенного иммунологического анализа). Вид изнутри.

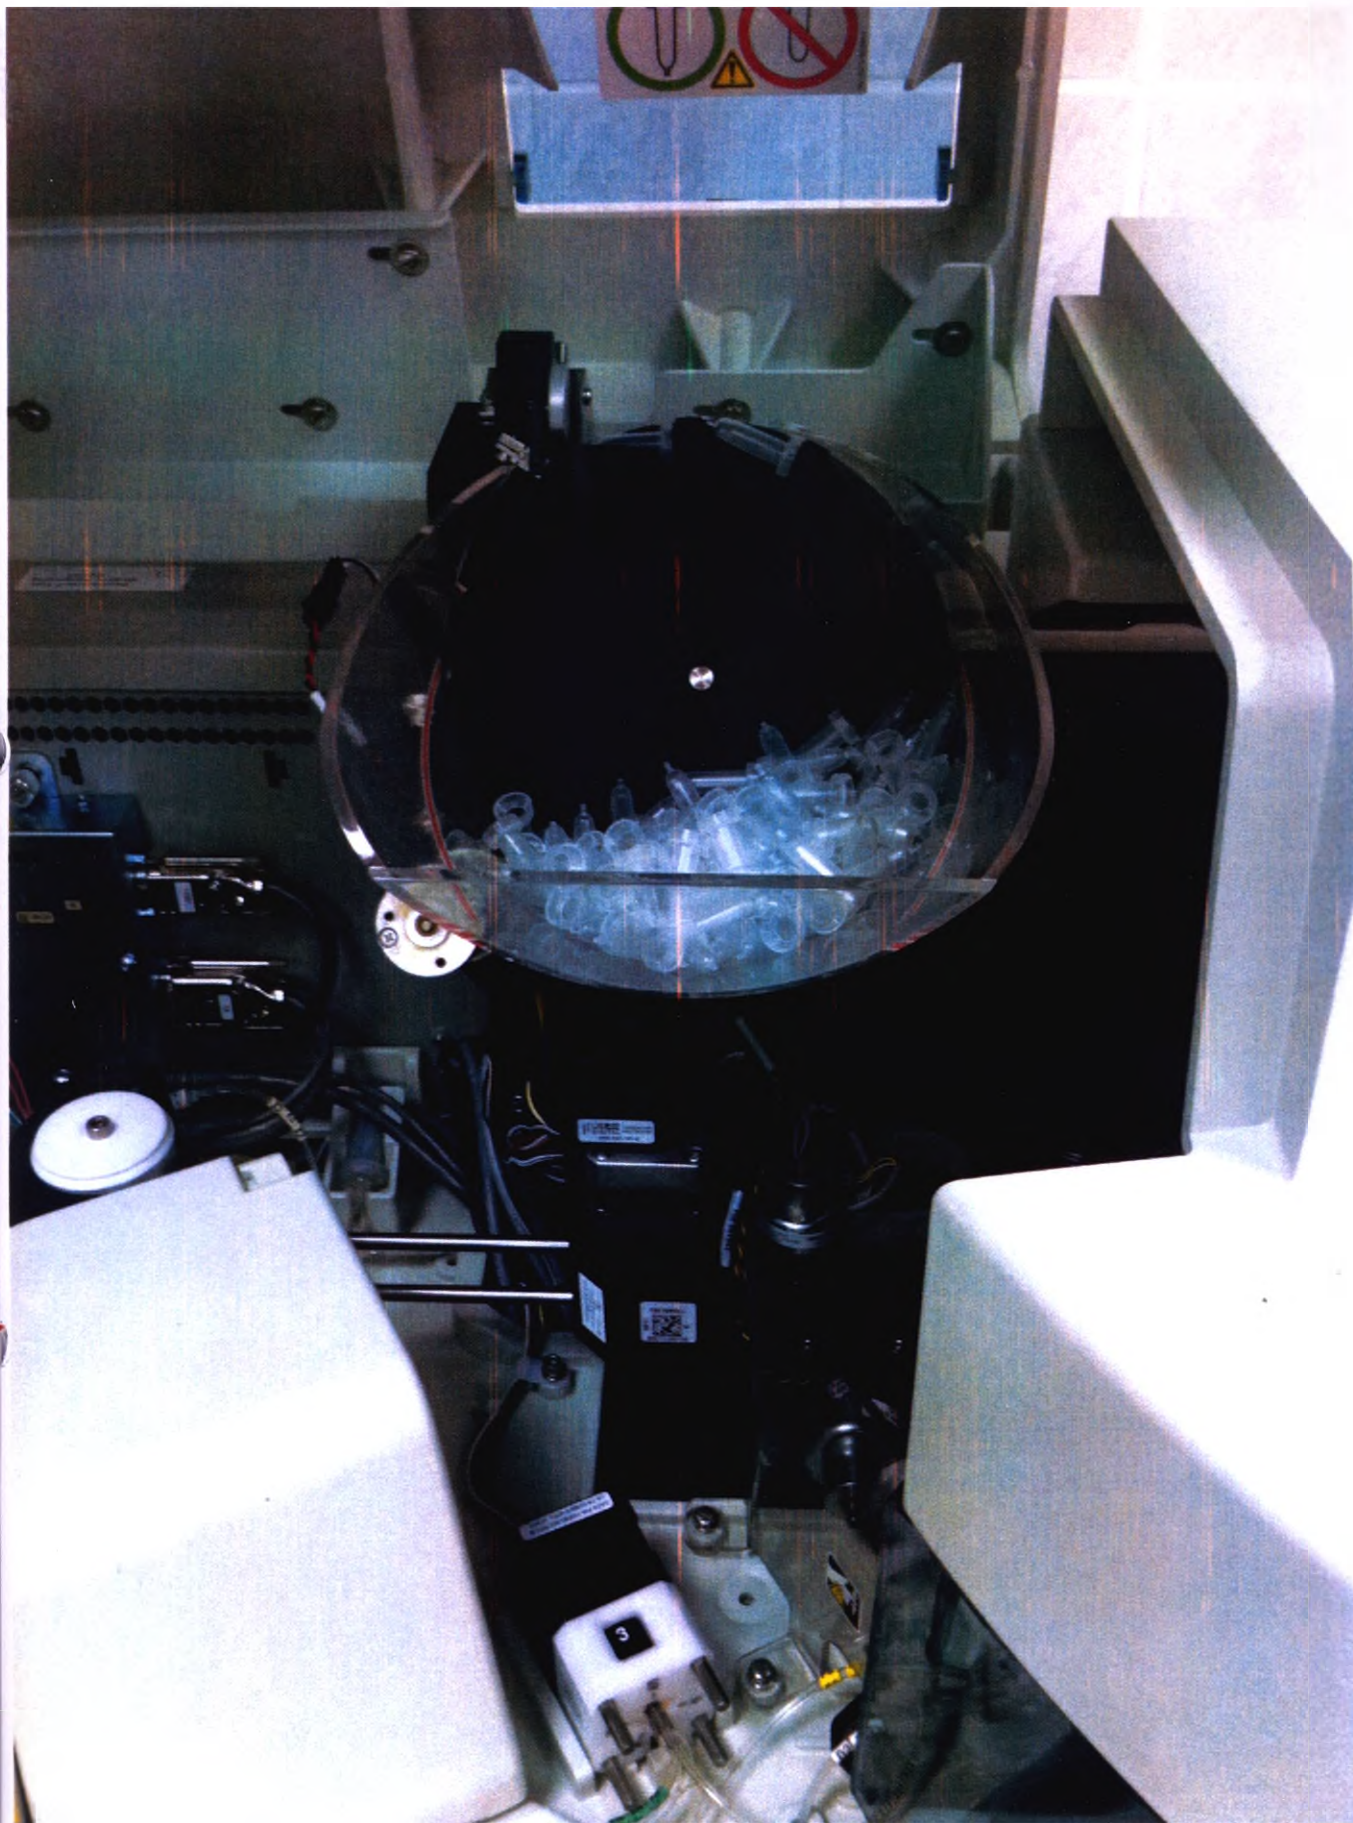


3.1. Область ГИА (модуль гетерогенного иммунологического анализа (Heterogeneous Immunoassay Module)).




3.2. Область ГИА (модуль гетерогенного иммунологического анализа (Heterogeneous Immunoassay Module)).

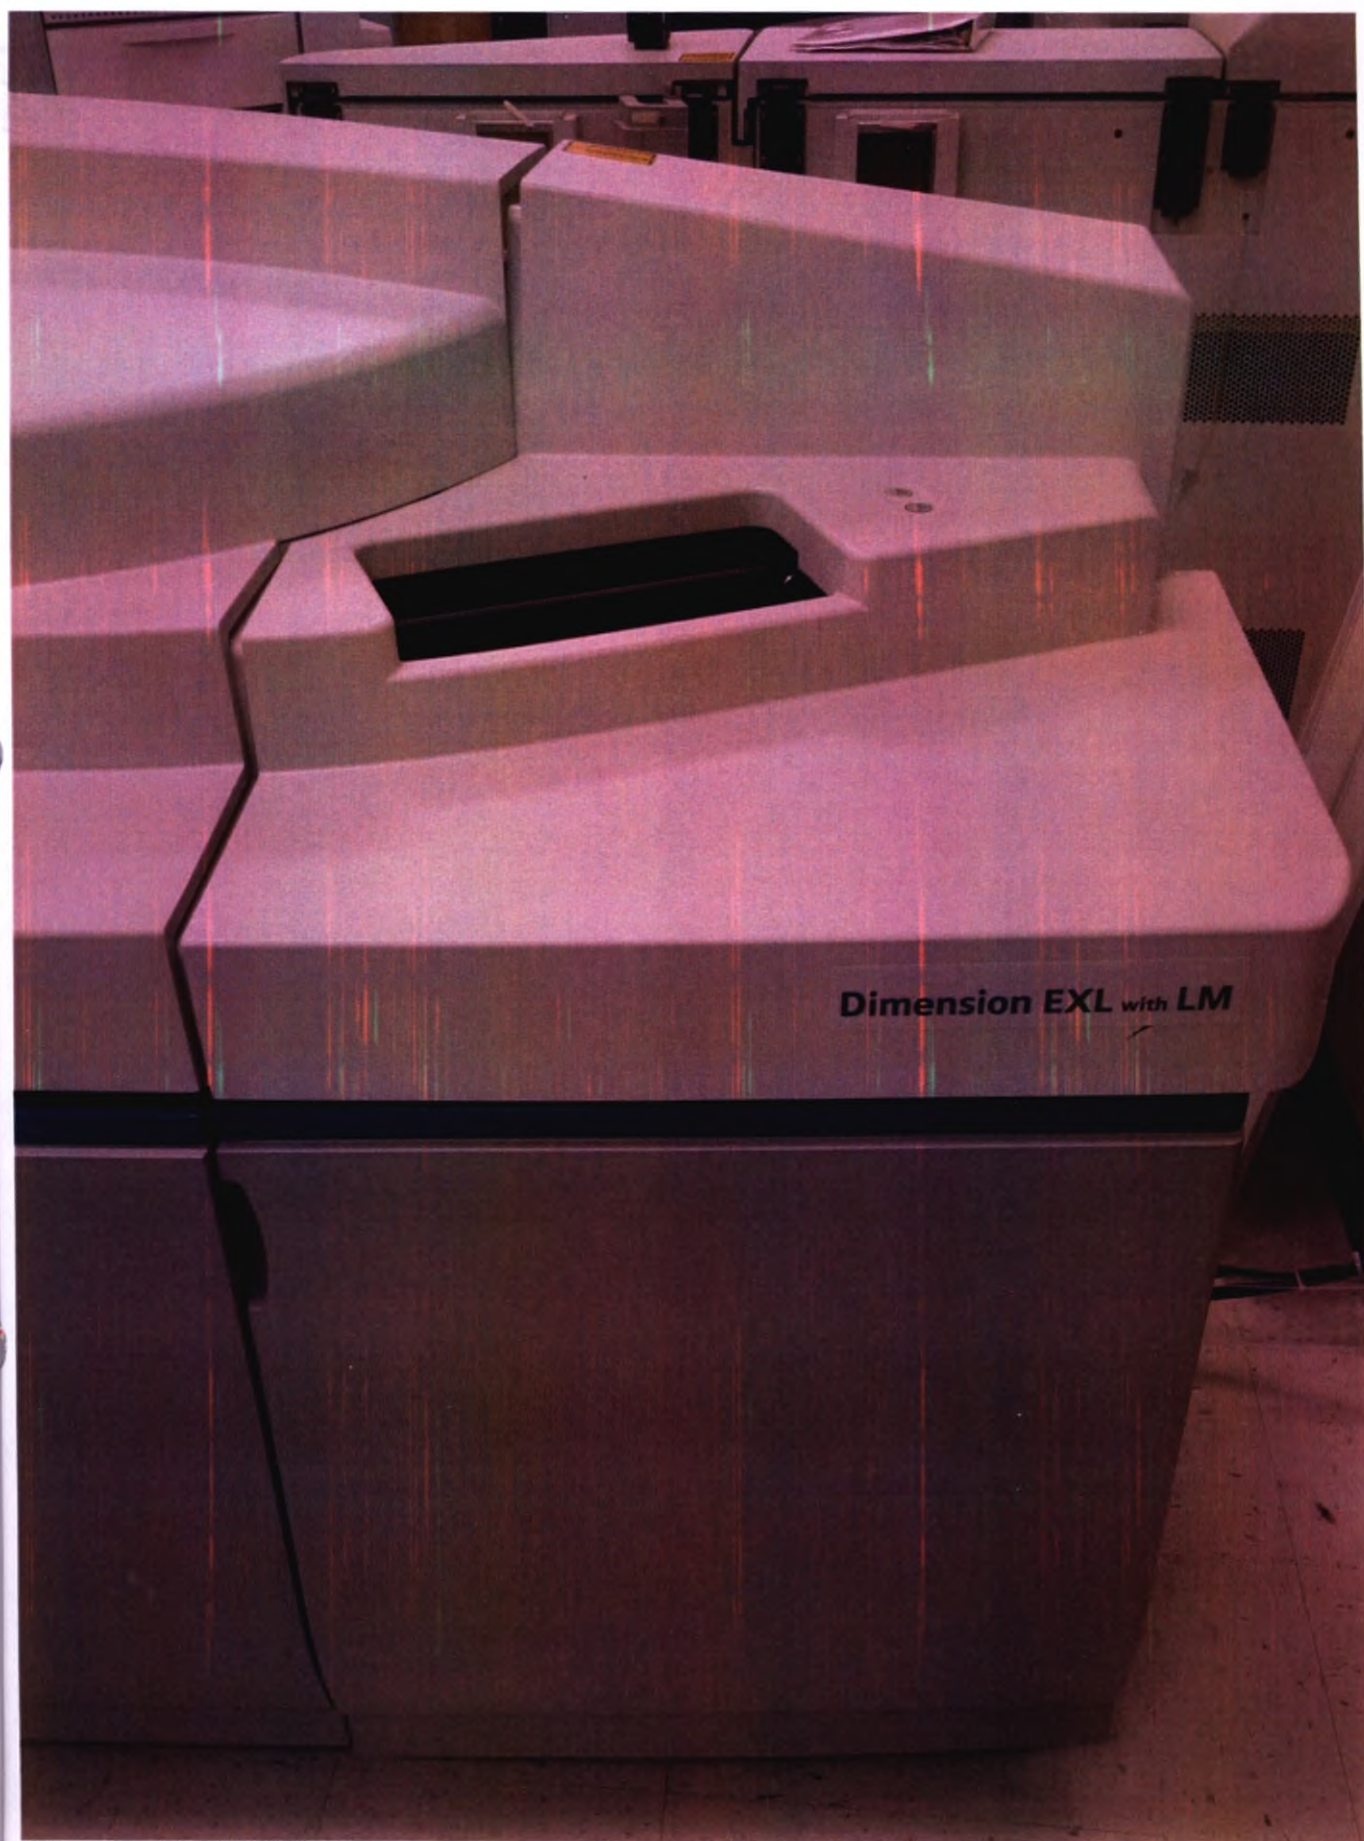

4. RMS (модуль управления реагентами (Reagent Management System)). Общий вид.

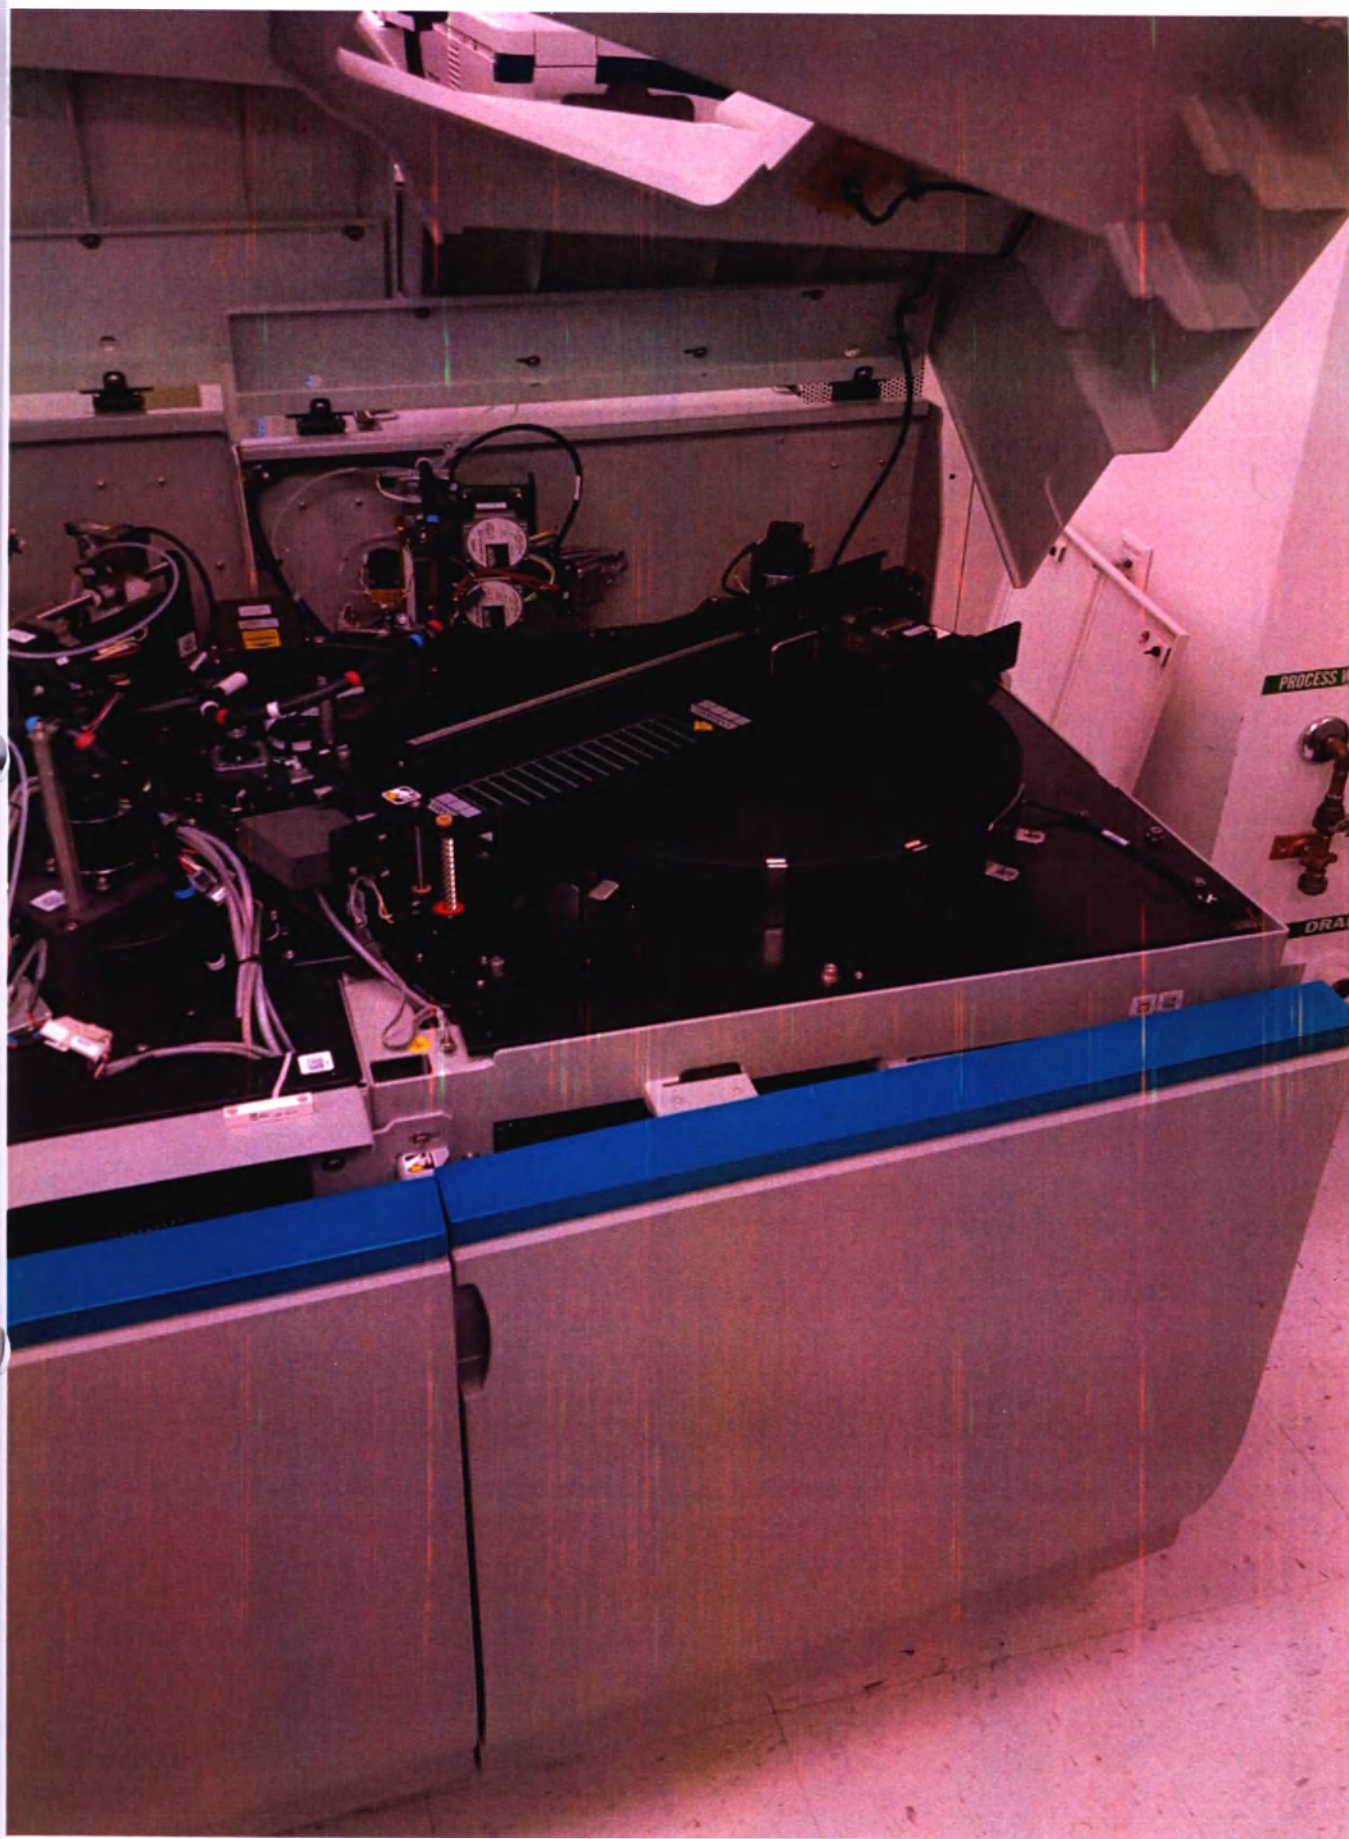


4.1. RMS (модуль управления реагентами (Reagent Management System)). Вид изнутри.

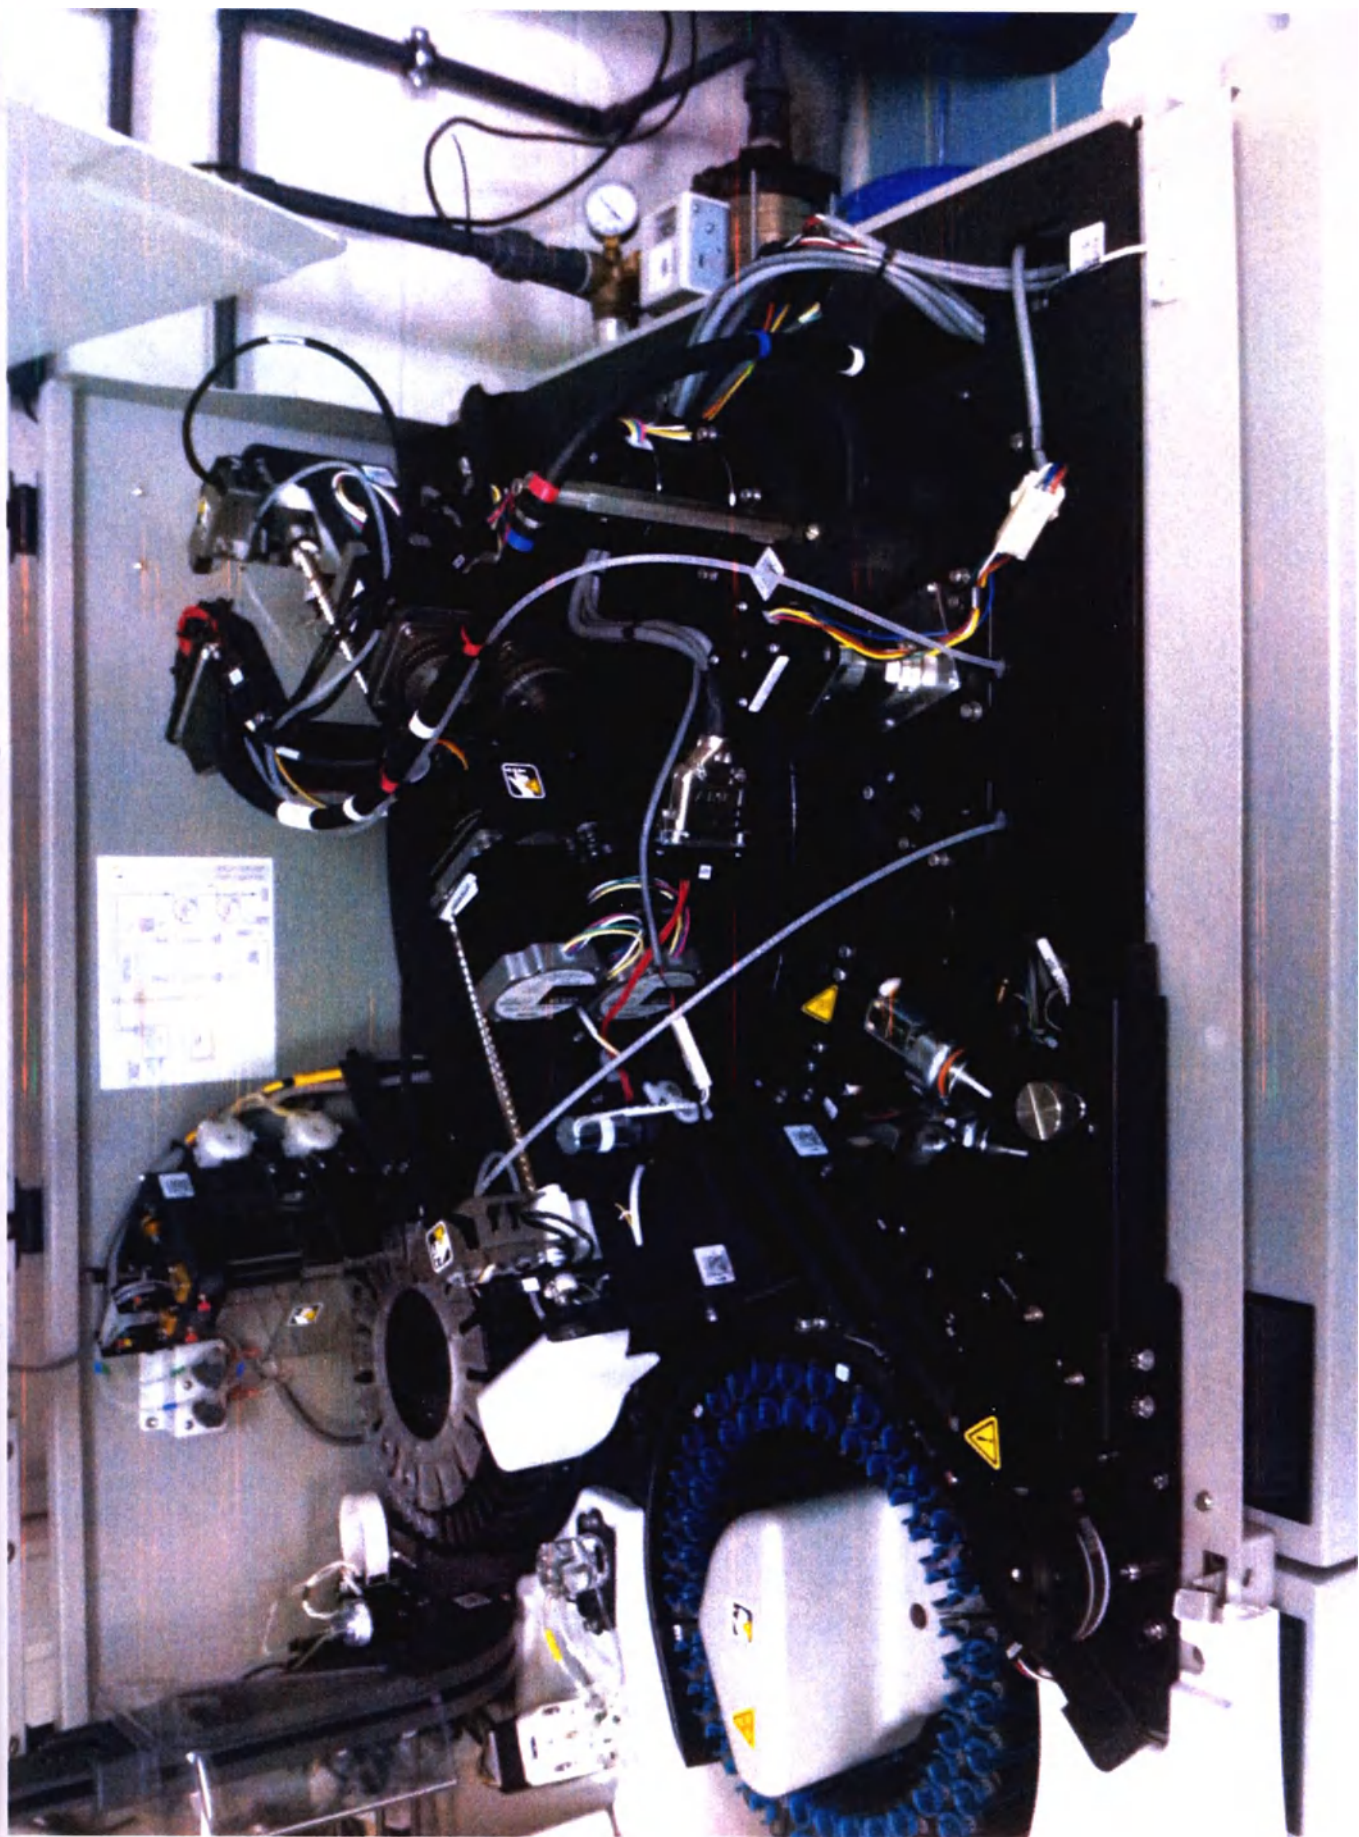

5. Модуль дозаторов реагентов.




6. Область тепловой камеры.

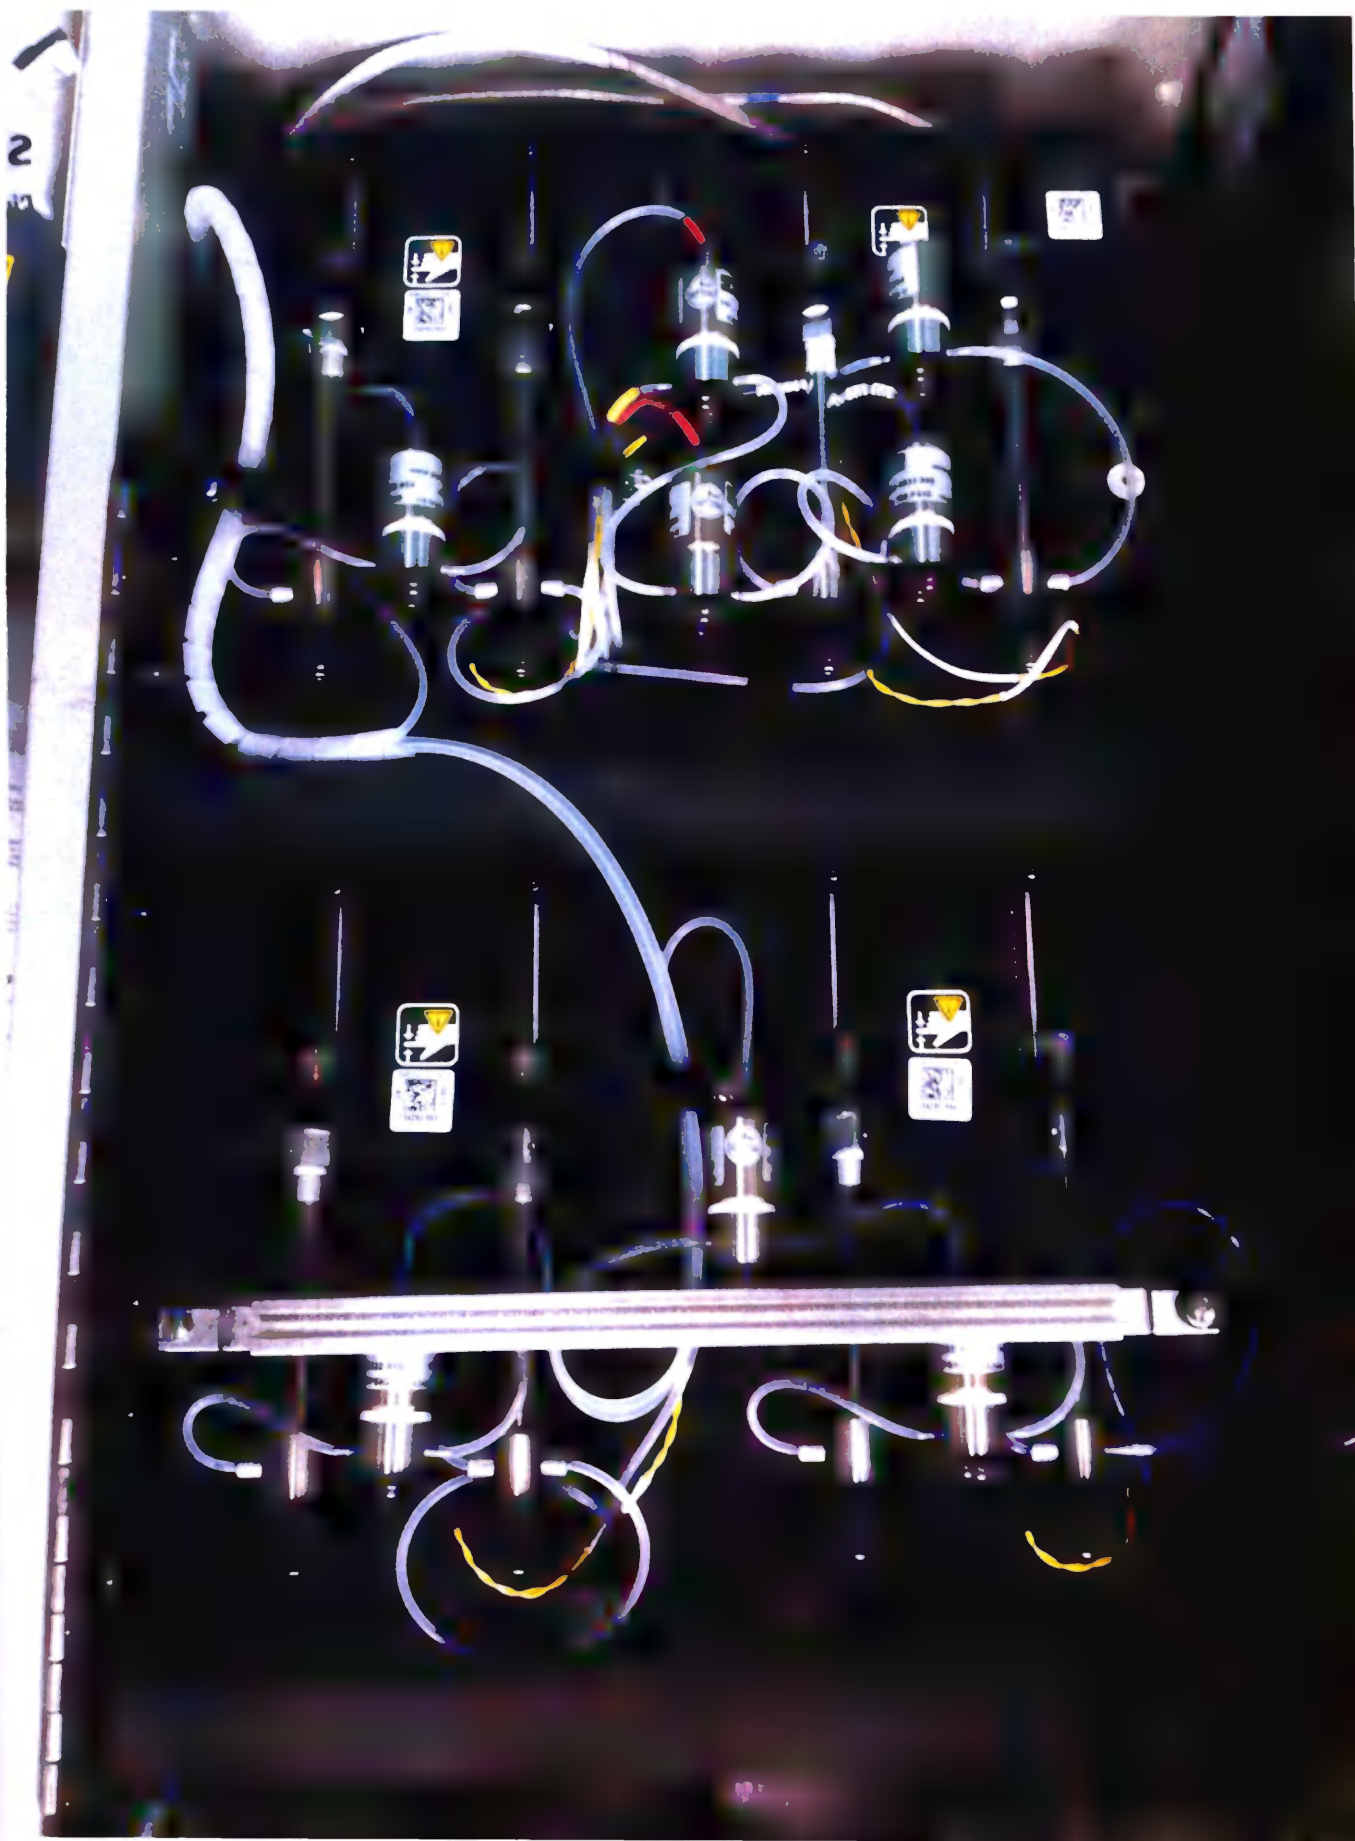

7. Панель насоса.



8. Контейнер для отработанных кювет.

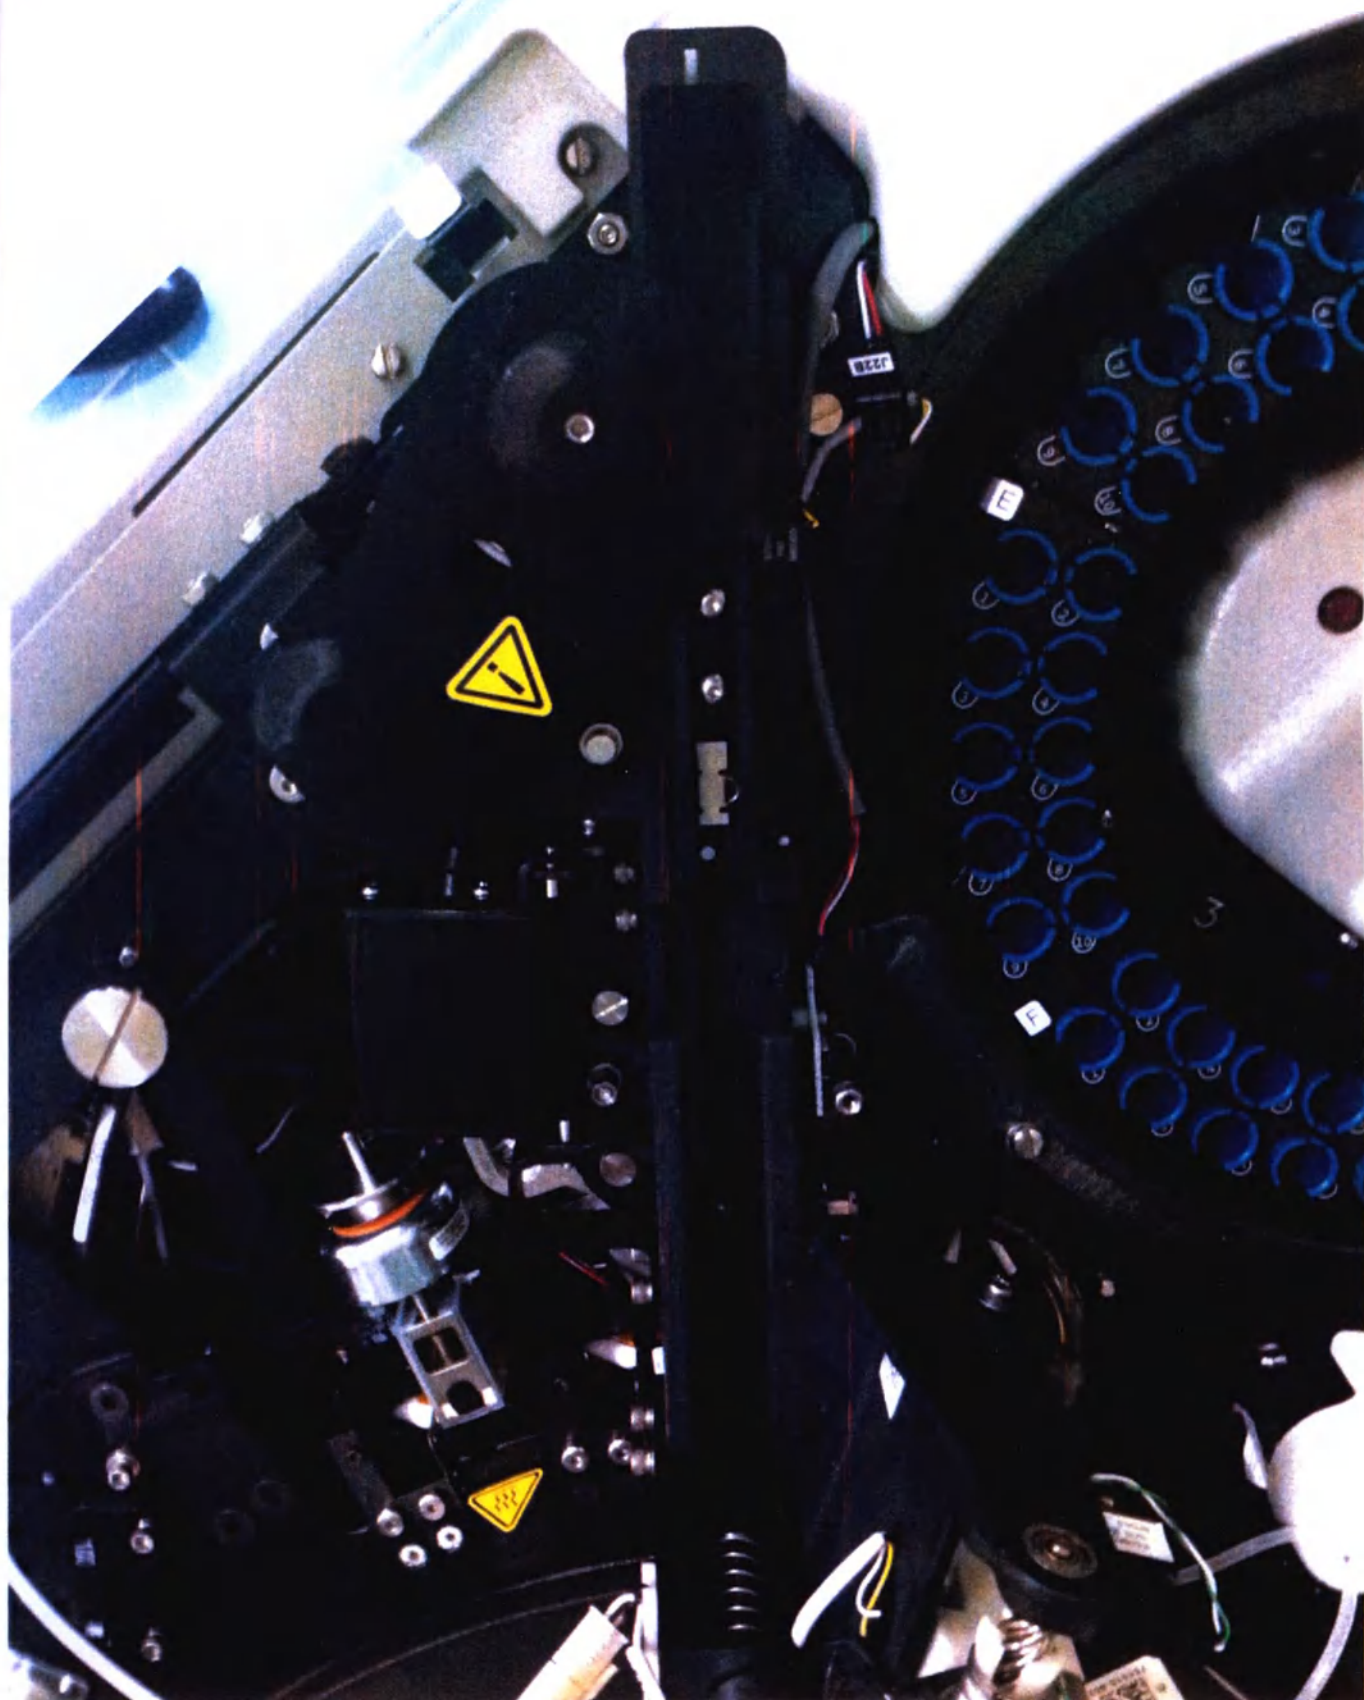

9. Загрузчик реагентных картриджей Flex.




10. Сканер штрих-кодов внутренний.




11. Сканер штрих-кодов внешний.




12. Источник бесперебойного питания. Общий вид.

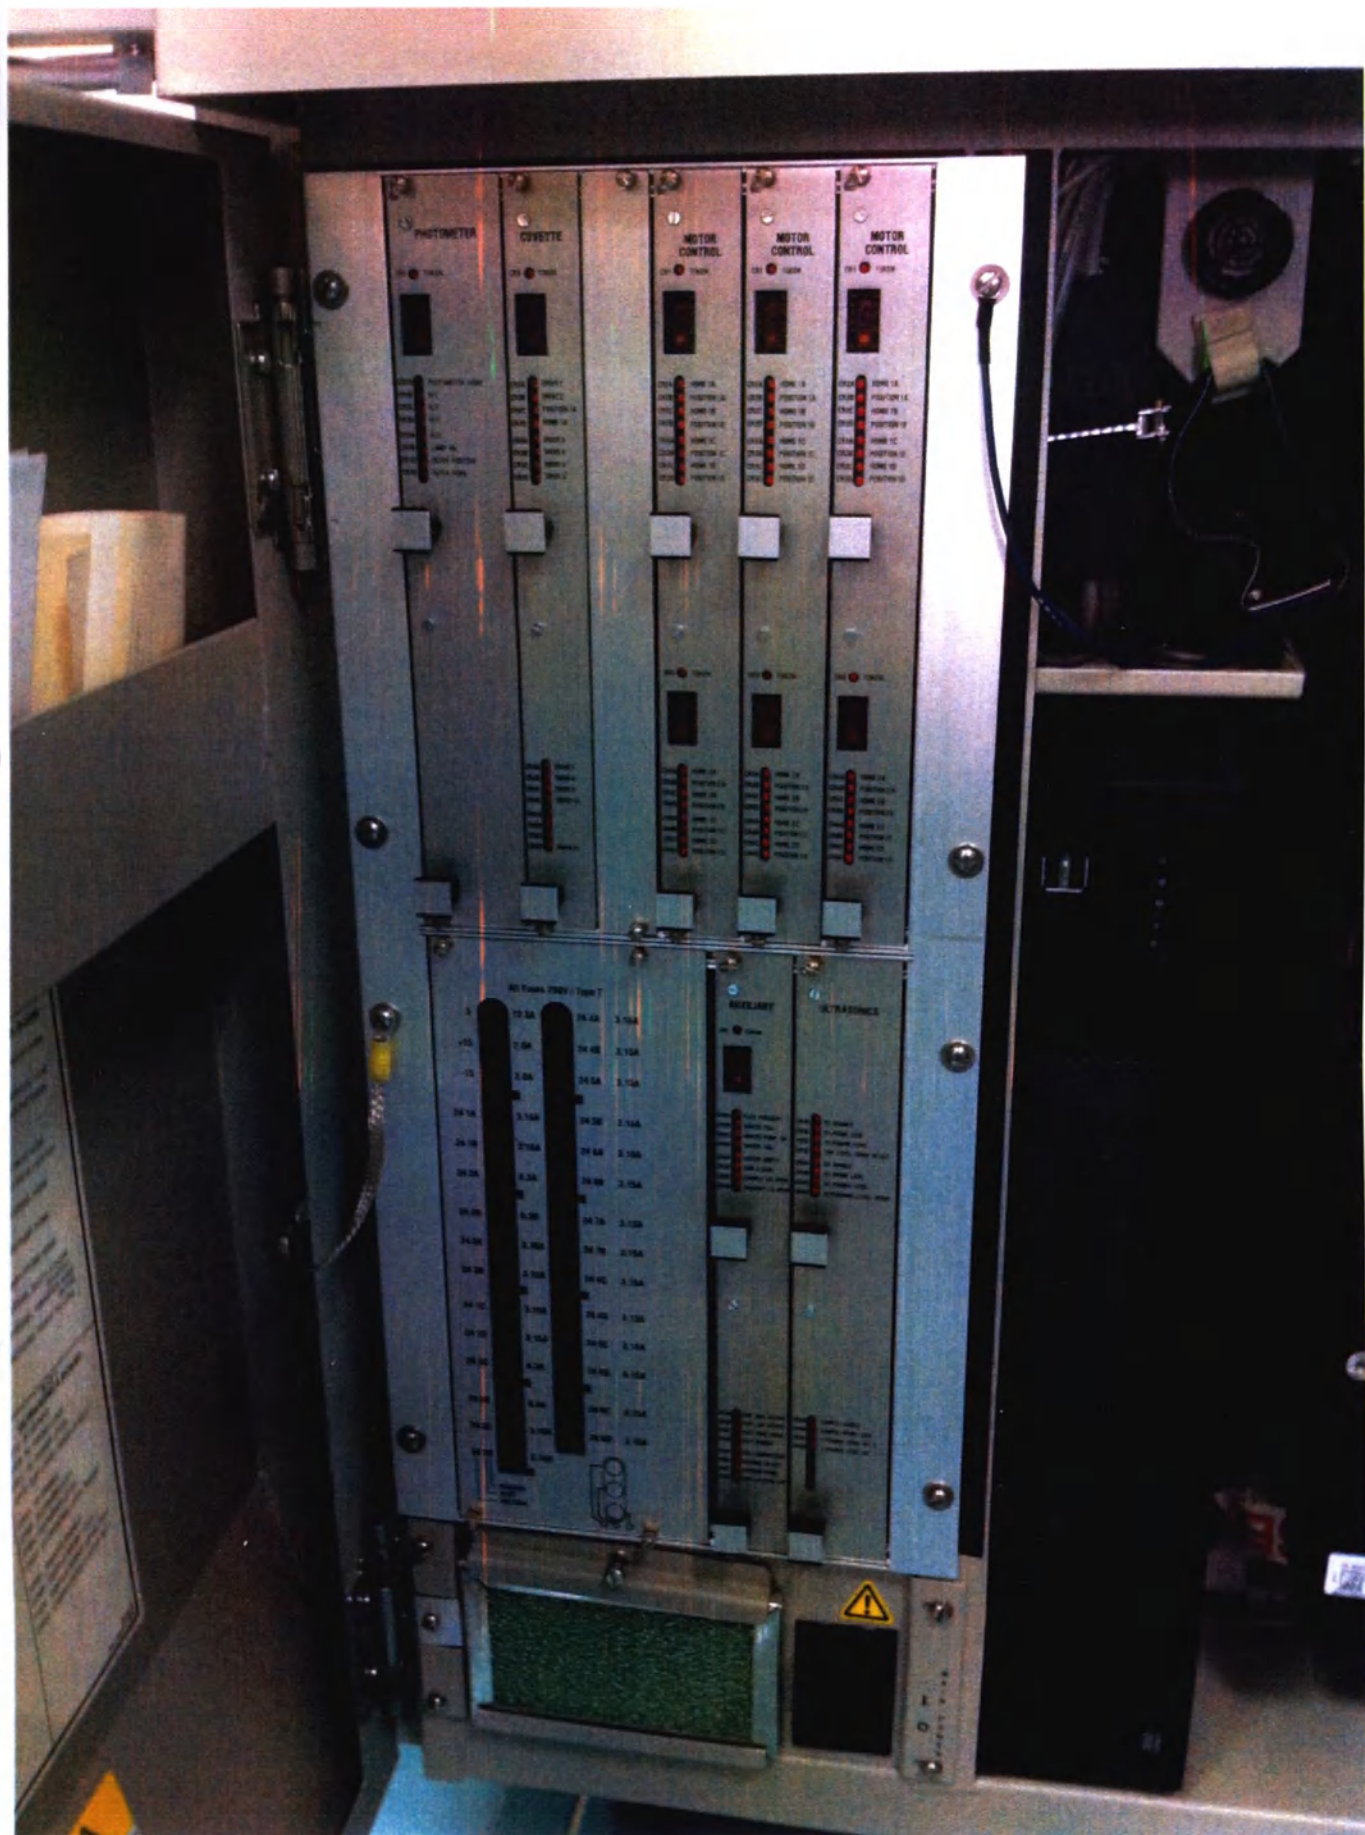

13. Блок платы управления.

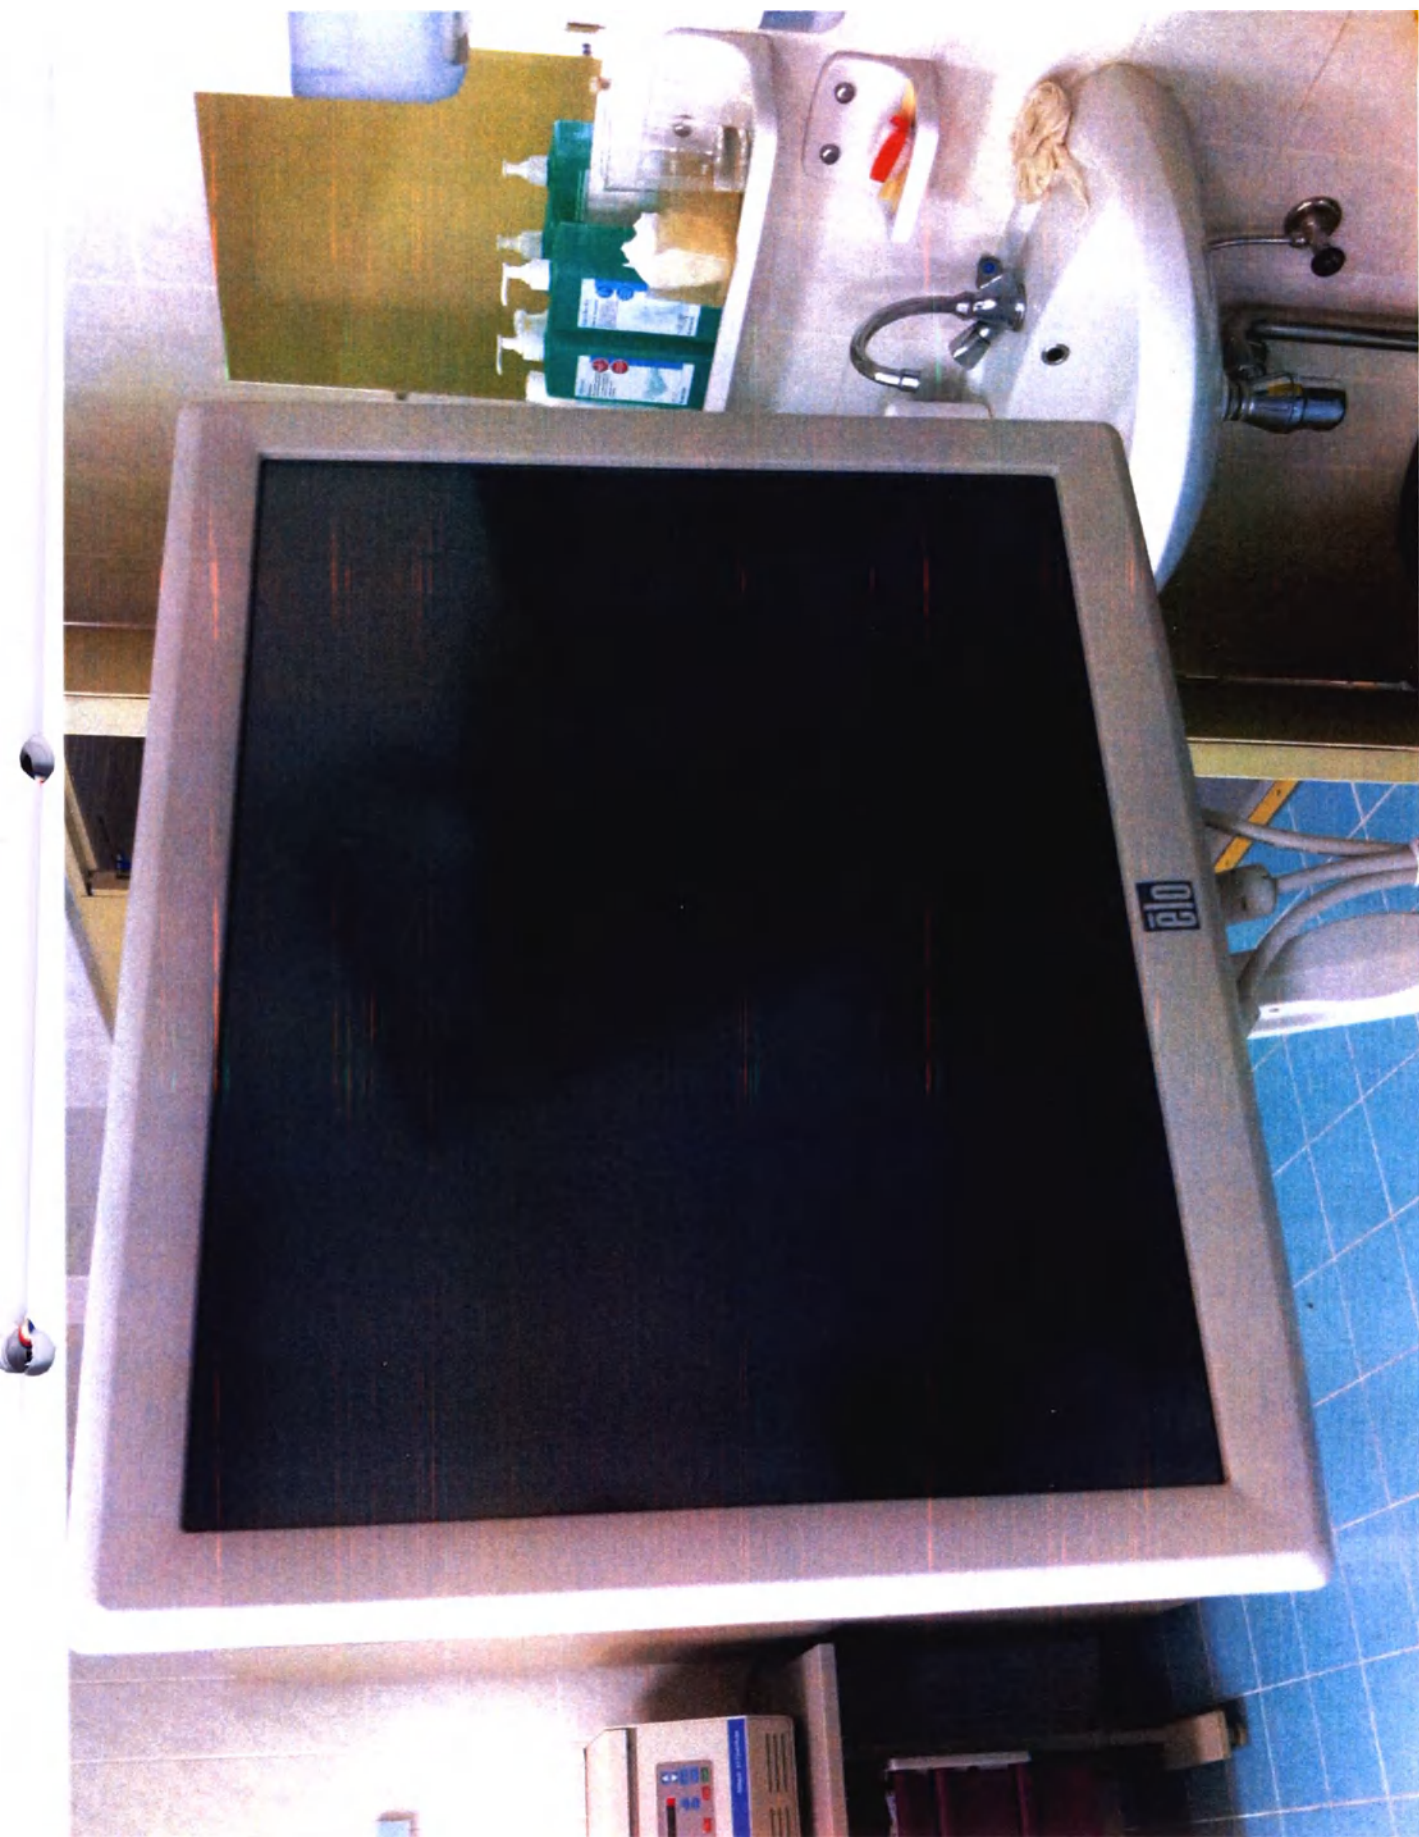

14. Сенсорный экран.

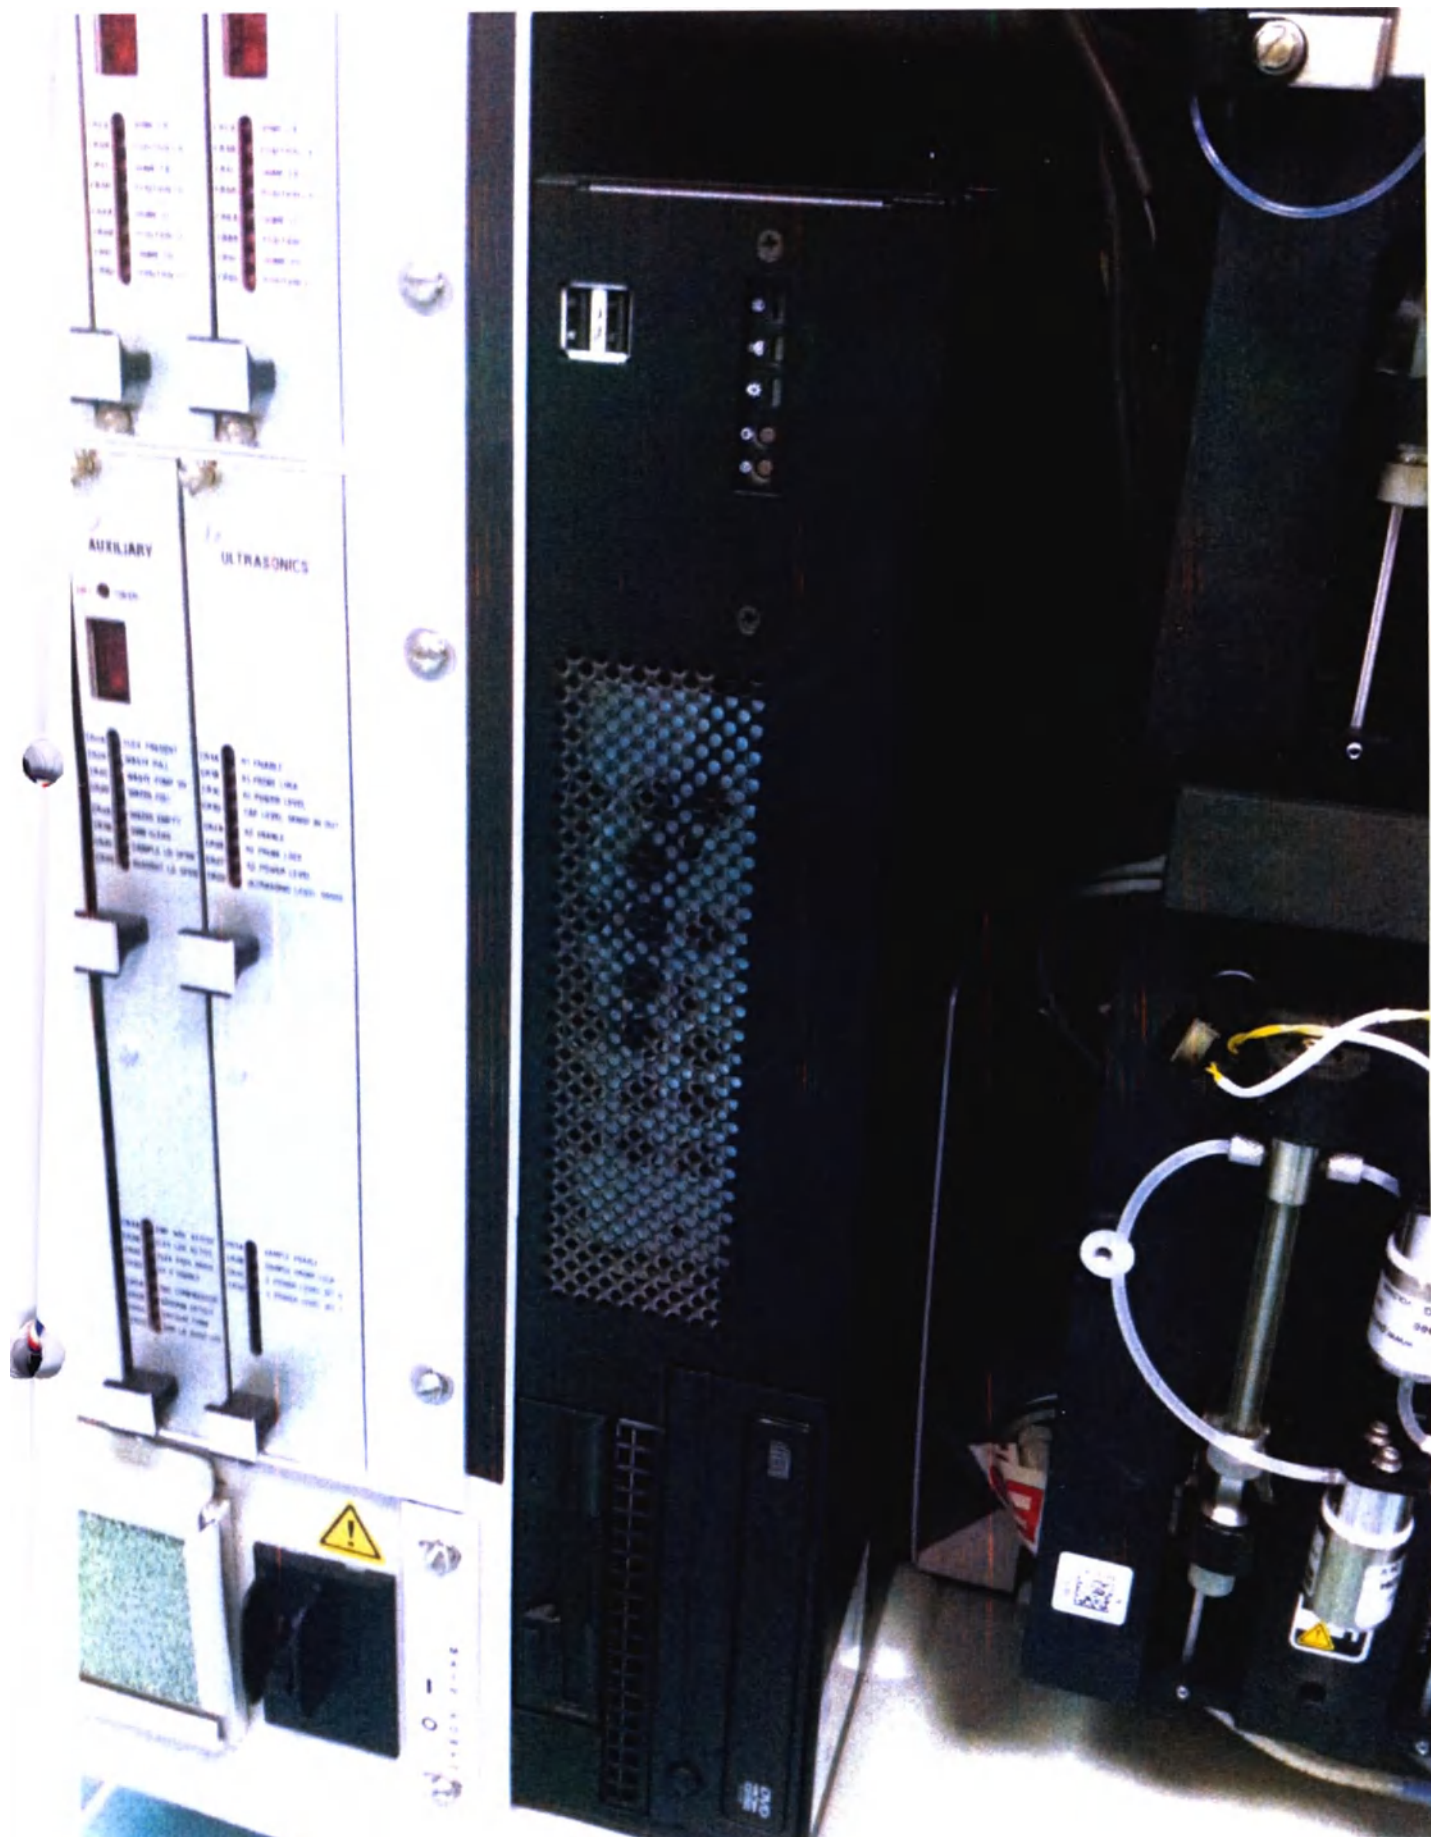

15. Компьютер. Общий вид.

Всего прошито и пронумеровано
49 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

